

Микроскоп лазерный сканирующий конфокальный ЛСКМ

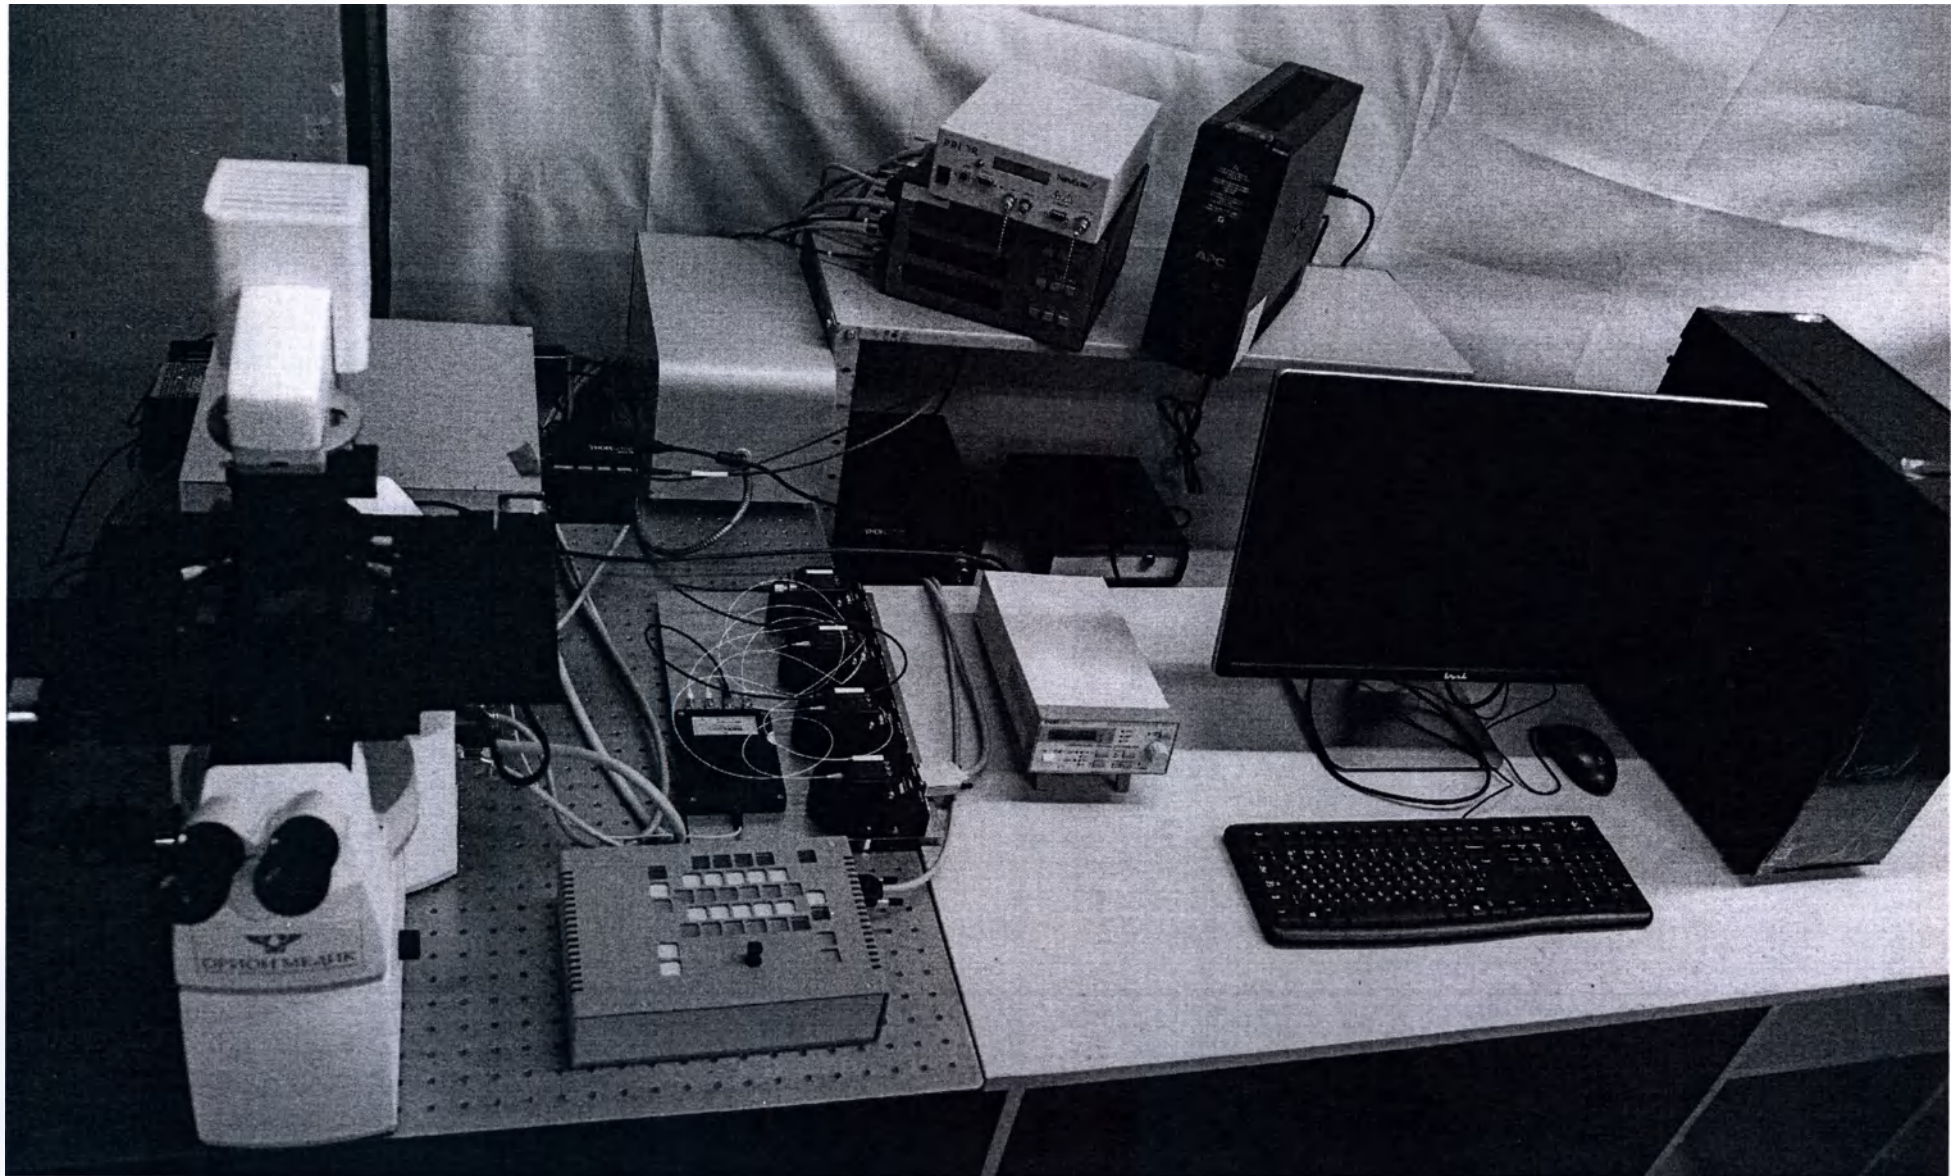
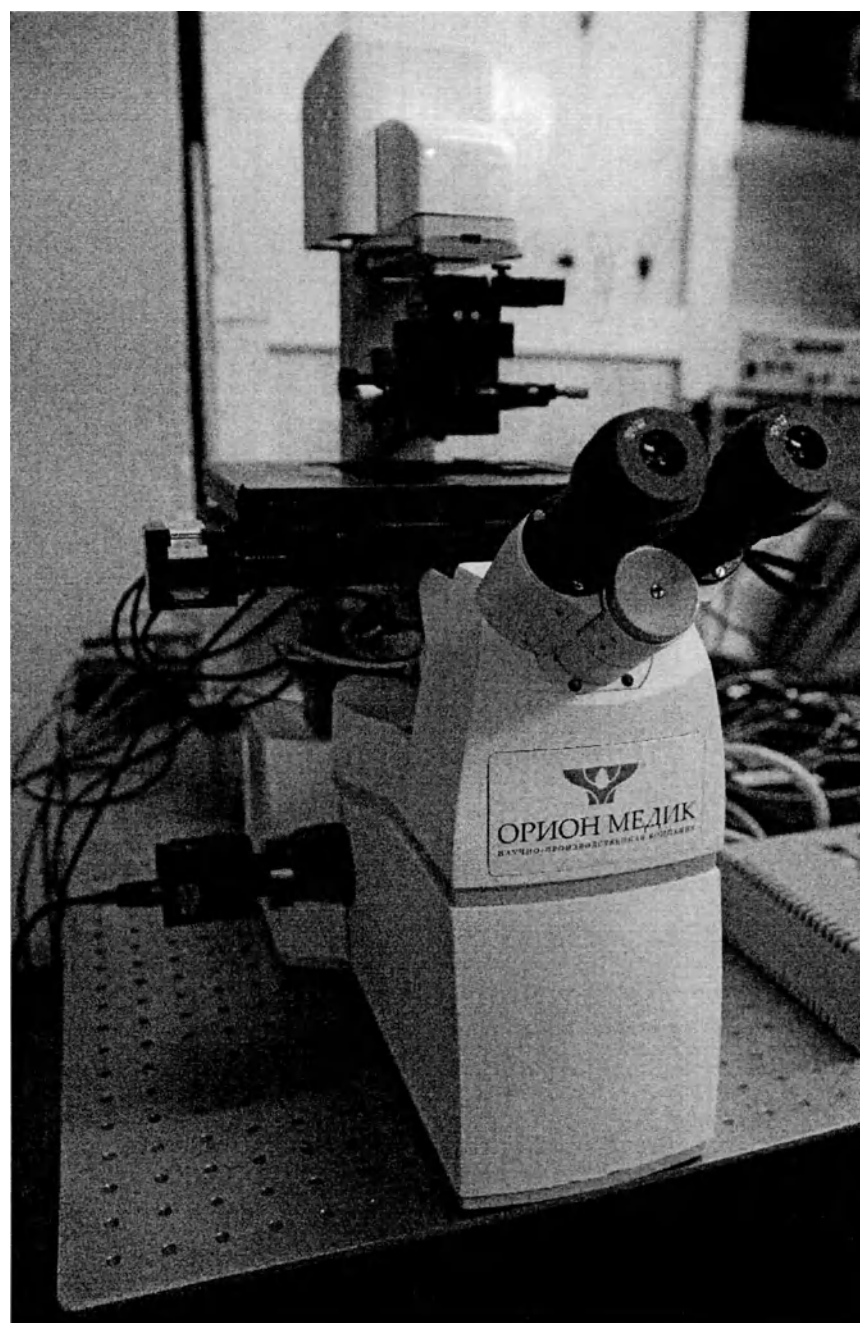
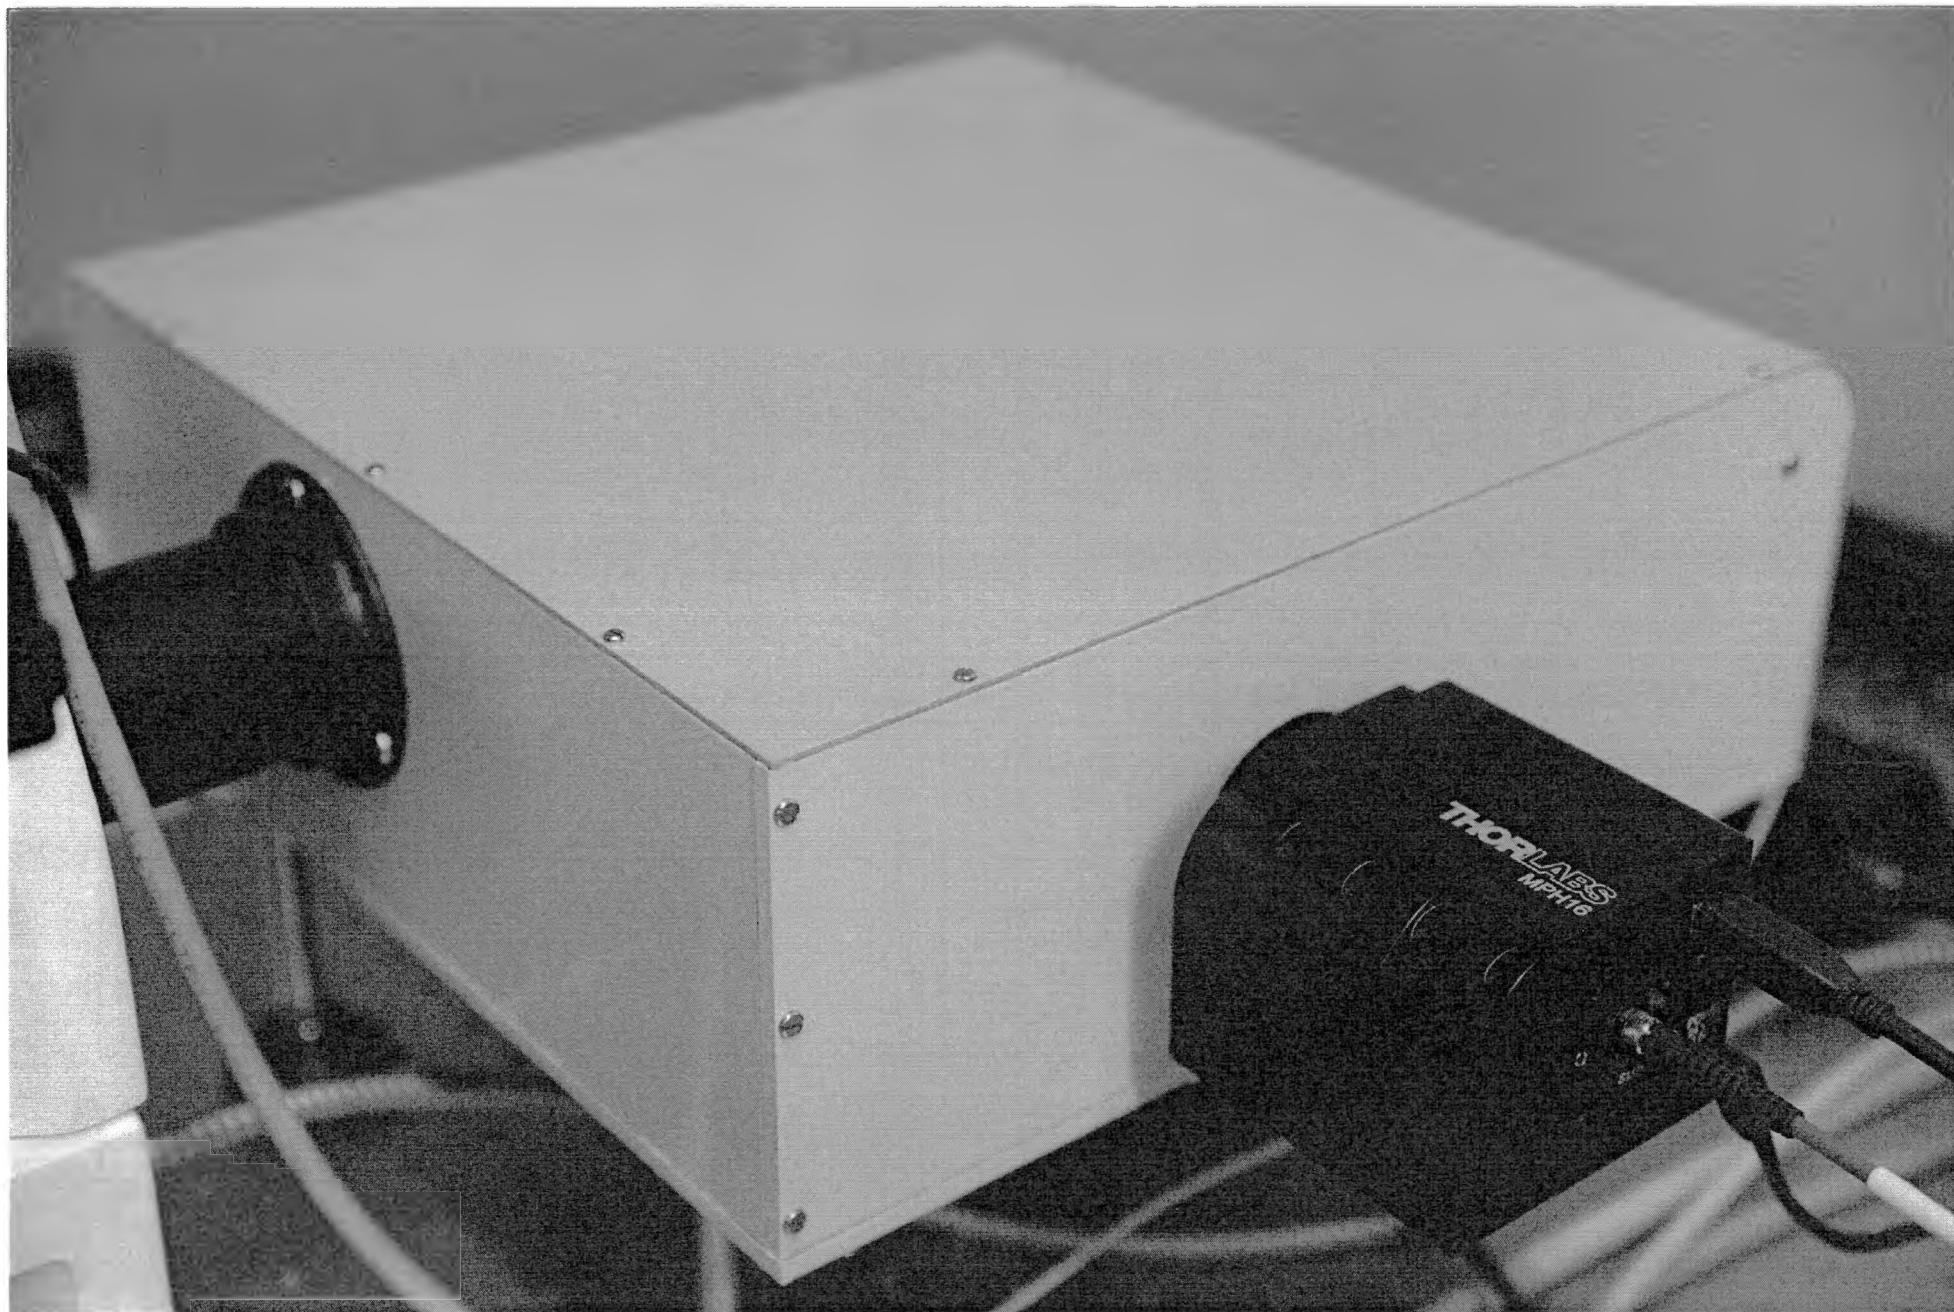
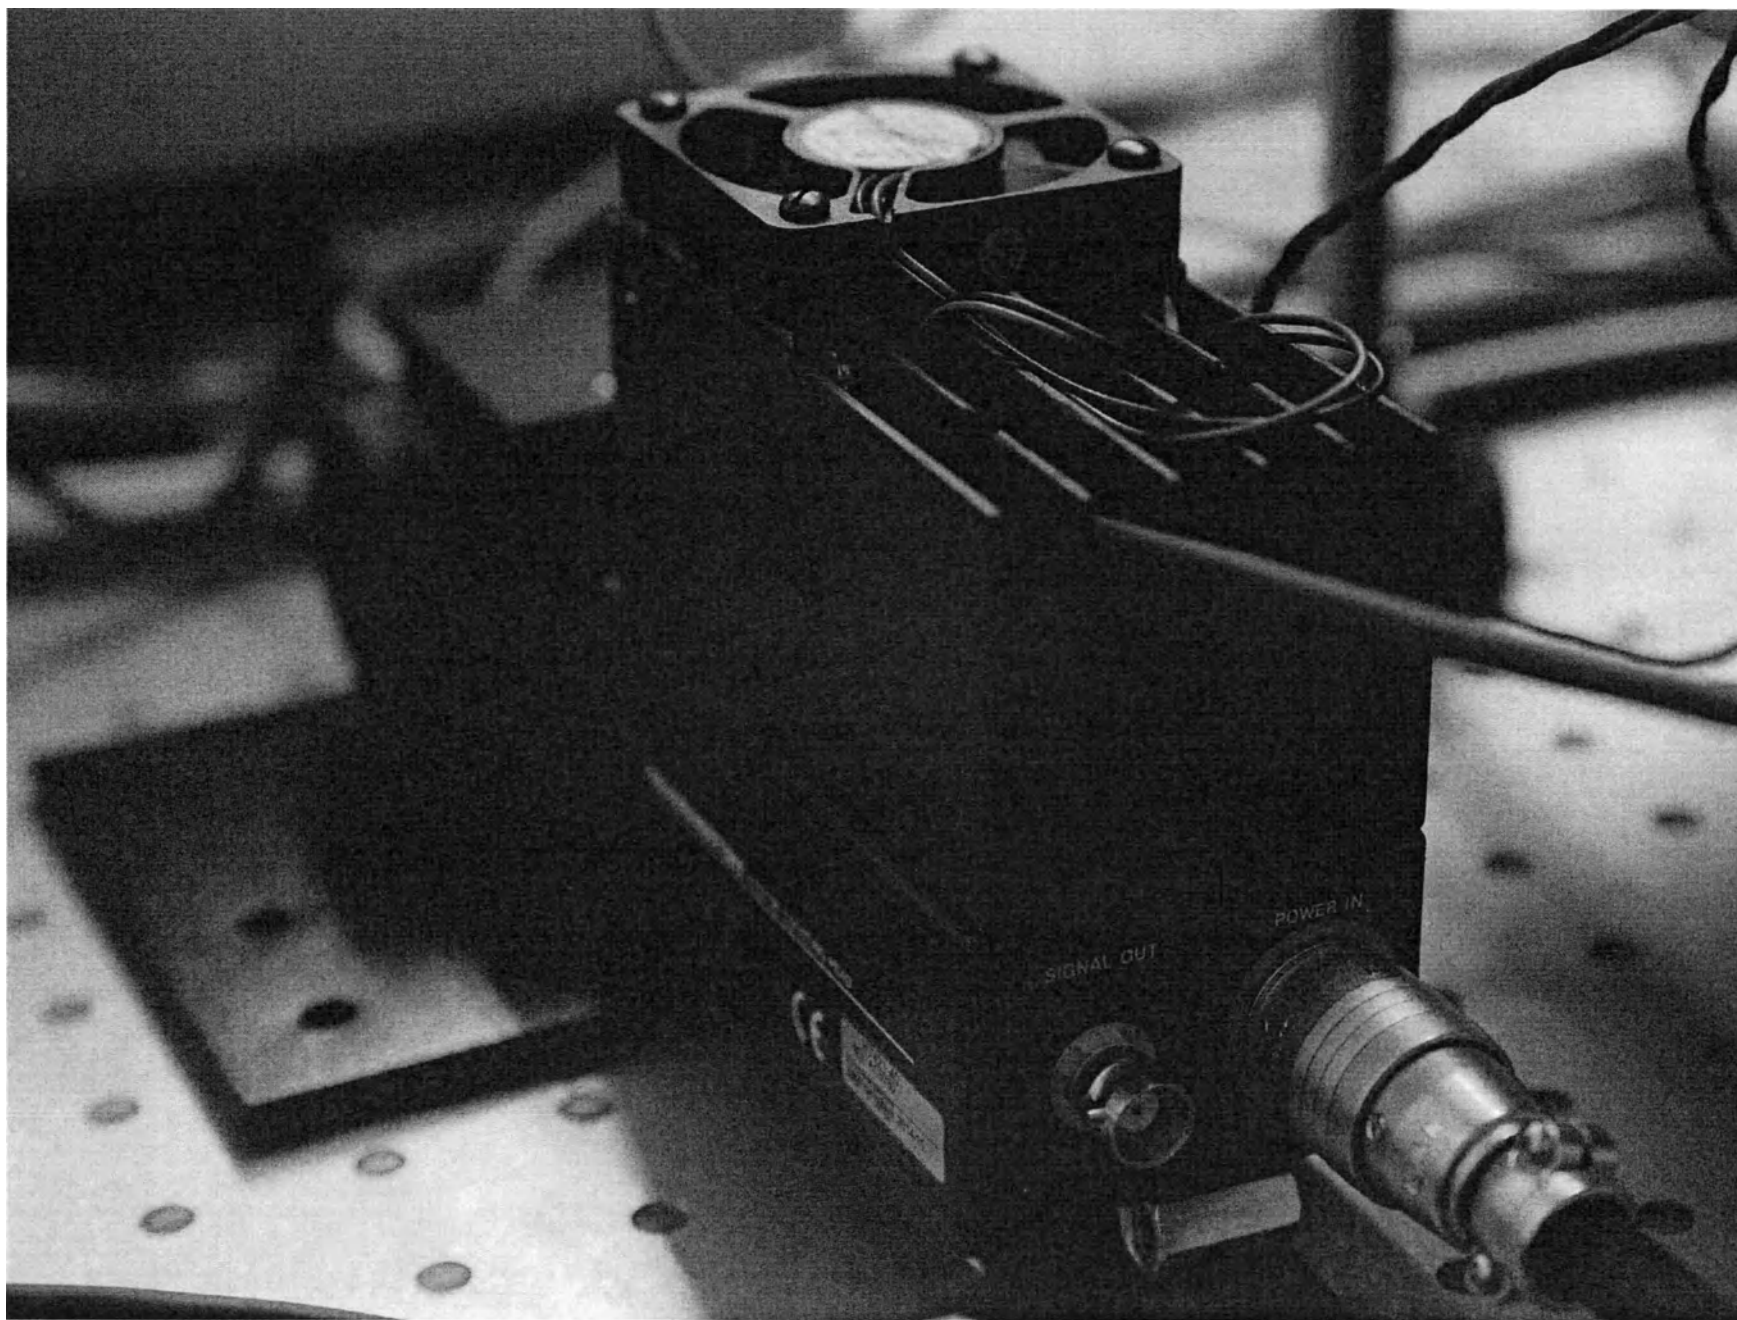


Рис.1. Общий вид микроскопа лазерного сканирующего конфокального ЛСКМ







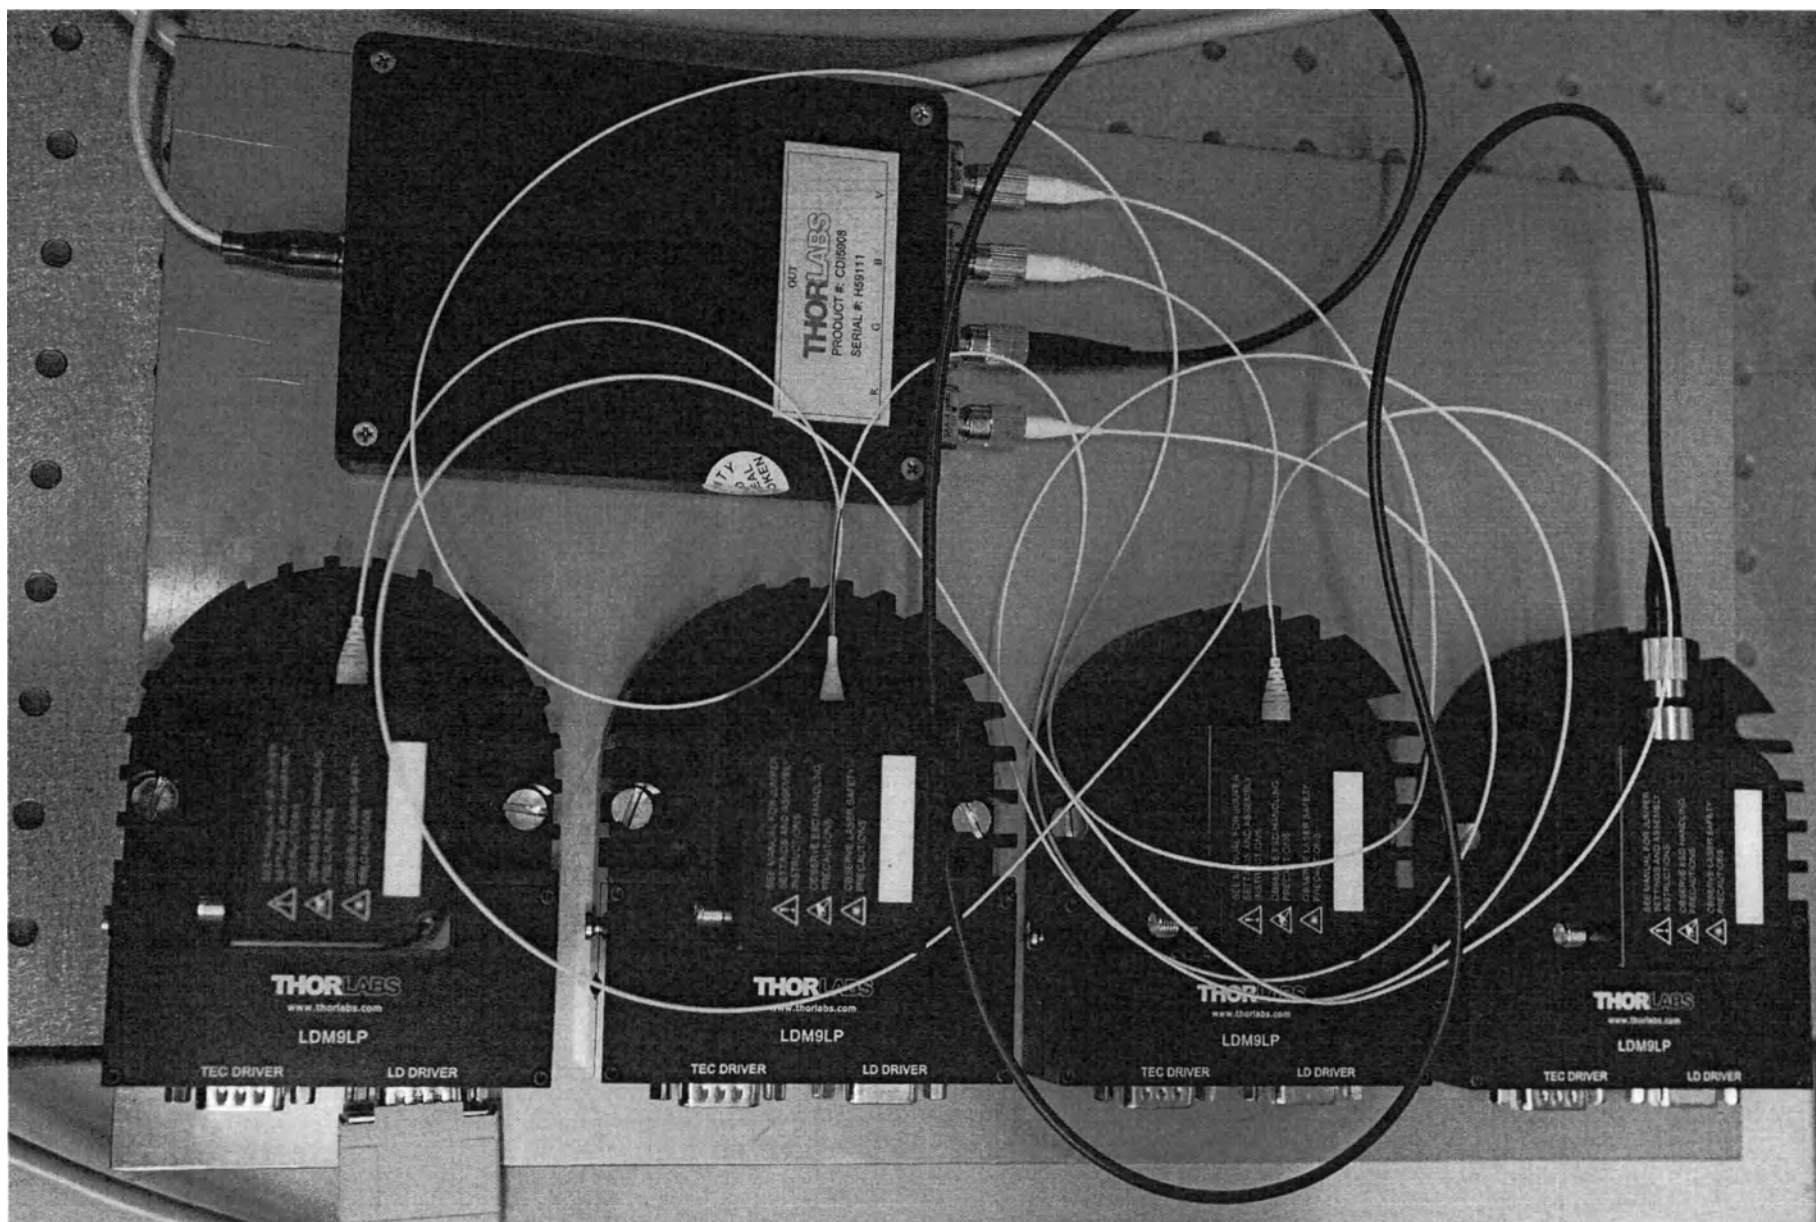


Рис.5. Блок излучателей

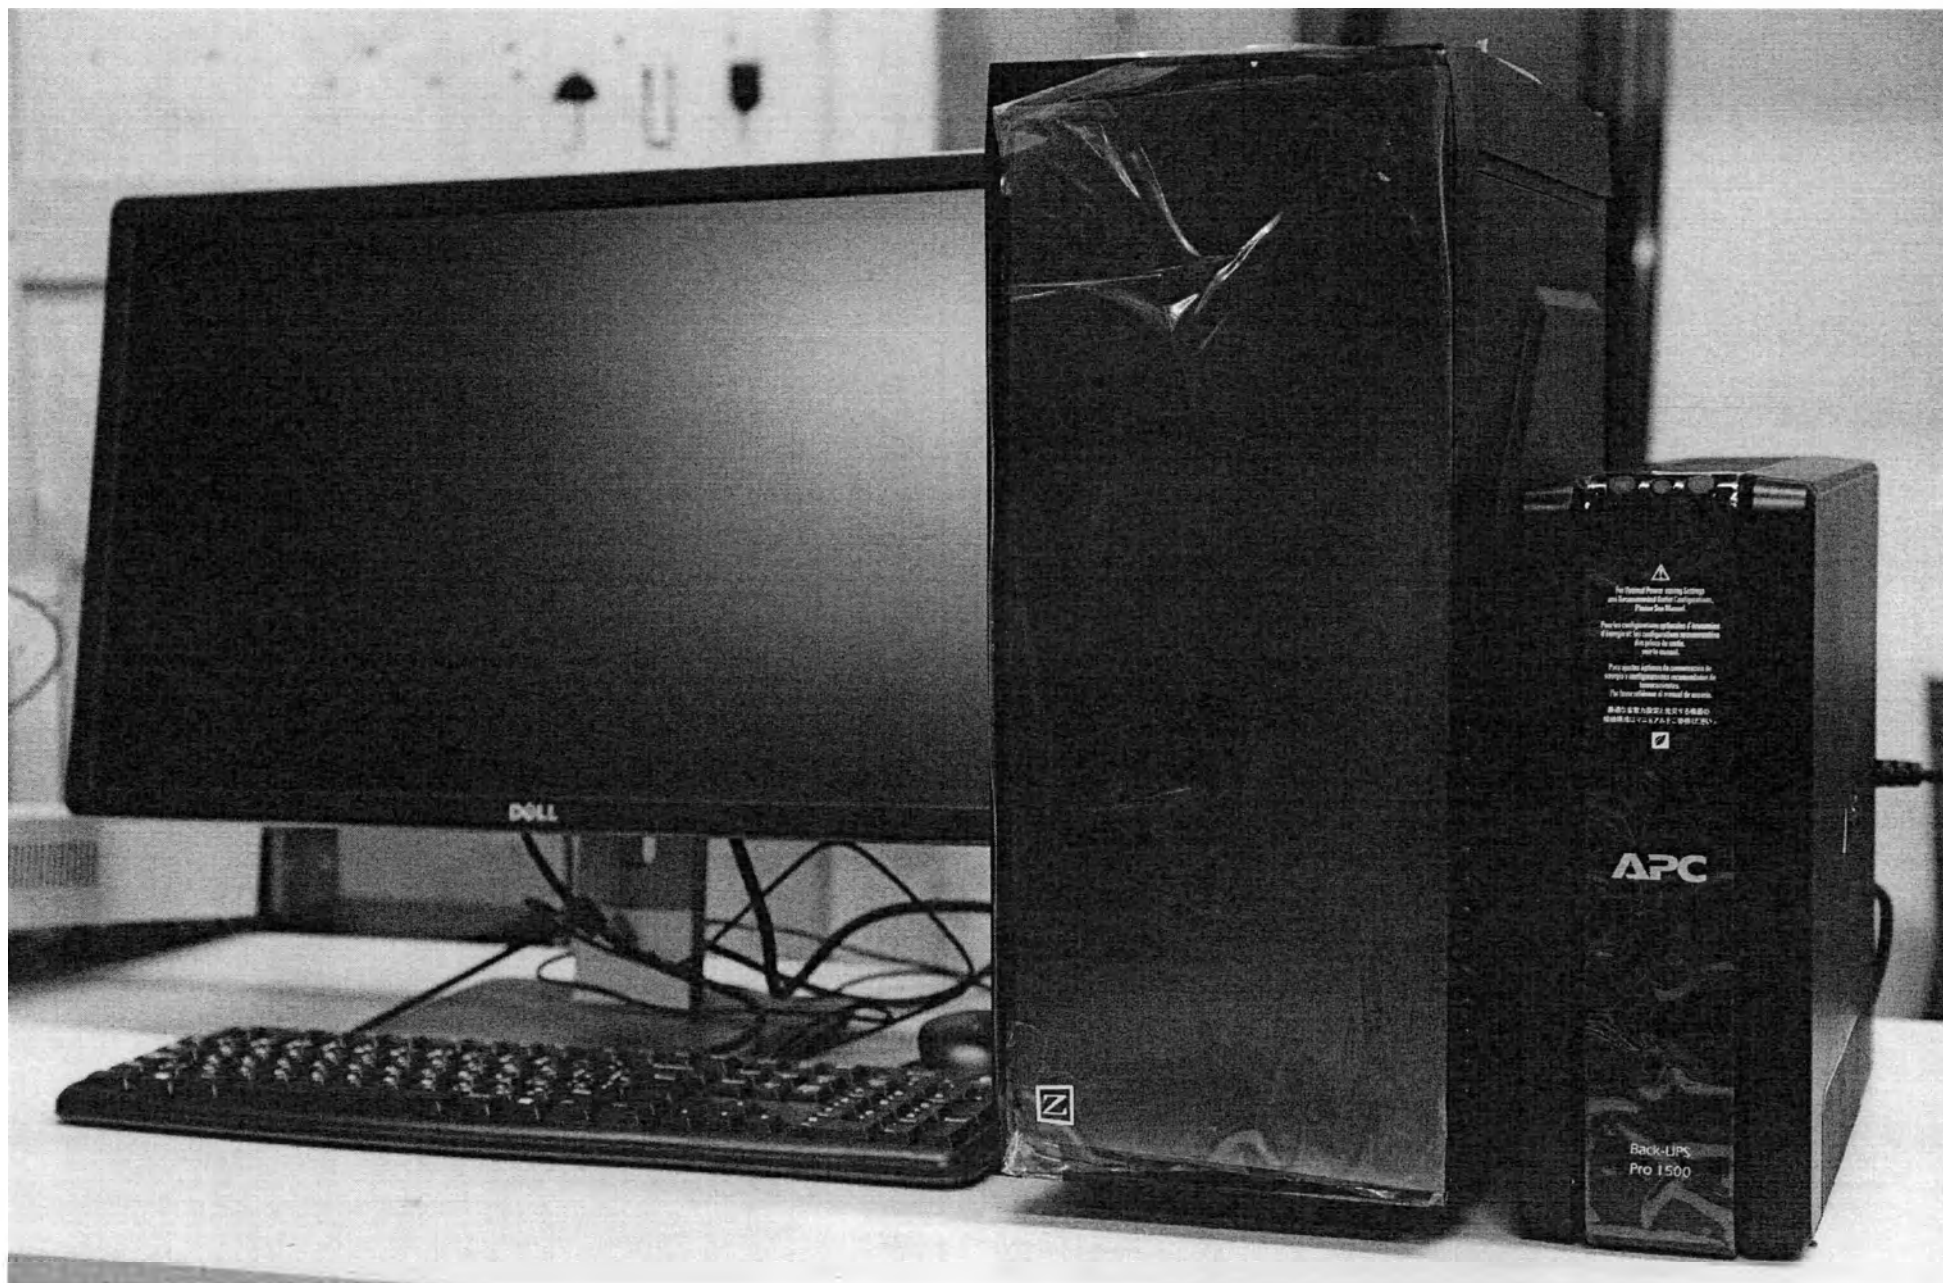


Рис.6. Система управления



Рис.7. Стол приборный

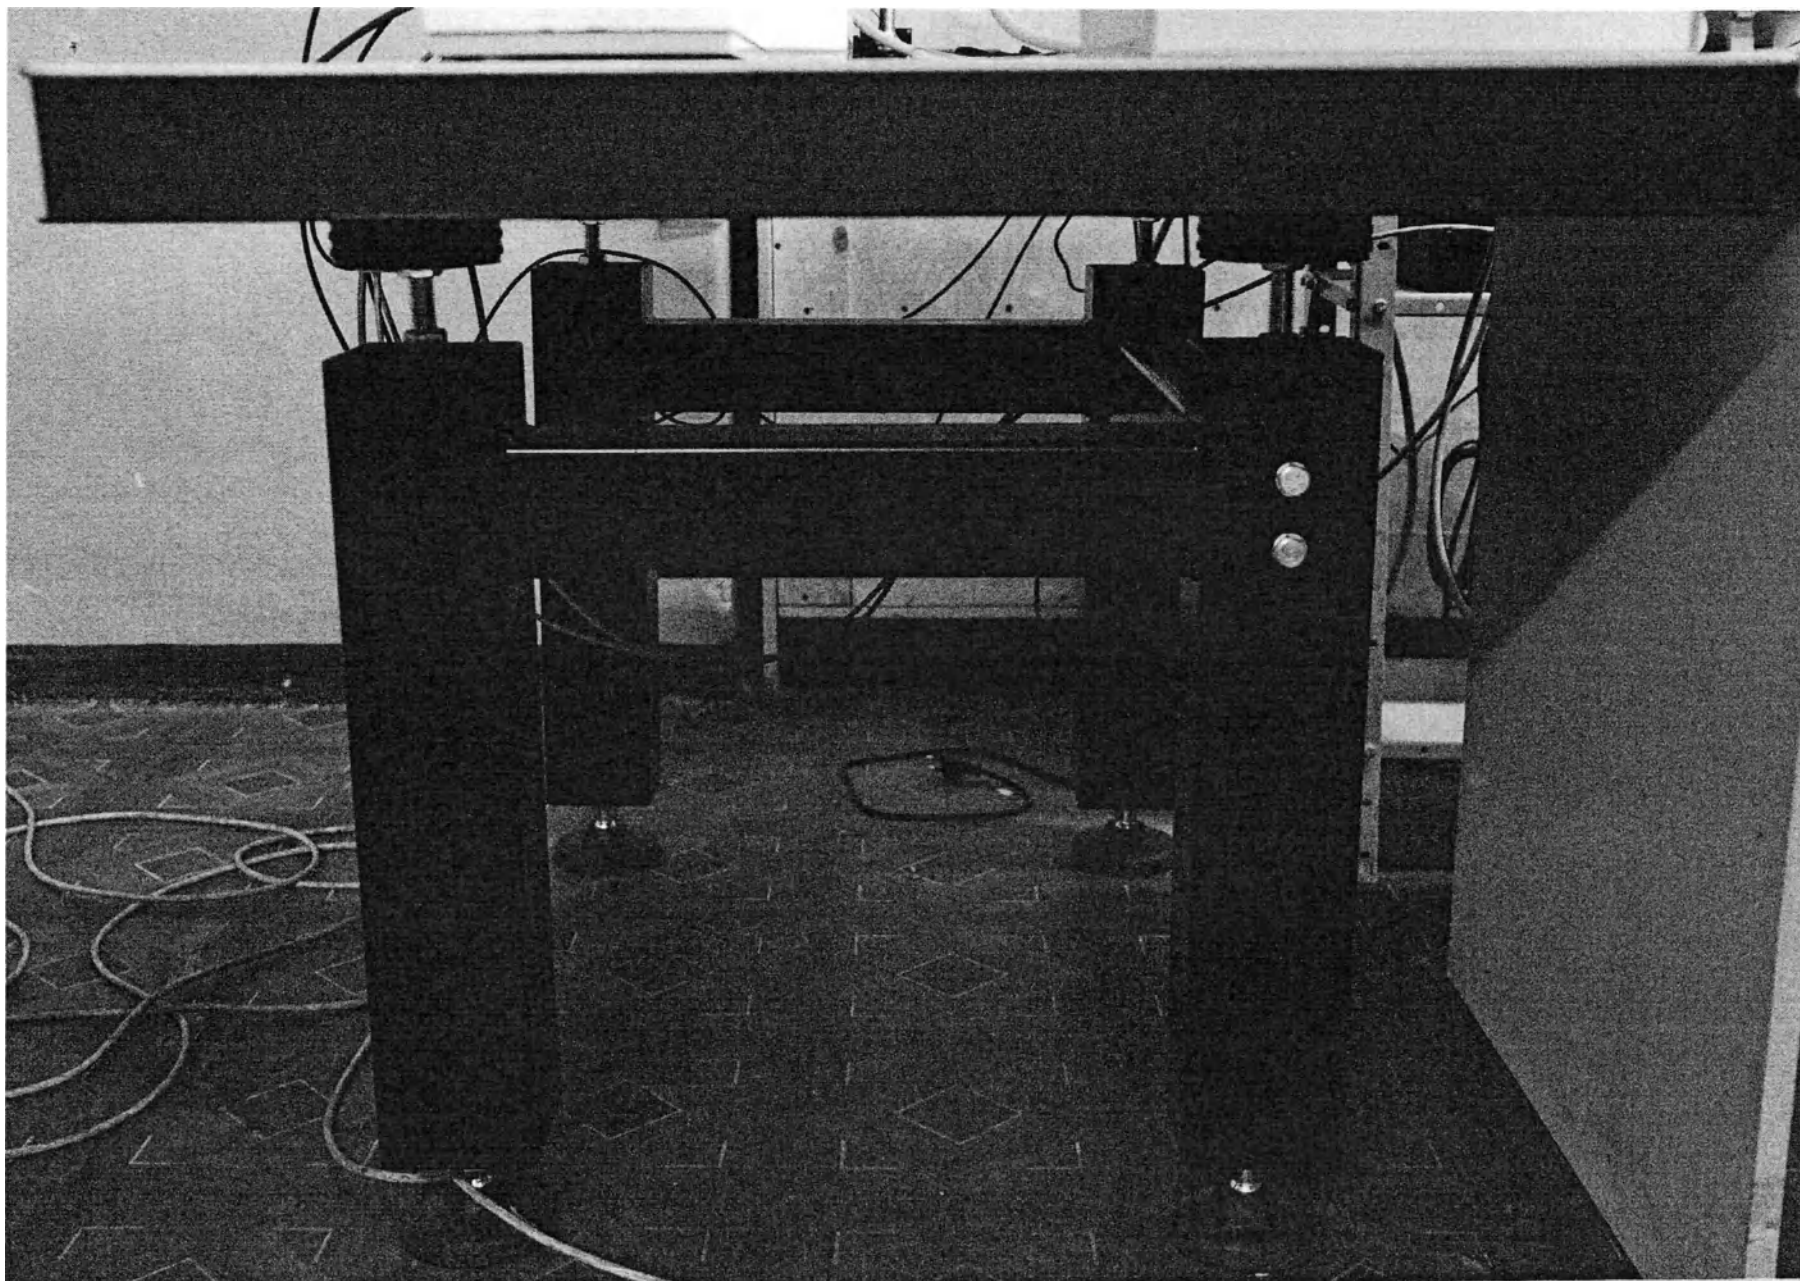


Рис.8. Стол антивибрационный



Рис.9. Окуляры 10х



Рис.10. Объективы планапохроматы ОЛСК (10Л, 20Л,40Л,63Л)

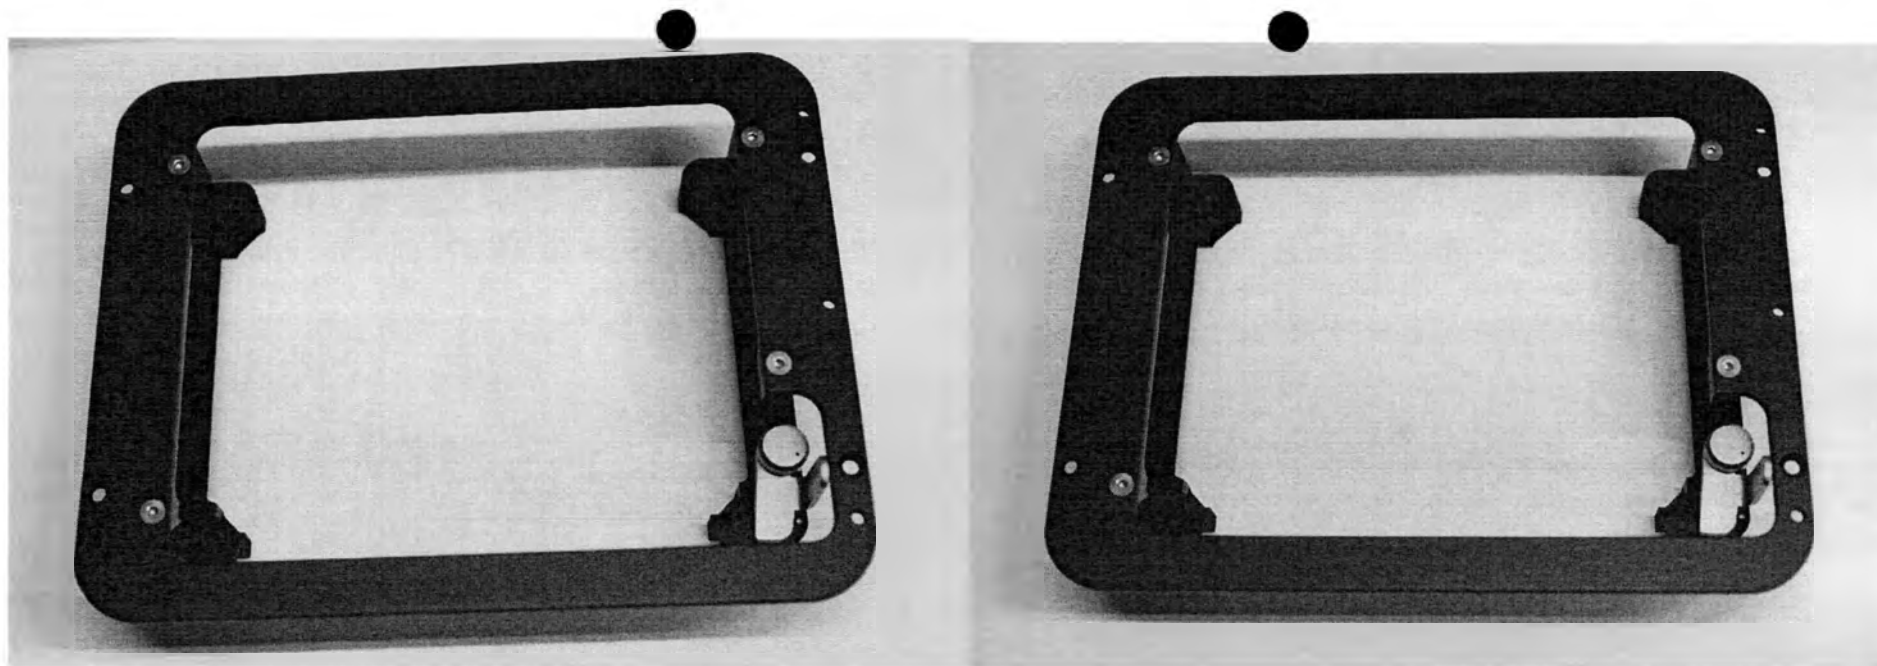


Рис.11. Держатели образцов универсальные

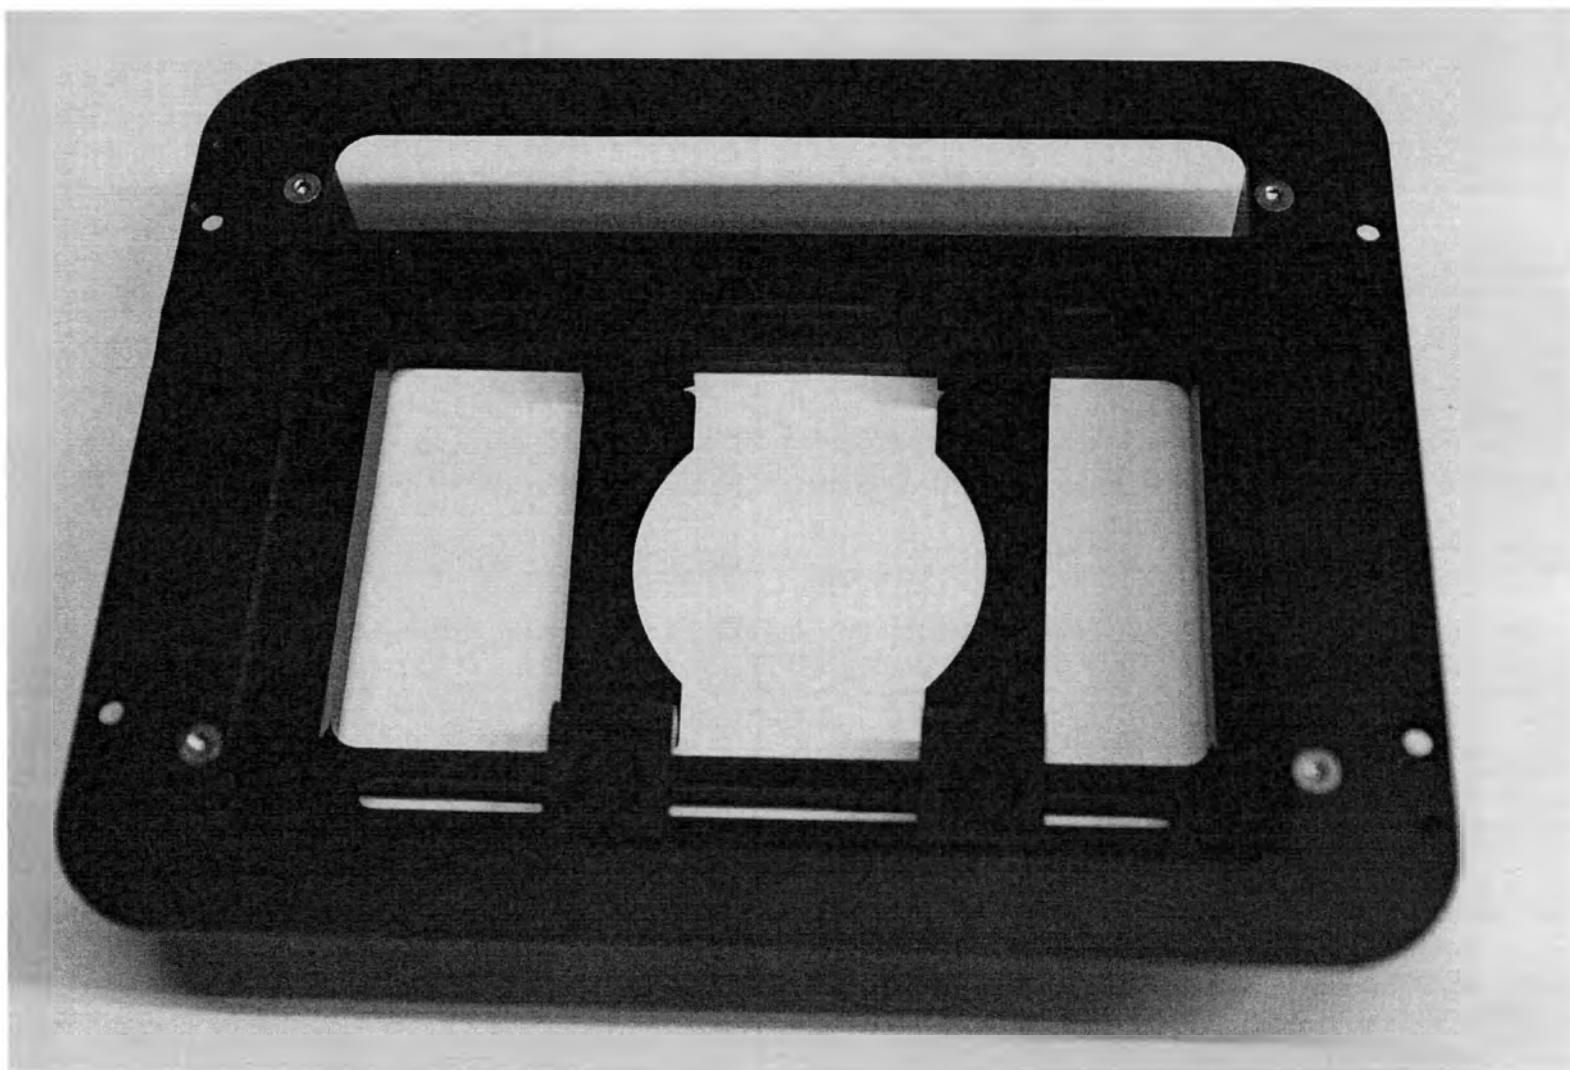


Рис.12. Держатель образцов для четырёх предметных стёкол

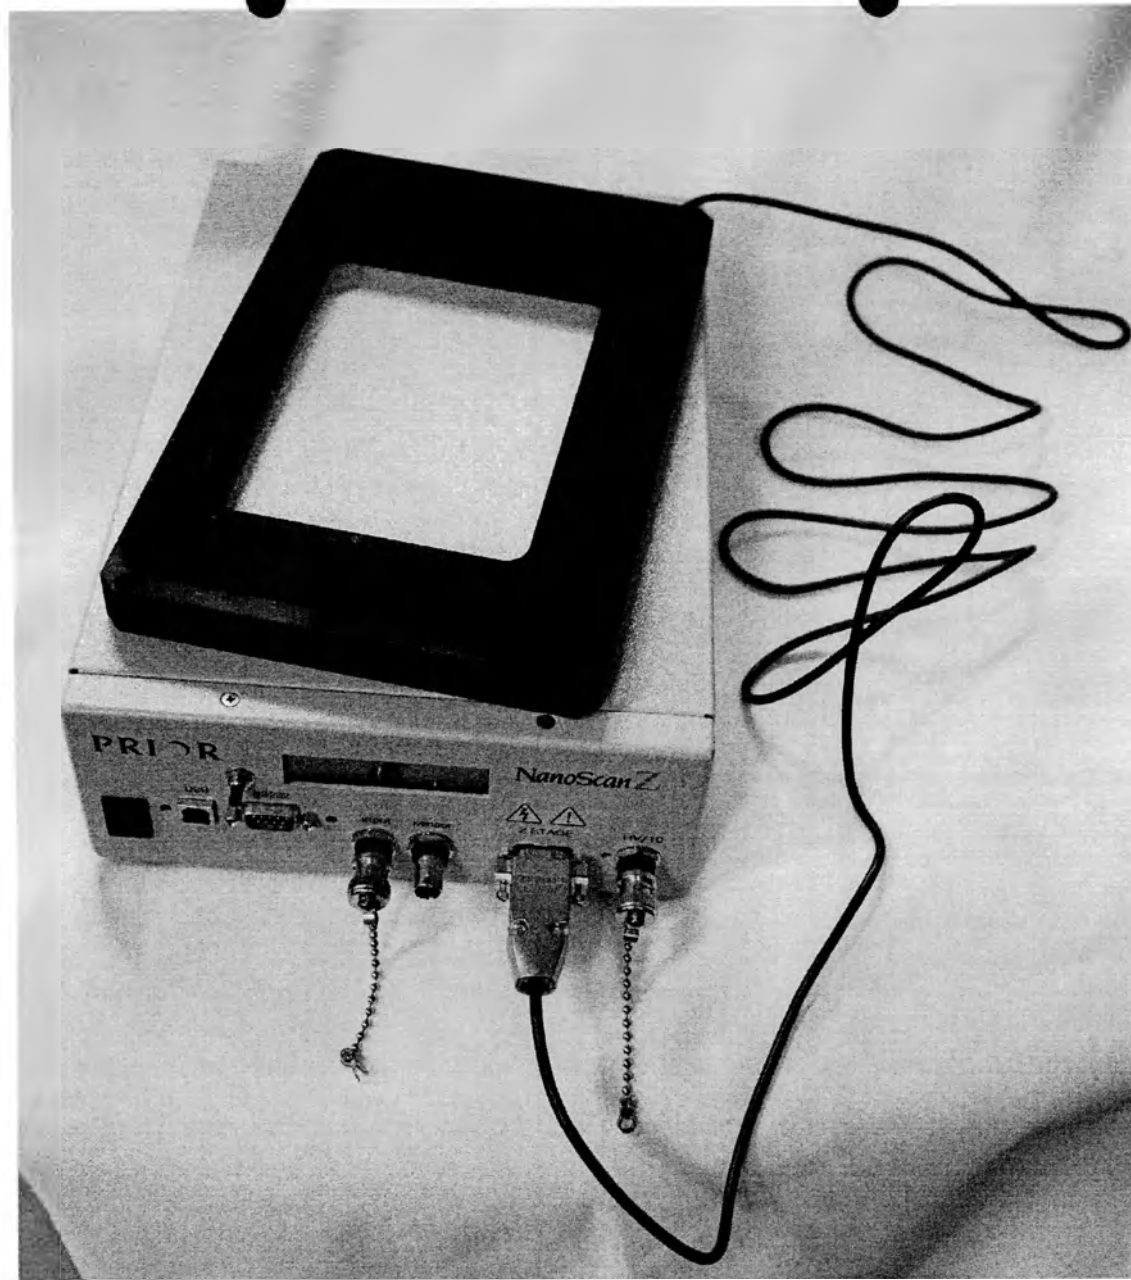


Рис.13. Пьезоподвижка вертикальная 400 мкм

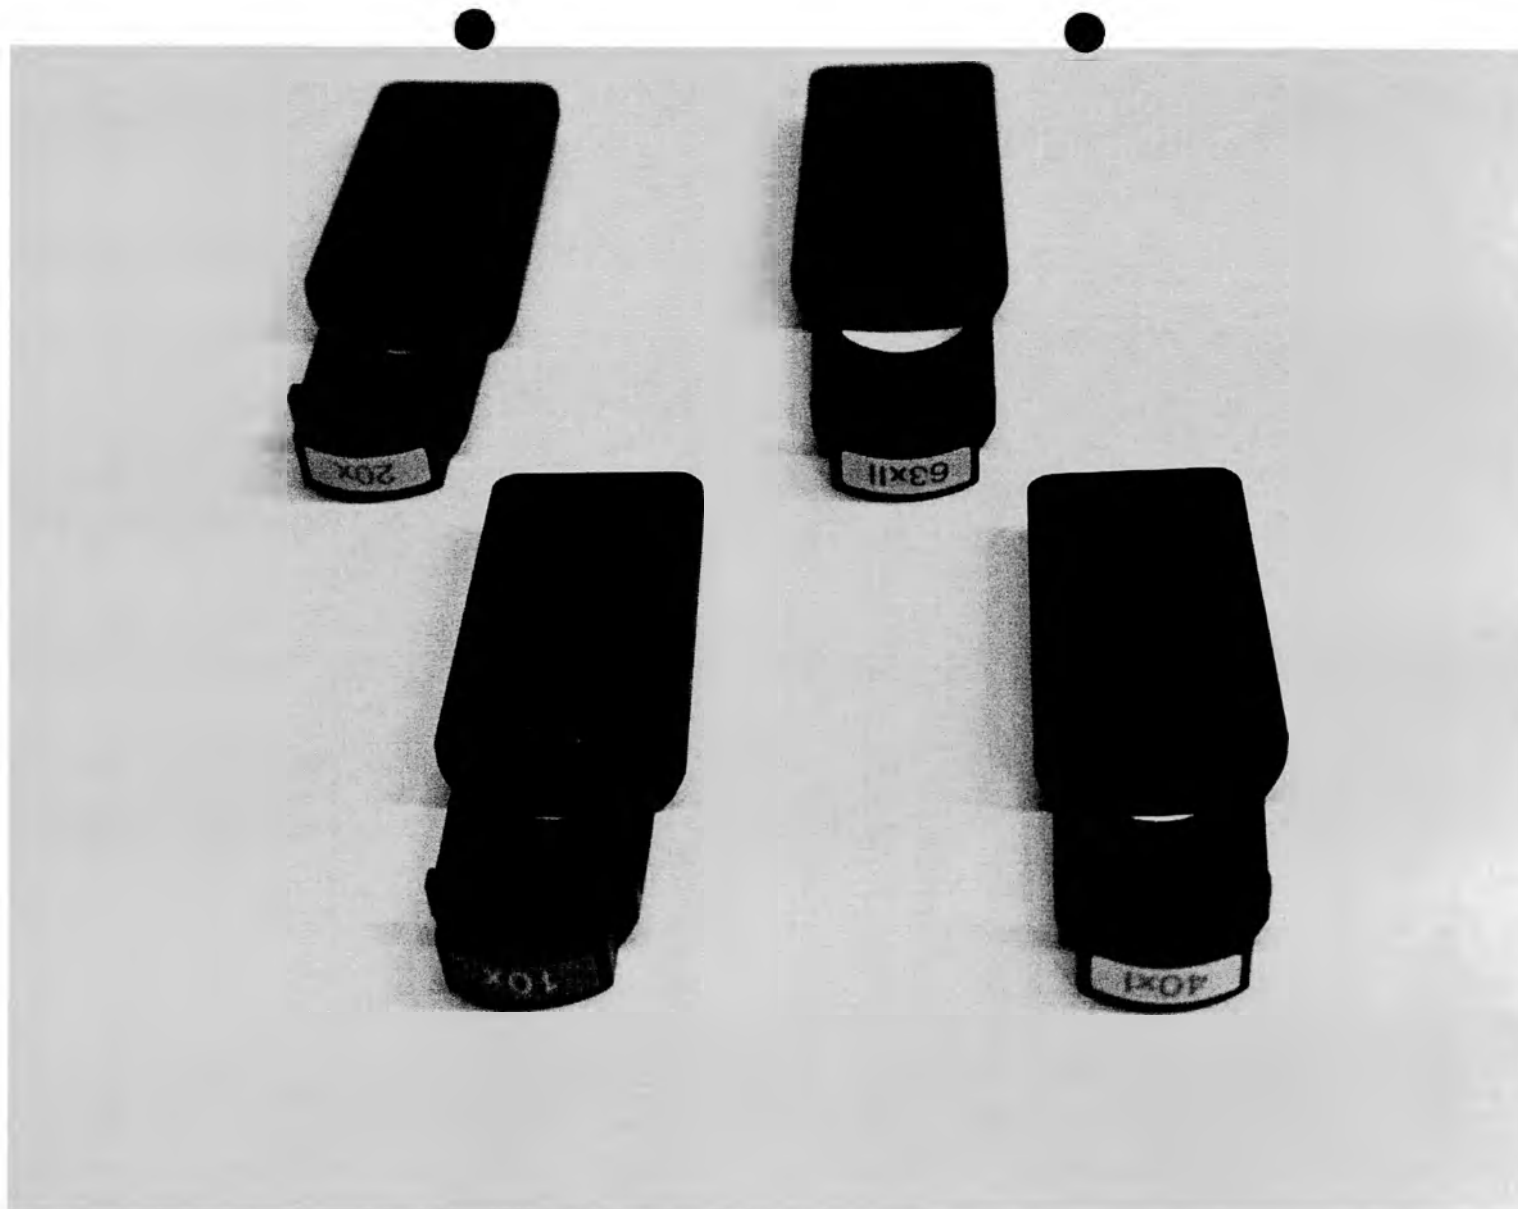


Рис.14. ДИК слайдеры в револьвер (10х,20х,40х, 63х)



Рис.15. ДИК слайдер в конденсор



Рис.16. Поляфильтр-поляризатор

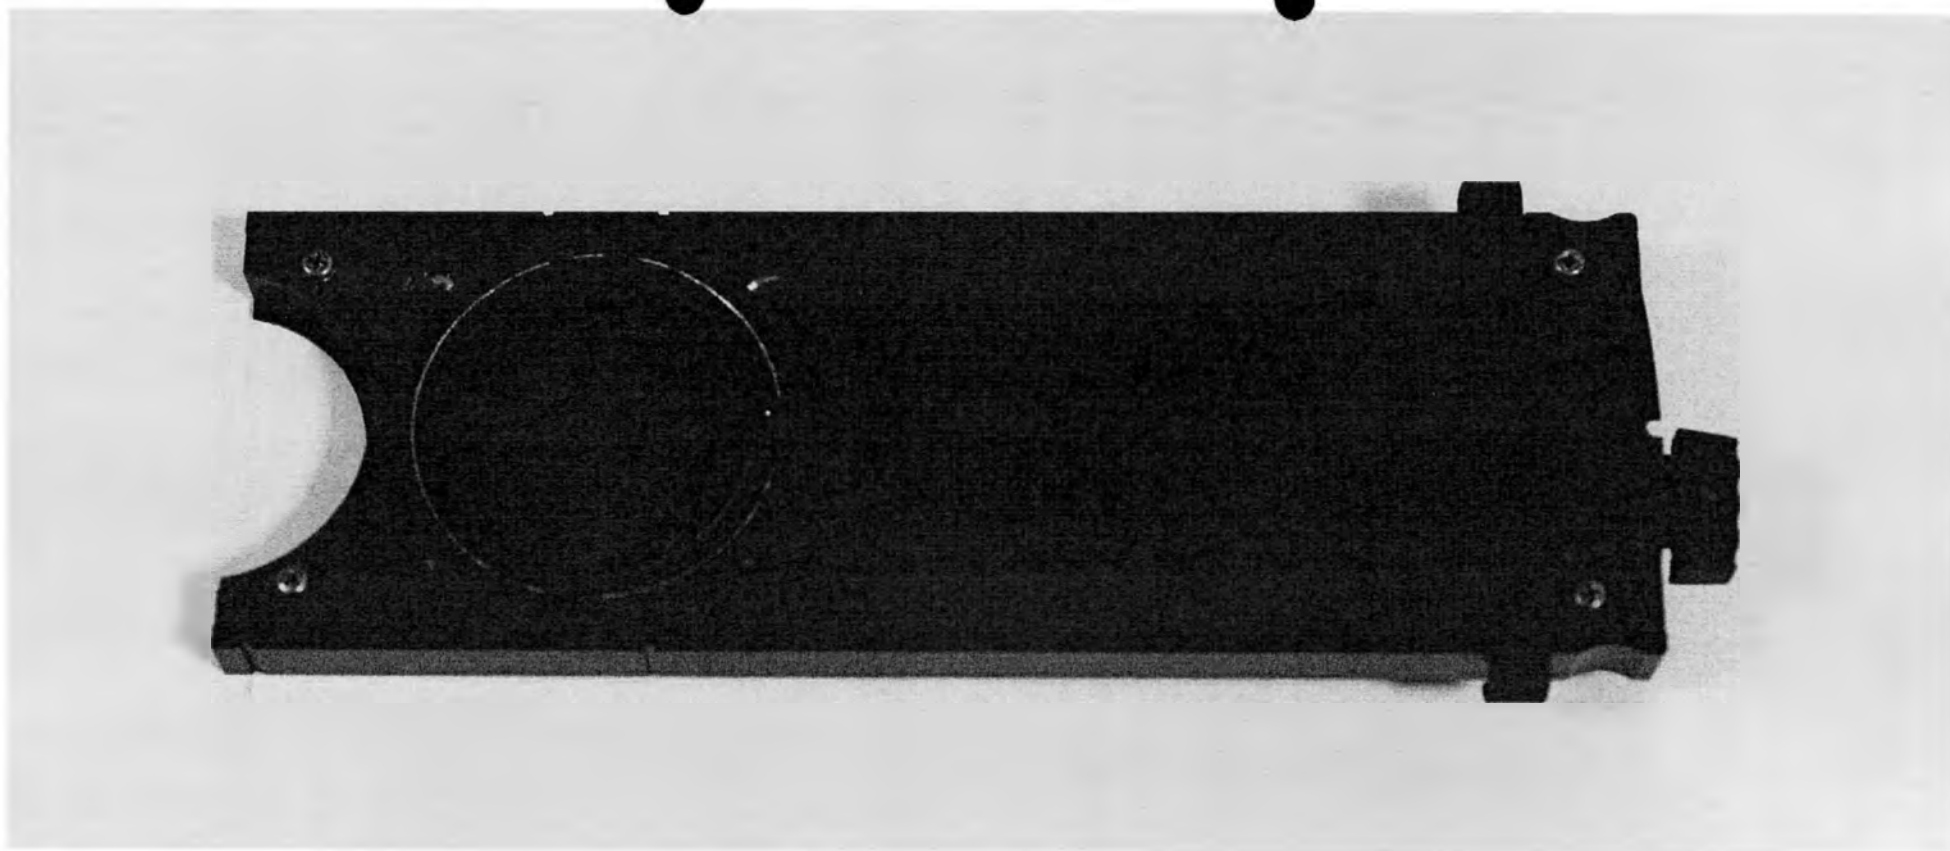


Рис.17. Поляфильтр-анализатор

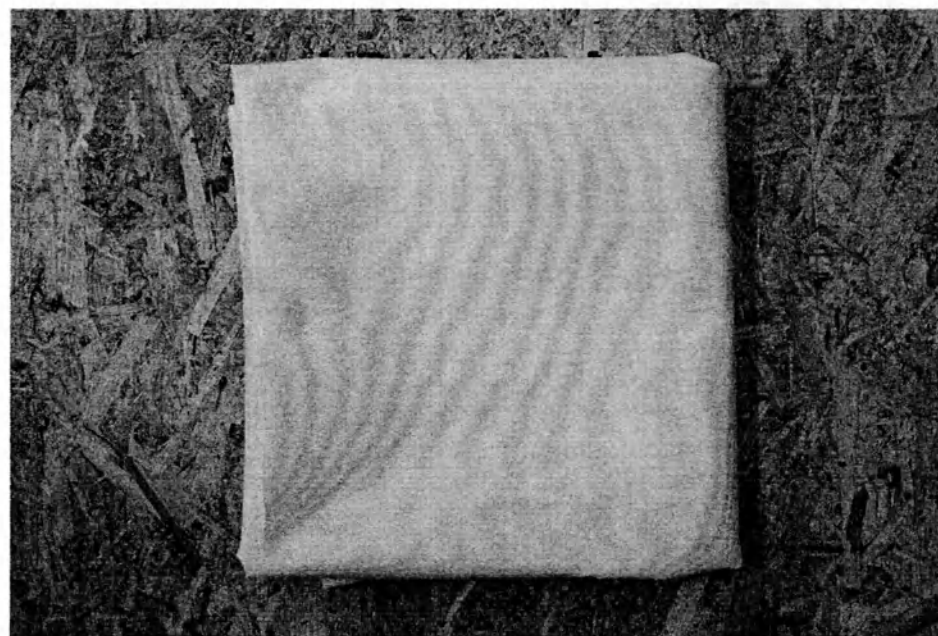
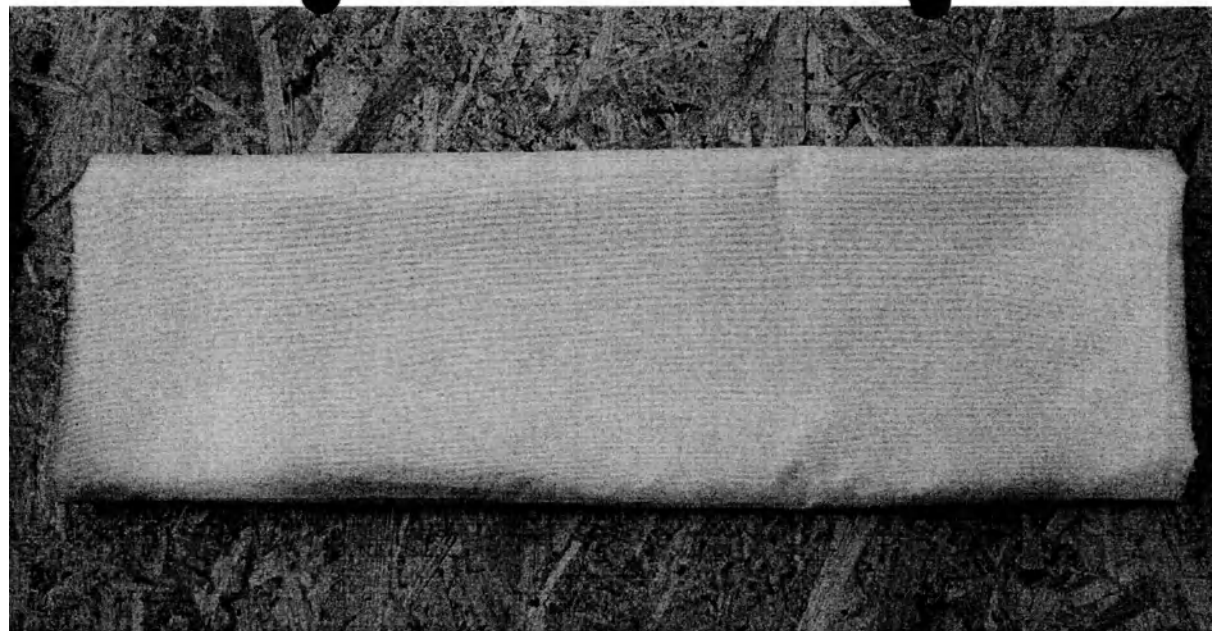


Рис.18. Чехлы



Рис.19. Объект-микрометр ОМ-П

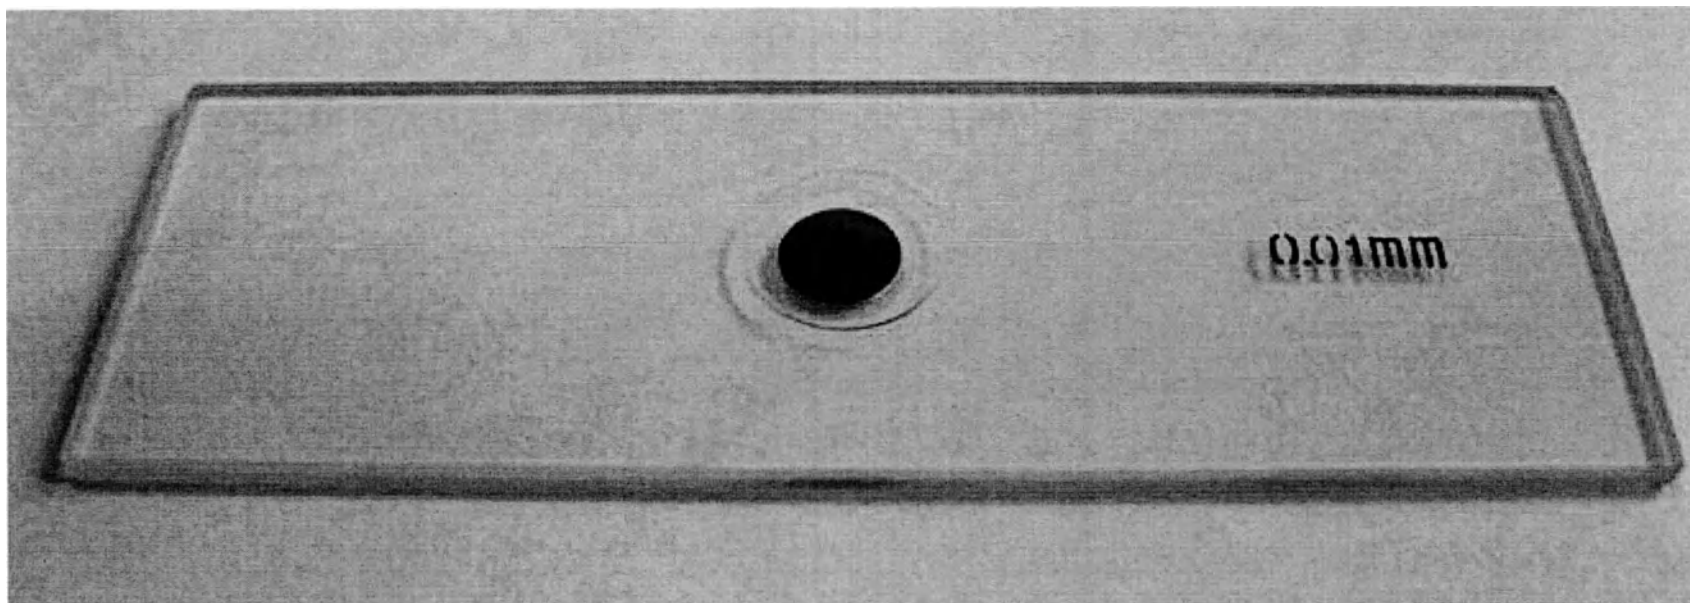


Рис.20. Объект-микрометр ОМ-О

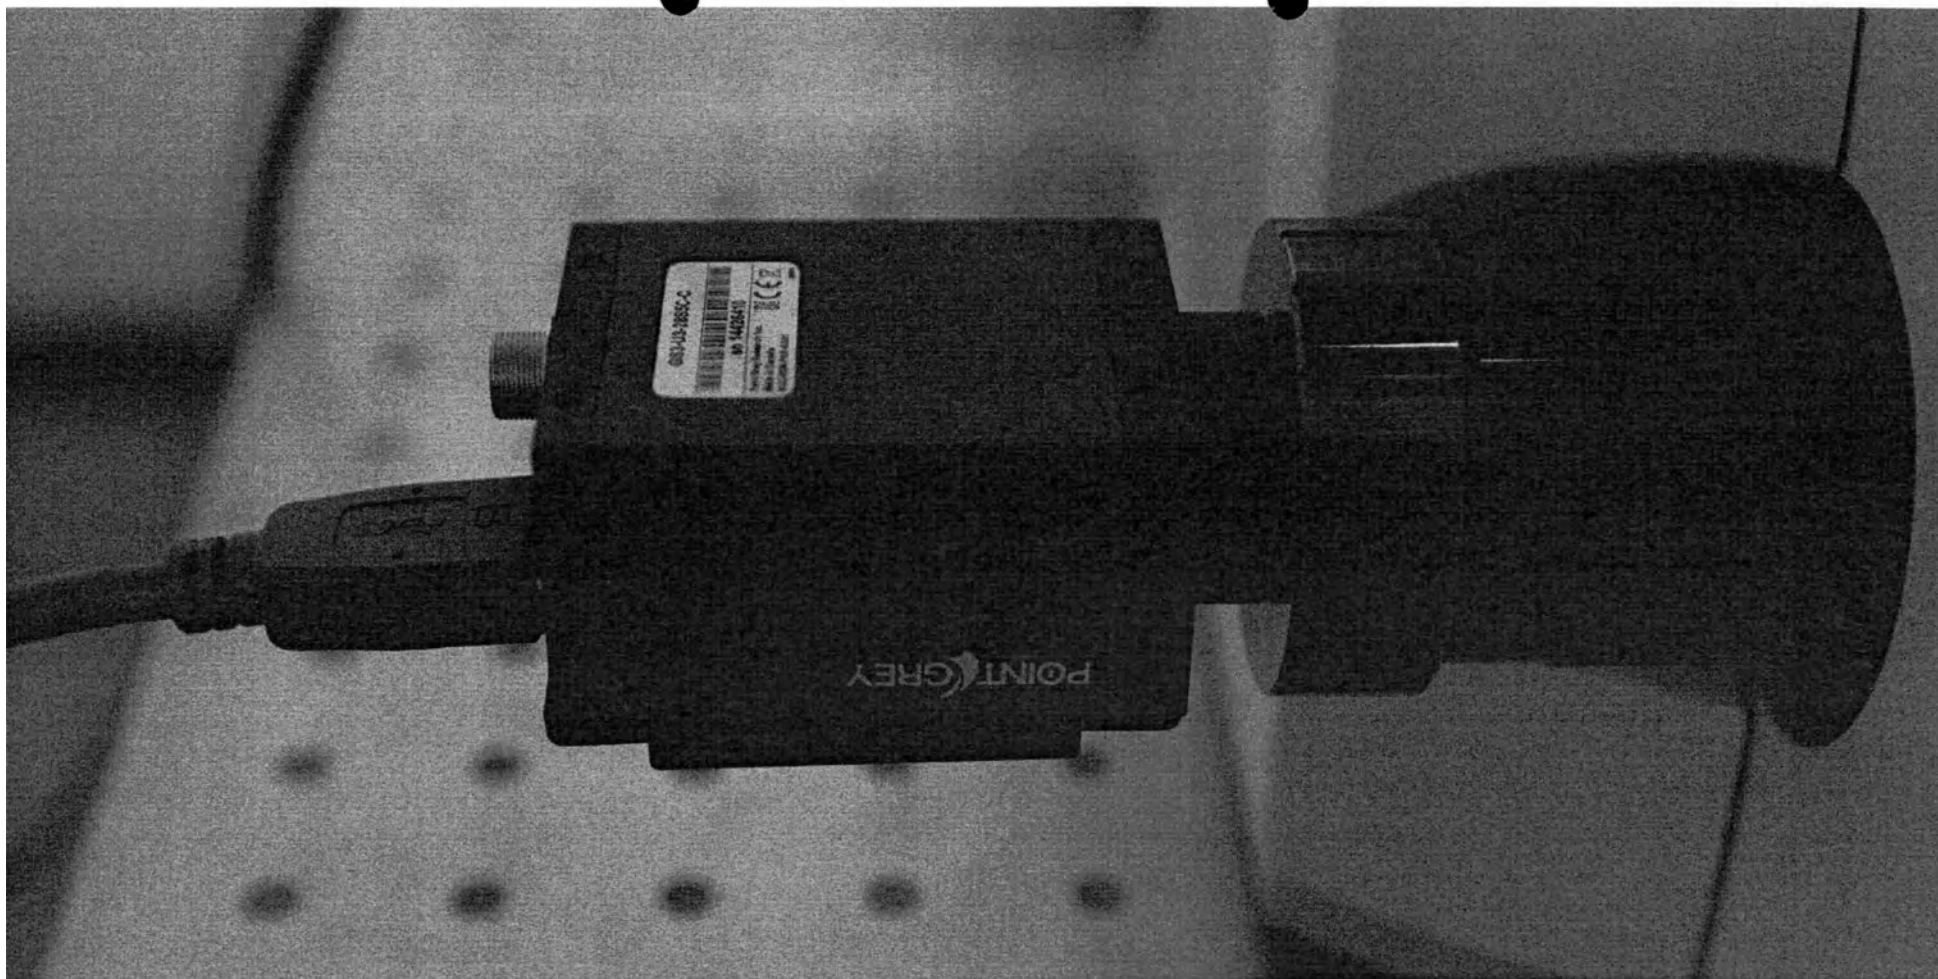


Рис.21. ССД видеокамера

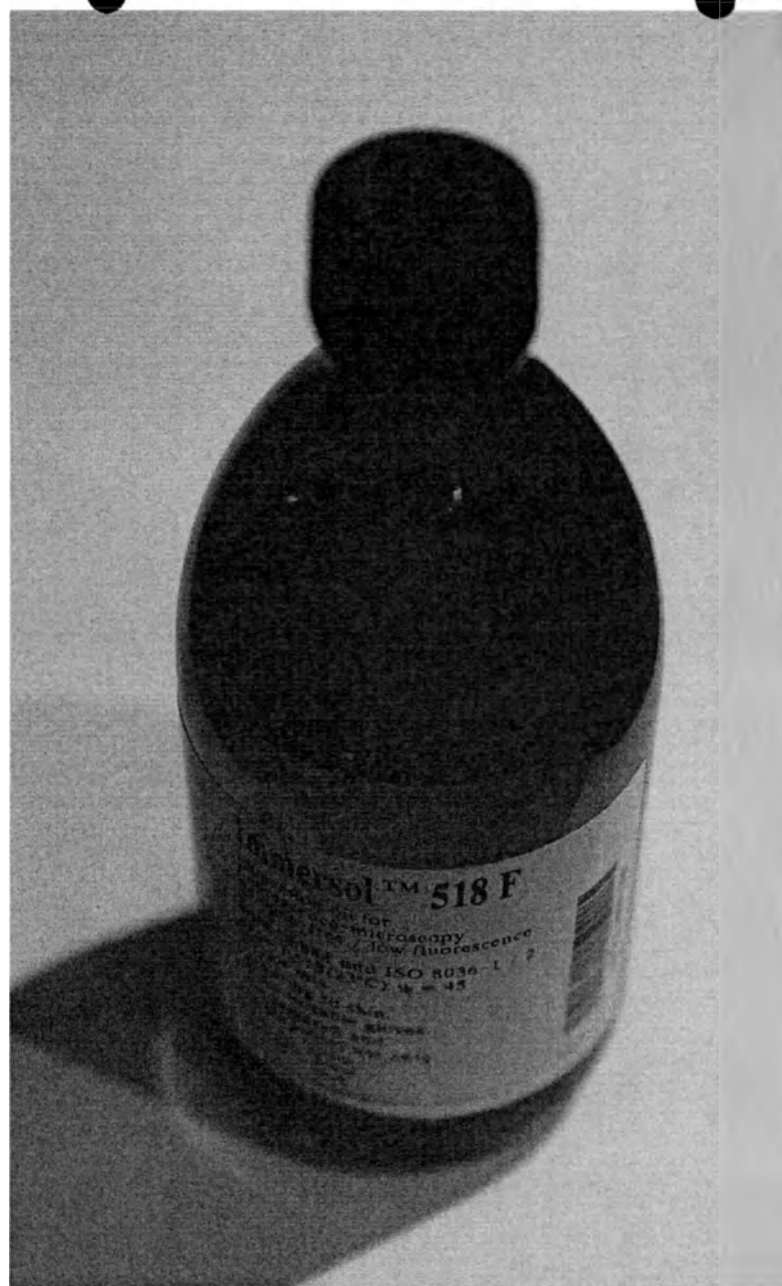


Рис.22. Флакон с иммерсионным маслом

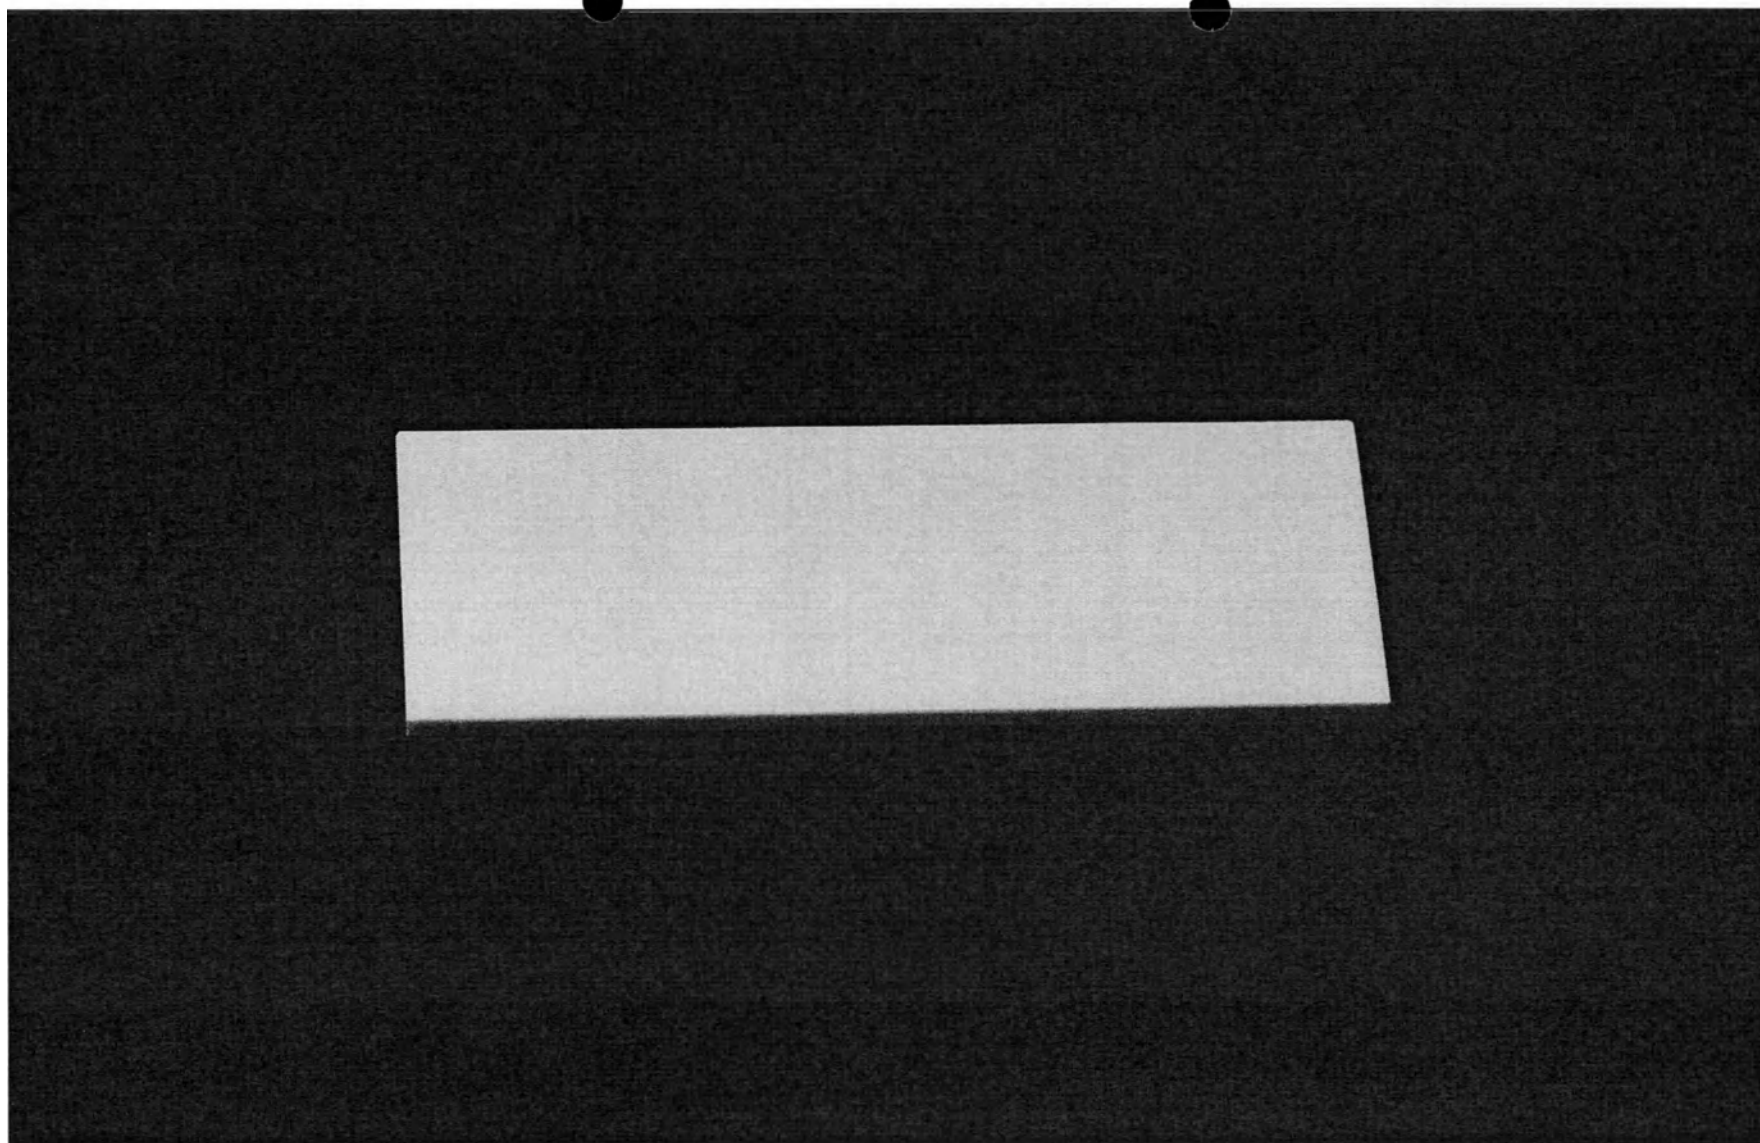


Рис.23. Пластина (эталон белого)

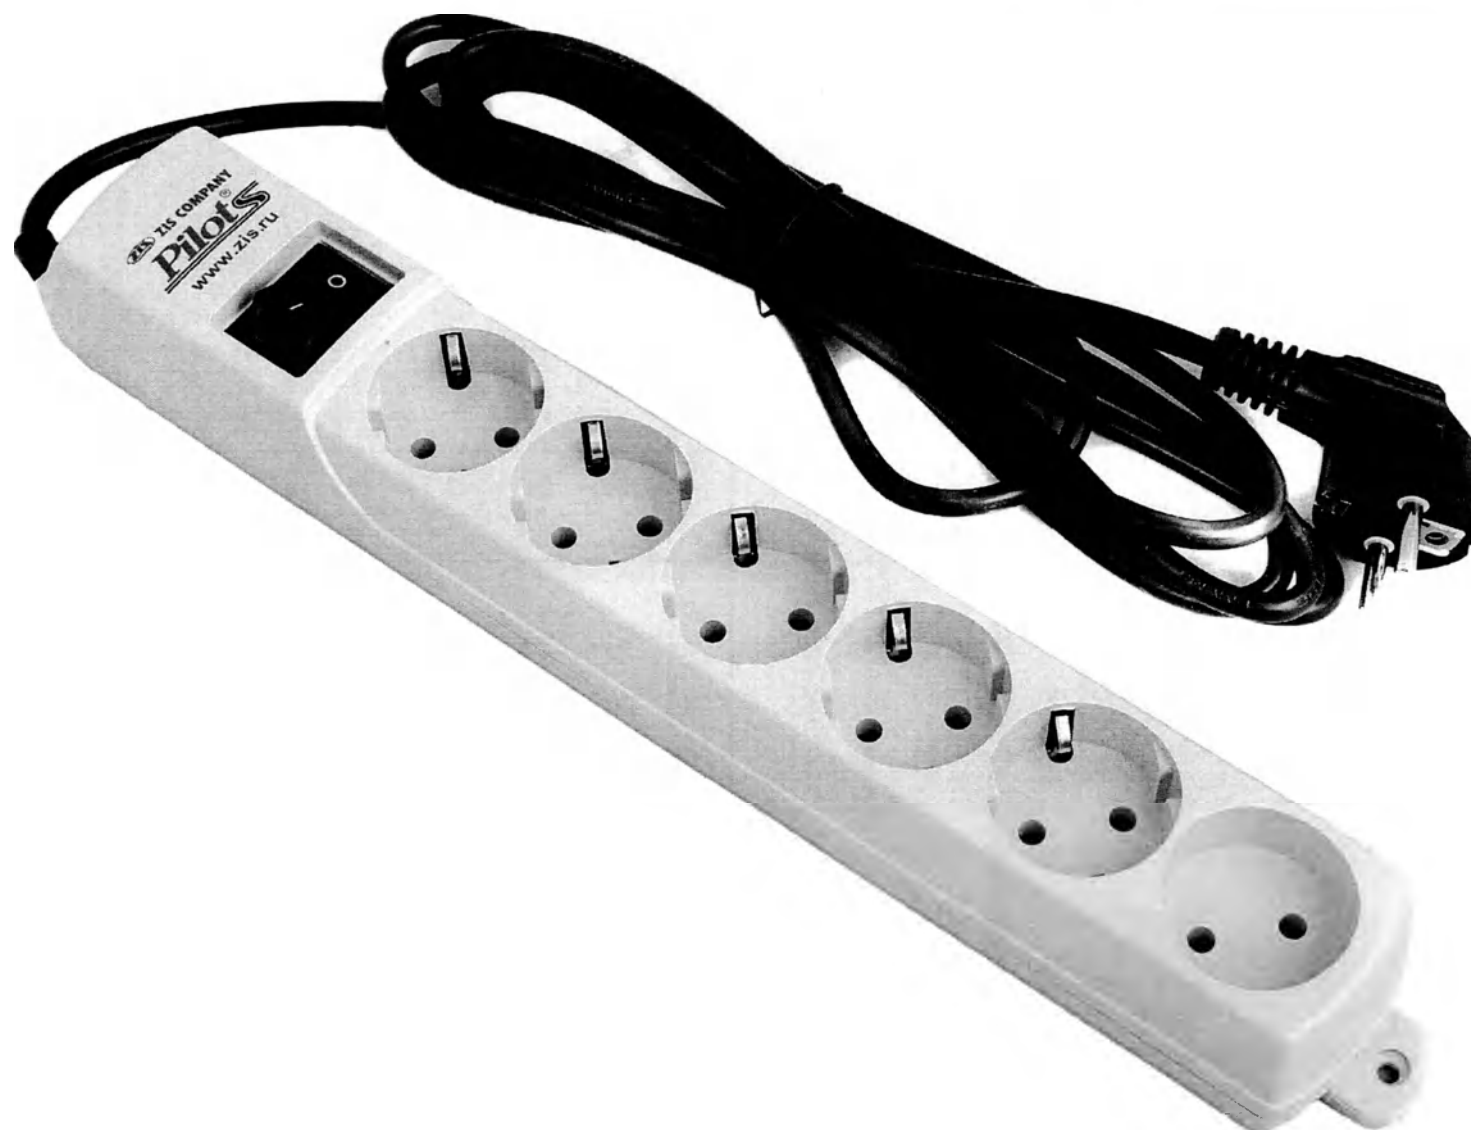


Рис.24. Фильтр сетевой (PILOT)



Рис.25. Предохранитель керамический (6А, 250В)



Рис.26. Комплект упаковки

В документе прошито и пронумеровано

26 (двадцать шесть) лист 66

Генеральный директор

ЗАО «ОРИОН МЕДИК»

Д.И. Пантелеев

