

Фотографические изображения

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET).

Состав:

- 1. Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.**
- 2. Реагент HCV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.**
- 3. Количественный стандарт РНК (RNA QS) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.**
- 4. Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.**



Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото общего вида



Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET).

- Состав: 1. Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.
2. Реагент HCV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.
3. Количественный стандарт РНК (RNA Q5) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.
4. Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделия стабильны максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» («Рох Дианостикс ГмбХ»), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостикс Рус» (ООО «Рох Дианостикс Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-82-64, E-mail: posomk.georbin_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979602190

cobas® HCV

*Quantitative nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System*


c4800 HCV AMP/DET




cobas®

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): маркировка

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото общего вида

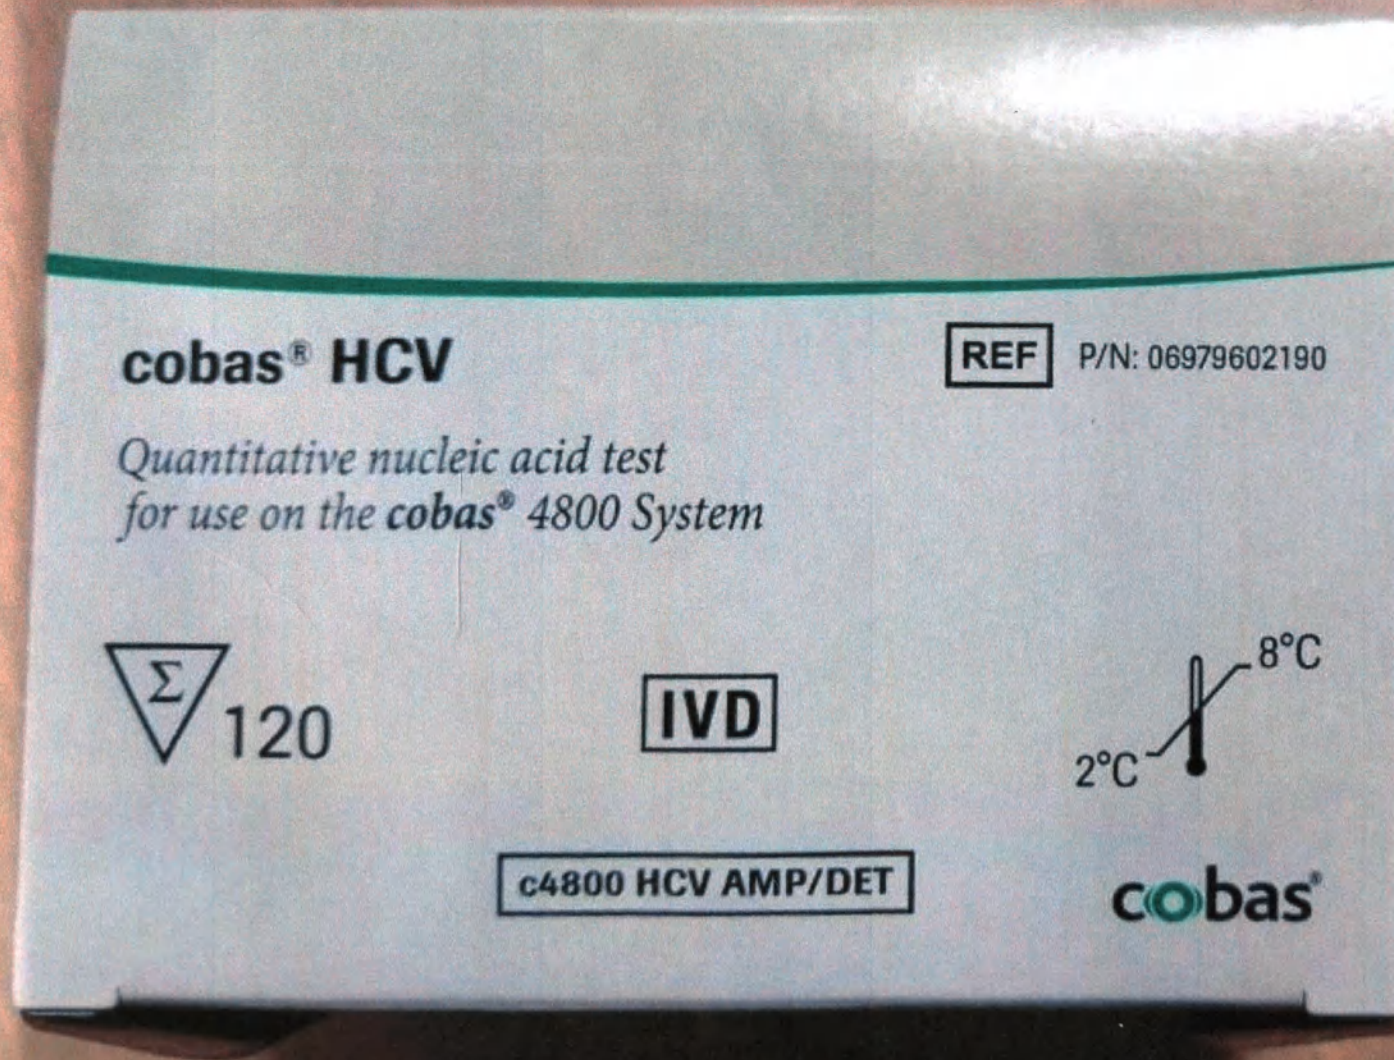

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото общего вида

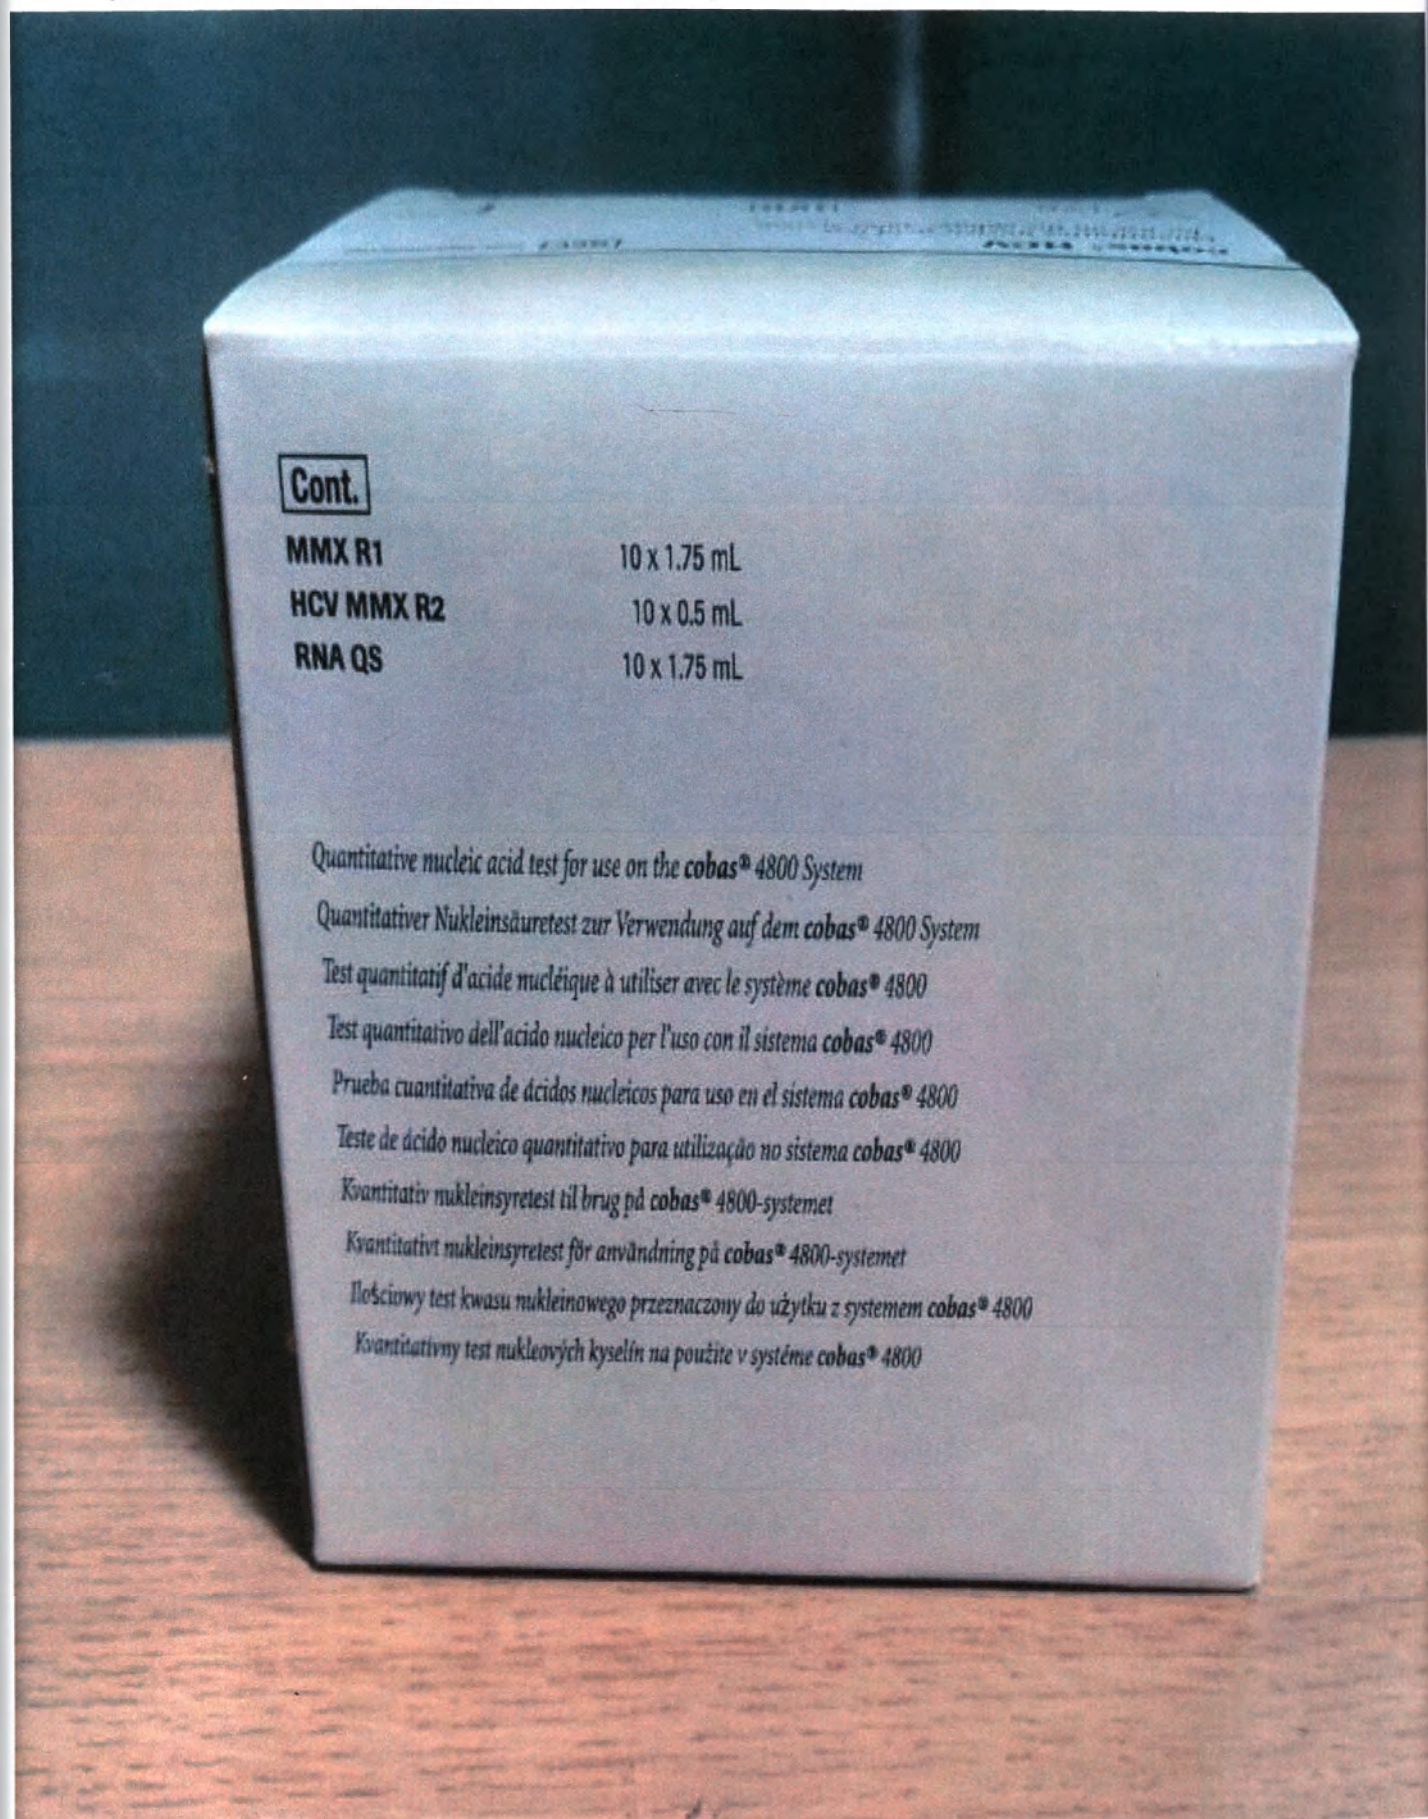

Cont.

MMX R1	10 x 1.75 mL
HCV MMX R2	10 x 0.5 mL
RNA QS	10 x 1.75 mL

Quantitative nucleic acid test for use on the **cobas**[®] 4800 System

Quantitativer Nukleinsäuretest zur Verwendung auf dem **cobas**[®] 4800 System

Test quantitatif d'acide nucléique à utiliser avec le système **cobas**[®] 4800

Test quantitativo dell'acido nucleico per l'uso con il sistema **cobas**[®] 4800

Prueba cuantitativa de ácidos nucleicos para uso en el sistema **cobas**[®] 4800

Teste de ácido nucleico quantitativo para utilização no sistema **cobas**[®] 4800

Kvantitativ nukleinsyretest til brug på **cobas**[®] 4800-systemet

Kvantitativ nukleinsyretest för användning på **cobas**[®] 4800-systemet

Ilościowy test kwasu nukleinowego przeznaczony do użytku z systemem **cobas**[®] 4800

Kvantitatívny test nukleových kyselín na použitie v systéme **cobas**[®] 4800

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото общего вида



c4800 HCV AMP/DET

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



Distributed by

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, Switzerland

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Roche Diagnostics, SL
Avda. Generalitat, 171-173
E-08174 Sant Cugat del Valles
Barcelona, Spain

Roche Diagnostics
201, boulevard Armand-Frappier
H7V 4A2 Laval, Québec, Canada
(For Technical Assistance call:
Pour toute assistance technique,
appeler le: 1-877-273-3433)

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors
38240 Meylan, France

Distributore in Italia:
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G. B. Stucchi 110
20052 Monza, Milano, Italy

Distribuidor em Portugal:
Roche Sistemas de Diagnósticos Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora, Portugal

Roche Diagnostica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Bilings, 1729
Jaguare, Building 10
05321-010 São Paulo, SP, Brazil

COBAS is a trademark of Roche. ©2015 Roche Molecular Systems, Inc.


Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото общего вида



Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.



Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.

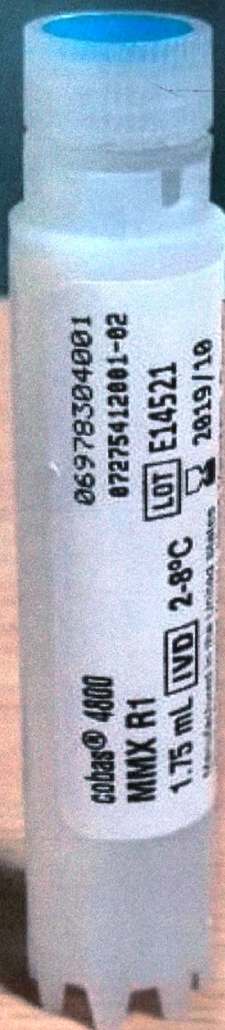


Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото Реагент HCV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.




Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото Реагент HCV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.



Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото Количественный стандарт РНК (RNA QS) во флаконе, объем 1,7 мл, 10 шт.

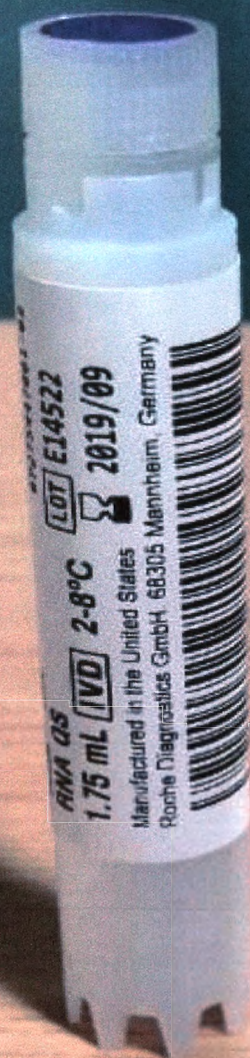

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото Количественный стандарт РНК (RNA QS) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.

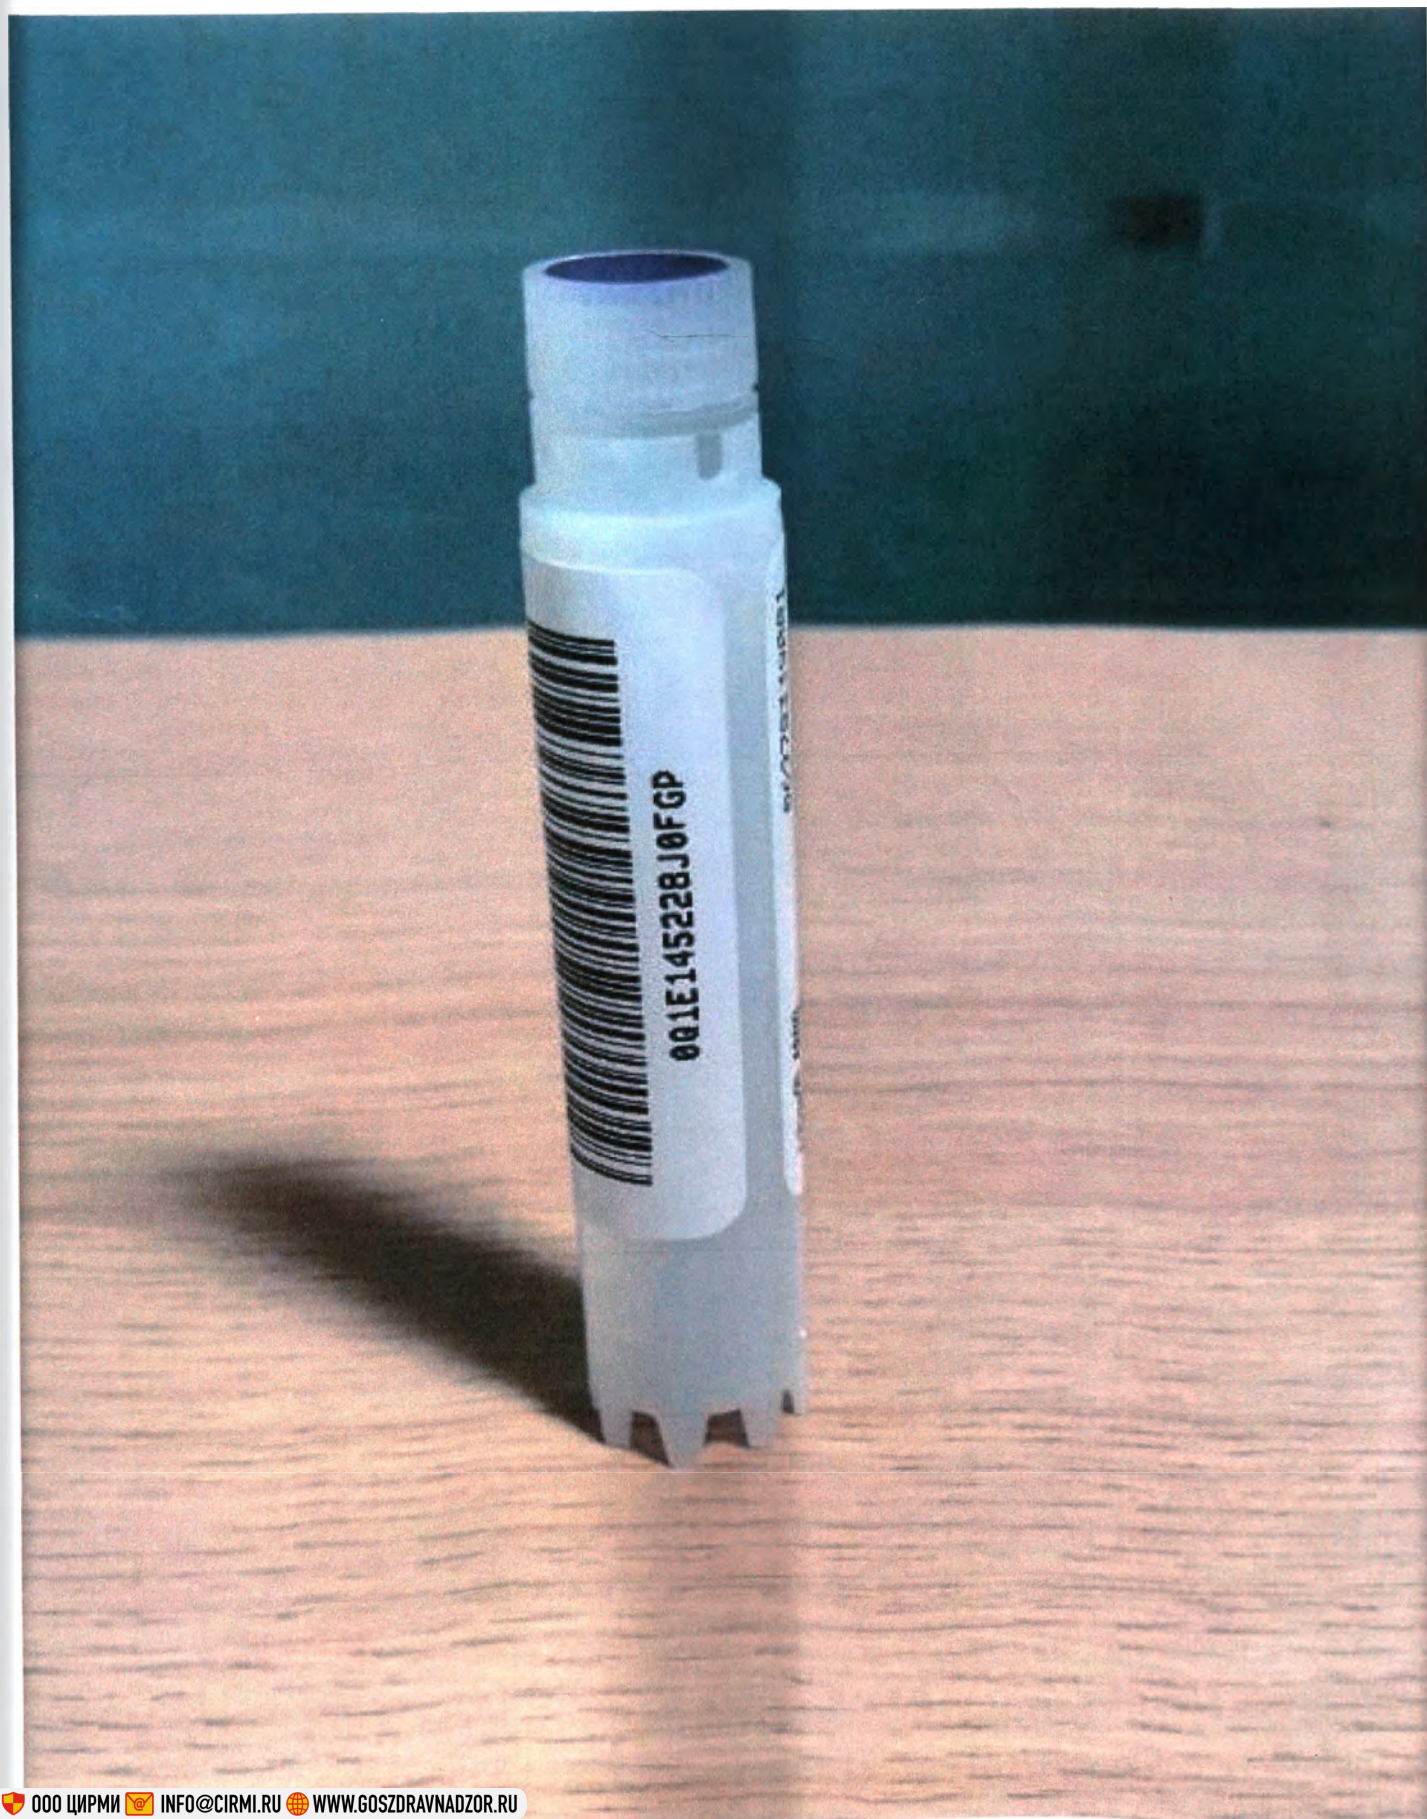

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.

cobas® HCV

IVD

Quantitative nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System

c4800 HCV AMP/DET

KIT **LOT**

E14437

LOT

MMX R1

E14521

HCV MMX R2

E14525

RNA QS

E14522



cobas® 4800 system
cobas® HCV AP v1.1 or higher

cobas® 4800 system
Application Software Version 2.2 or higher



Non-USA: website: <http://e-labdoc.roche.com>
Method Sheet Catalog No.: 06979602190
Doc Rev. 4.0

Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HCV/c4800 HCV AMP/DET): фото Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.

cobas® HCV Quantitative nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System

c4800 HCV AMP/DET



KIT **LOT** E14437

2019-08-31

LOT

IVD

MMX R1 E14521

HCV MMX R2 E14525

RNA QS E14522



cobas® 4800 system
cobas® HCV AP v1.1 or higher
cobas® 4800 system Application Software Version 2.2 or higher

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

07373929001-02

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
пятикратная (15) листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018