

Фотографические изображения

Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800

(cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2)

Состав:

Дилуэнт (SD 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.

Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2)

Состав: Дилуэнт (SD 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-89-99, факс: +7 495 229-82-84. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979556190



COBAS is a trademark of Roche.
©2015 Roche Molecular Systems, Inc.

Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2): фото маркировки

cobas[®] 4800 System Specimen Diluent 2

REF P/N: 06979556190

IVD

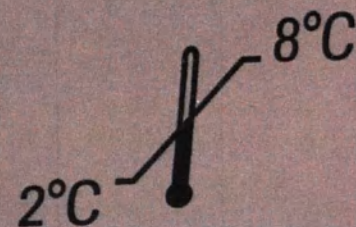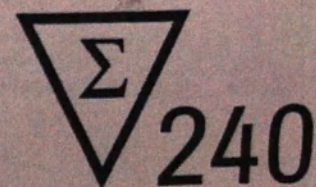


cobas[®]

Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2): фото общего вида

Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800
(cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2): фото общего вида



Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800
(cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2): фото общего вида

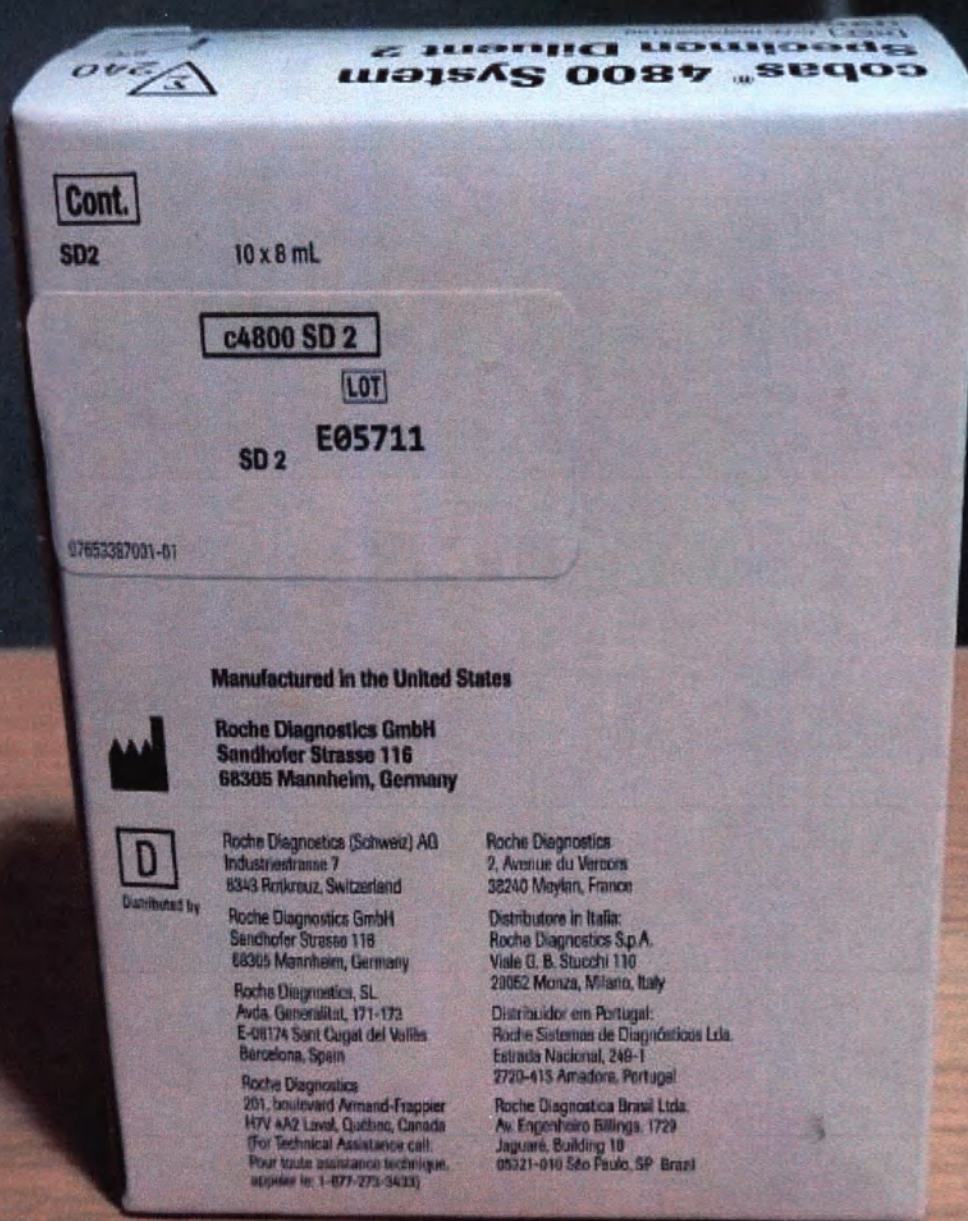

Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2): фото Дилуэнт (SD 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.



Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2): фото Дилуэнт (SD 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.



Дилуэнт для образцов для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Specimen Diluent 2/c4800 SD 2): фото Дилуэнт (SD 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
деветь (9) листа (ов)

Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018

