



Фотографические изображения

Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET)

Состав:


- 1. Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.**
- 2. Реагент HIV-1 MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.**
- 3. Количественный стандарт РНК (RNA QS) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.**
- 4. Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.**



Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека

и нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800

HIV-1 AMP/DET): фото общего вида

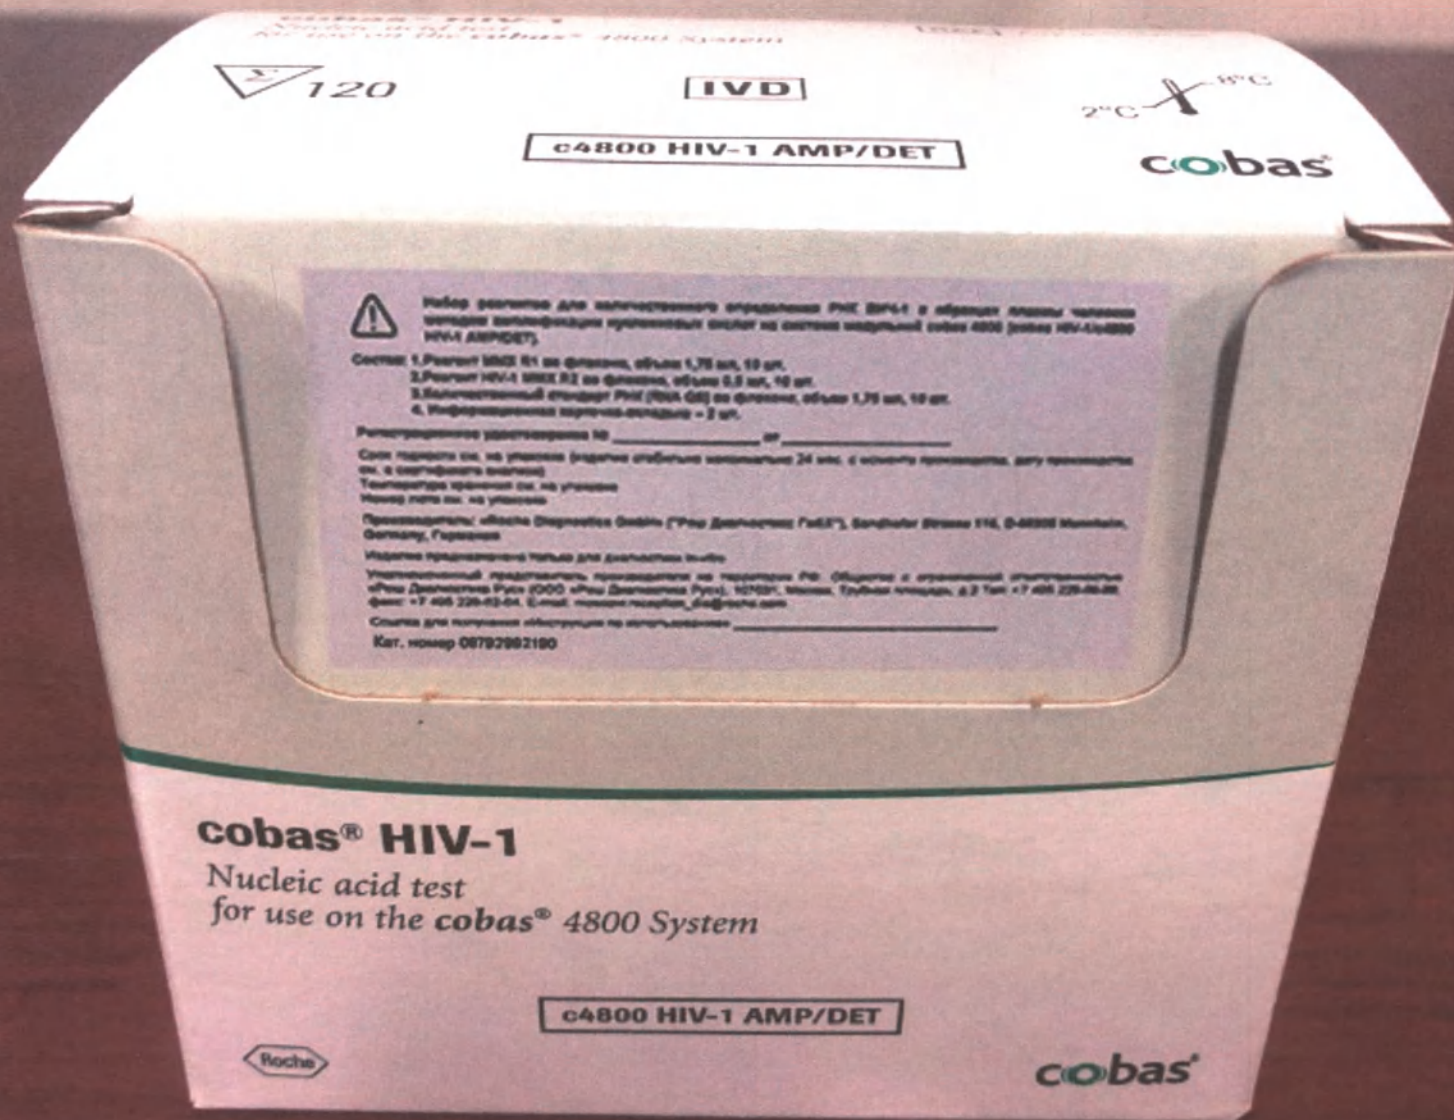

Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET):



Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET):

Cont.

MMX R1	10 x 1.75 mL
HIV-1 MMX R2	10 x 0.5 mL
RNA QS	10 x 1.75 mL

Nucleic acid test for use on the **cobas® 4800** System

Nukleinsäuretest zur Verwendung auf dem **cobas® 4800** System

Test d'acide nucléique à utiliser avec le système **cobas® 4800**

Test dell'acido nucleico per l'uso con il sistema **cobas® 4800**

Prueba de ácidos nucleicos para uso en el sistema **cobas® 4800**

Teste de ácido nucleico para utilização no sistema **cobas® 4800**

Nukleinsyretest til brug på **cobas® 4800**-systemet

Nukleinsyretest för användning på **cobas® 4800**-systemet

Test kwasu nukleinowego przeznaczony do użytku z systemem **cobas® 4800**


Test nukleových kyselín na použítie v systéme **cobas® 4800**

Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET):




Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET):


Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/cobas HIV-1 AMP/DET): фото Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.

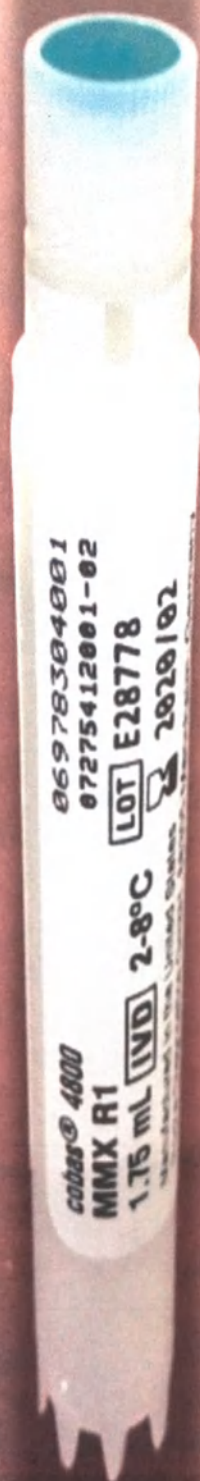

Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET): фото Реагент HIV-1 MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.

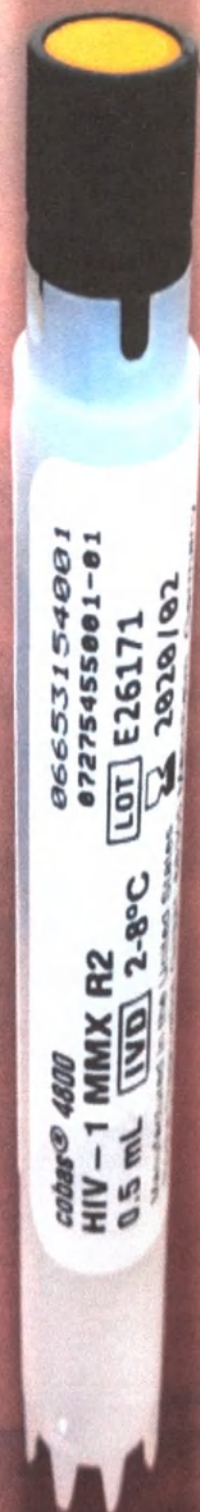

Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET): фото Количественный стандарт РНК RNA QS) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.

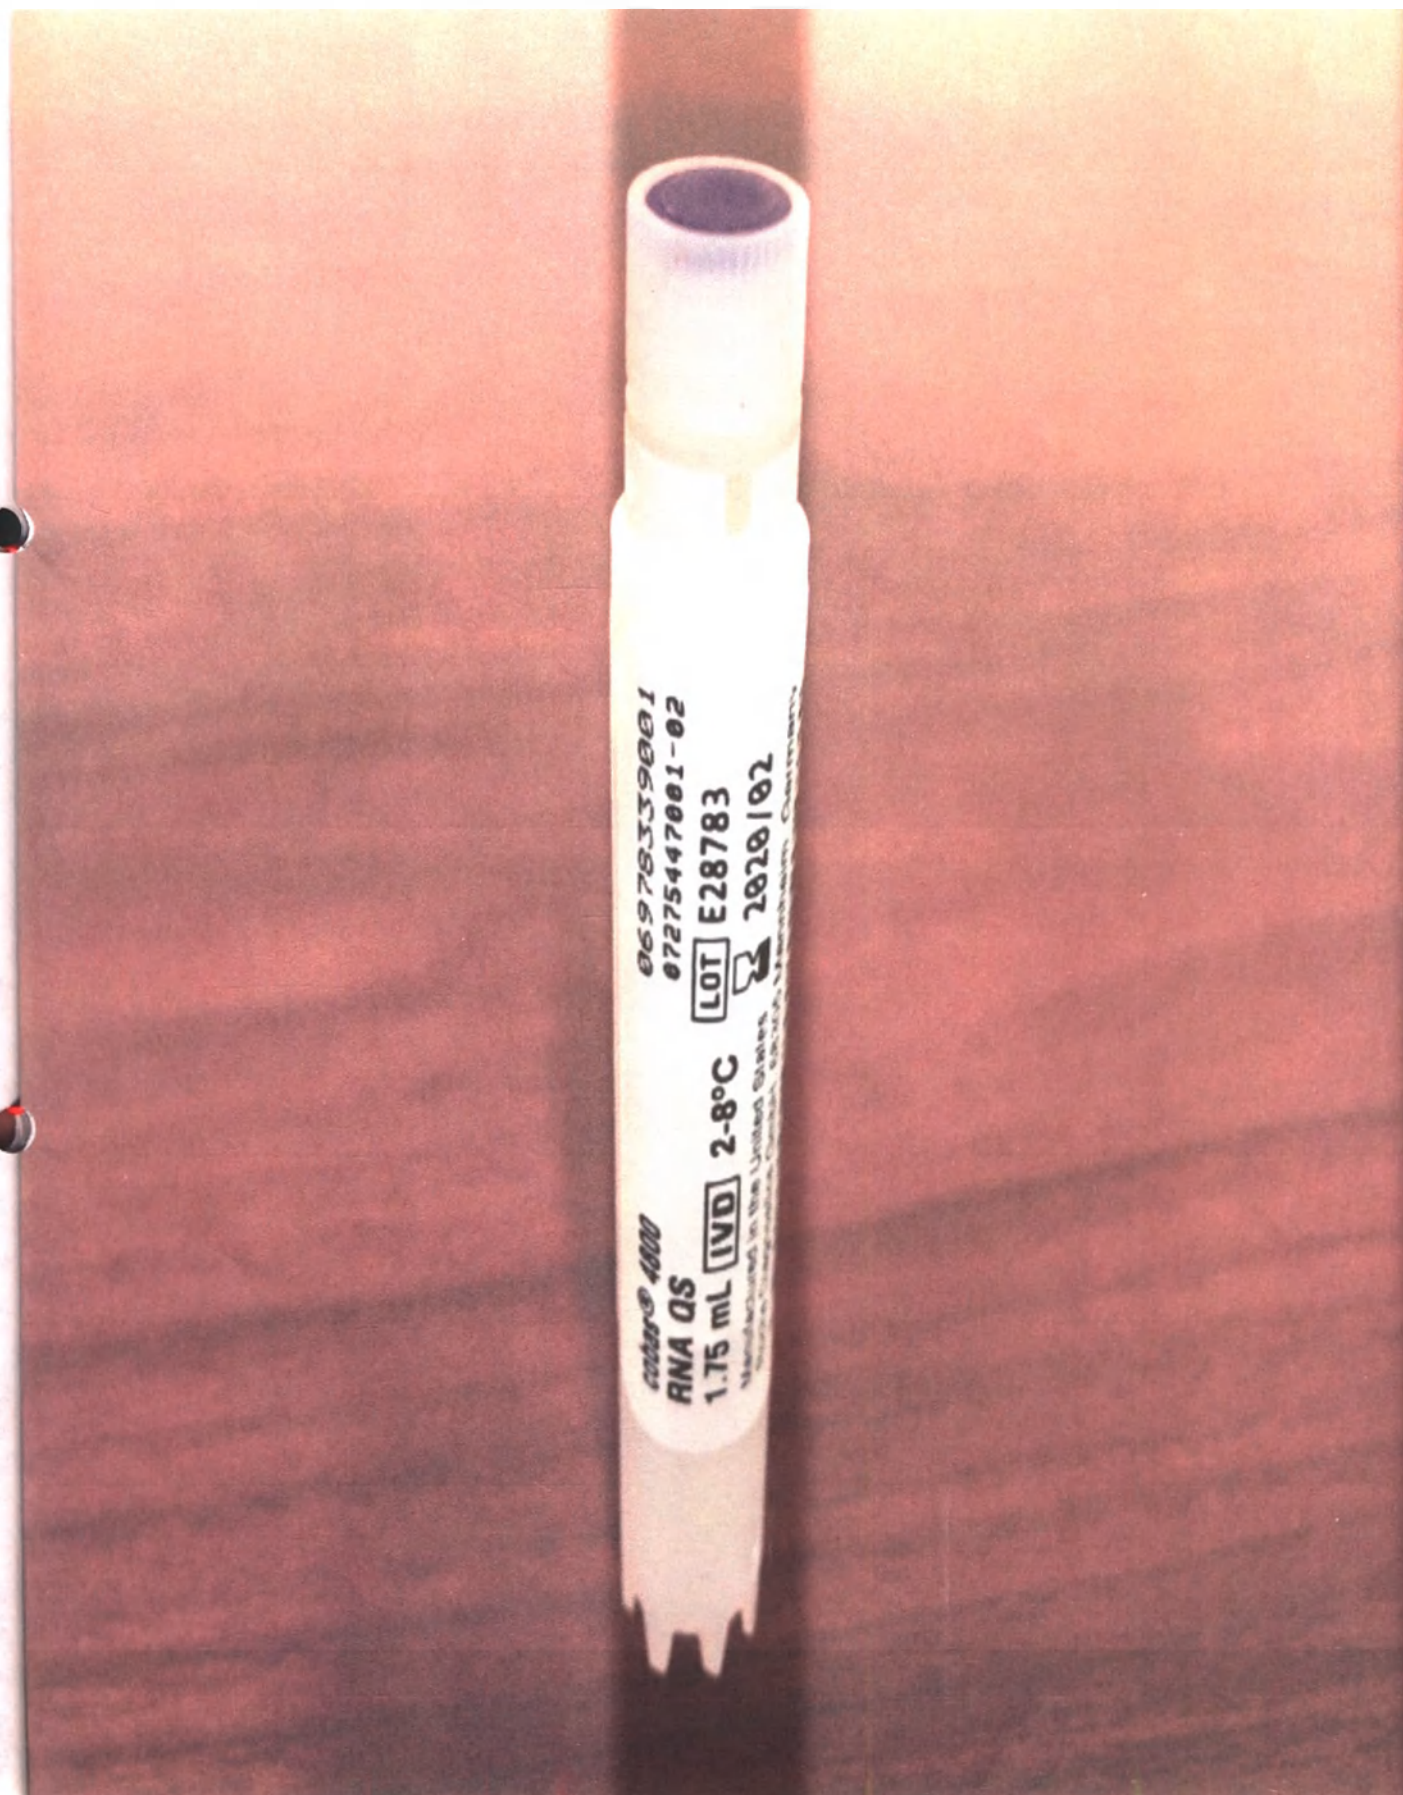

Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET): фото Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.

cobas® HIV-1 Nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System

c4800 HIV-1 AMP/DET



KIT **LOT** F04557

 2020-01-31

LOT

IVD

MMX R1 E28778

HIV-1 MMX R2 E26171

RNA QS E28783



cobas® 4800 system
cobas® HIV-1 AP v1.1 or higher
cobas® 4800 system Application Software Version 2.2 or higher

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

07373937001-02

Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1 в образцах плазмы человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HIV-1/c4800 HIV-1 AMP/DET): фото Информационная карточка-зкладыш – 2 шт.

cobas® HIV-1 **IVD**
Nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System

c4800 HIV-1 AMP/DET

KIT **LOT**
F04557

MMX R1	LOT E28778
HIV-1 MMX R2	E26171
RNA QS	E28783

 **cobas® 4800 system**
cobas® HIV-1 AP v1.1 or higher
cobas® 4800 system
Application Software Version 2.2 or higher

 website: <http://e-labdoc.roche.com>
Method Sheet Catalog No.: 06979599190
Doc Rev. 3.0

Please contact your local Roche affiliate if you require a printed copy free of charge or need technical support to access the package insert. / Bei Ihrer zuständigen Roche-Vertretung erhalten Sie einen kostenfreien Ausdruck oder technische Unterstützung für den Zugriff auf die Packungsbeilage. / Veuillez contacter votre société Roche locale pour obtenir un exemplaire papier gratuit ou une assistance technique pour accéder à la notice. / Contattare il rappresentante Roche locale per ottenere gratuitamente una copia stampata o richiedere istruzioni per reperire il foglio illustrativo. / Póngase en contacto con su filial local de Roche si necesita una copia impresa gratuita o ayuda del servicio técnico para acceder al boletín técnico. / Se desejar uma cópia impressa gratuita ou necessitar de assistência técnica para aceder ao folheto informativo, entre em contacto com o representante local da Roche. / Kontakt den lokale Roche-repræsentant, hvis du ønsker en gratis skriftlig kopi eller har brug for teknisk support for at få adgang til indlægssedlen. / Kontakta din Roche-representant om du vill ha en pappersversion kostnadsfritt eller om du behöver teknisk support för att komma åt bipacksedeln. / Aby otrzymać darmową drukowaną wersję lub jeśli zaistniały problemy techniczne z dostępem do ulotki dołączonej do opakowania, należy skontaktować się z miejscowym oddziałem firmy Roche. / Ak potrebujete bezplatnú vytlačenu kópiu alebo ak potrebujete technickú pomoc ohľadne prístupu k príbalovým letákom, obráťte sa na miestne zastúpenie spoločnosti Roche.

Manufactured in the United States

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

07529720003 03

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
12 листа (ов)

