





Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP- D898MD

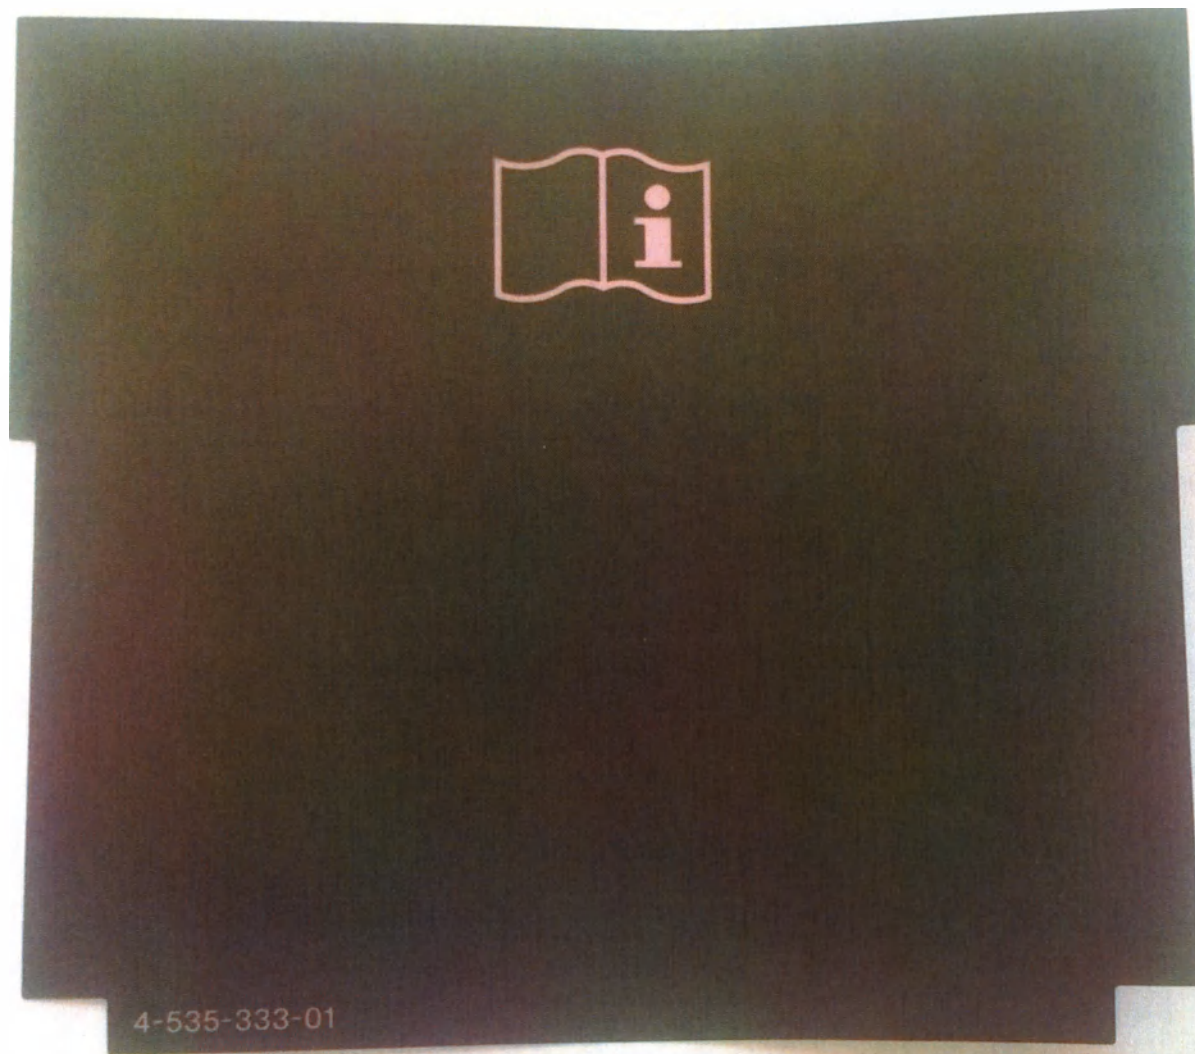

Лист для очистки термопечатающей головки (110 × 95 мм)

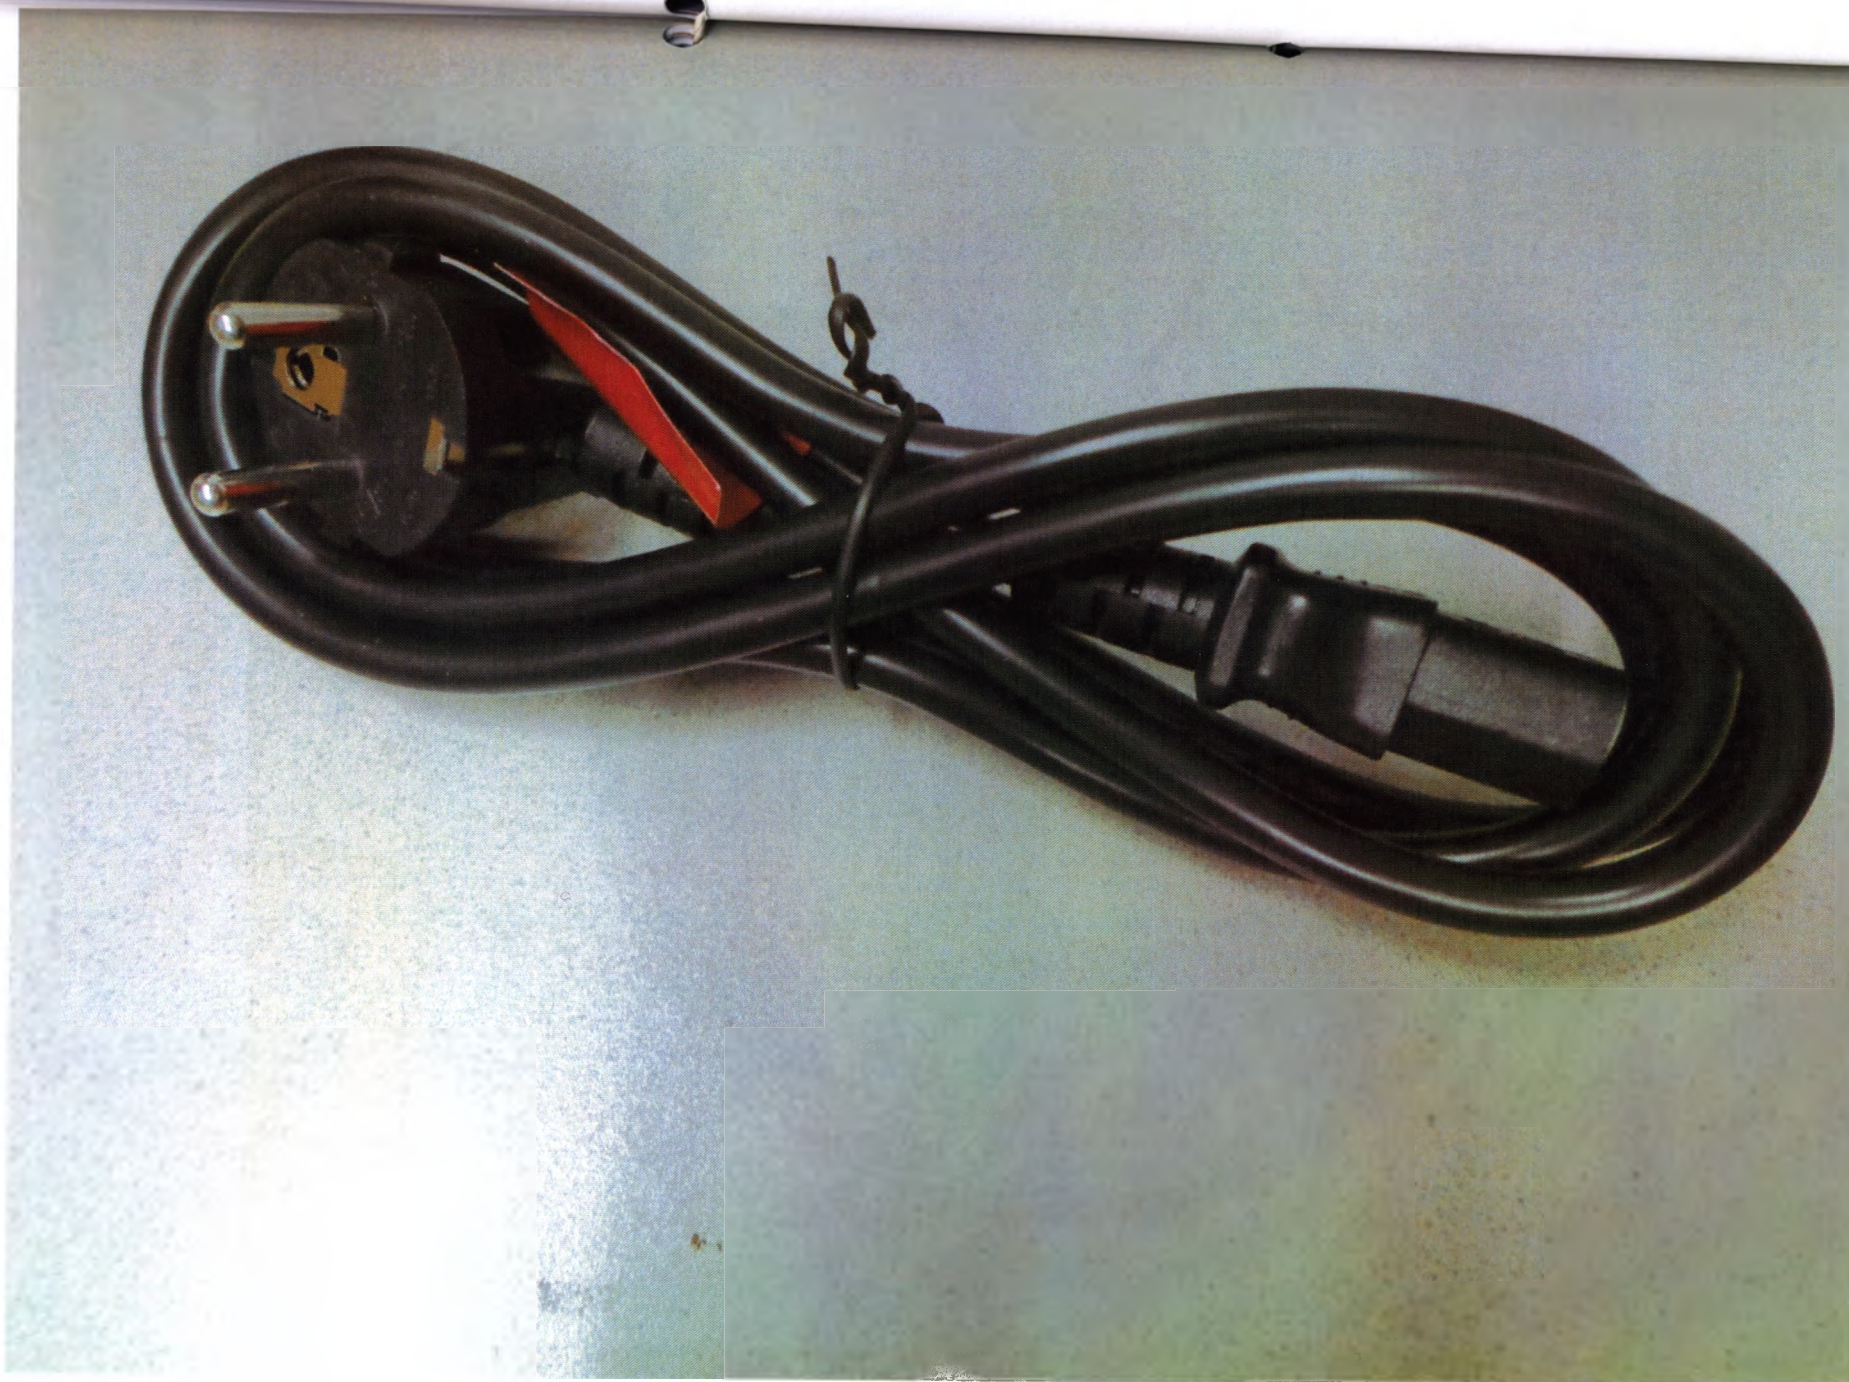

Кабель питания переменного тока



компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver.1.00)

SONY®

REF 4-528-661-61 (2)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕЧАТИ МОНОХРОМНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

UP-D898MD


EAC

© 2016 Sony Corporation


Руководство пользователя




Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP- X898MD

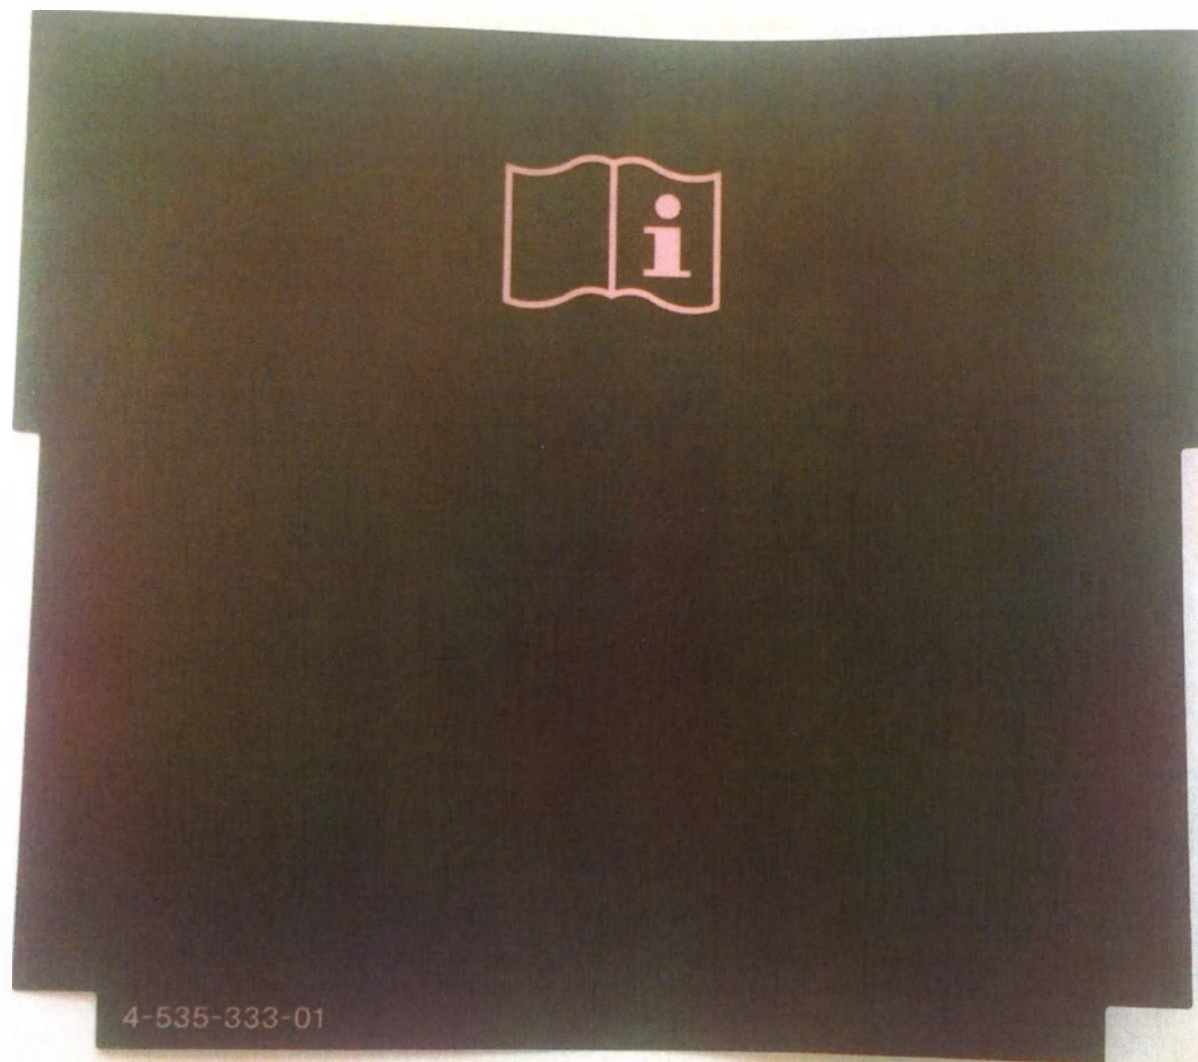

Лист для очистки термопечатающей головки (110 × 95 мм)

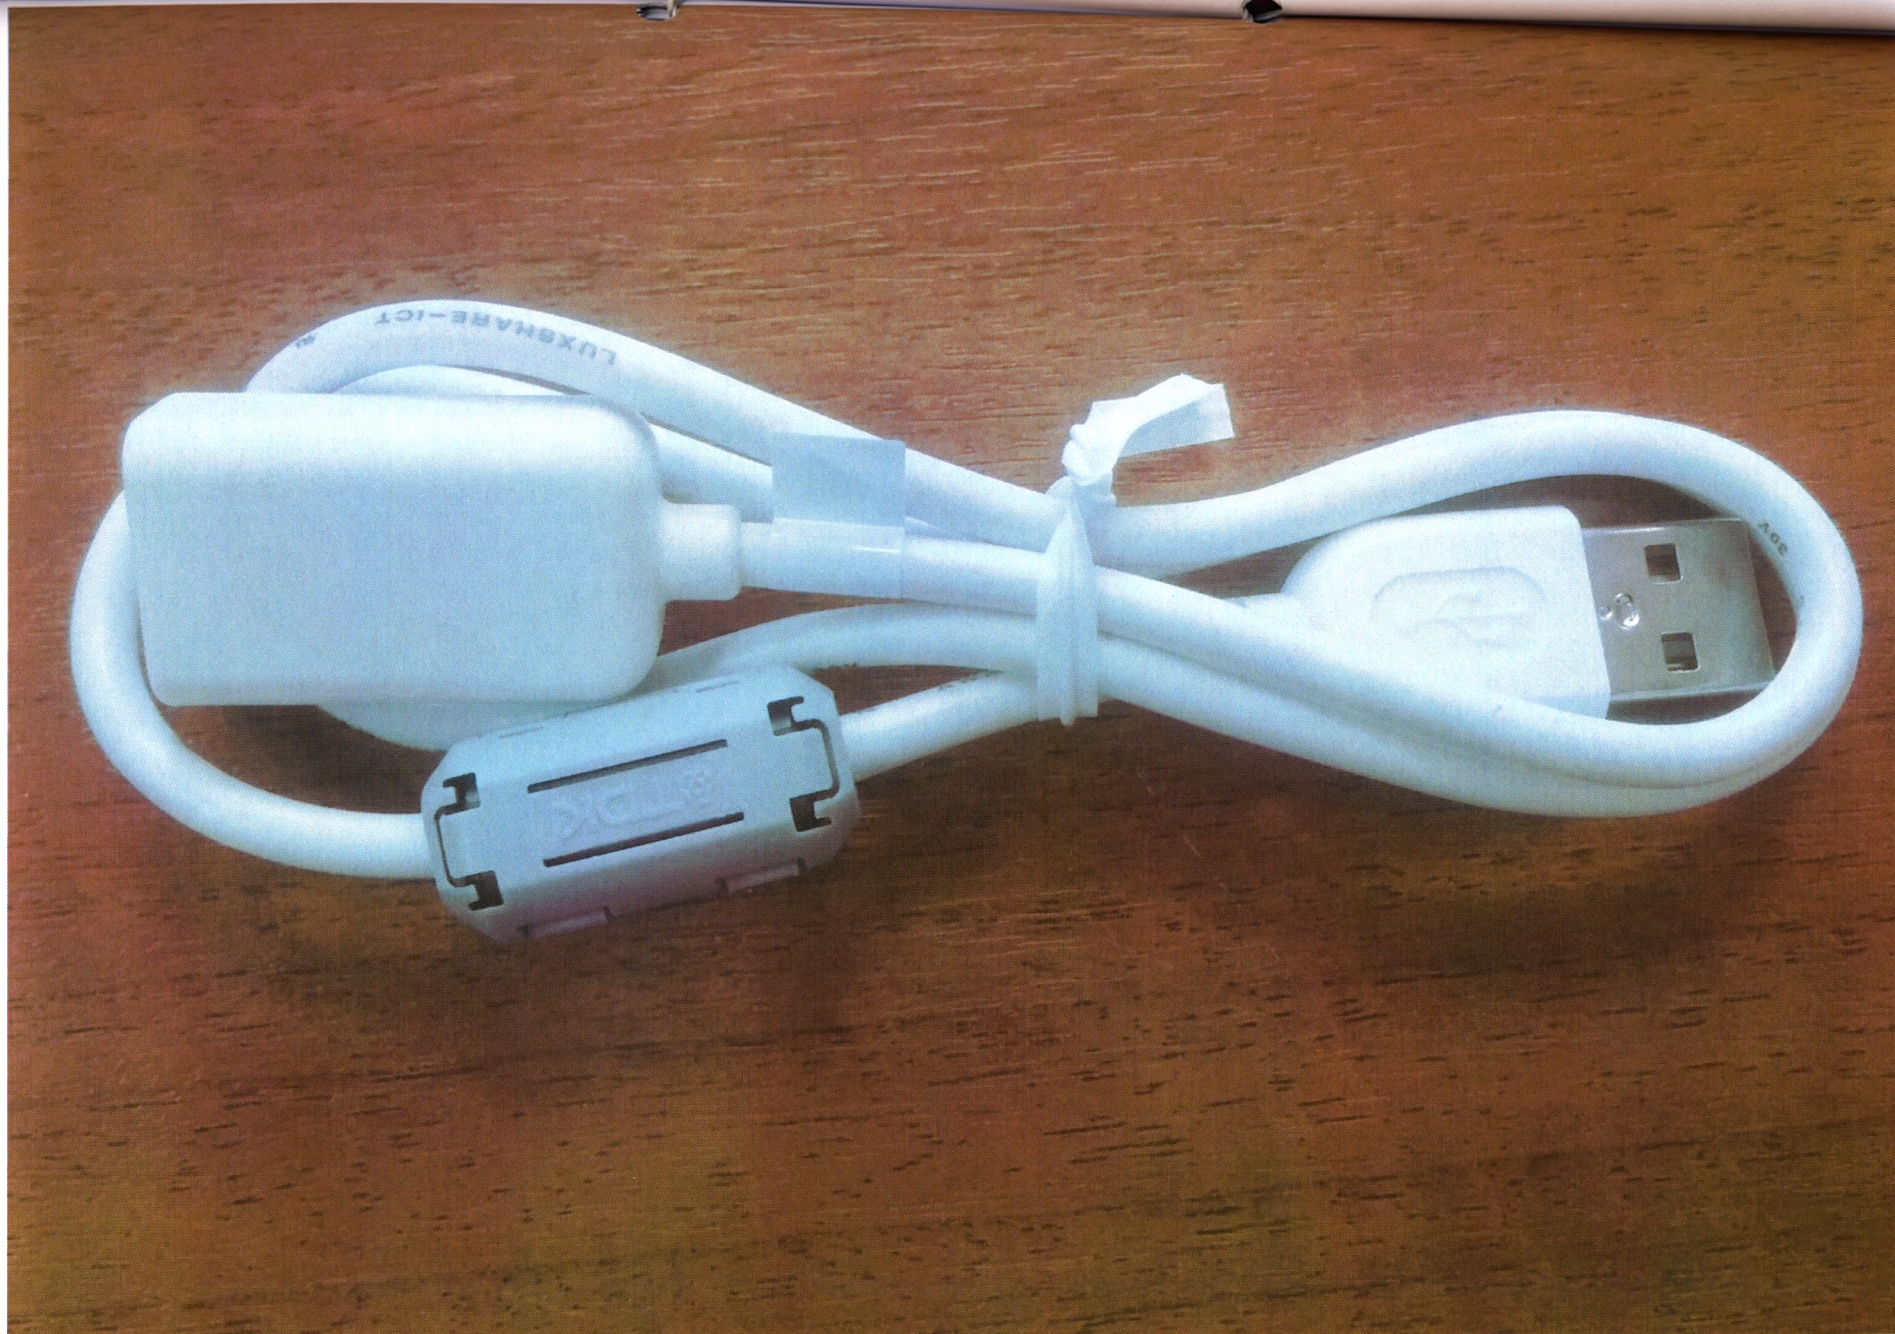

Удлинительный кабель флэш-накопителя USB 1-848-418-11

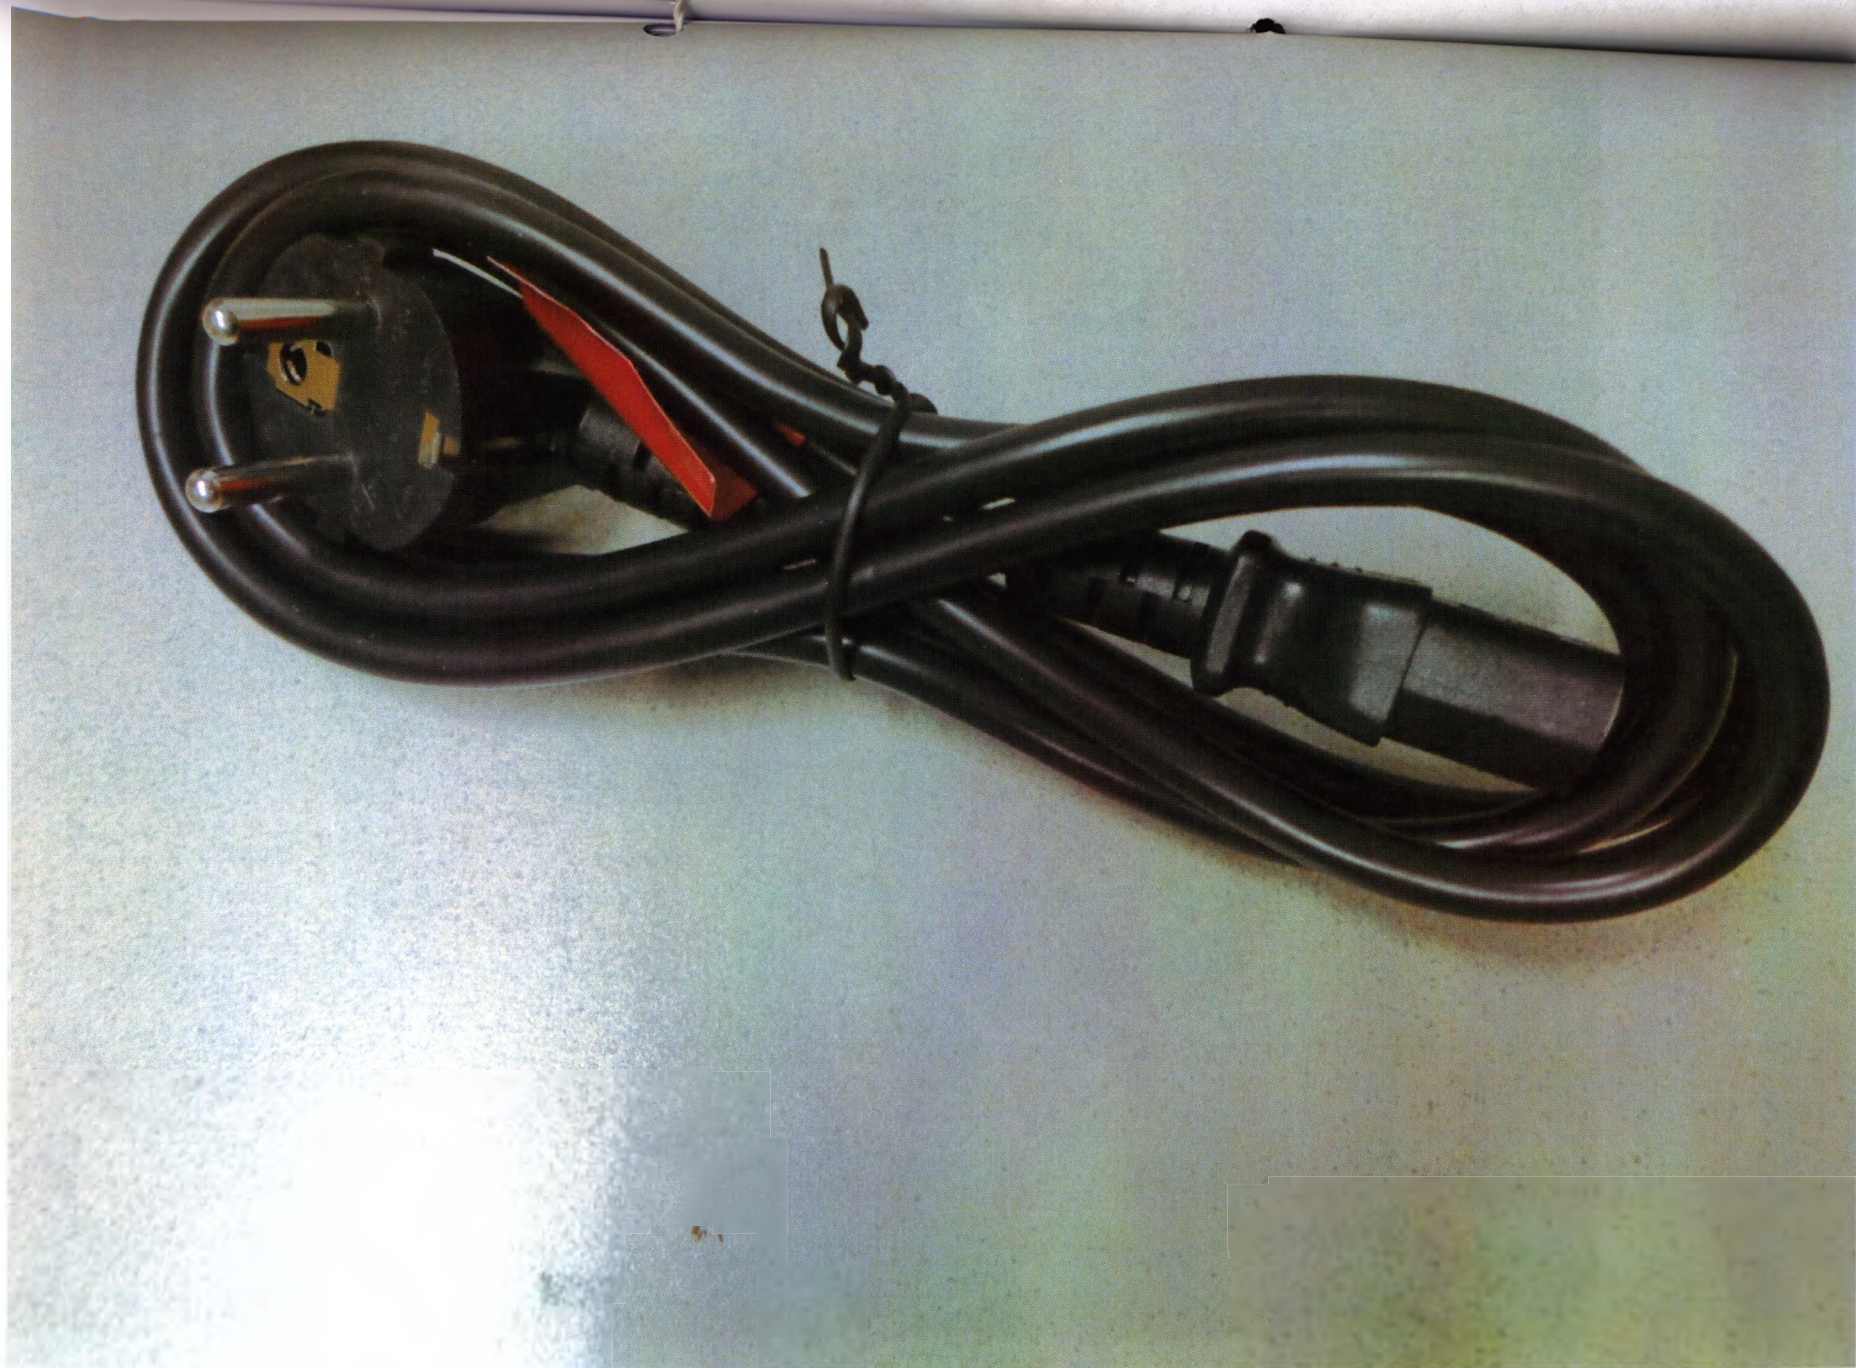

Кабель питания переменного тока



Компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver.1.00)



Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG

SONY®

REF 4-525-689-61-121

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕЧАТИ МОНОХРОМНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

UP-X898MD


EAC

© 2016 Sony Corporation

руководство пользователя




Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-971AD

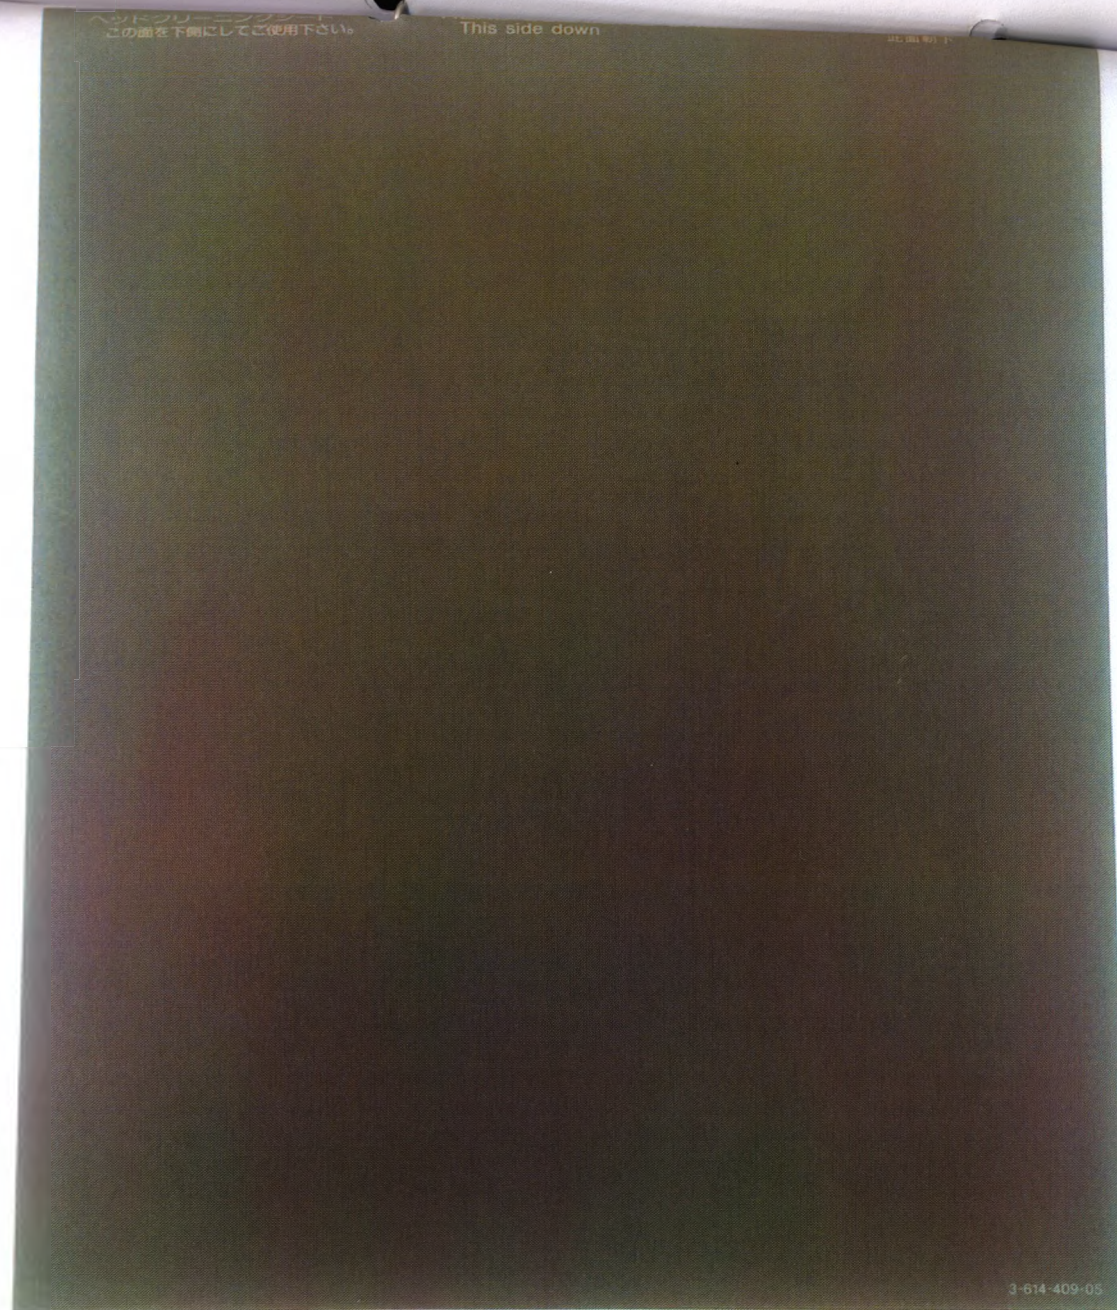

Лист для очистки термопечатающей головки (210 × 260 мм)



Кабель питания переменного тока

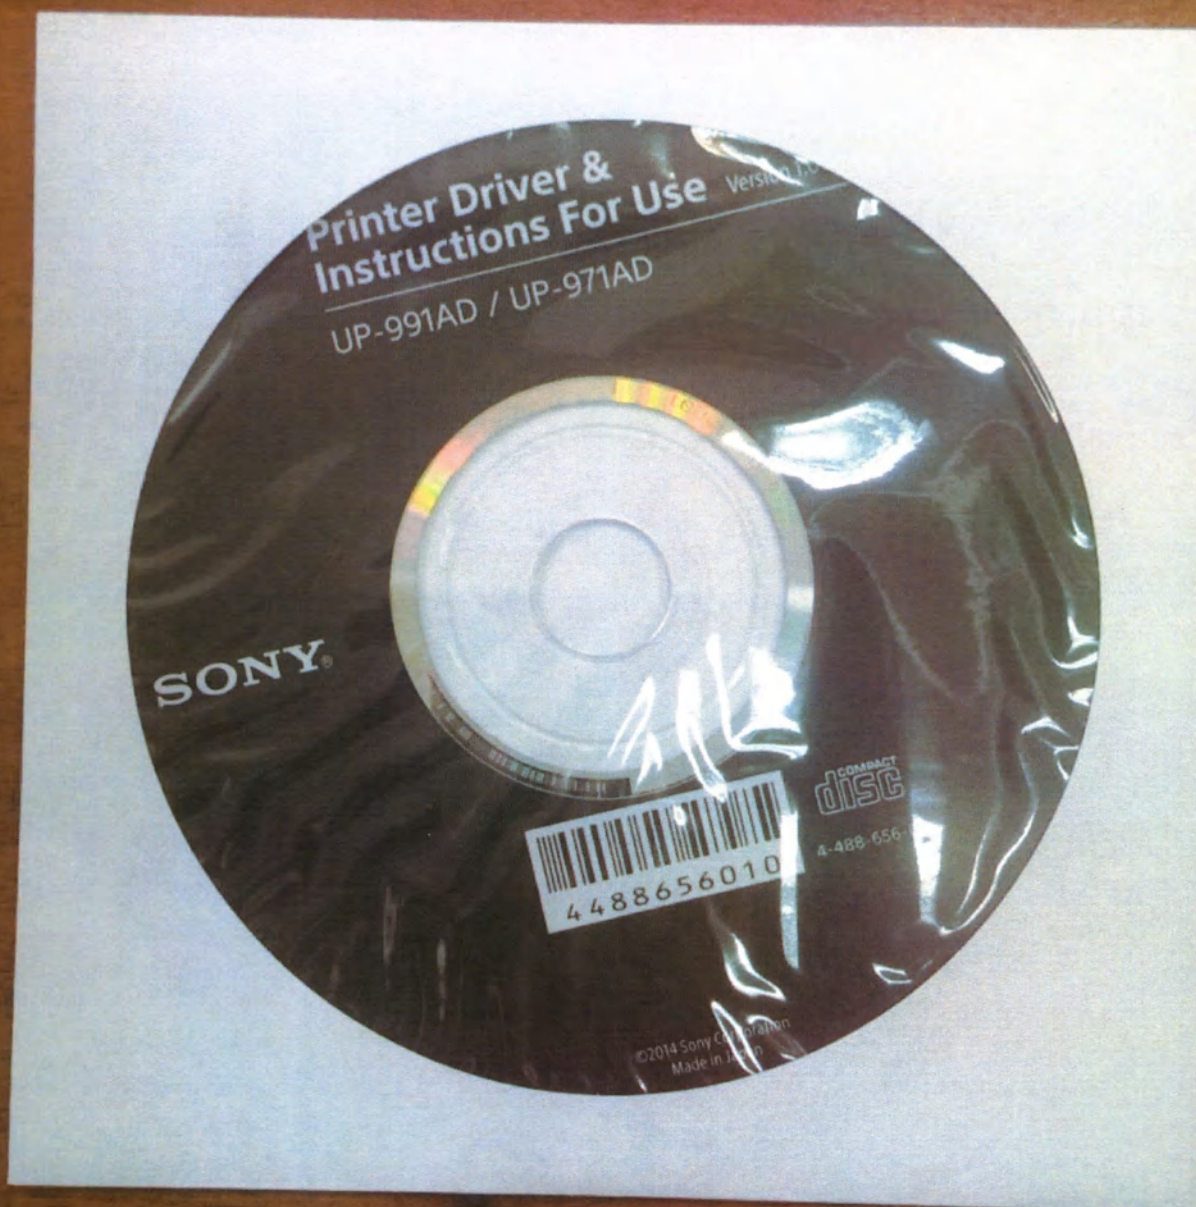

Компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver.1.00)



Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках: UPP-210HD

SONY

REP 4-498-652-61-11

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕЧАТИ МОНОХРОМНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

UP-991AD/UP-971AD

EAC

© 2016 Sony Corporation

Руководство пользователя



ヘッドクリーニングシート
この面を下側にしてご使用下さい。


HEAD CLEANING SHEET
This side down

打印头清洁纸
此面朝下

3-614-409-05

Лист для очистки термопечатающей головки (210 × 260 мм)



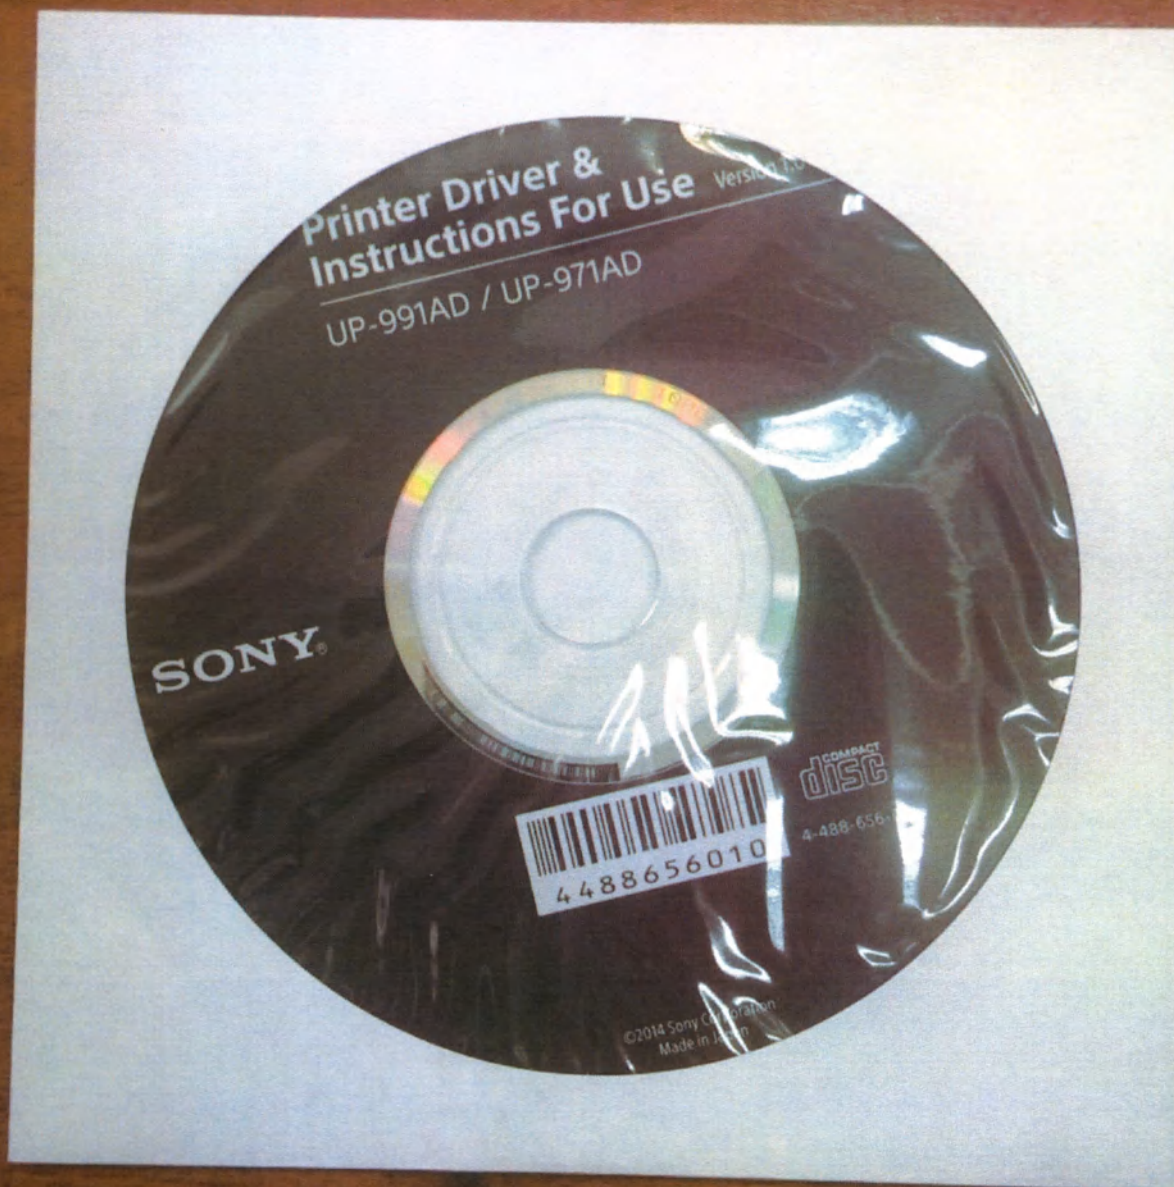

Компакт-диск с руководством по эксплуатации и ПО (Ver.1.00)



Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках: UPP-210HD

SONY

REF: 4-458-079-01-11

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕЧАТИ МОНОХРОМНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

UP-991AD/UP-971AD

EAC

© 2016 Sony Corporation

Руководство пользователя