


Директор Бизнес - подразделения

«Портативные системы в лабораторной диагностике»


А.Е.Самохвалова
«5»  2017 г.


Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

«Кассета для анализа мочи CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Urinalysis Cassette) в вариантах исполнения, с принадлежностями»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), США

Фото 1. Кассета для анализа мочи CLINITEK Novus PRO12 (CLINITEK Novus PRO 12 Urinalysis Cassette)



Фото 2. Кассета для анализа мочи CLINITEK Novus 10 (CLINITEK Novus 10 Urinalysis Cassette)


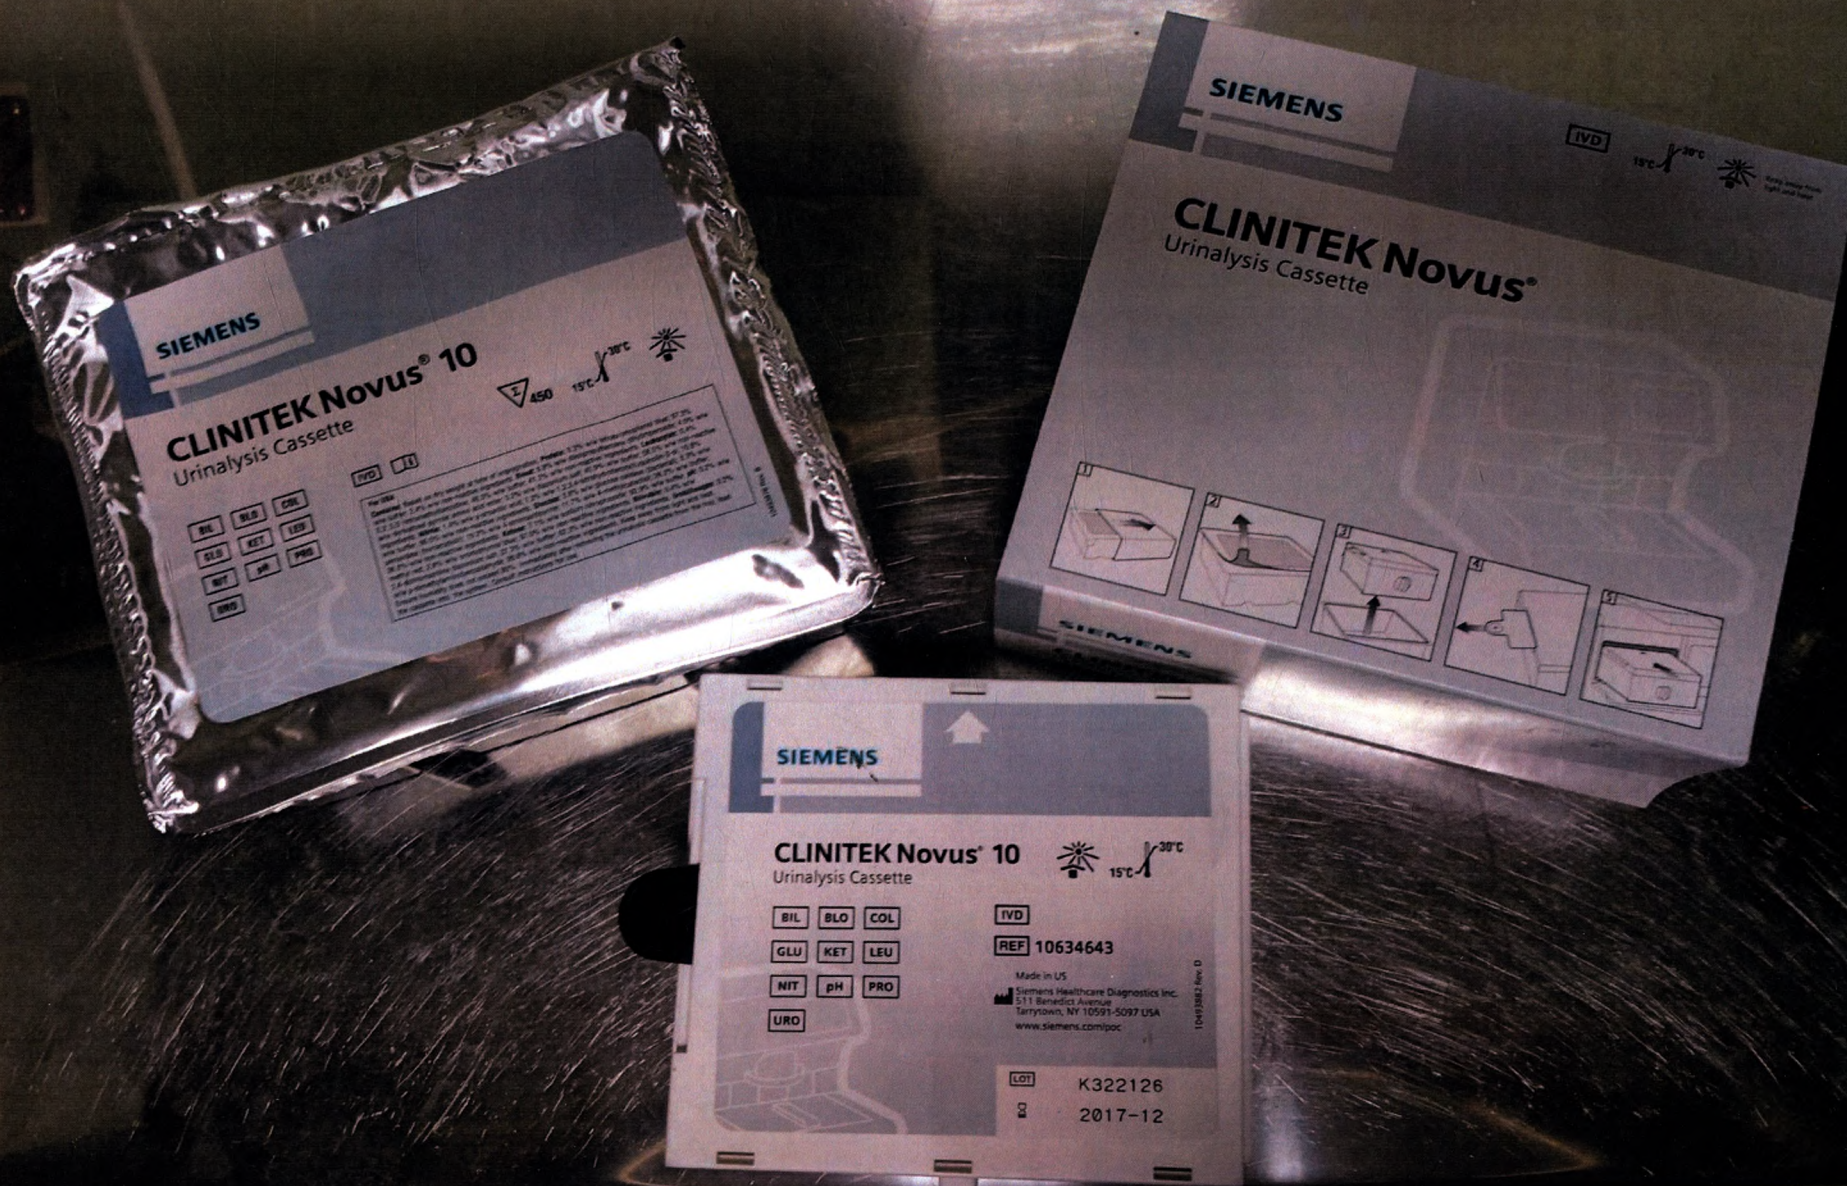


Фото 3. Концентрат промывочного раствора CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Rinse Additive)



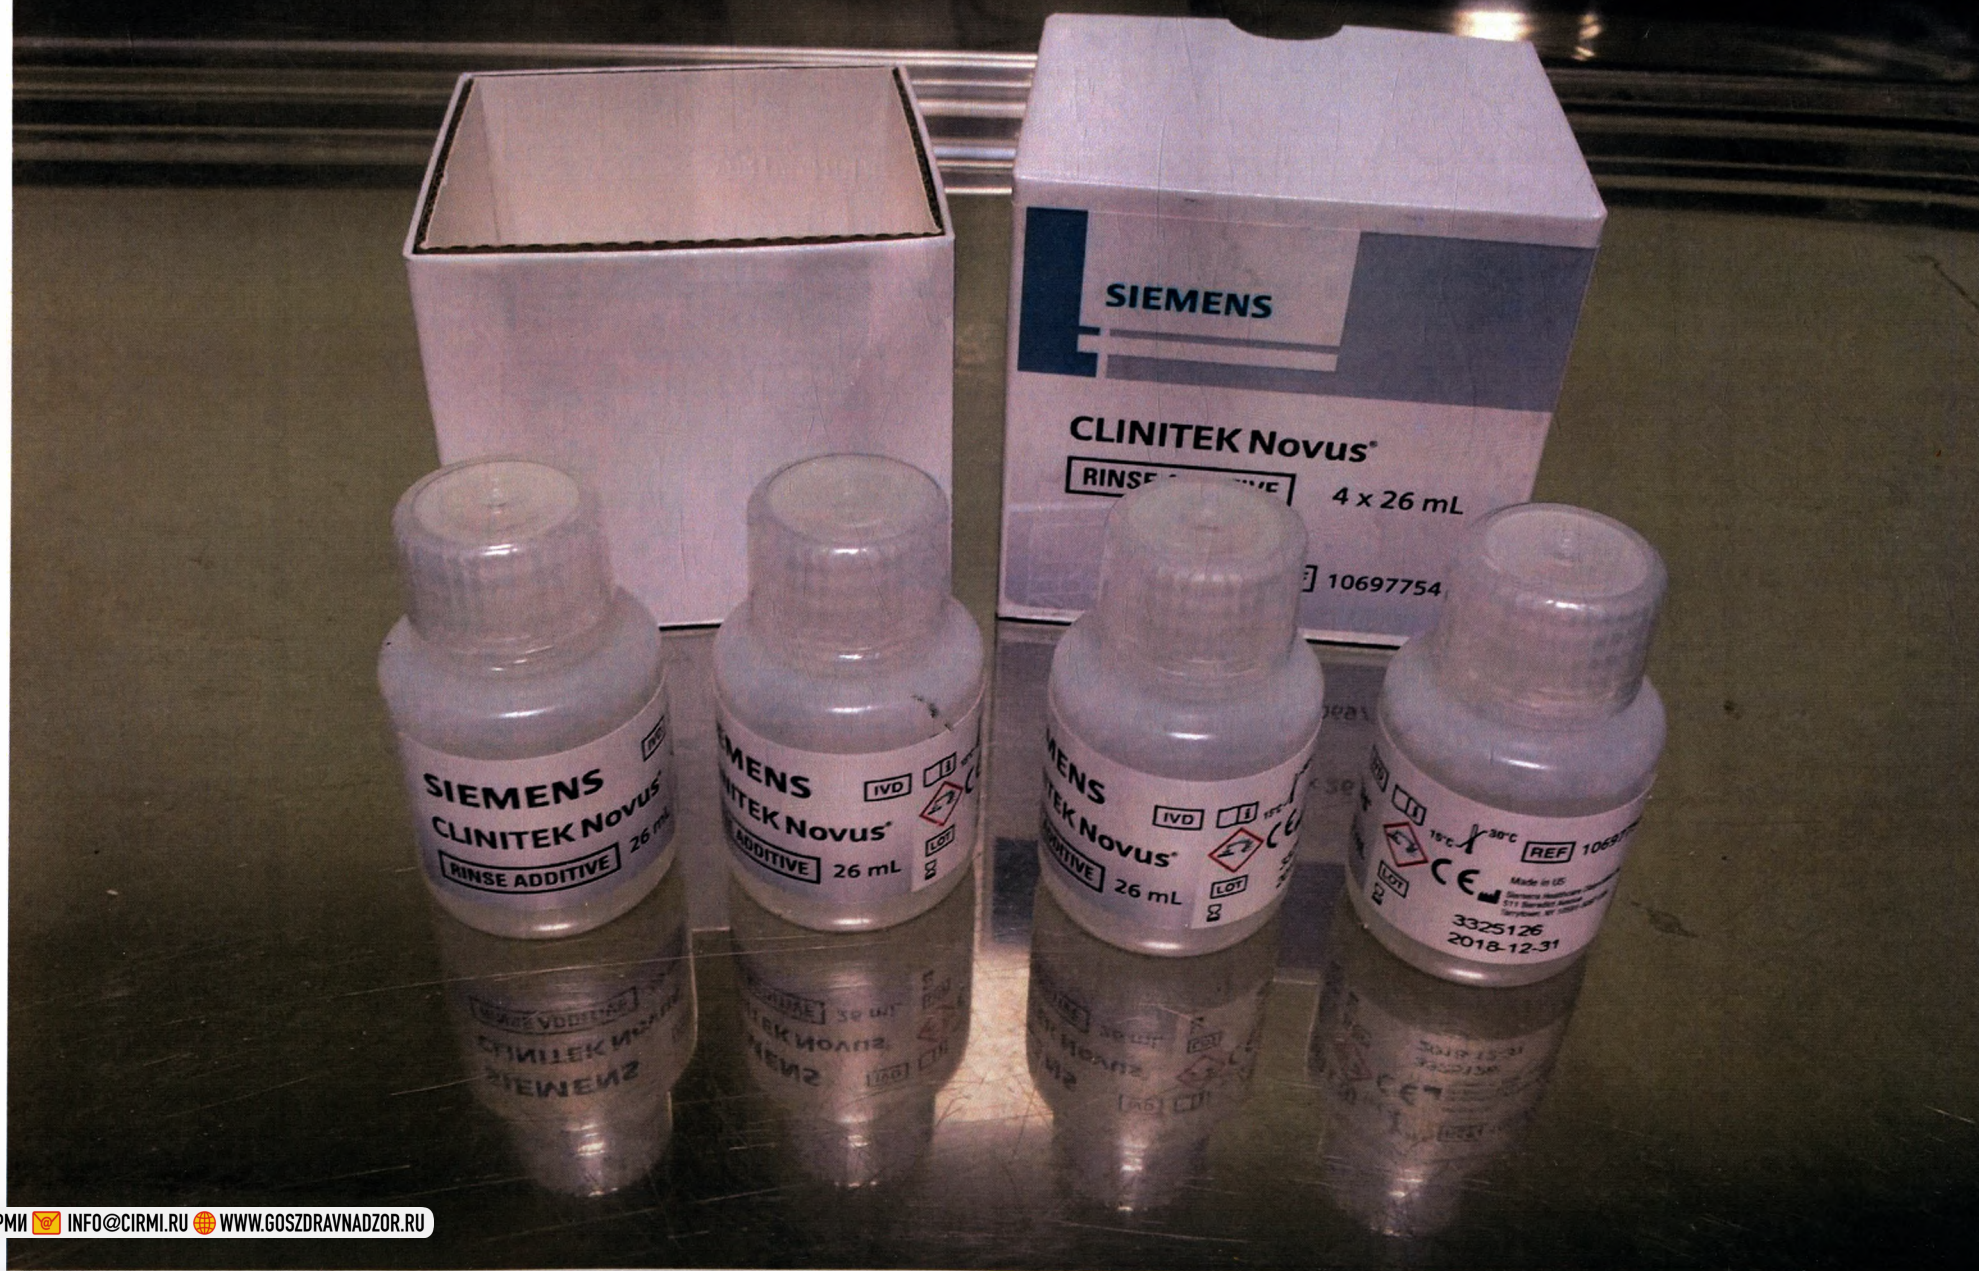

Всего прошито/пронумеровано

4 листа (ов)

А.Е. Куликов / А.Е. Куликов
Подпись ФИО

