

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «С.П.ГЕЛПИК»


А.Б.Самойлов

«31» августа 2018 г.



Фотографии медицинского изделия:

СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ DMX-600

производства «ДЖЕНОРЭЙ Ко., Лтд.», Корея

2018 г.

Список фотографий

на медицинское изделие: «СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ DMX-600»

- Рис 1. - Штатив устройства со встроенным излучателем моноблочного типа;
- Рис 2. - Устройство мобильное рентгеновское питающее;
- Рис 3. - Тумба мобильная;
- Рис 4. - Стекло рентгенозащитное для тумбы мобильной;
- Рис 5. - Переключатель экспозиции ручной;
- Рис 6. - АРМ управления аппаратом:
- (1) - Блок системный;
 - (2) - Монитор не менее 17 дюйм;
 - (3) - Клавиатура;
 - (4) - Манипулятор типа мышь;
 - (5) - Кронштейн для монитора;
- Рис 7. - Экран защитный лица пациента;
- Рис 8. - Устройство увеличивающее (x1.5);
- Рис 9. - Устройство увеличивающее (x1.8);
- Рис 10. - Лопатка стандартная для увеличивающего устройства (x1.5);
- Рис 11. - Лопатка стандартная для увеличивающего устройства (x1.8);
- Рис 12. - Лопатка для прицельных снимков для увеличивающего устройства (x1.5);
- Рис 13. - Лопатка для прицельных снимков для увеличивающего устройства (x1.8);
- Рис 14. - Лопатка стандартная компрессионная;
- Рис 15. - Лопатка для подмышечной проекции (укладки);
- Рис 16. - Лопатка мягкая, длина 352.3 мм, высота 300 мм, ширина 249 мм;
- Рис 17. - Лопатка мягкая, длина 352.3 мм, высота 340 мм, ширина 249 мм;
- Рис 18. - Лопатка биопсийная;
- Рис 19. - Лопатка для прицельных снимков;
- Рис 20. - Фильтр родиевый;
- Рис 21. - Монитор медицинский монохромный;
- Рис 22. - АРМ врача;
- Рис 23. - Фантом для калибровки;
- Рис 24. - Ключ активации PACS;
- Рис 25. - Блок из двух ножных педалей для управления аппаратом;
- Рис 26. - Руководство по эксплуатации.

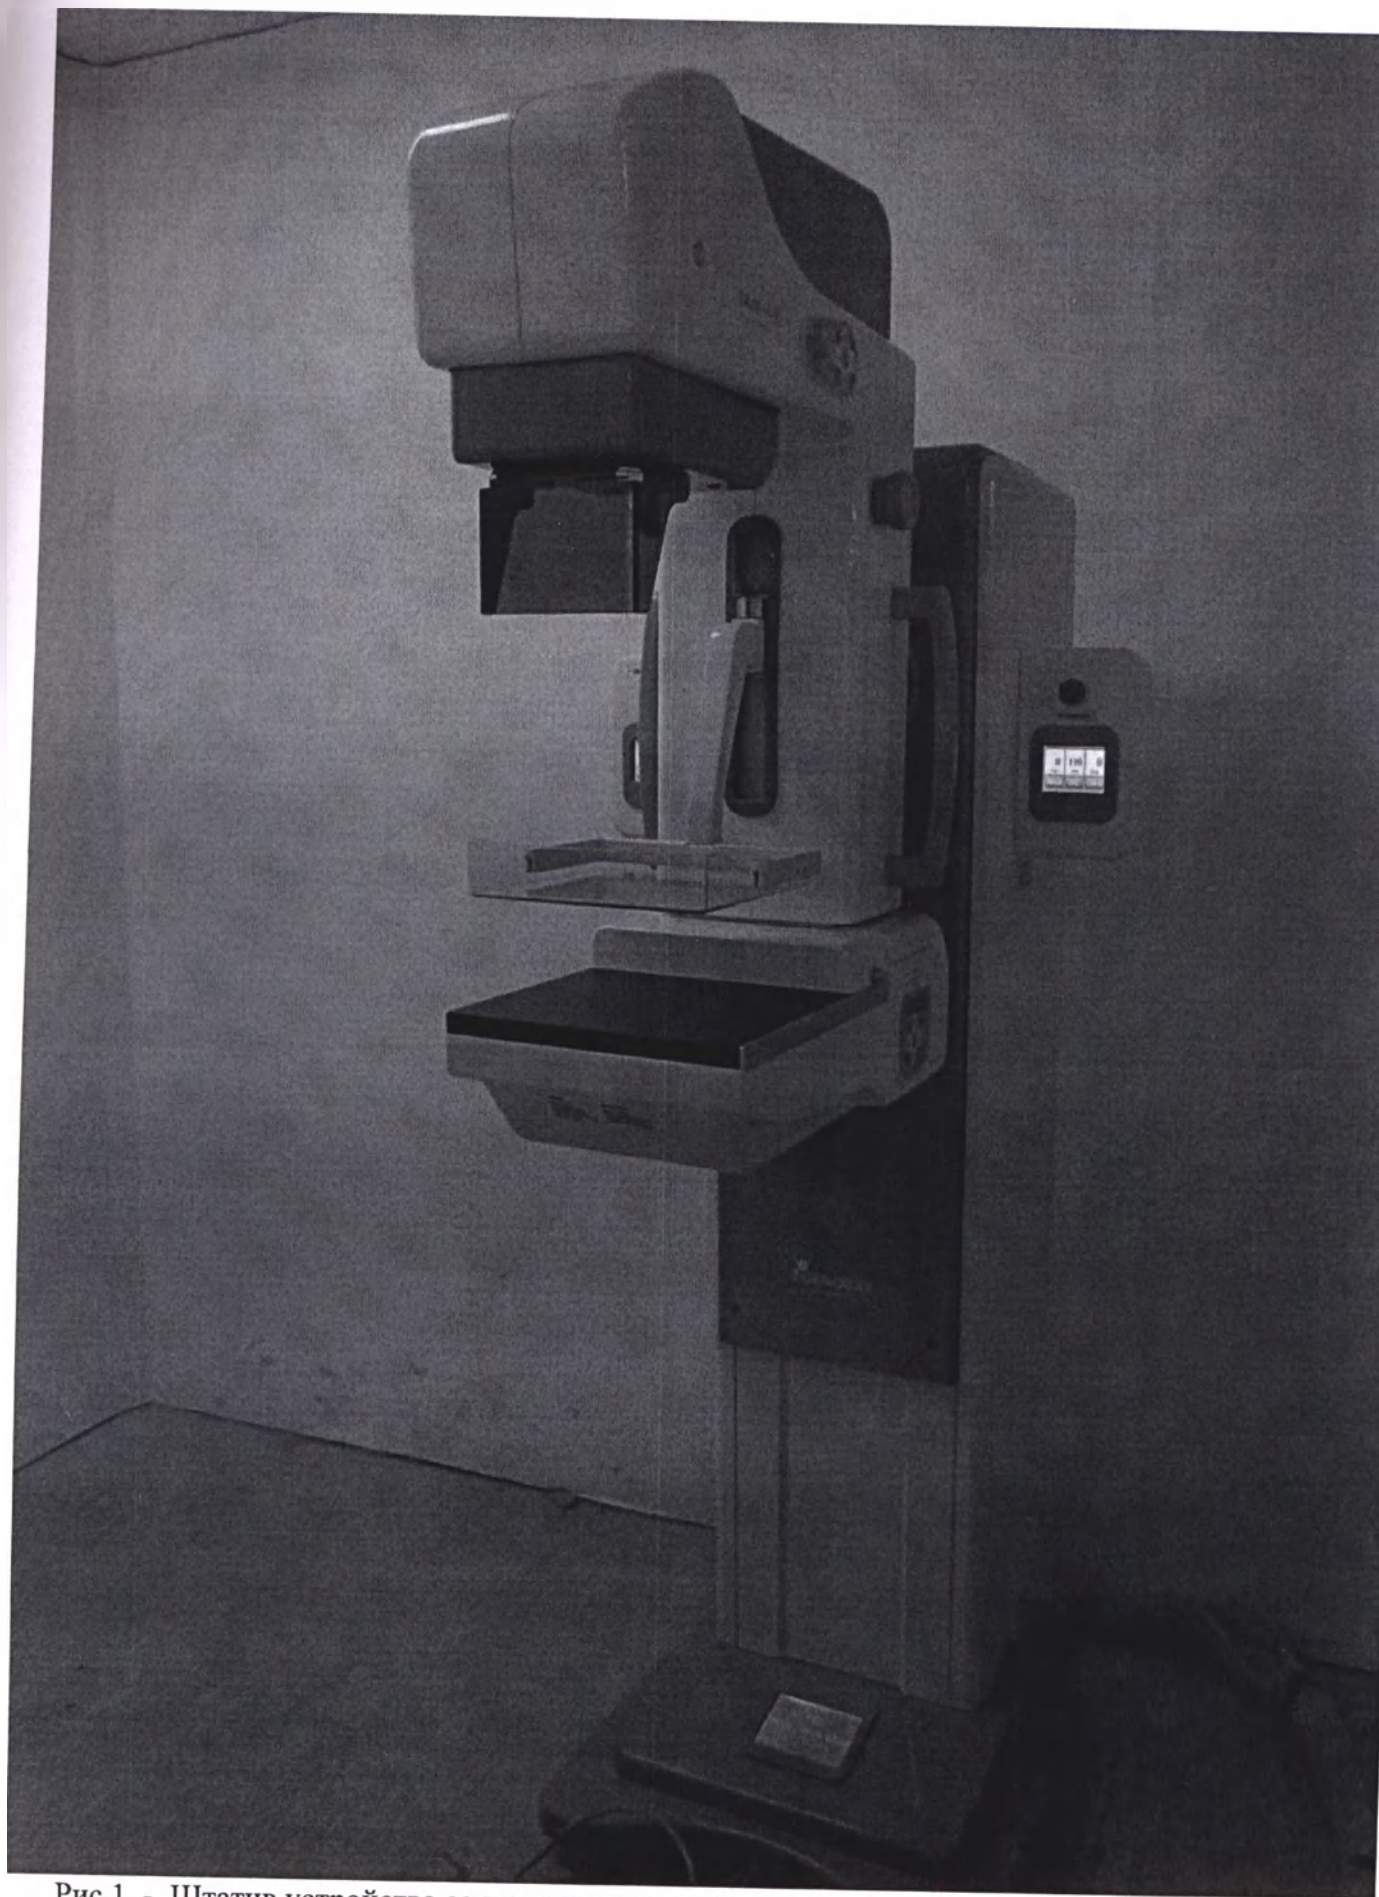


Рис 1. - Штатив устройства со встроенным излучателем моноблочного типа;

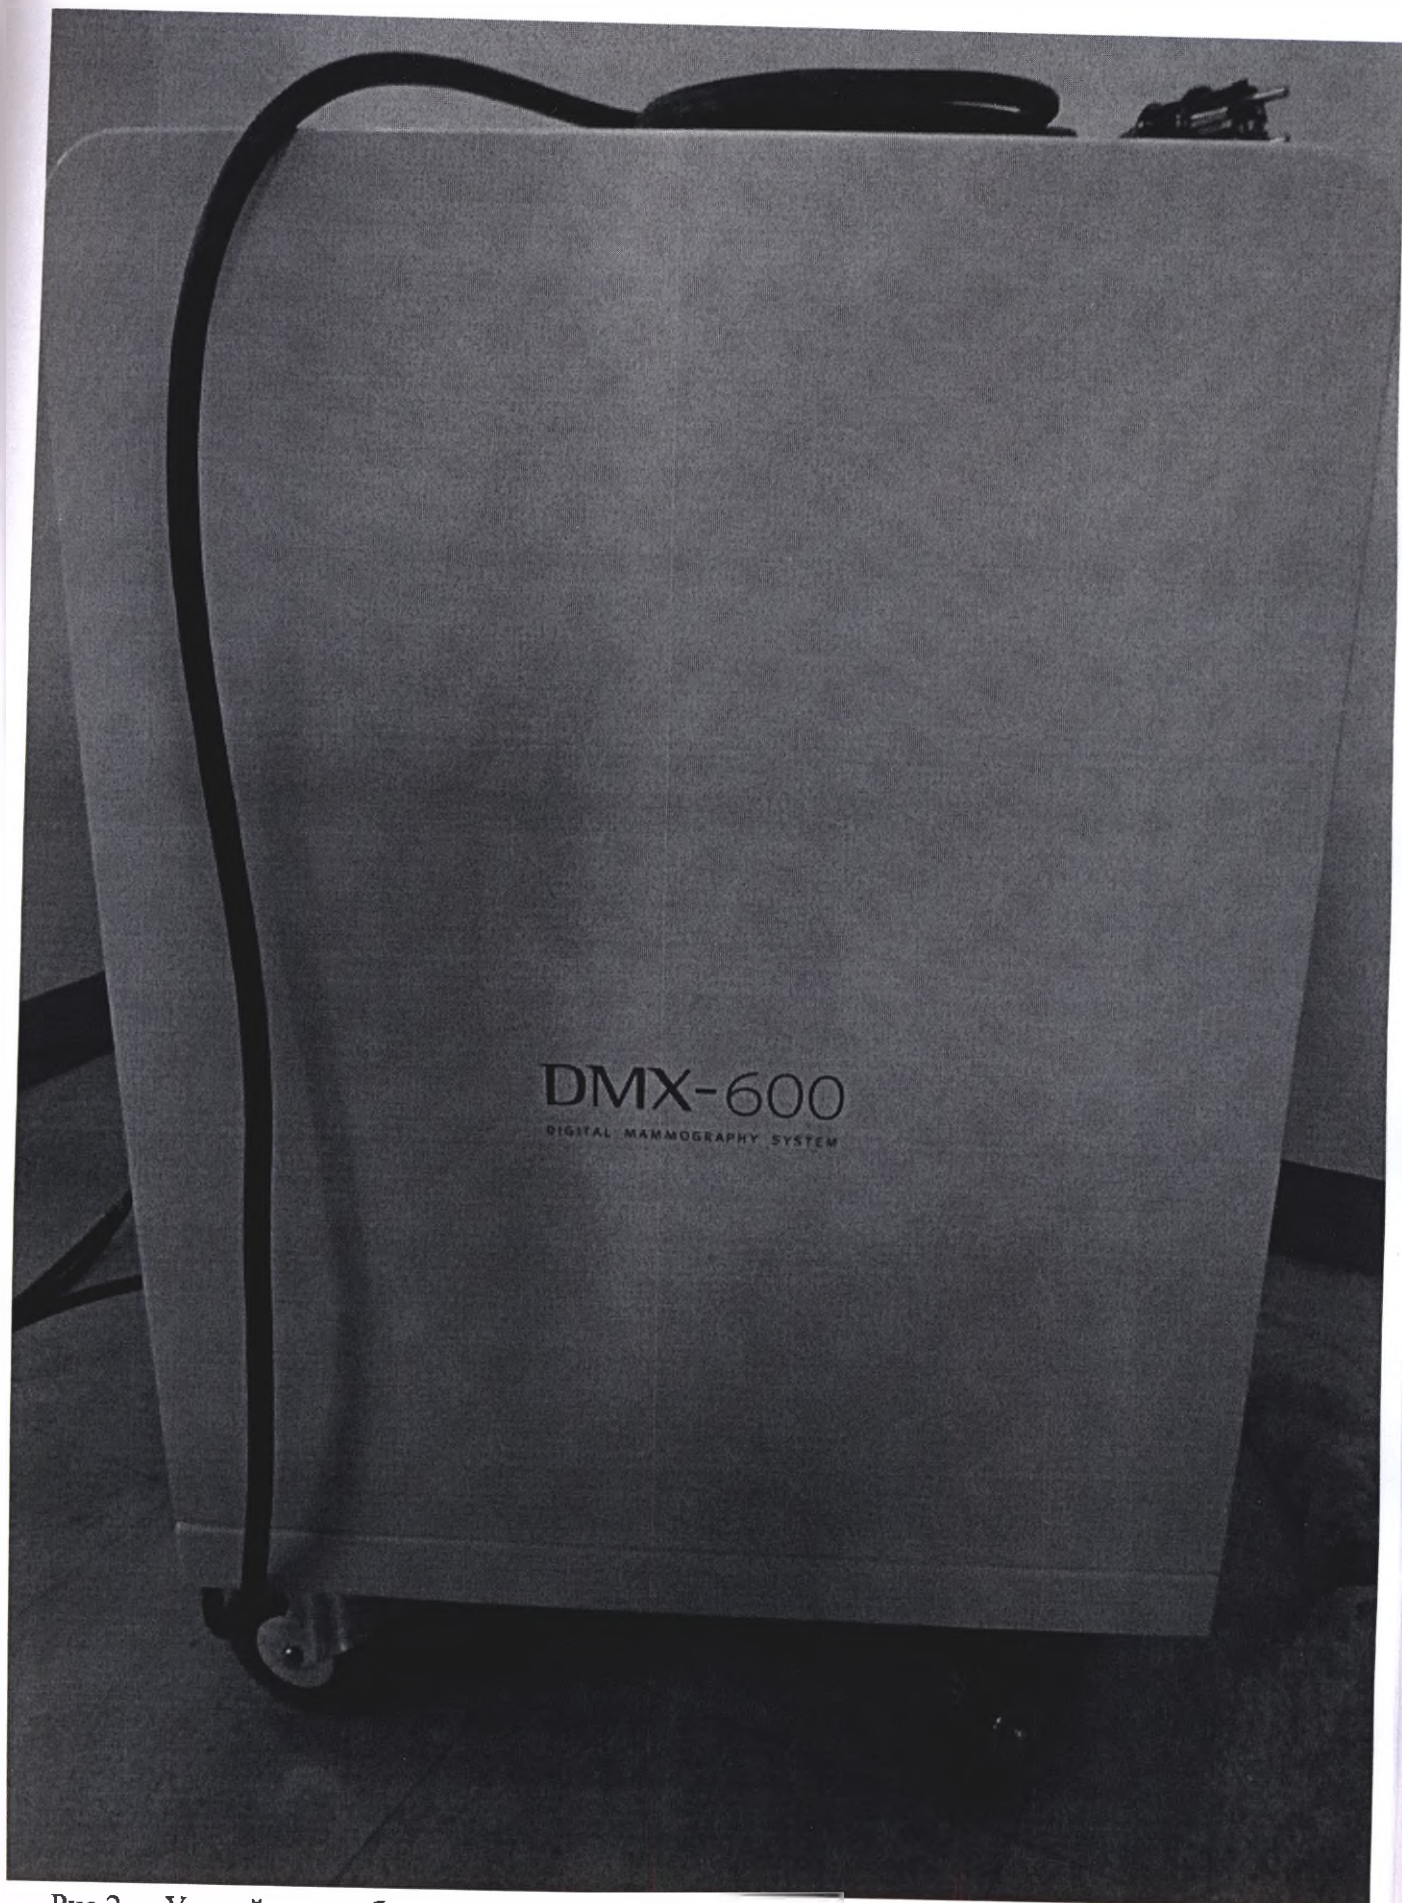


Рис 2. - Устройство мобильное рентгеновское питающее;



Рис 3. - Тумба мобильная;

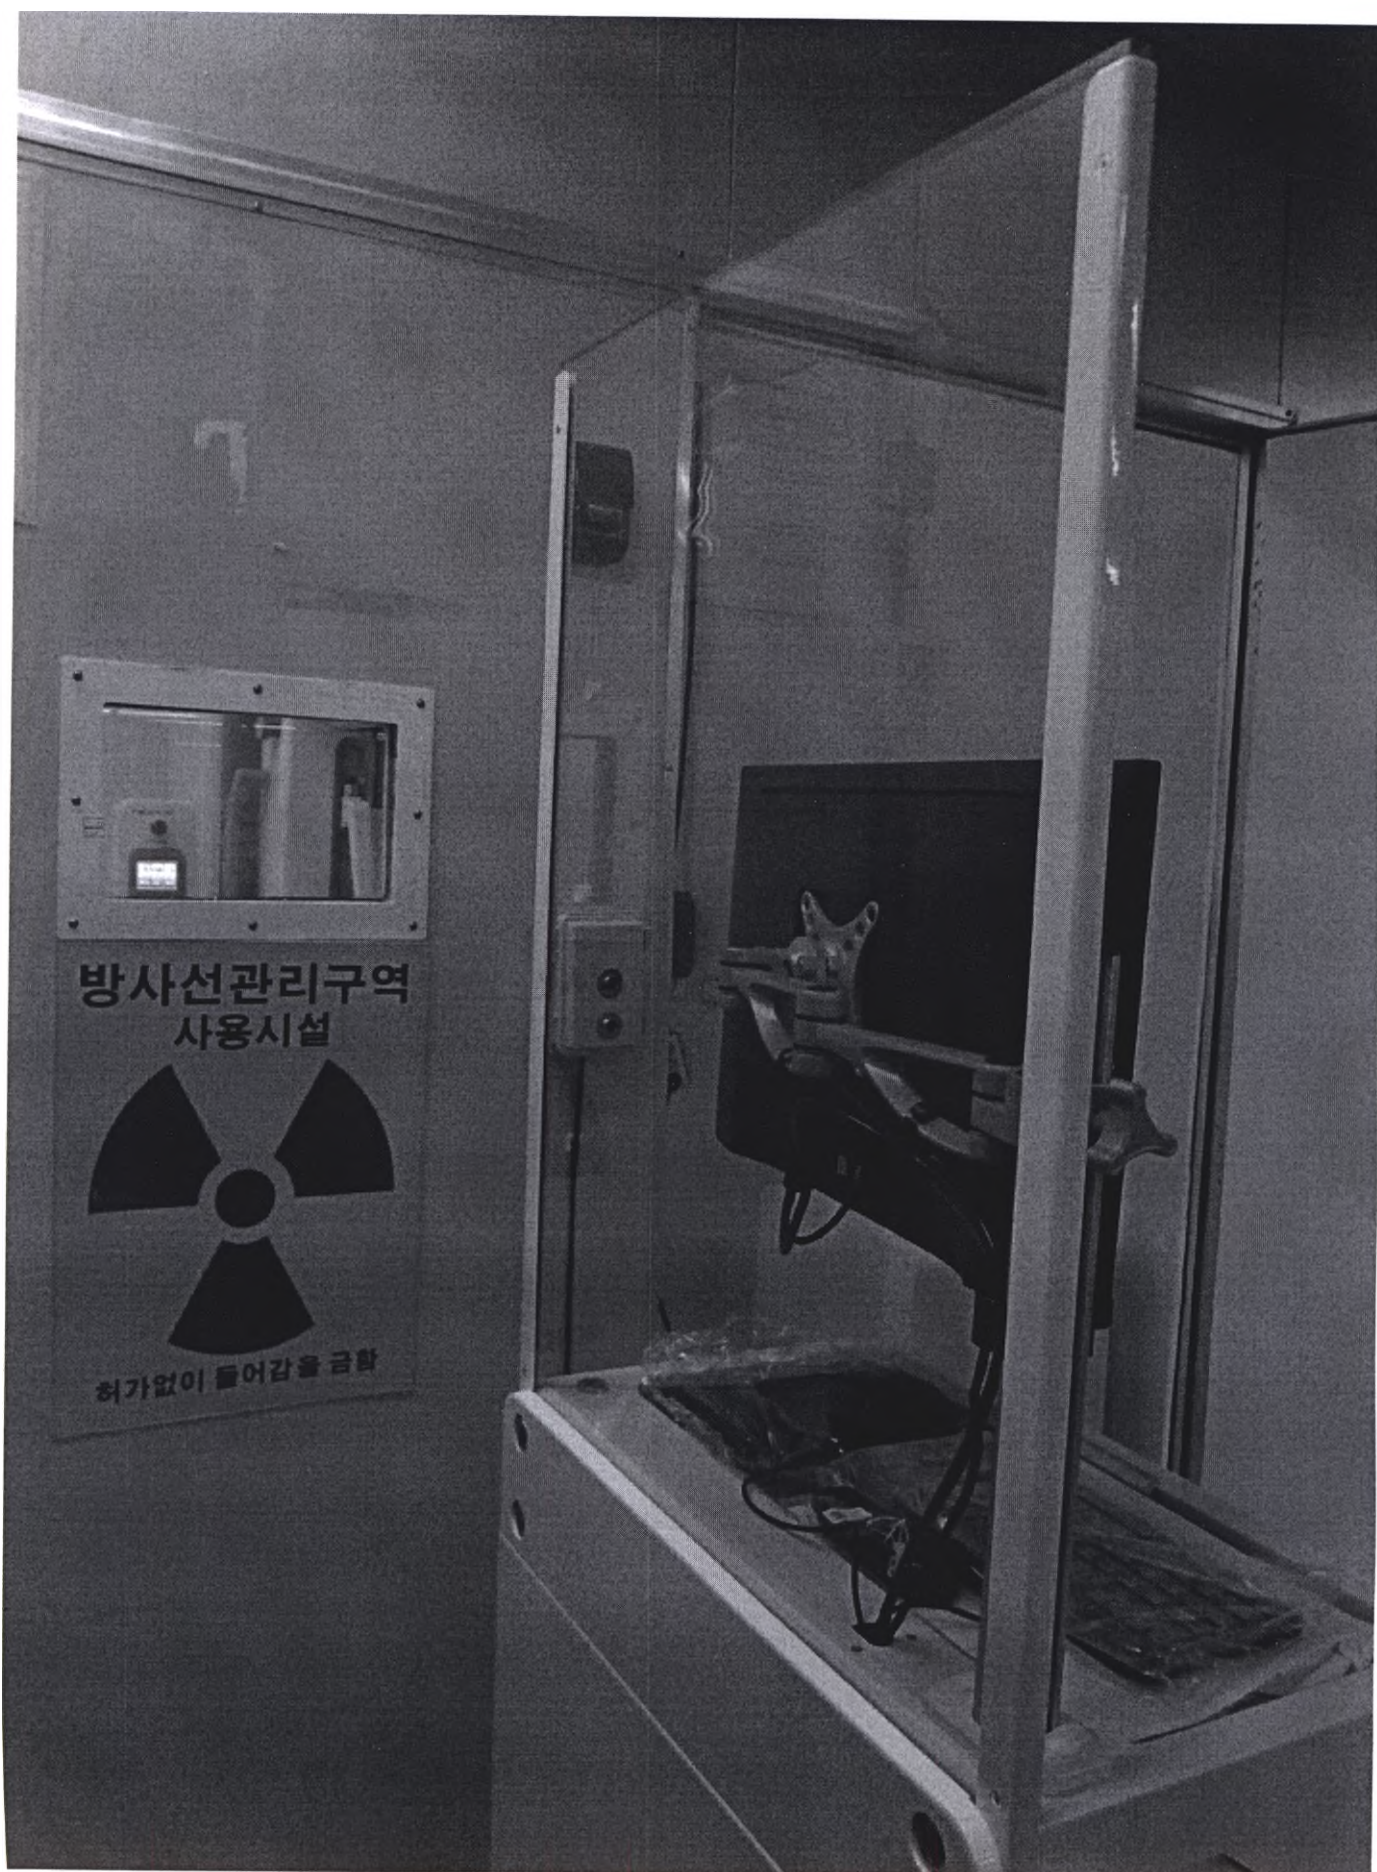


Рис 4. - Стекло рентгенозащитное для тумбы мобильной;

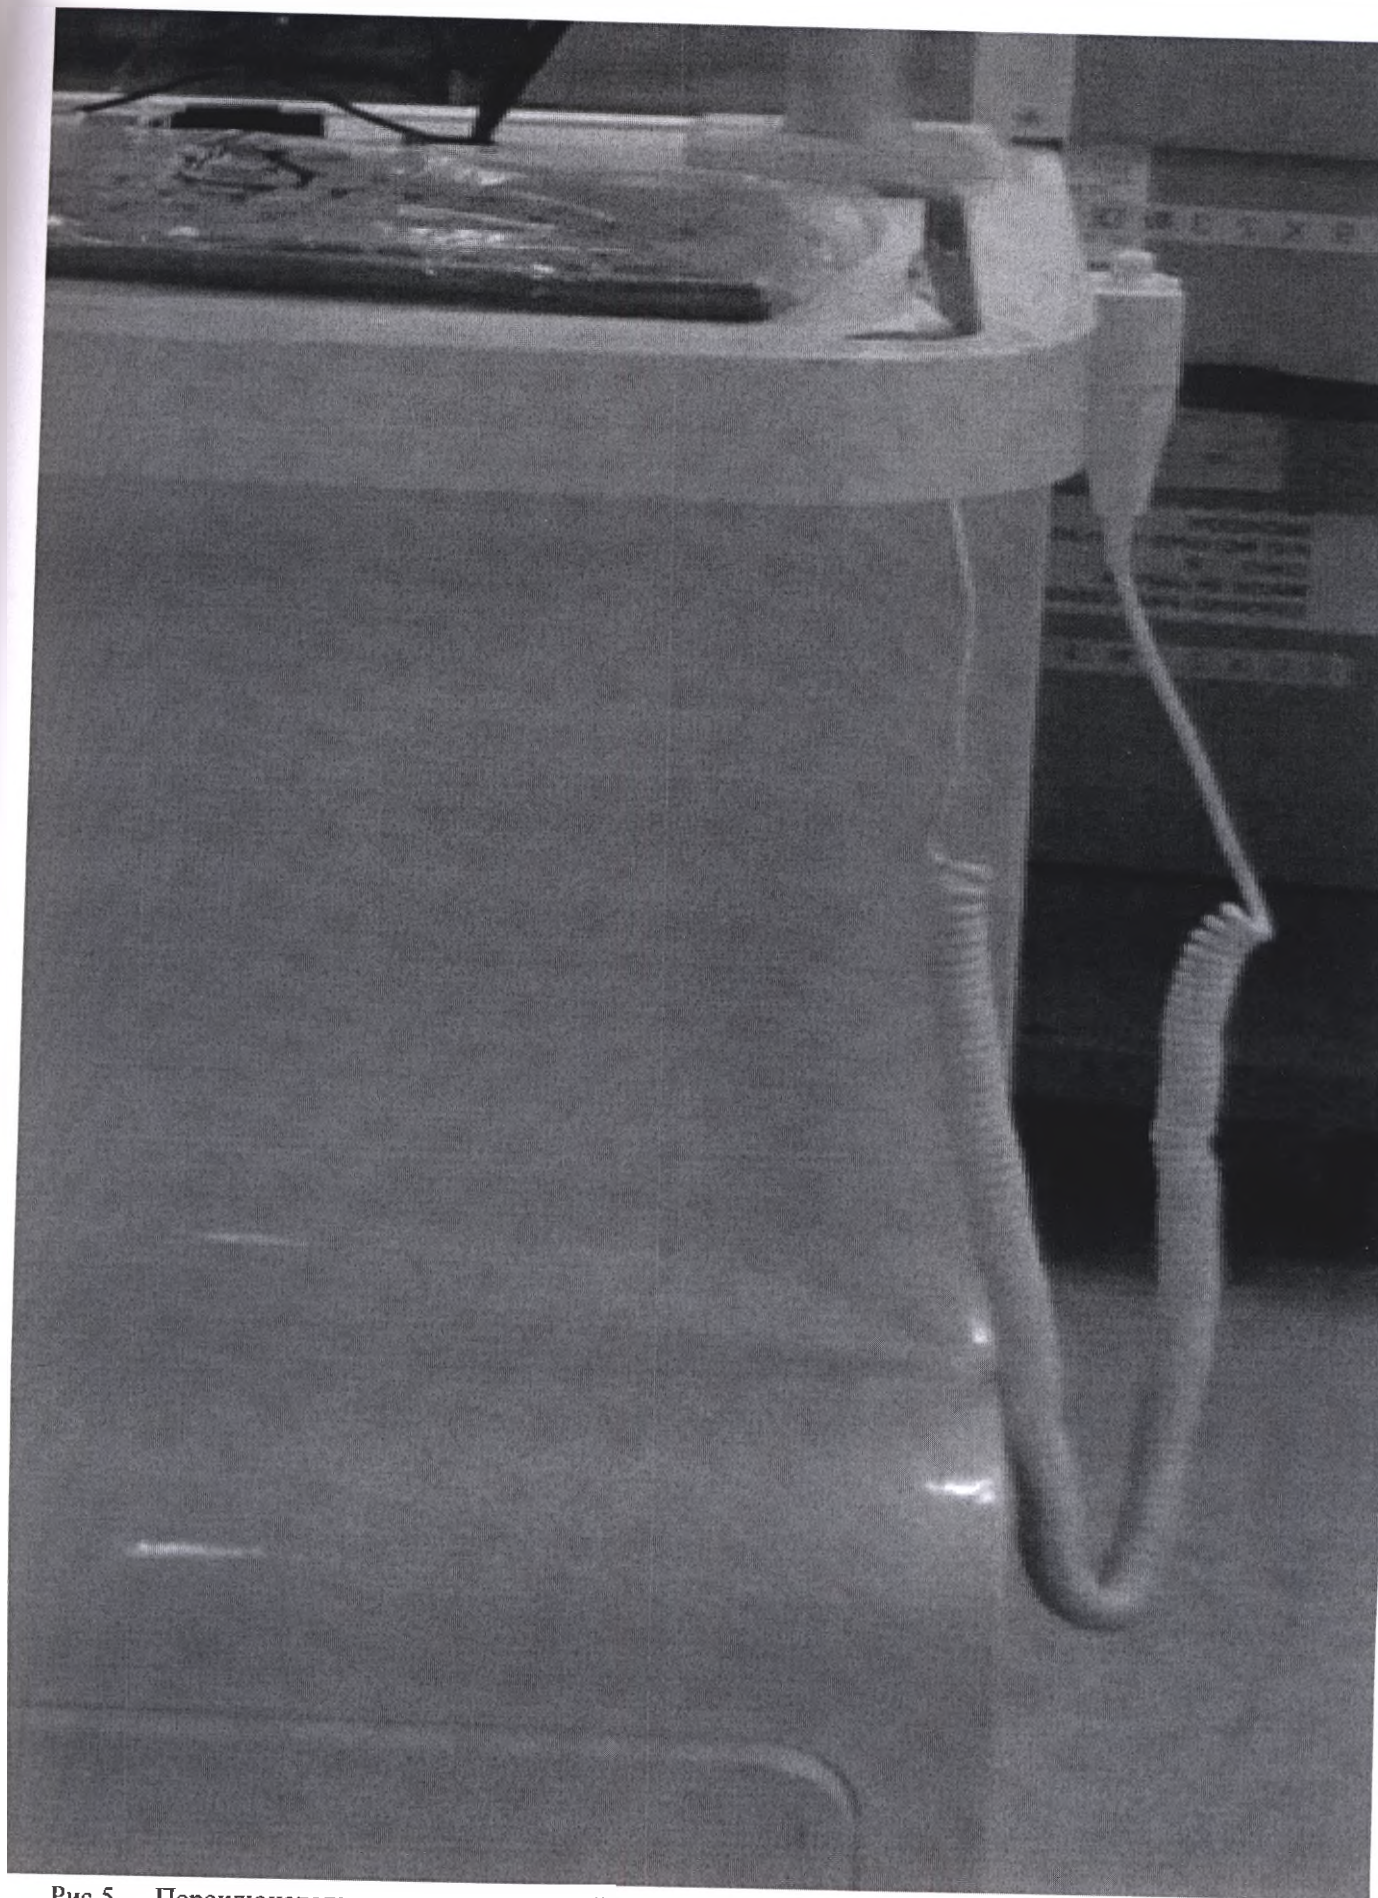


Рис 5. - Переключатель экспозиции ручной;

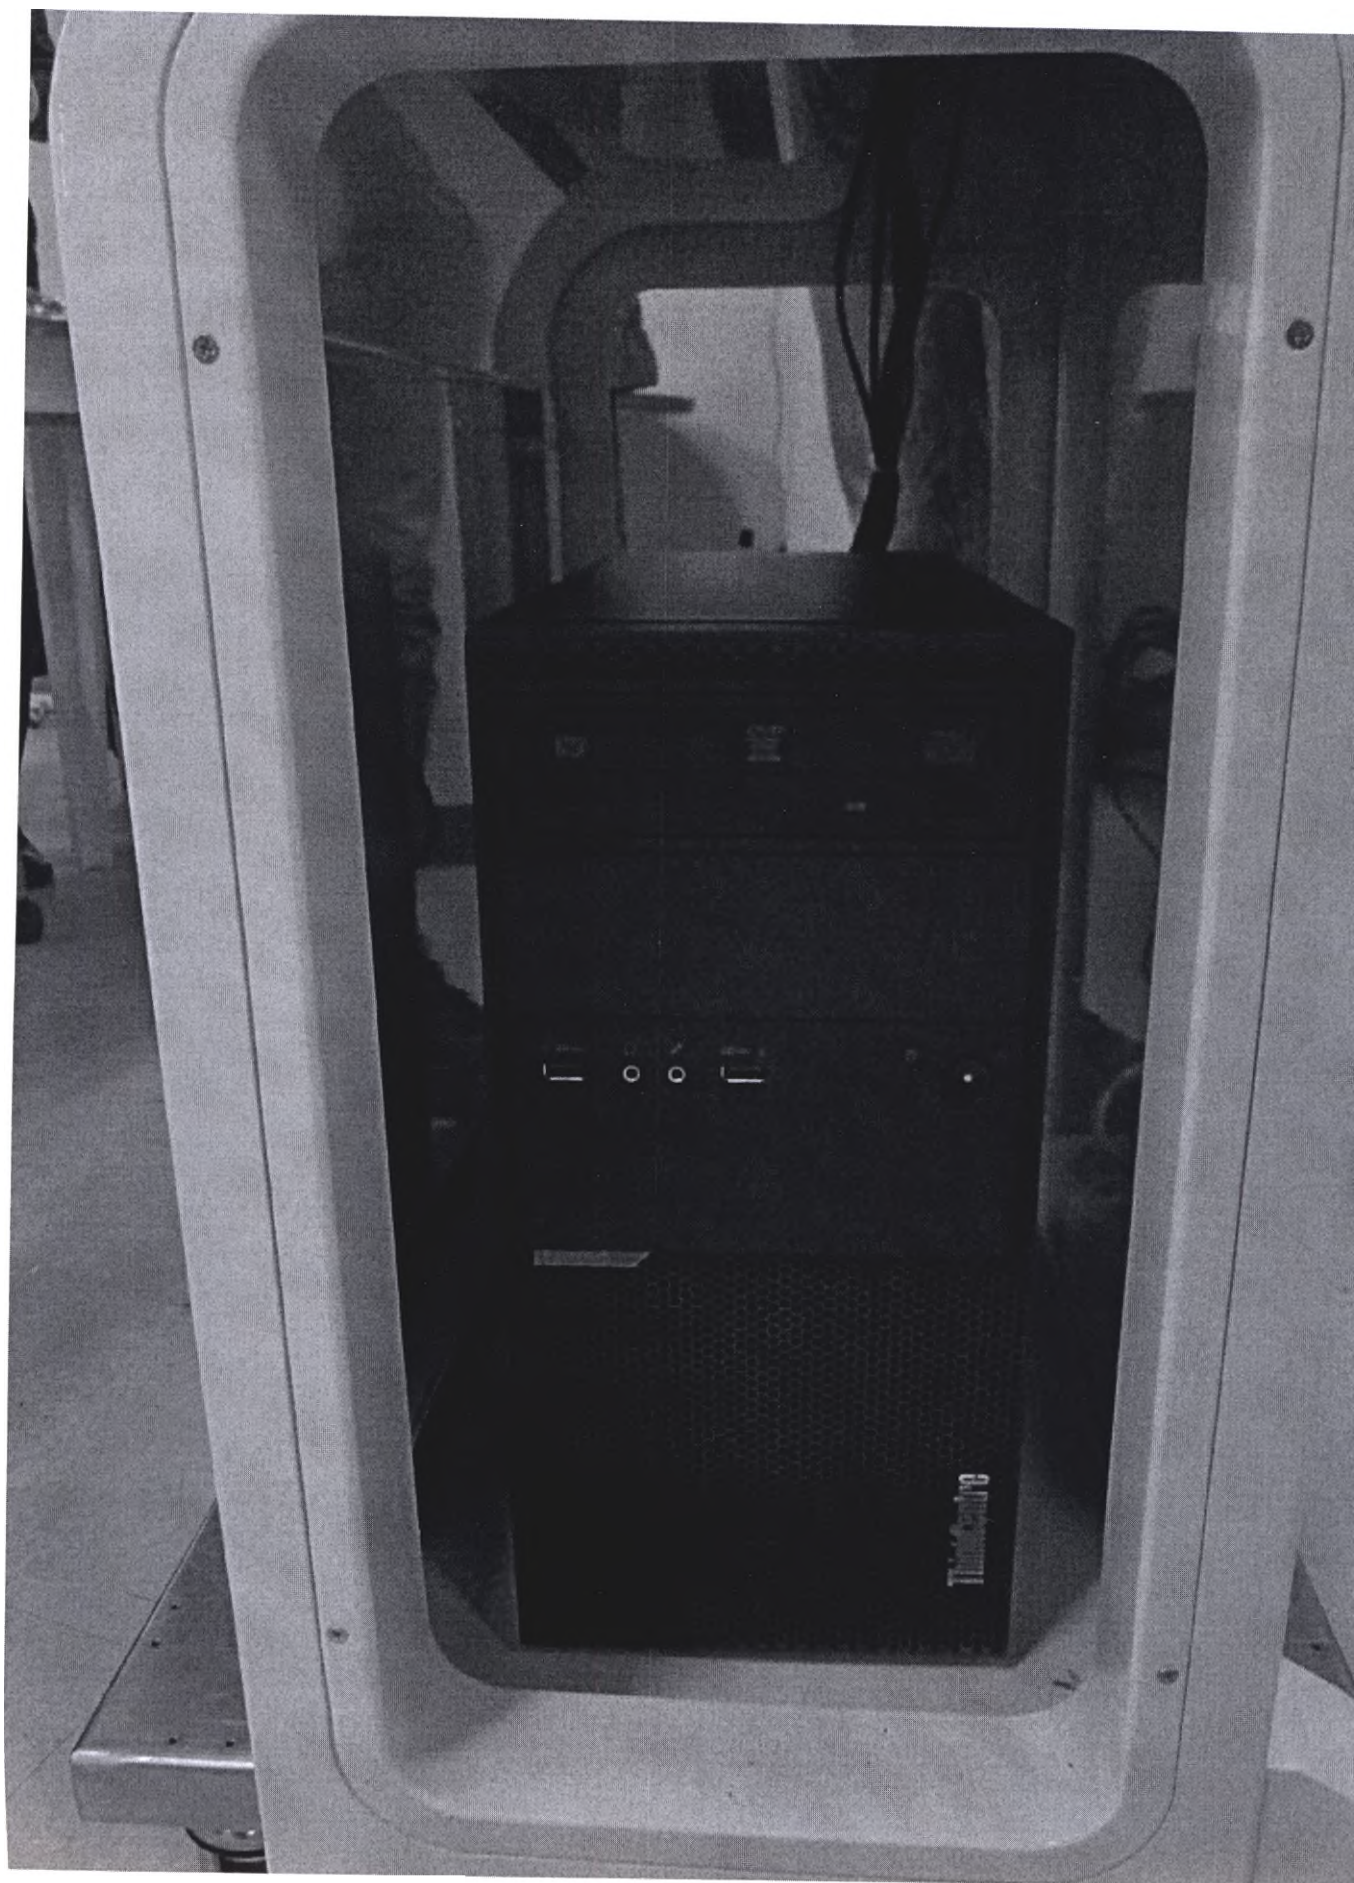


Рис 6. (1). - Блок системный;



Рис 6. (2). - Монитор не менее 17 дюйм;

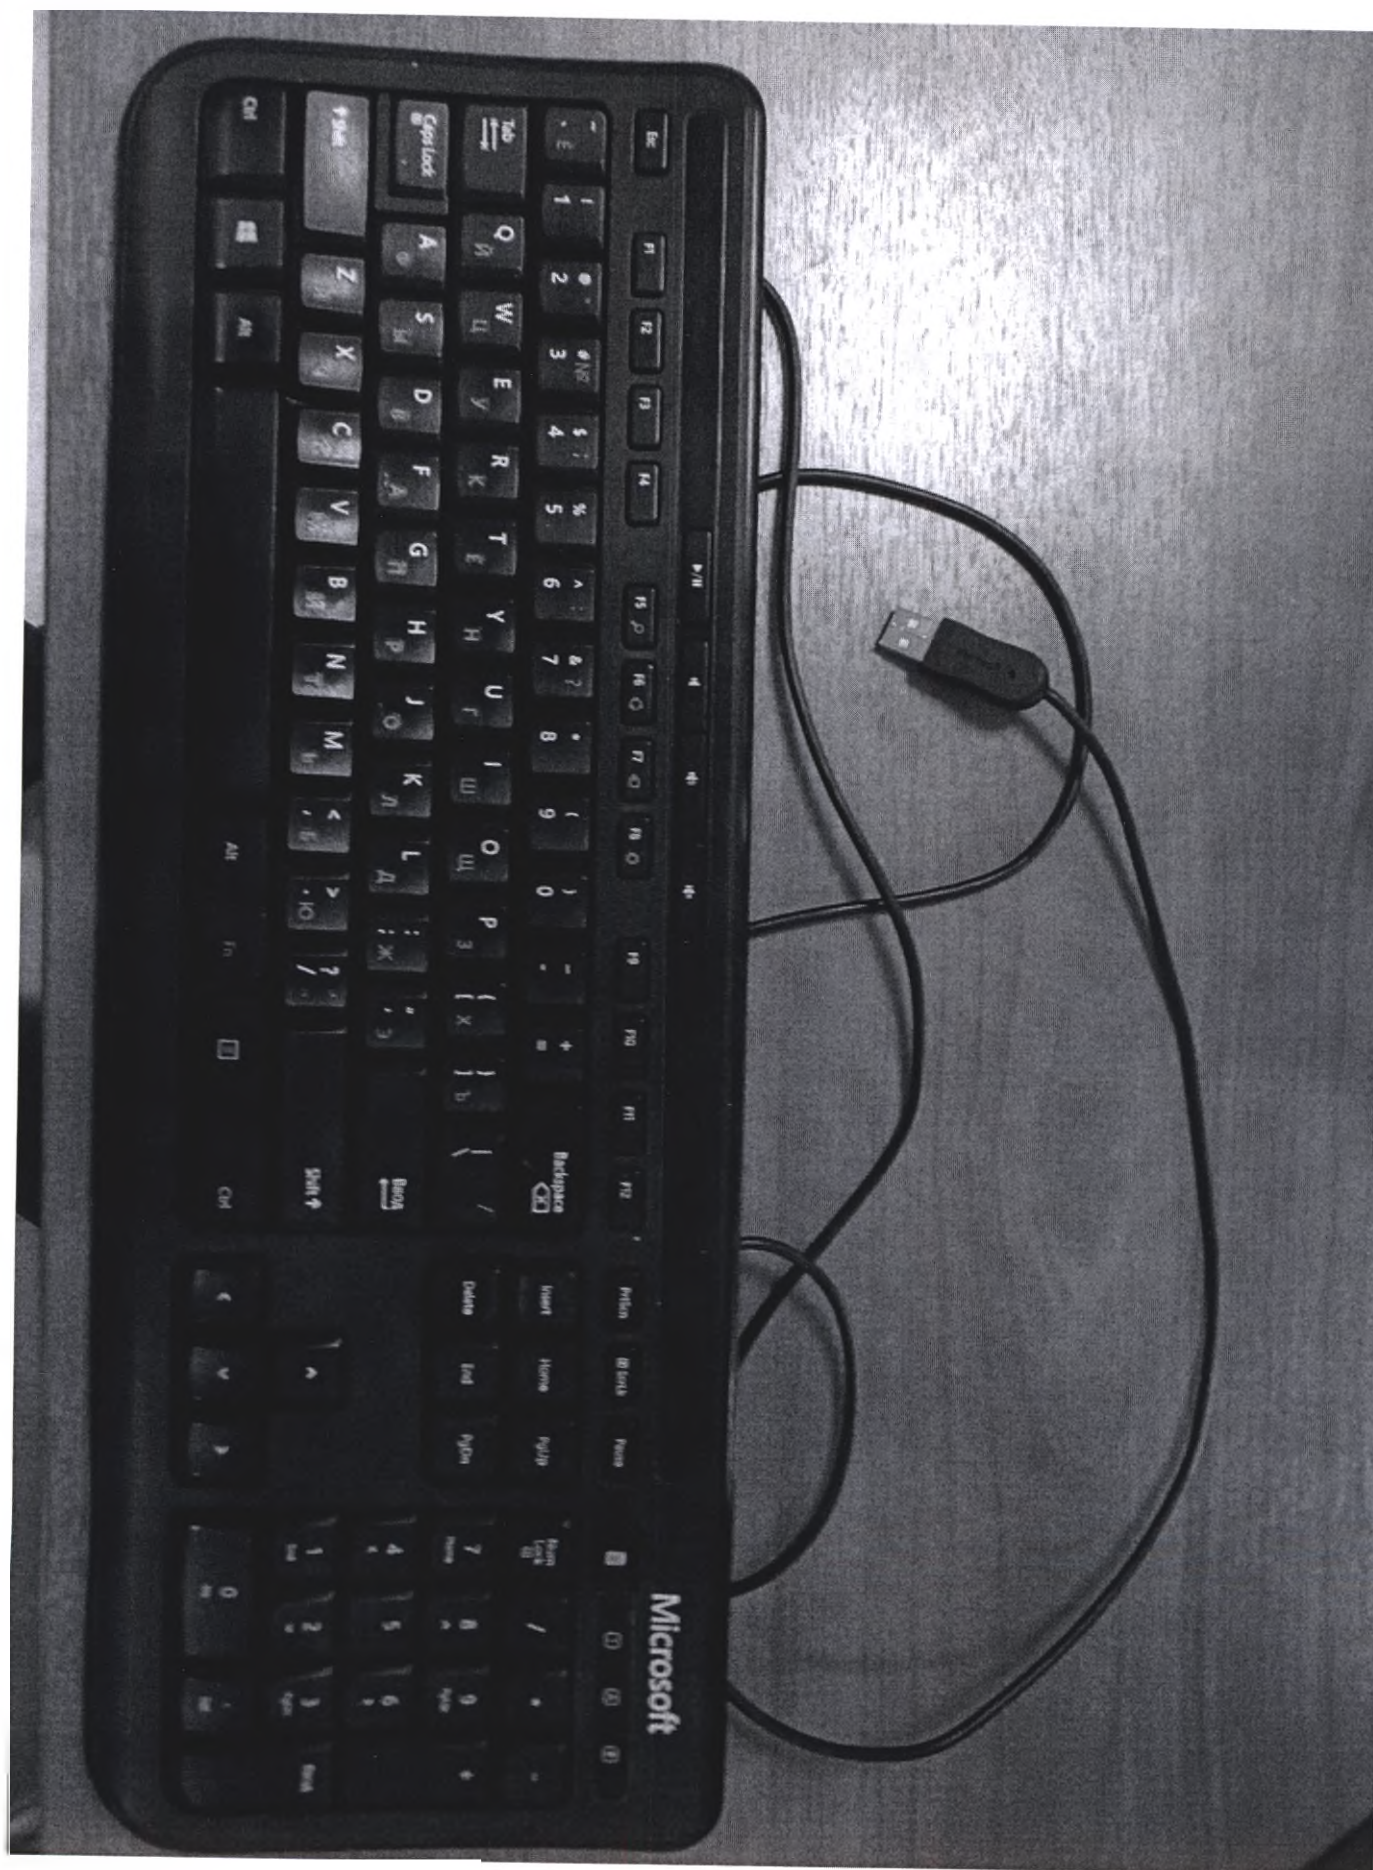


Рис 6. (3). - Клавиатура;



Рис 6. (4). - Манипулятор типа мышь;

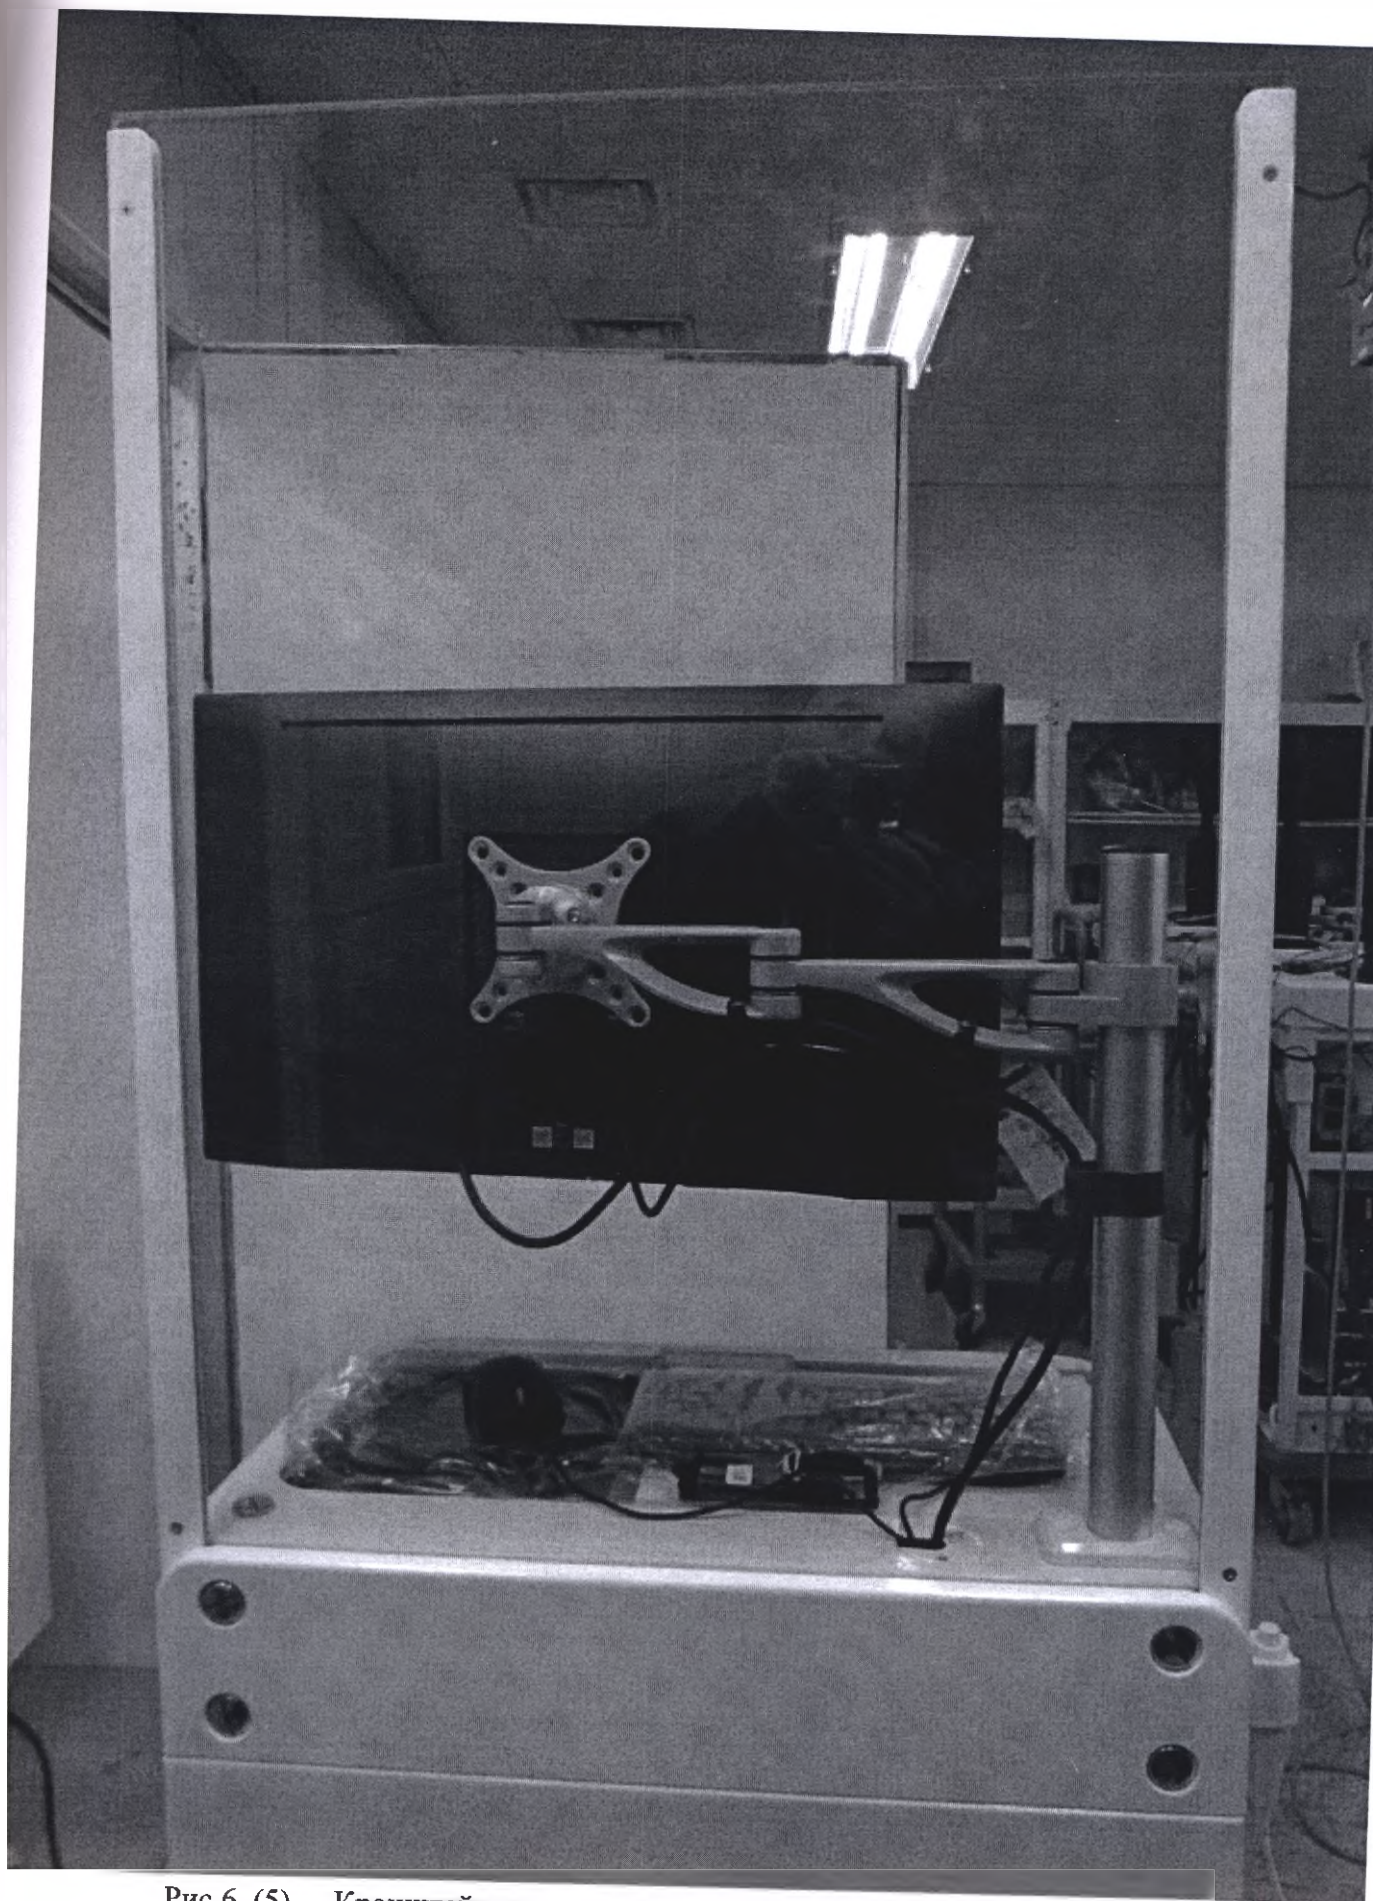


Рис 6. (5). - Кронштейн для монитора;



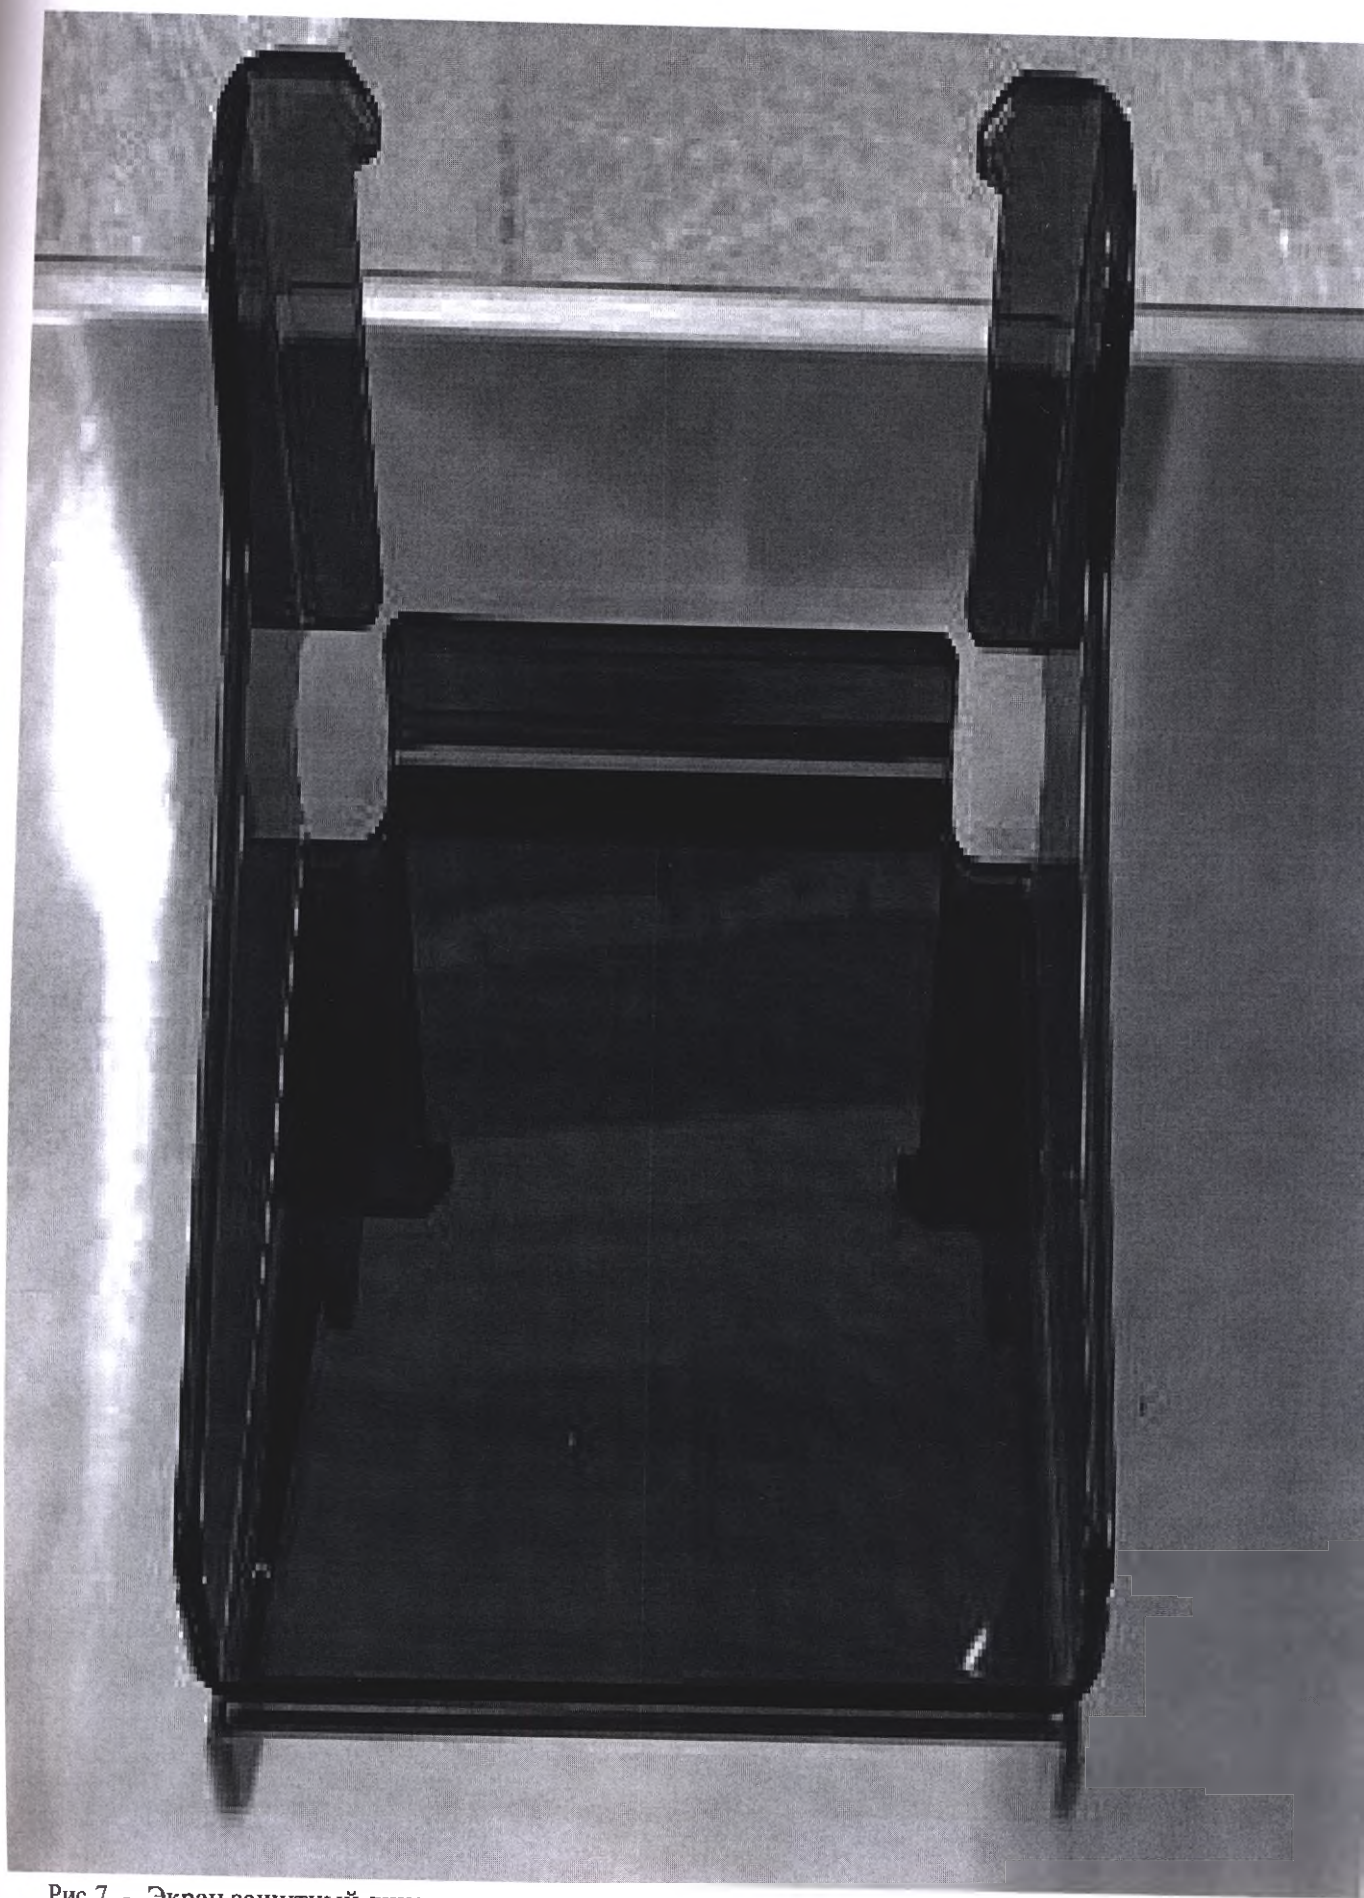


Рис 7. - Экран защитный лица пациента;

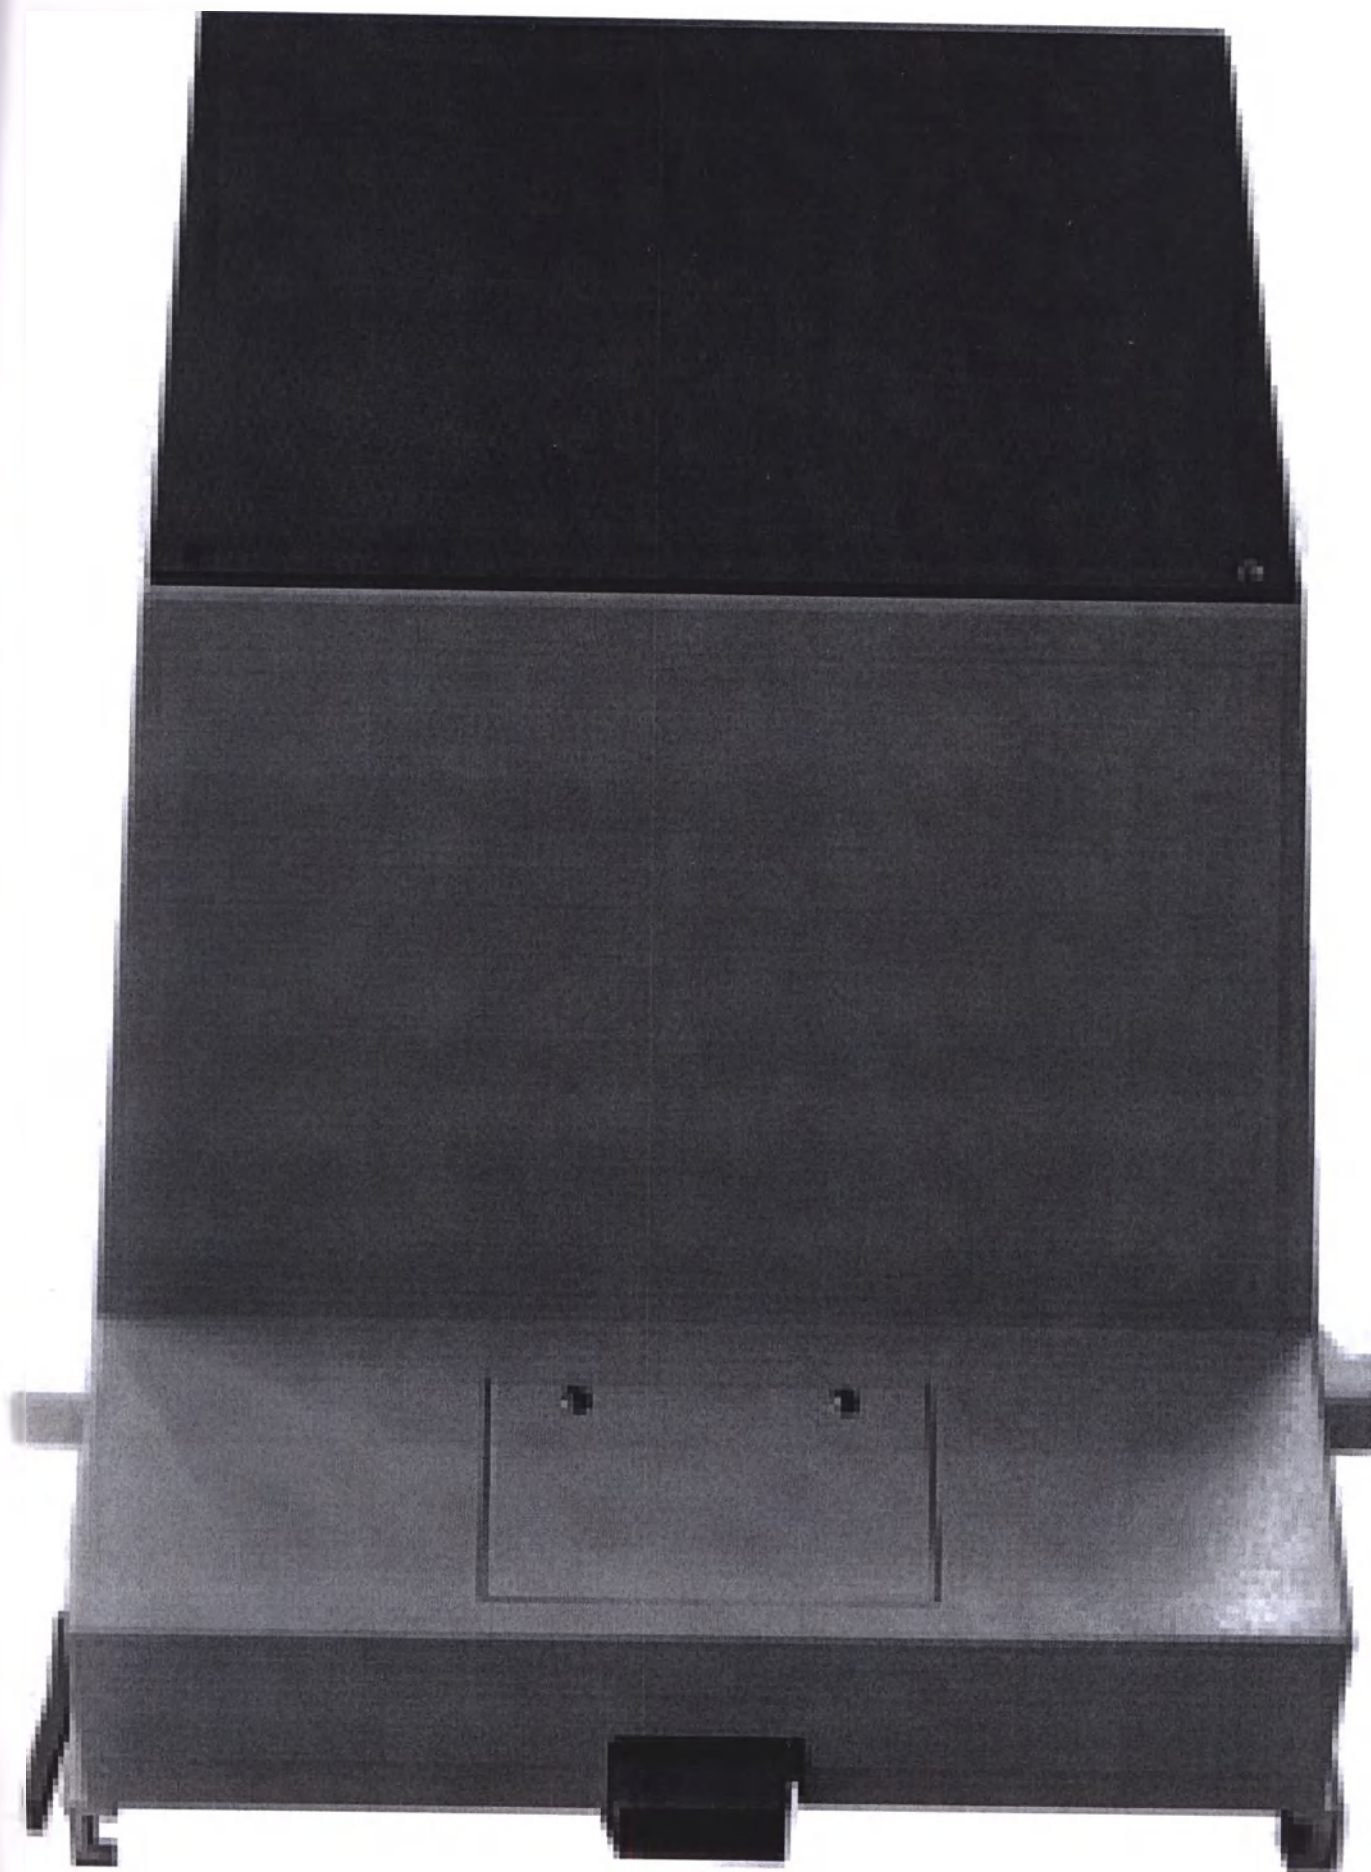


Рис 8. - Устройство увеличивающее (x1.5);

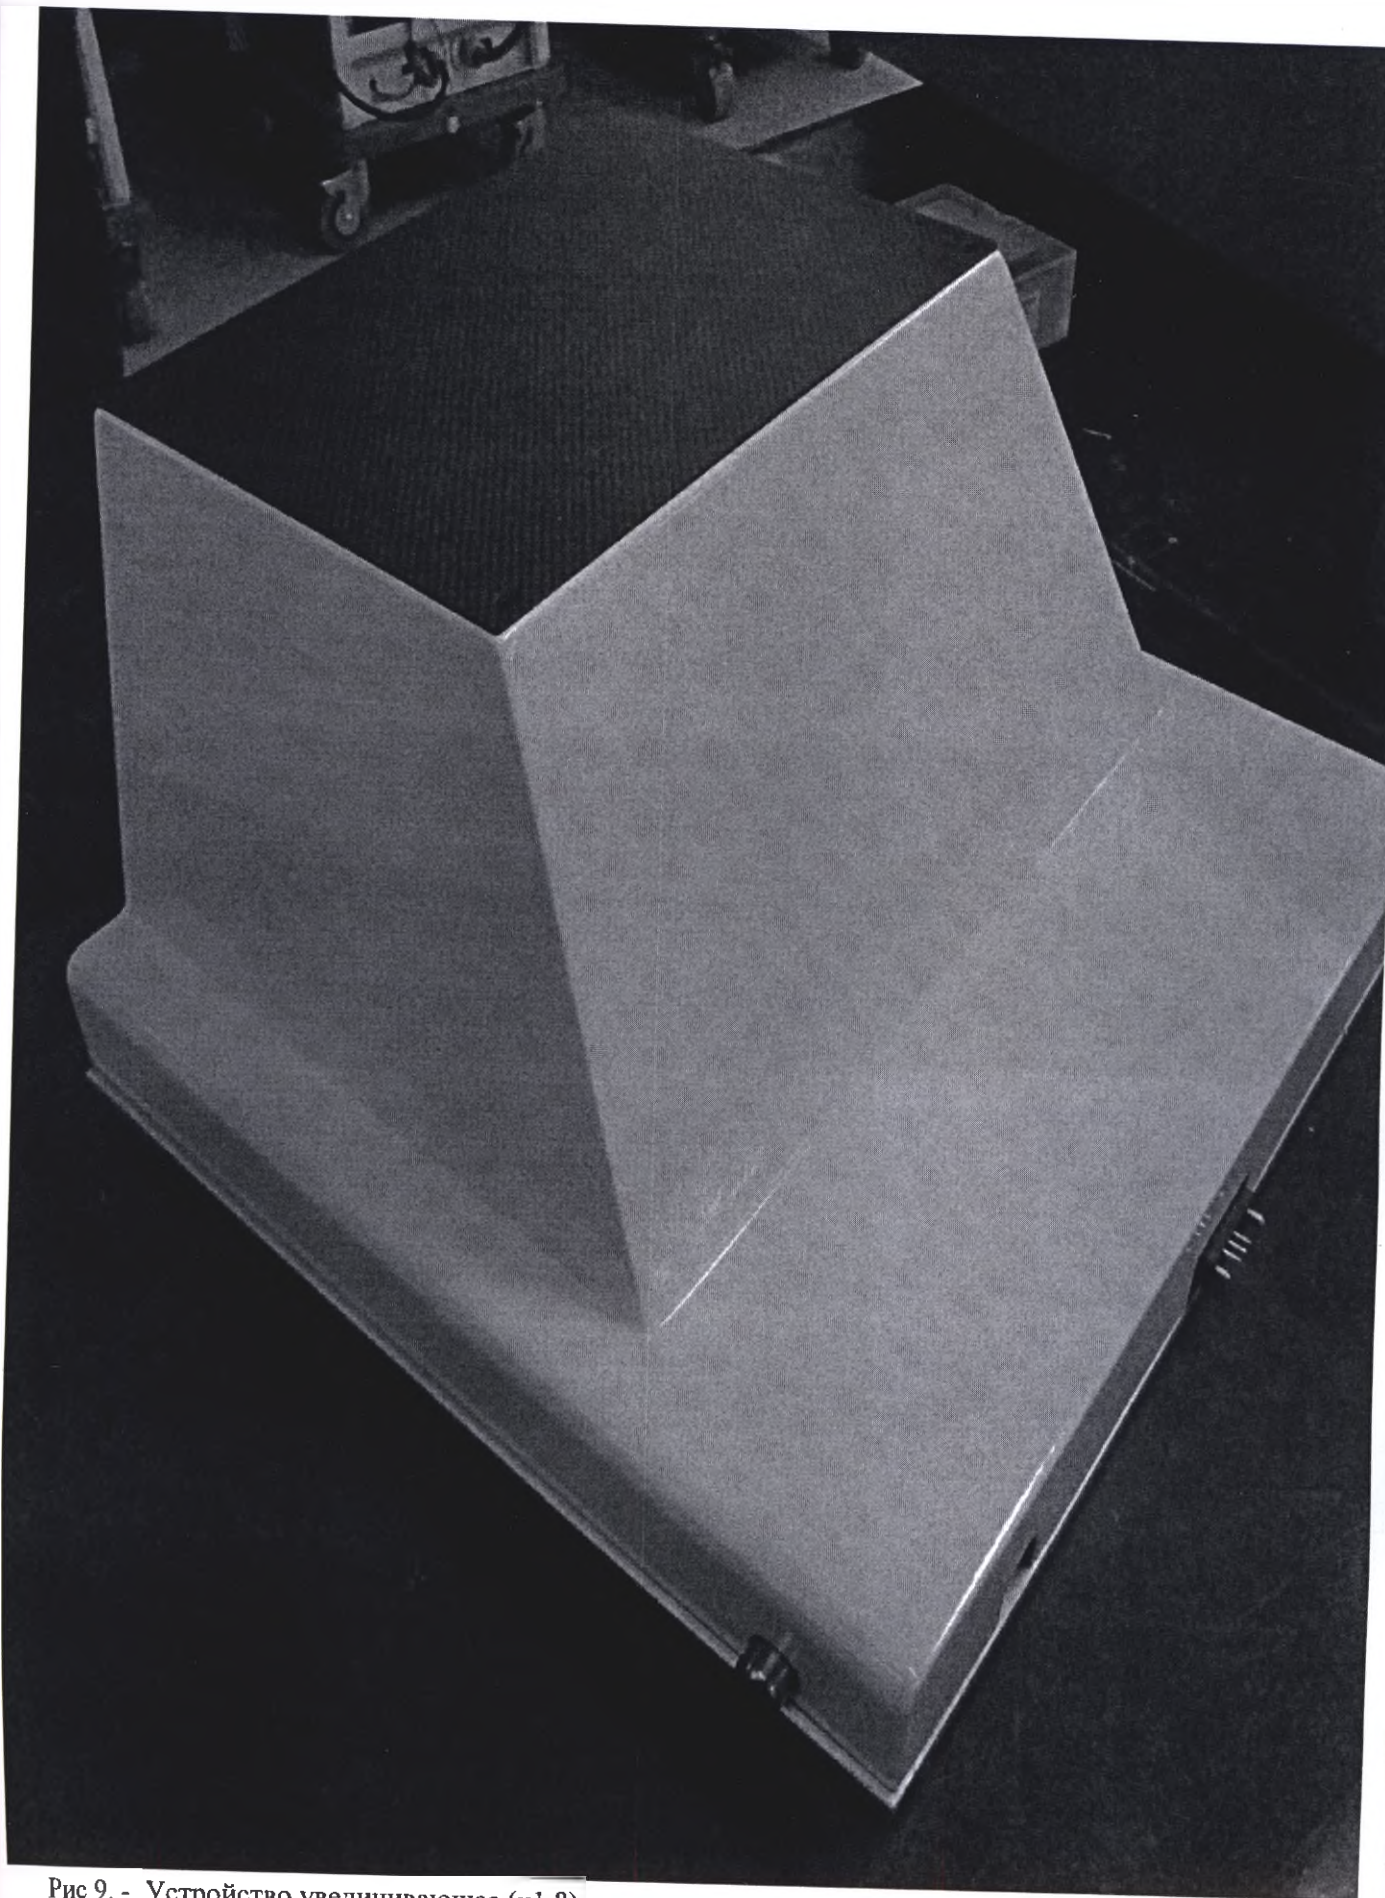


Рис 9. - Устройство увеличивающее (x1.8);

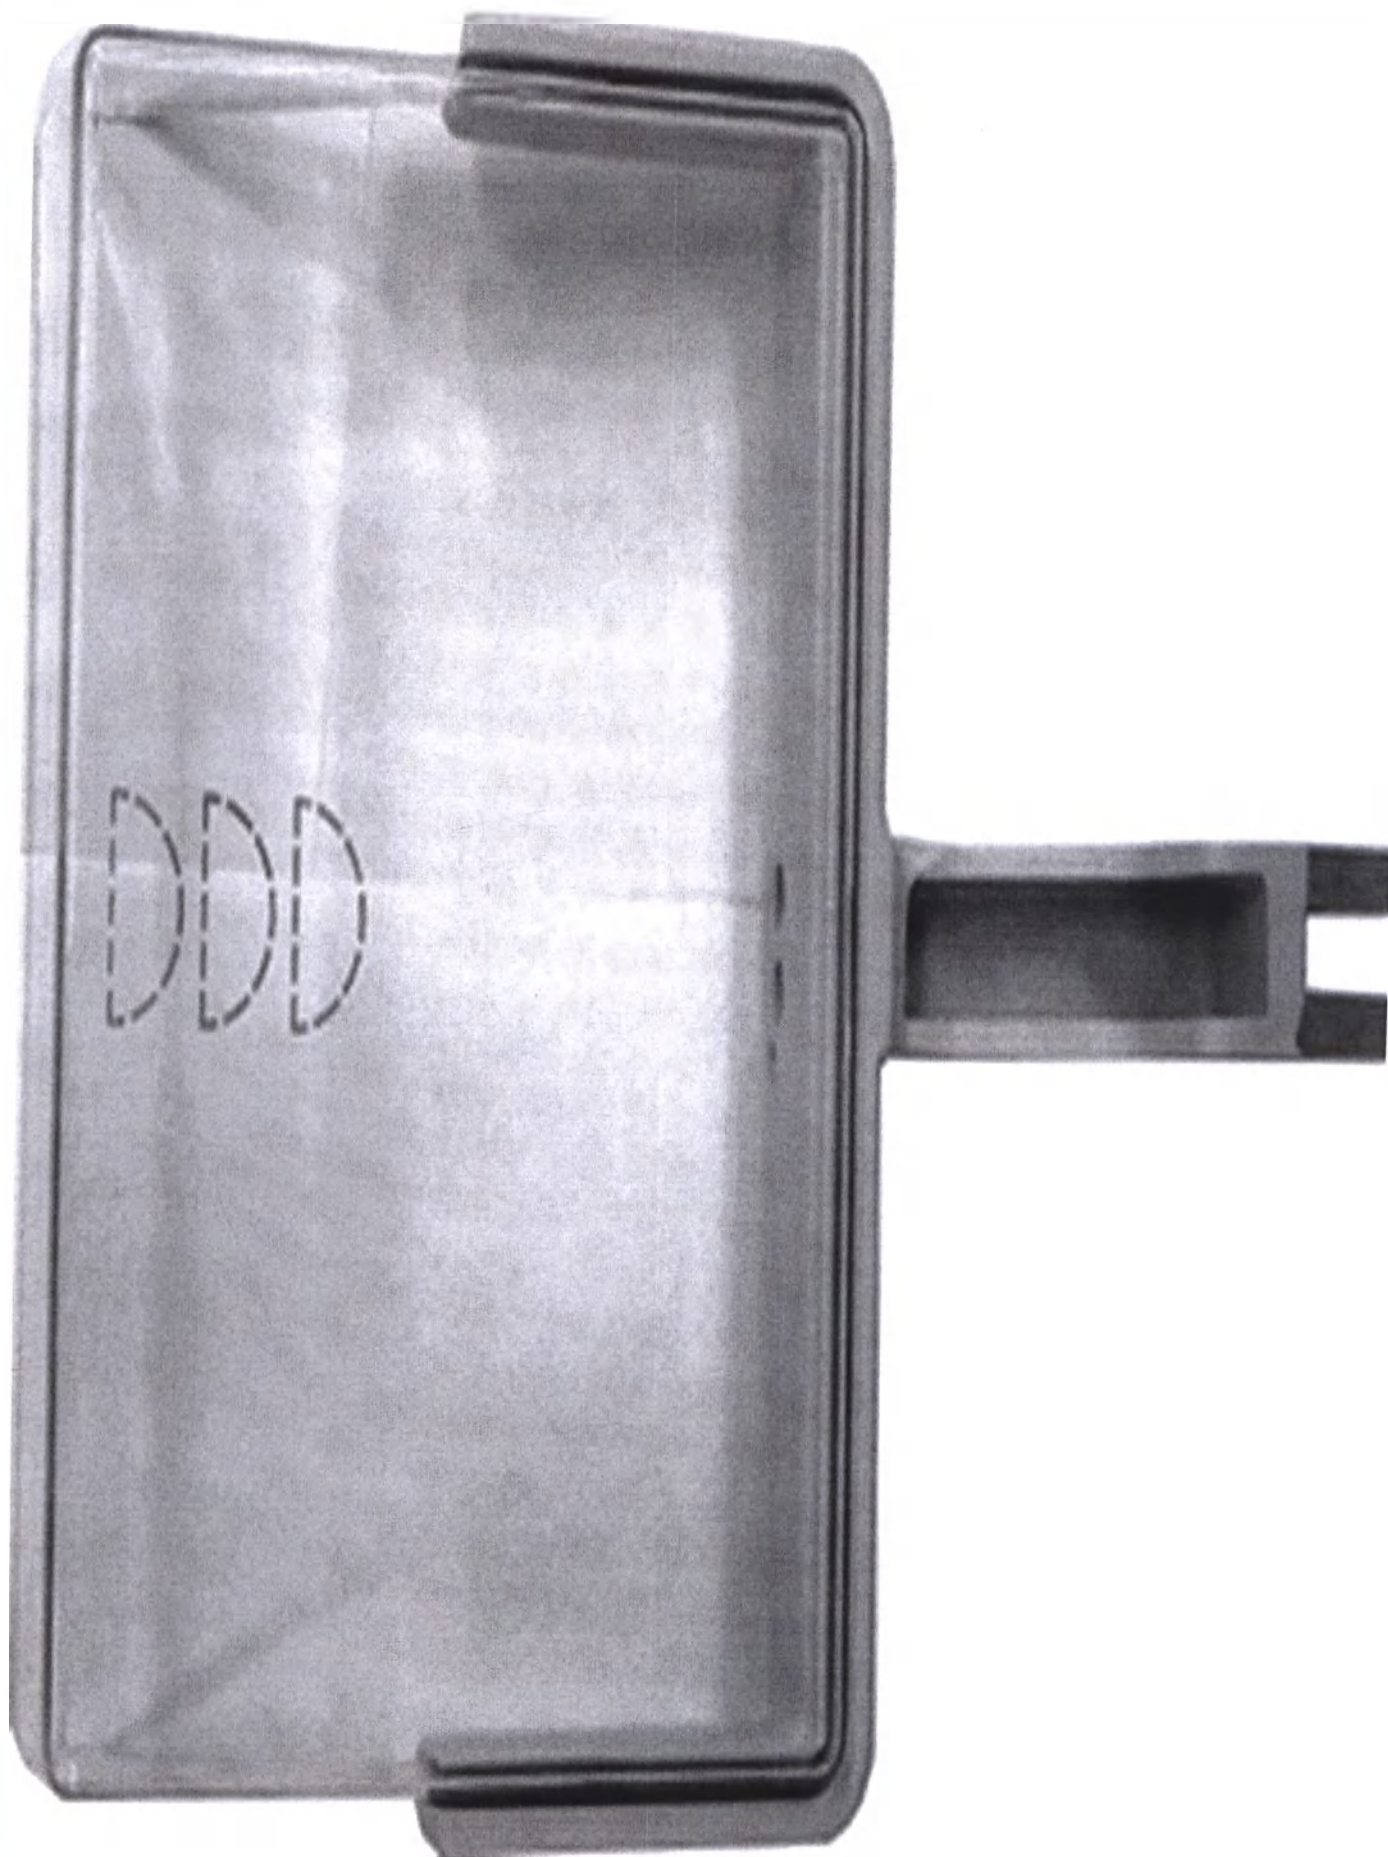


Рис 10. - Лопатка стандартная для увеличивающего устройства (x1.5);

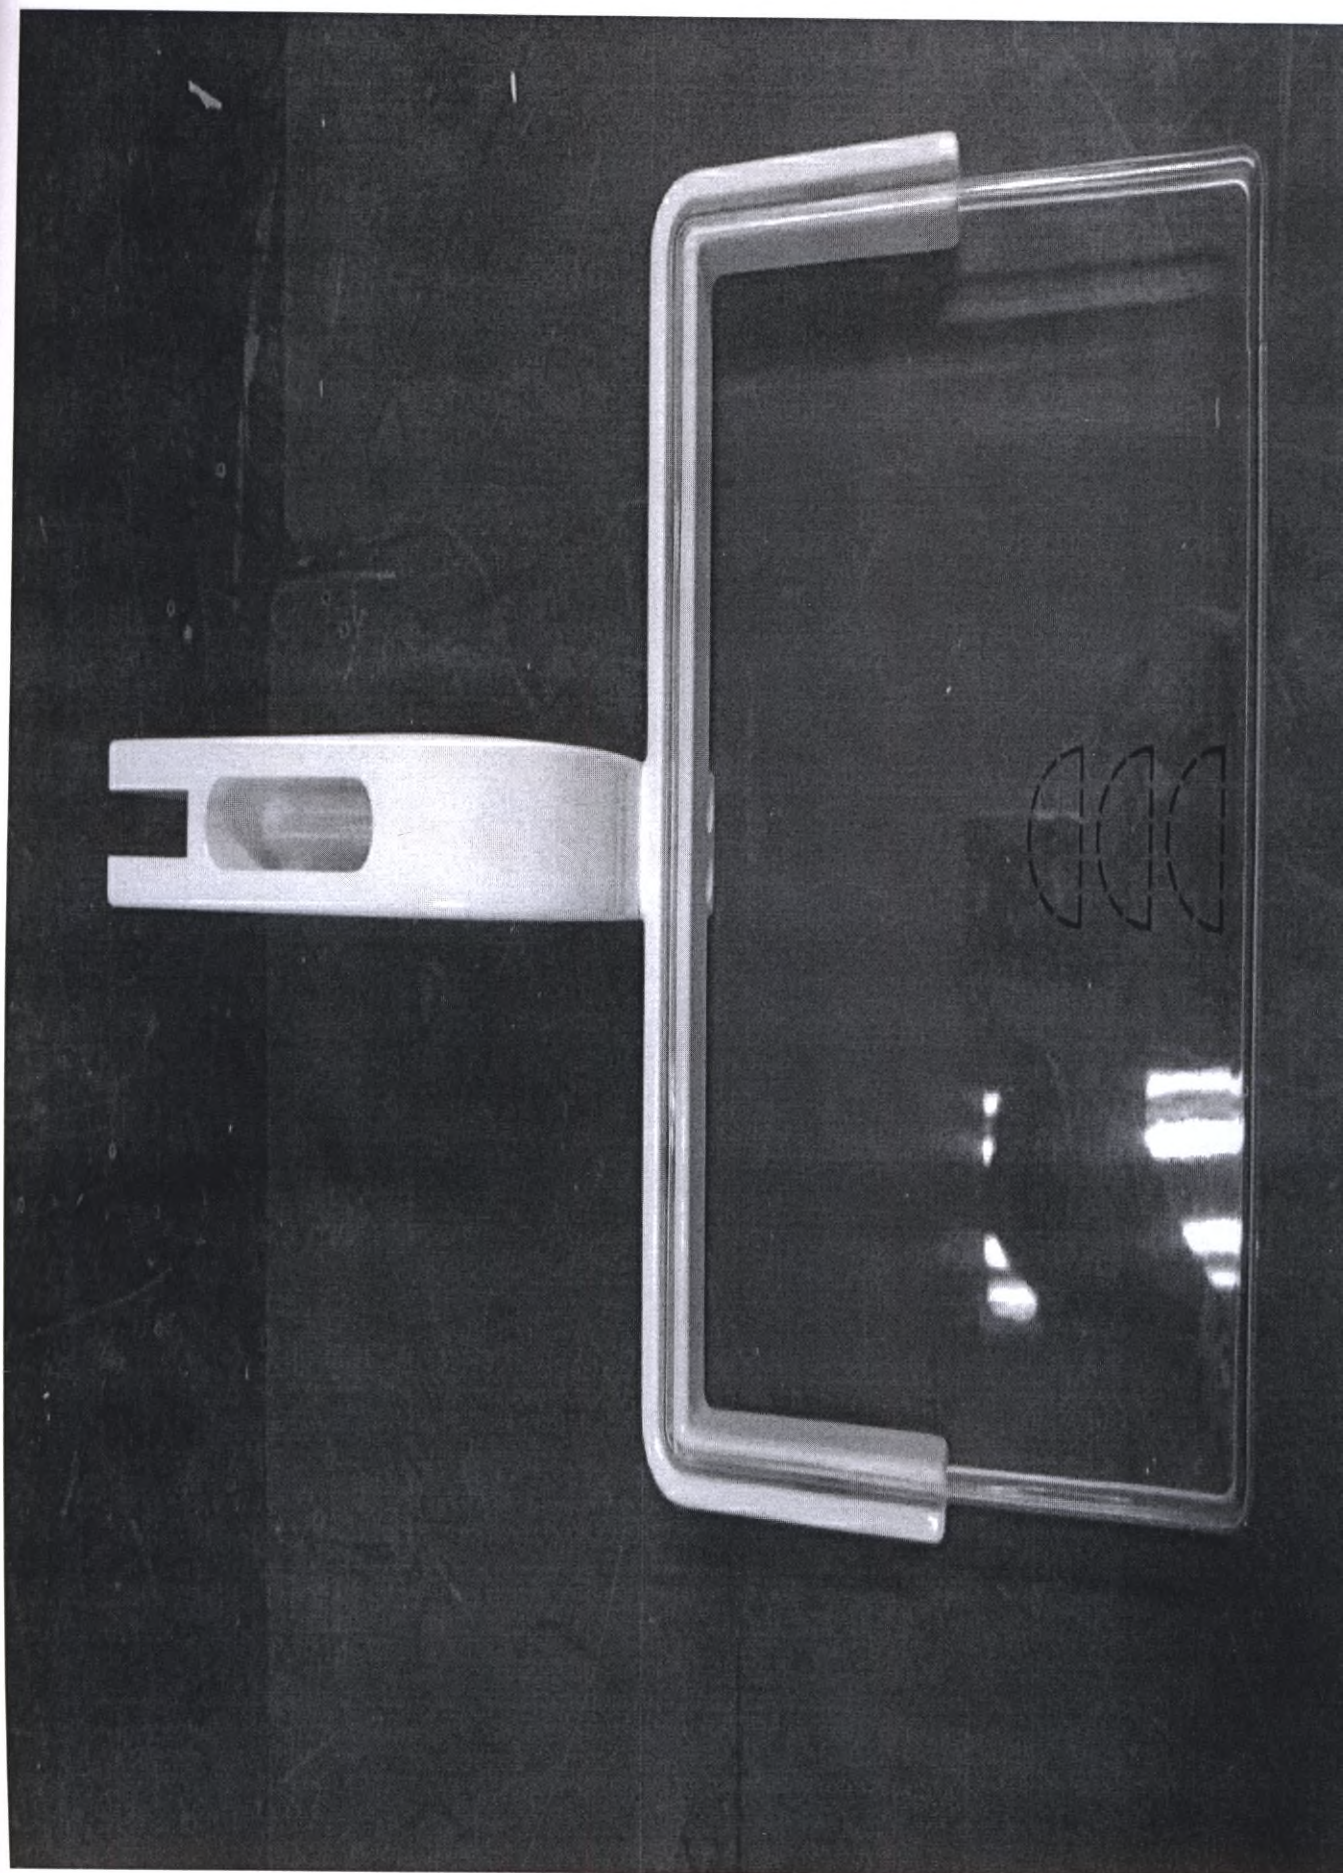


Рис 11. - Лопатка стандартная для увеличивающего устройства (x1.8);



Рис 12. - Лопатка для прицельных снимков для увеличивающего устройства (x1.5);

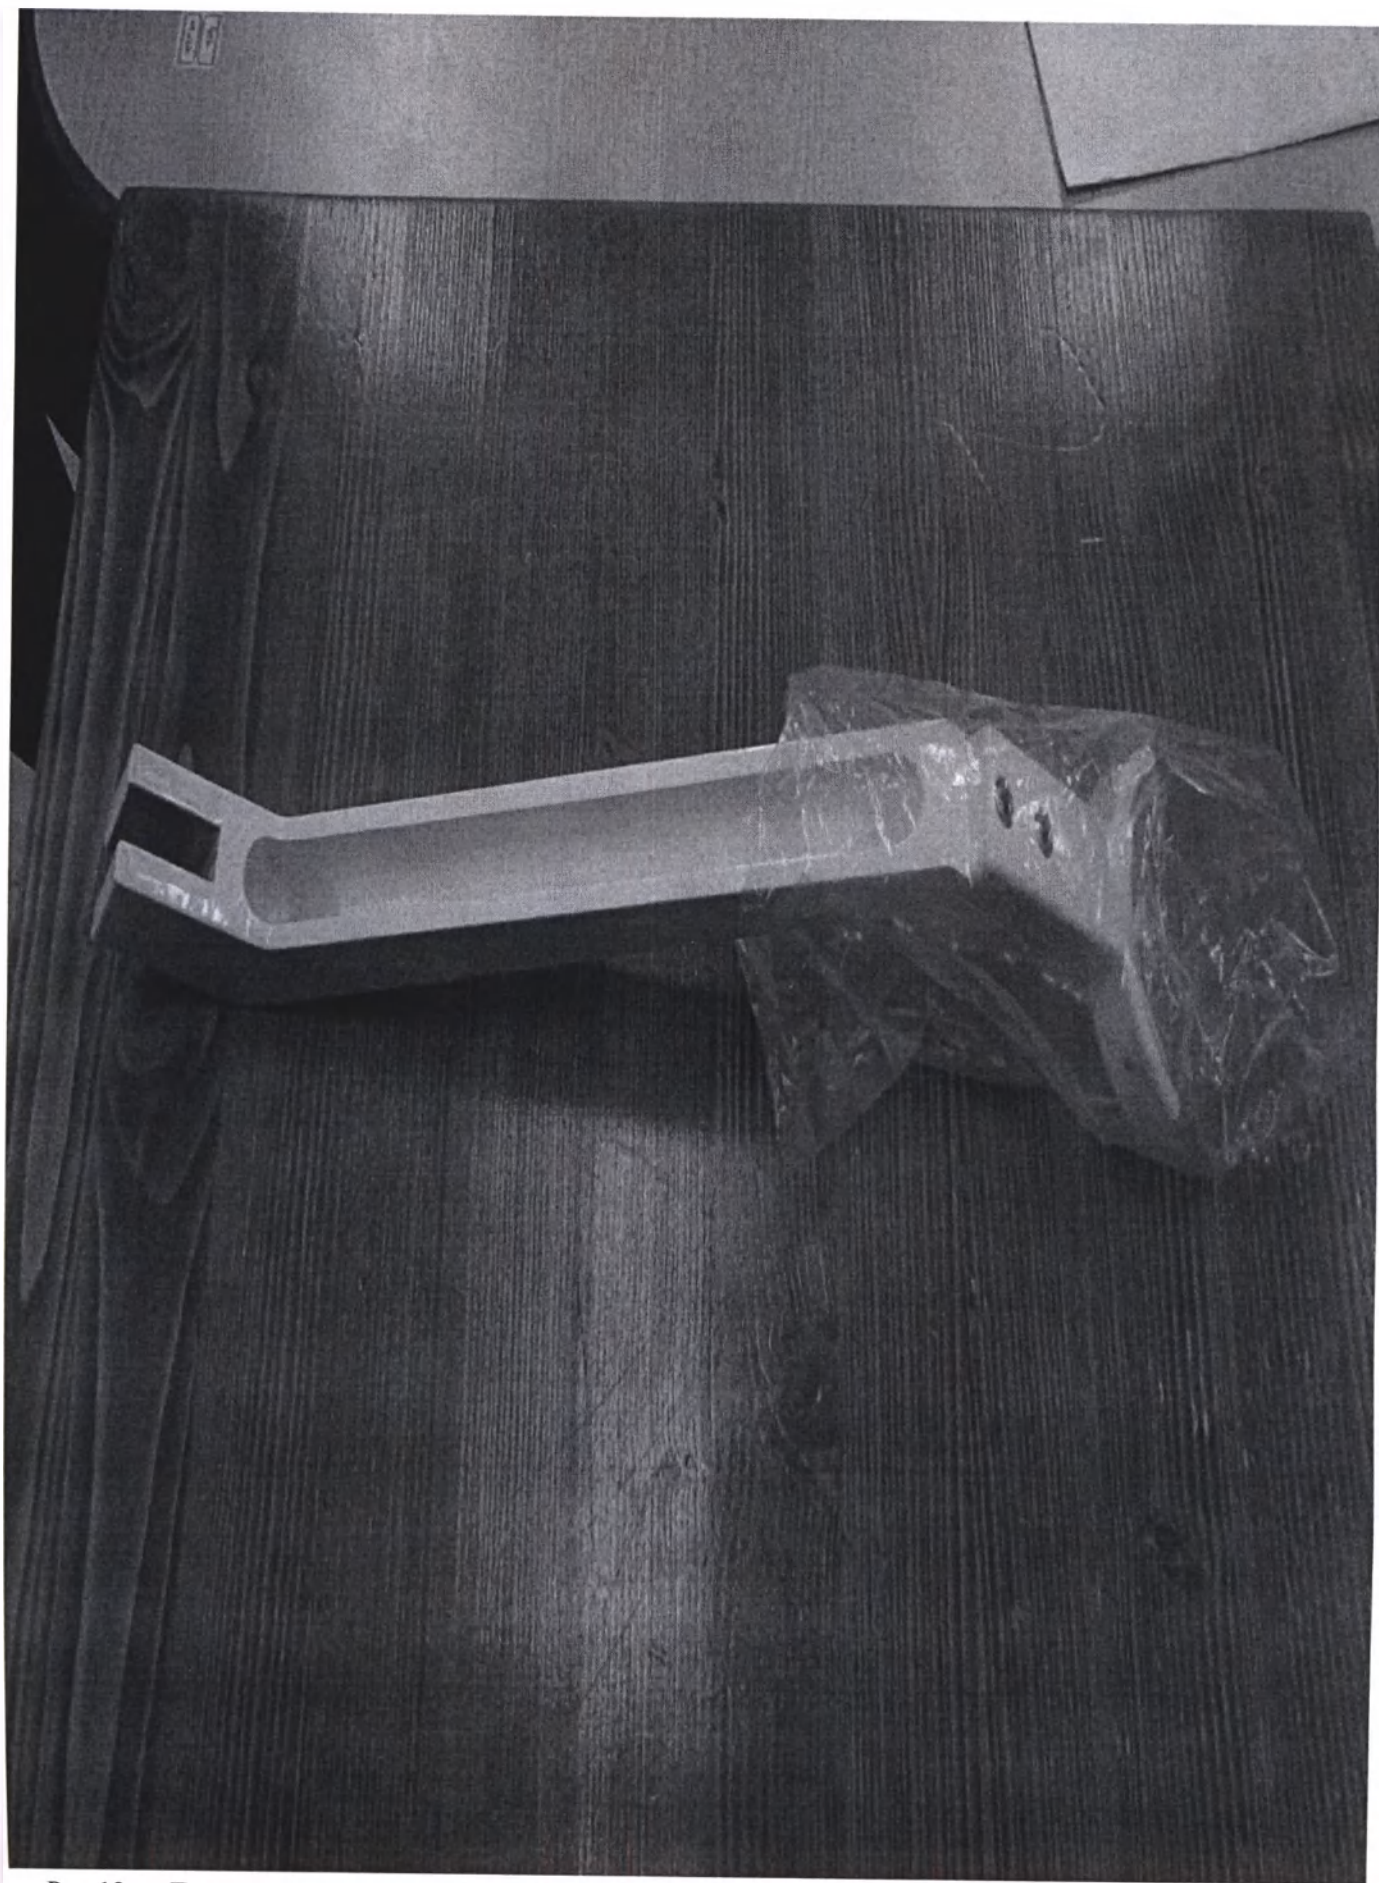


Рис 13. - Лопатка для прицельных снимков для увеличивающего устройства (x1.8);

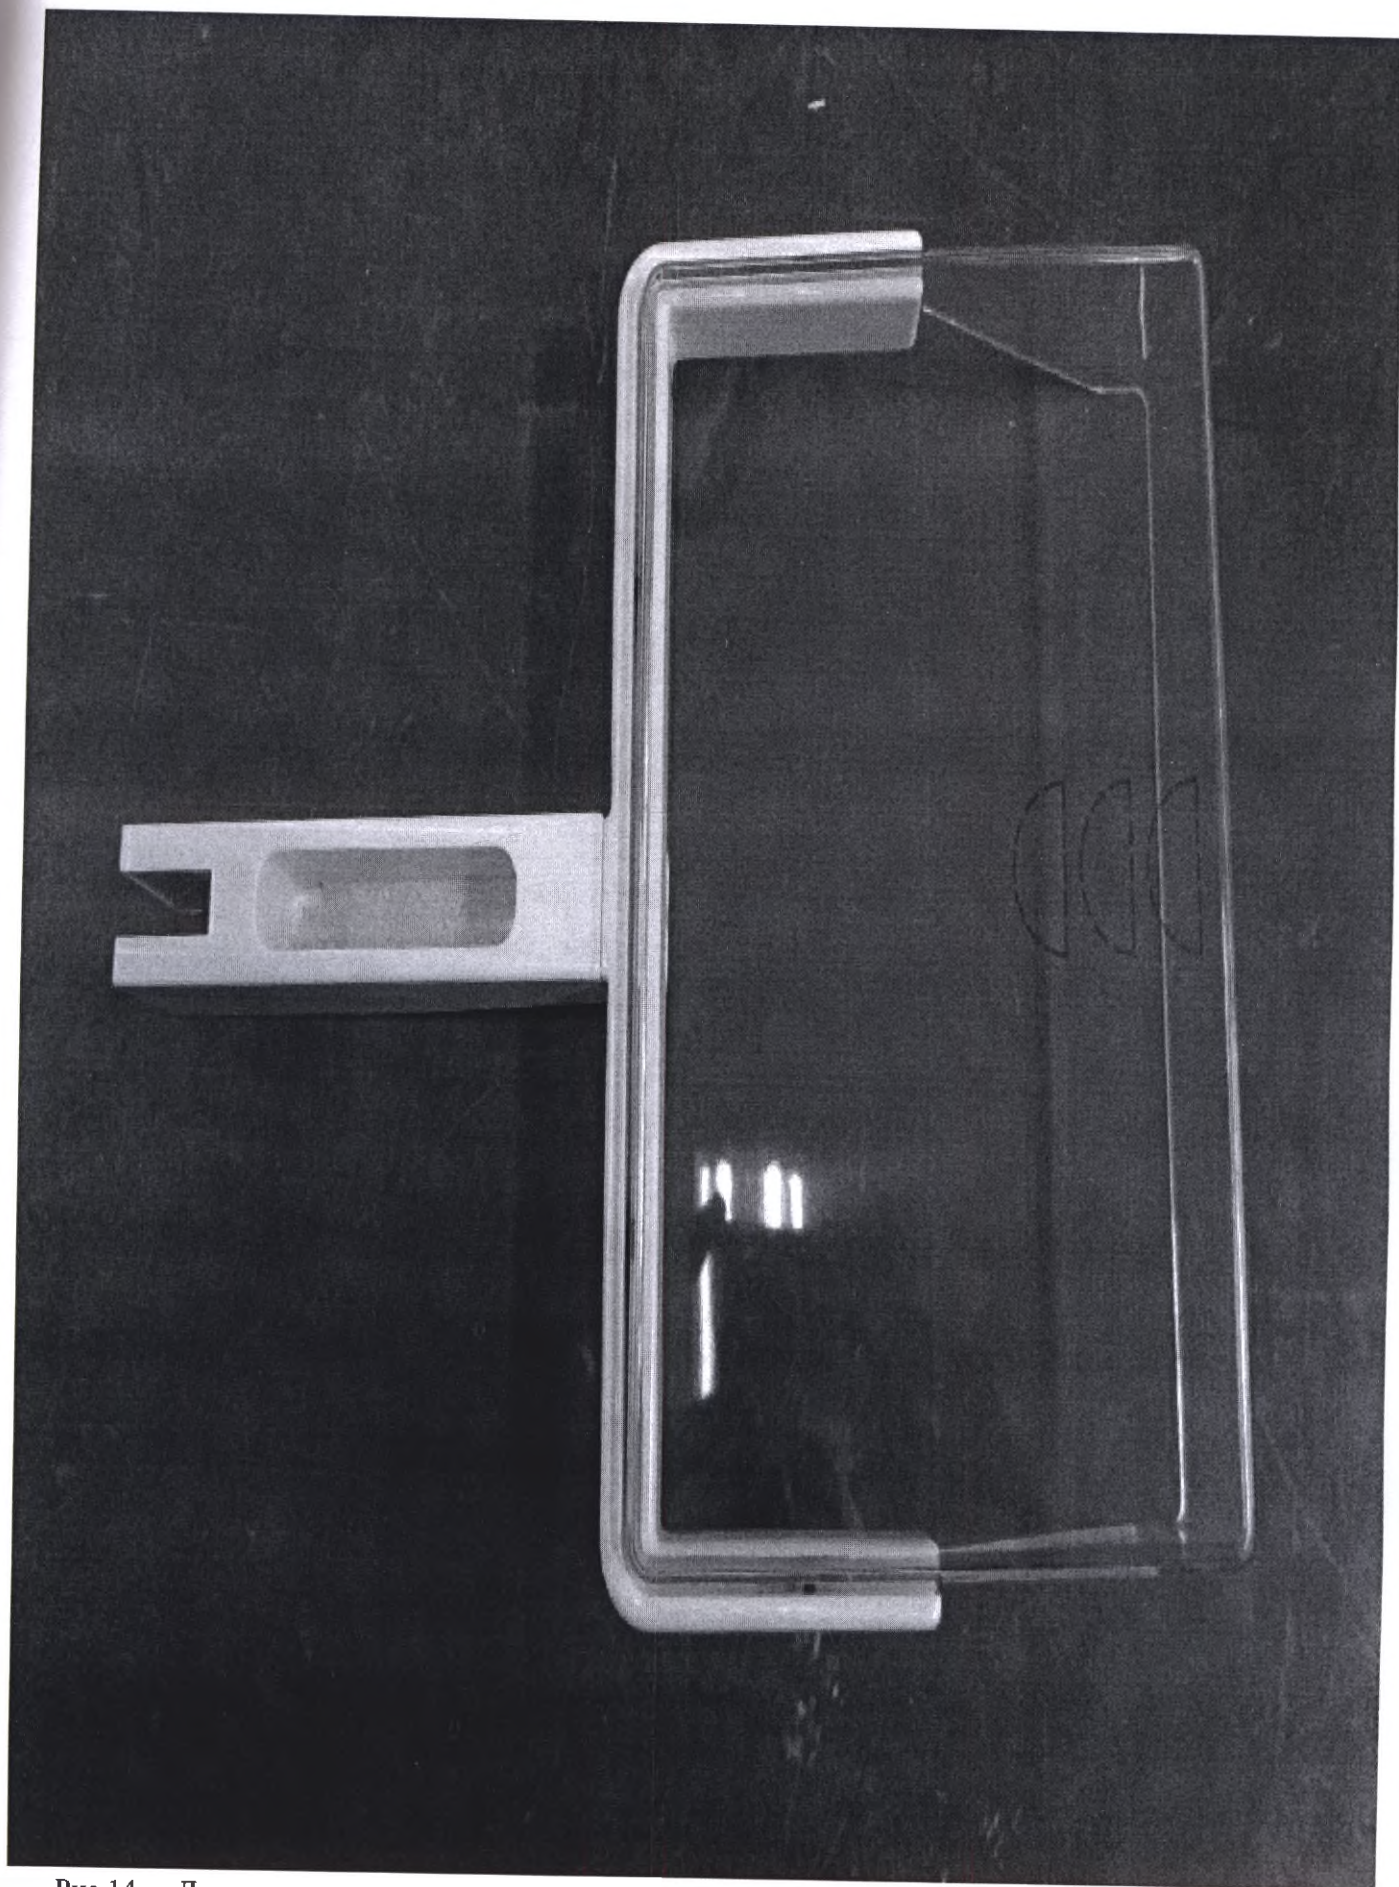


Рис 14. - Лопатка стандартная компрессионная;



Рис 15. - Лопатка для подмышечной проекции (укладки);

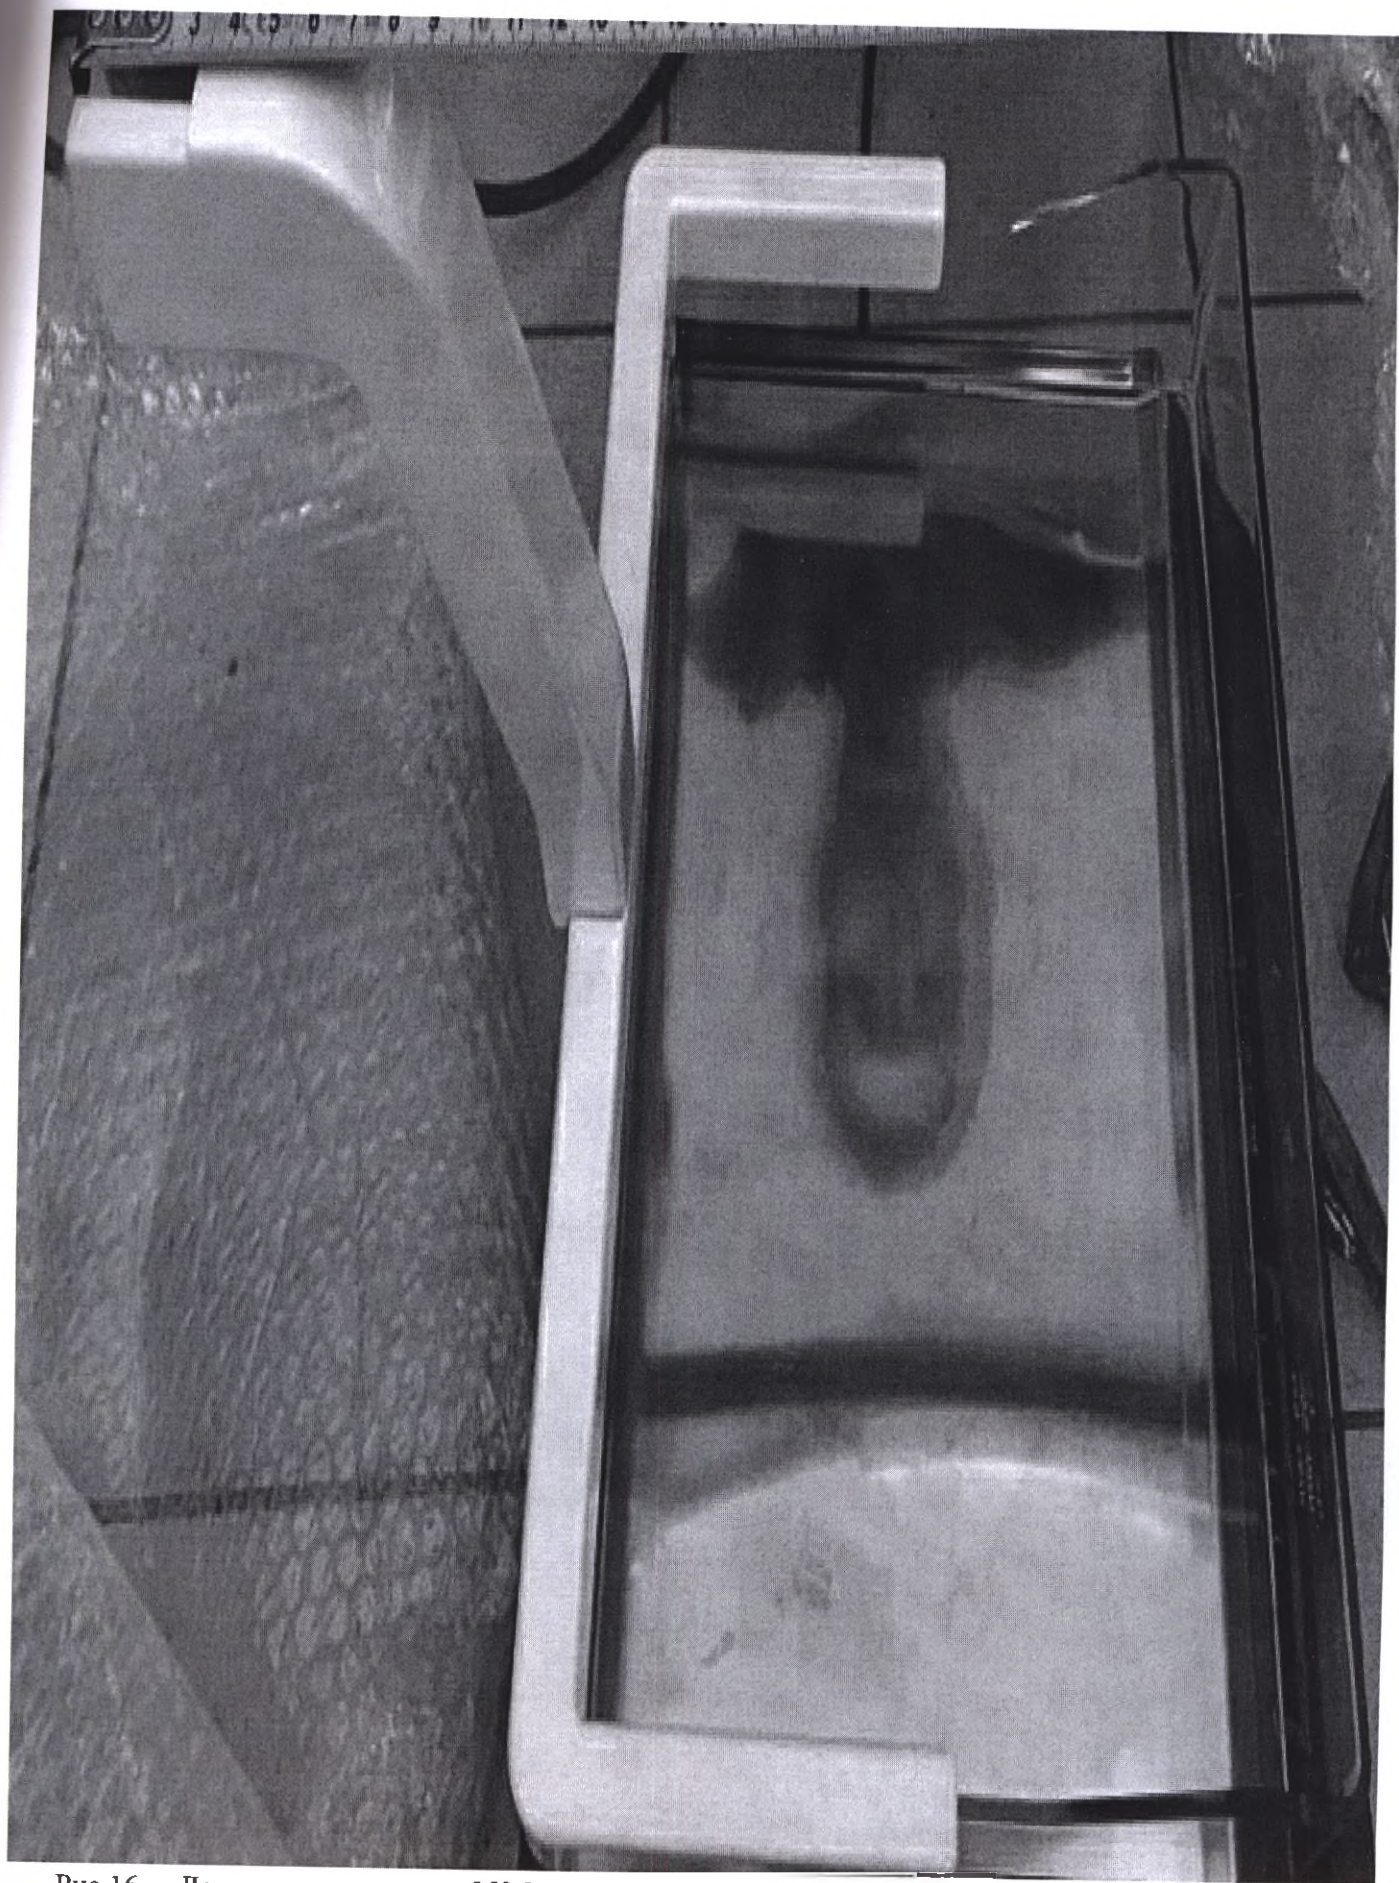


Рис 16. - Лопатка мягкая, длина 352.3 мм, высота 300 мм, ширина 249 мм;

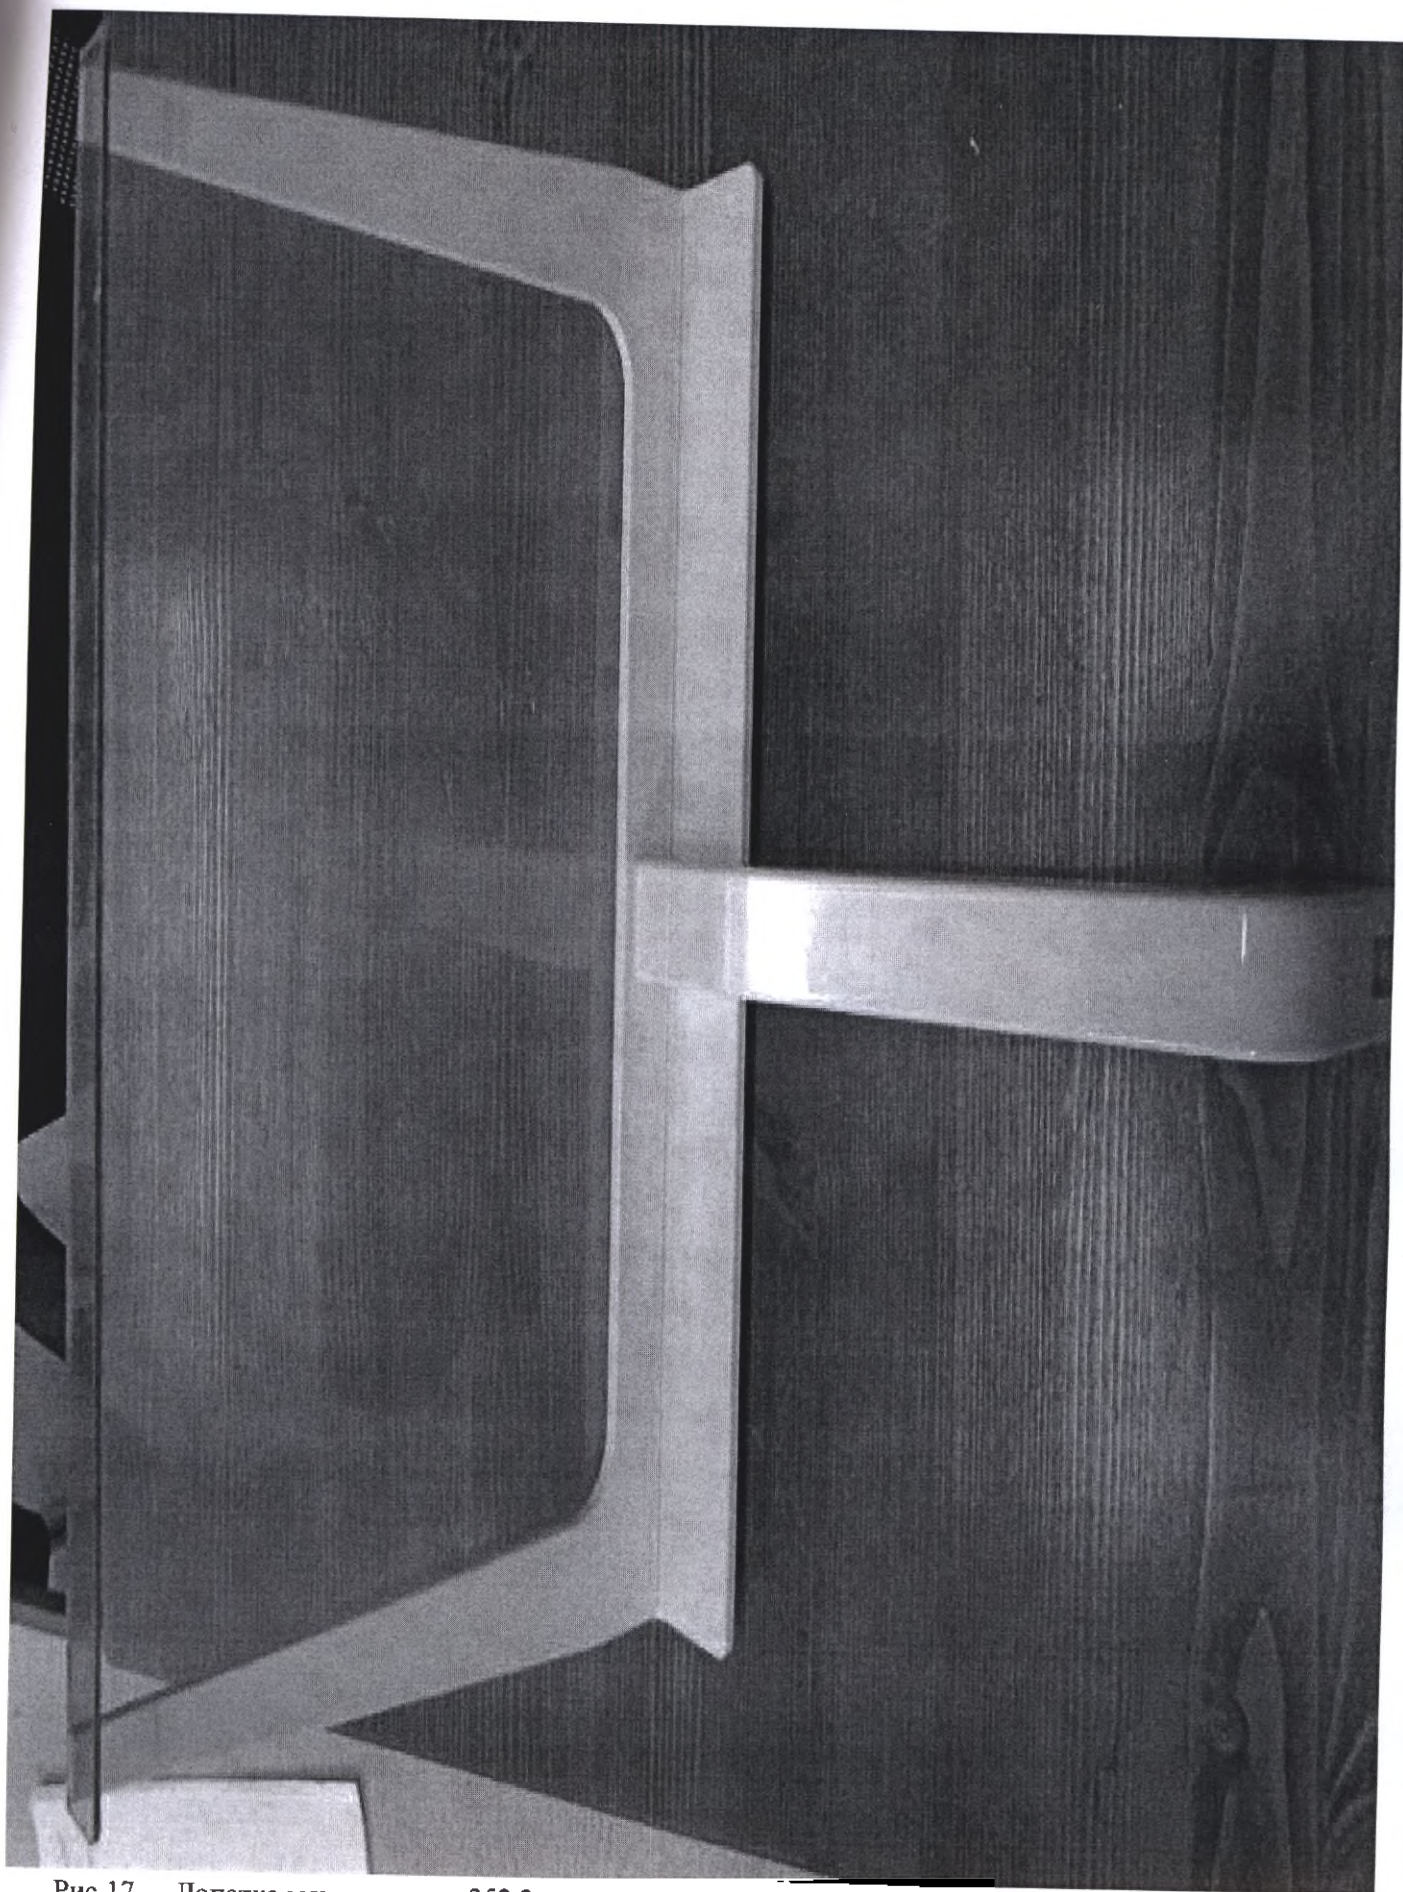


Рис 17. - Лопатка мягкая, длина 352.3 мм, высота 340 мм, ширина 249 мм;

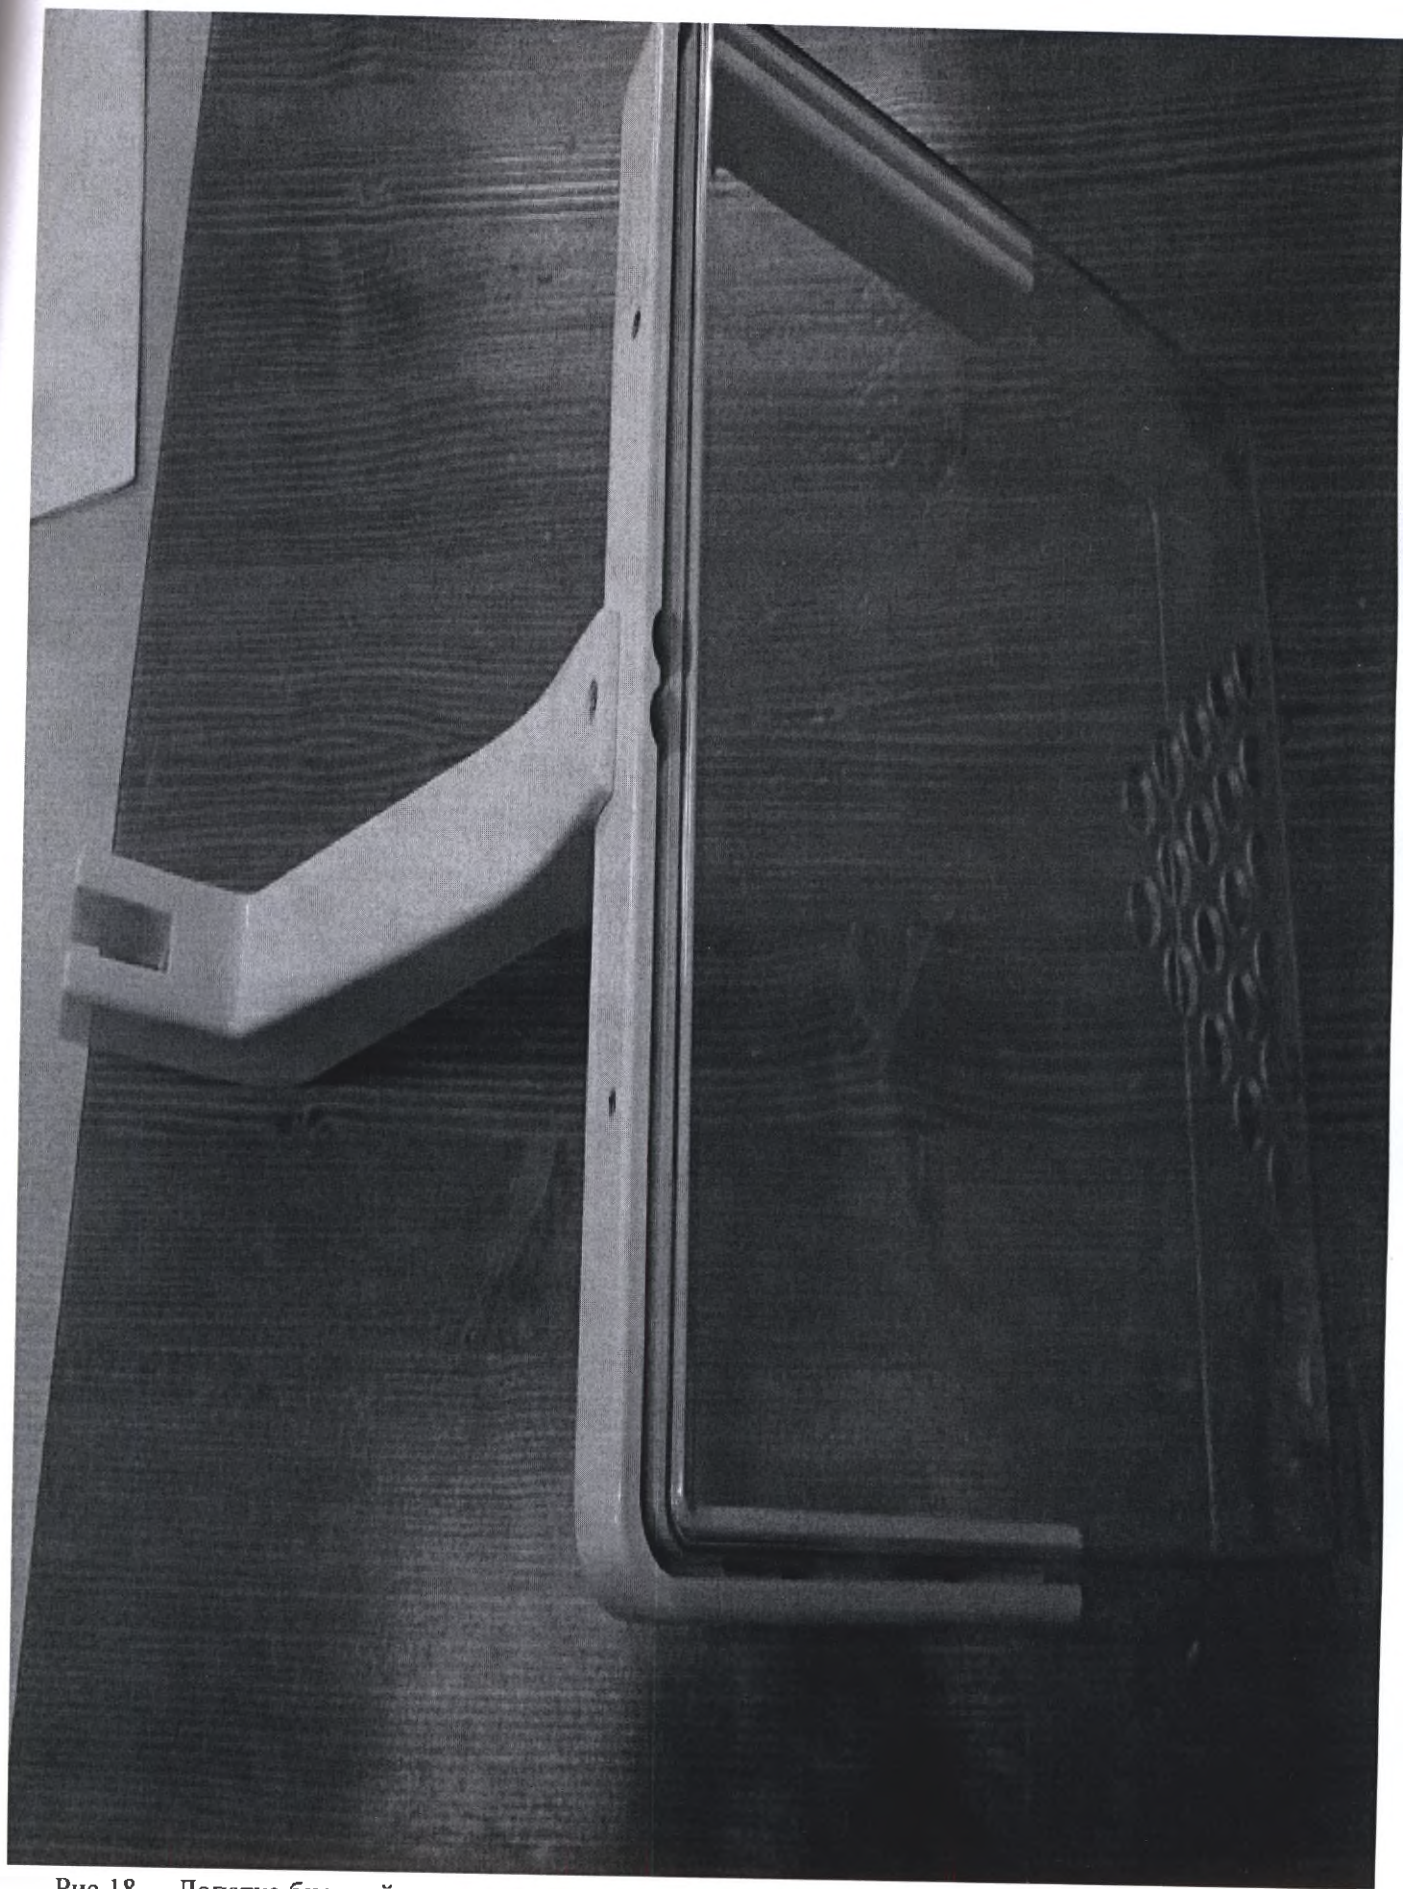


Рис 18. - Лопатка биопсийная;

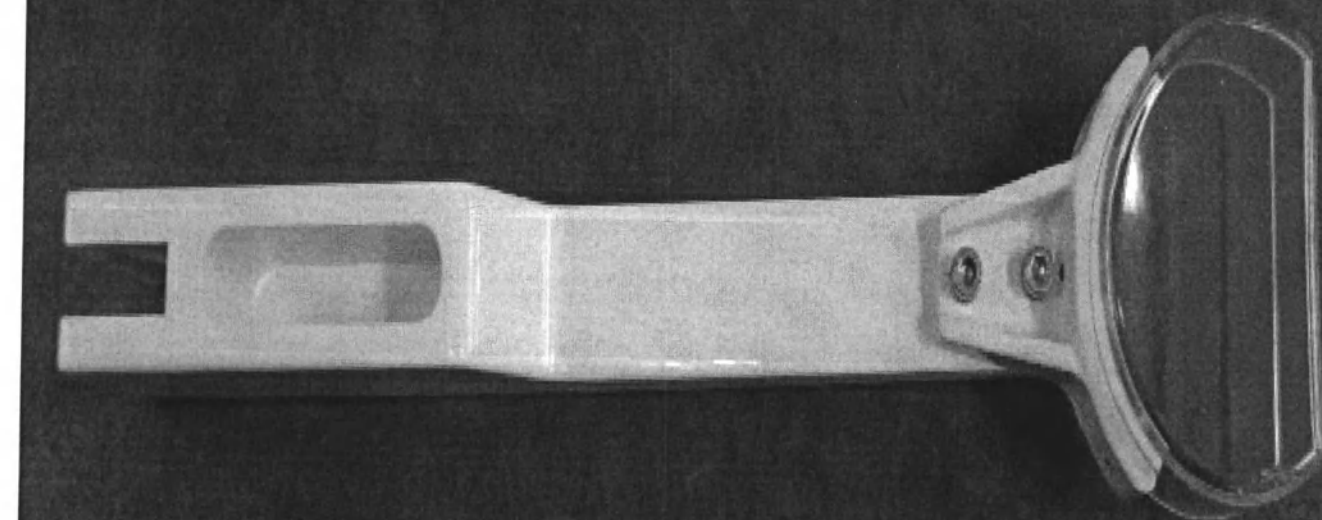


Рис 19. - Лопатка для прицельных снимков;

903987

Rhodium foil 0,025 x 50 x 50 mm/99,9%

Ch. 060312

1 piece CAS-Nr.: 7440-16-6

Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien. Die beim Umgang
Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.

Рис 20. - Фильтр родиевый;

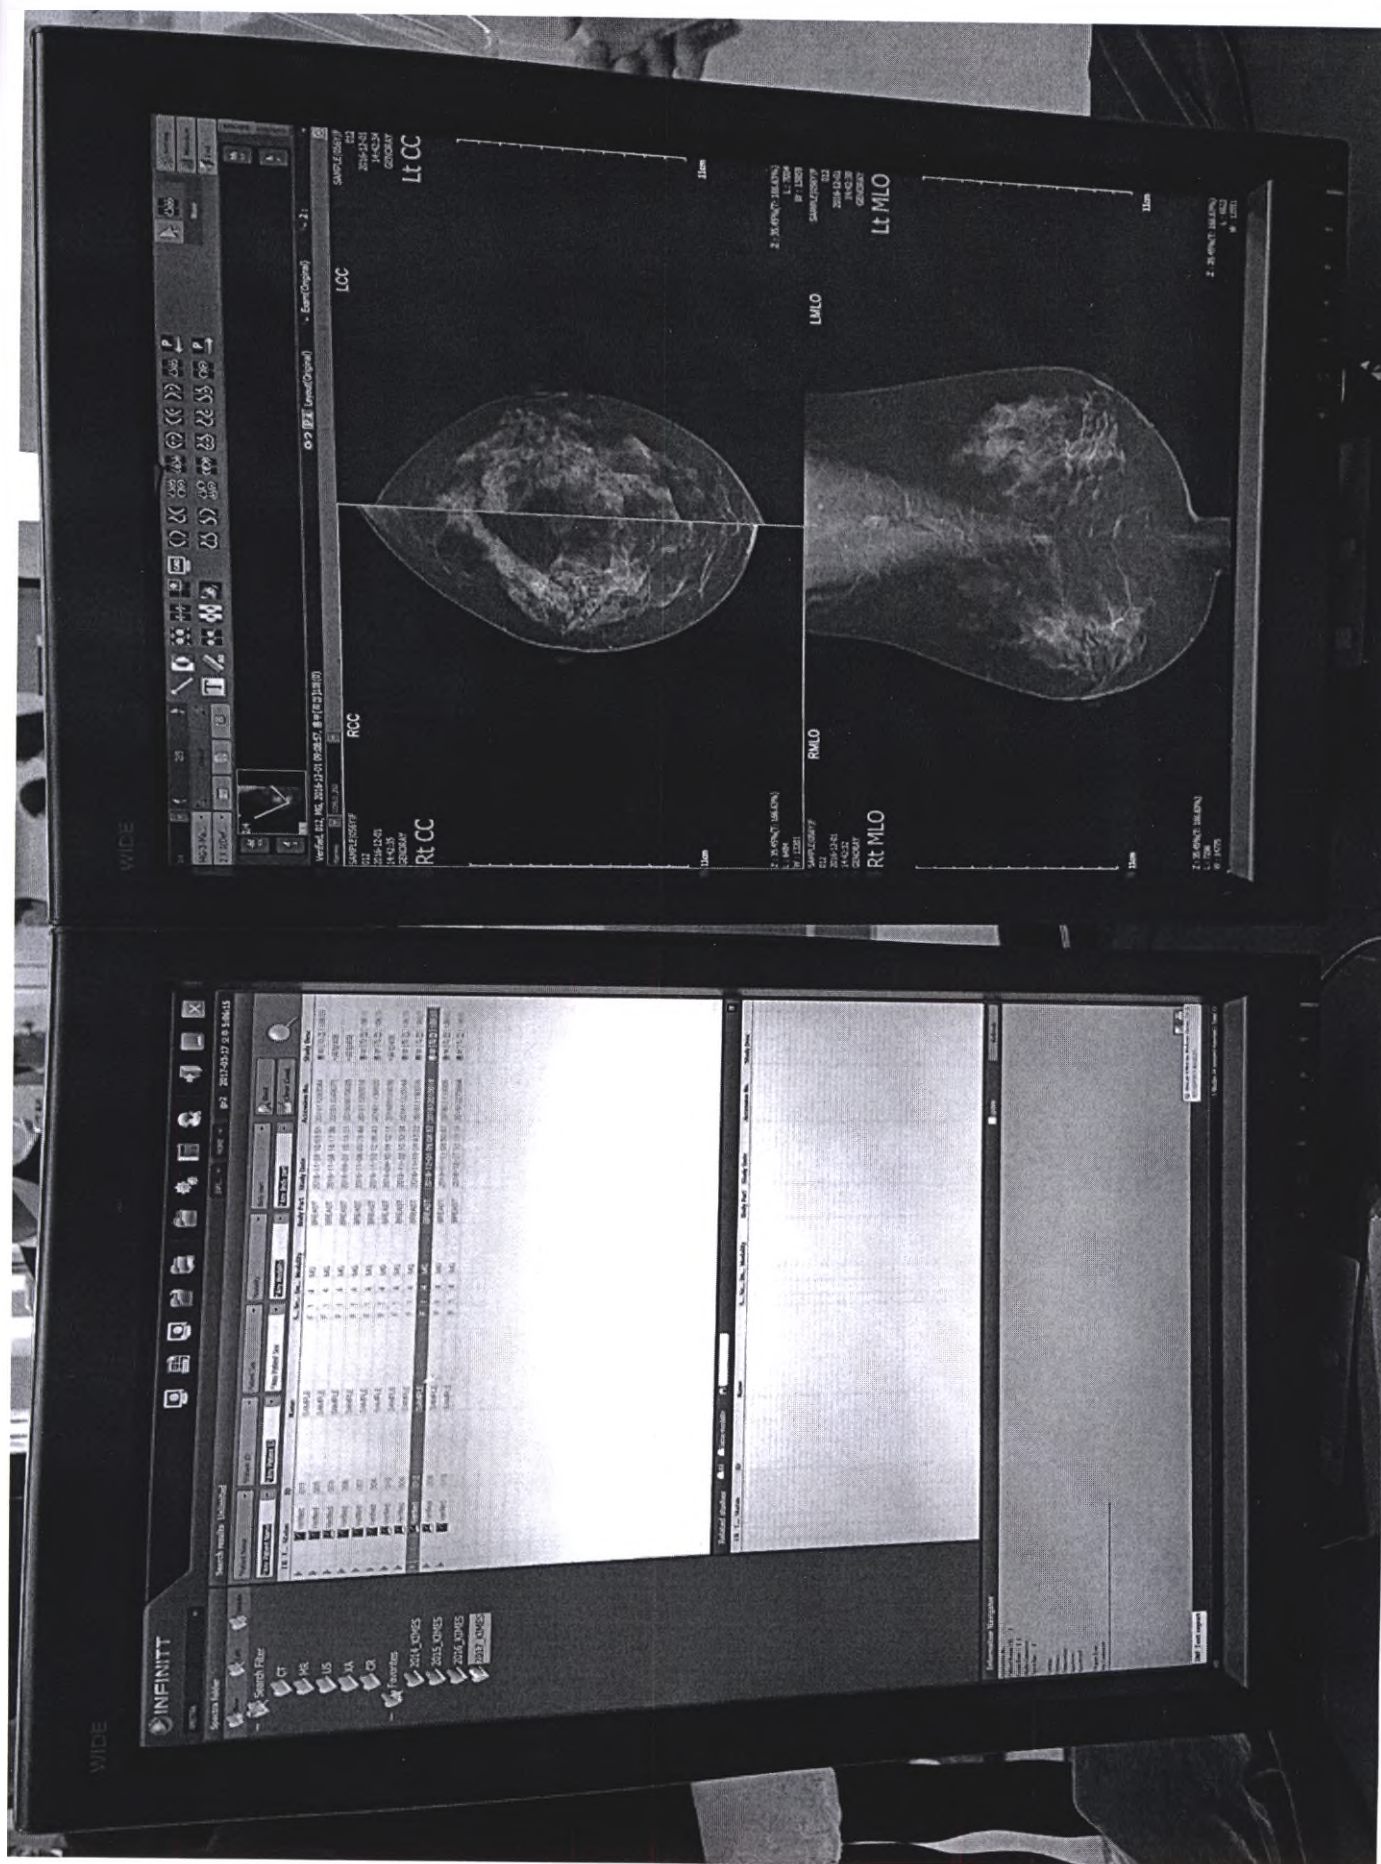


Рис 21. - Монитор медицинский монохромный;



Рис 22. - АРМ врача;

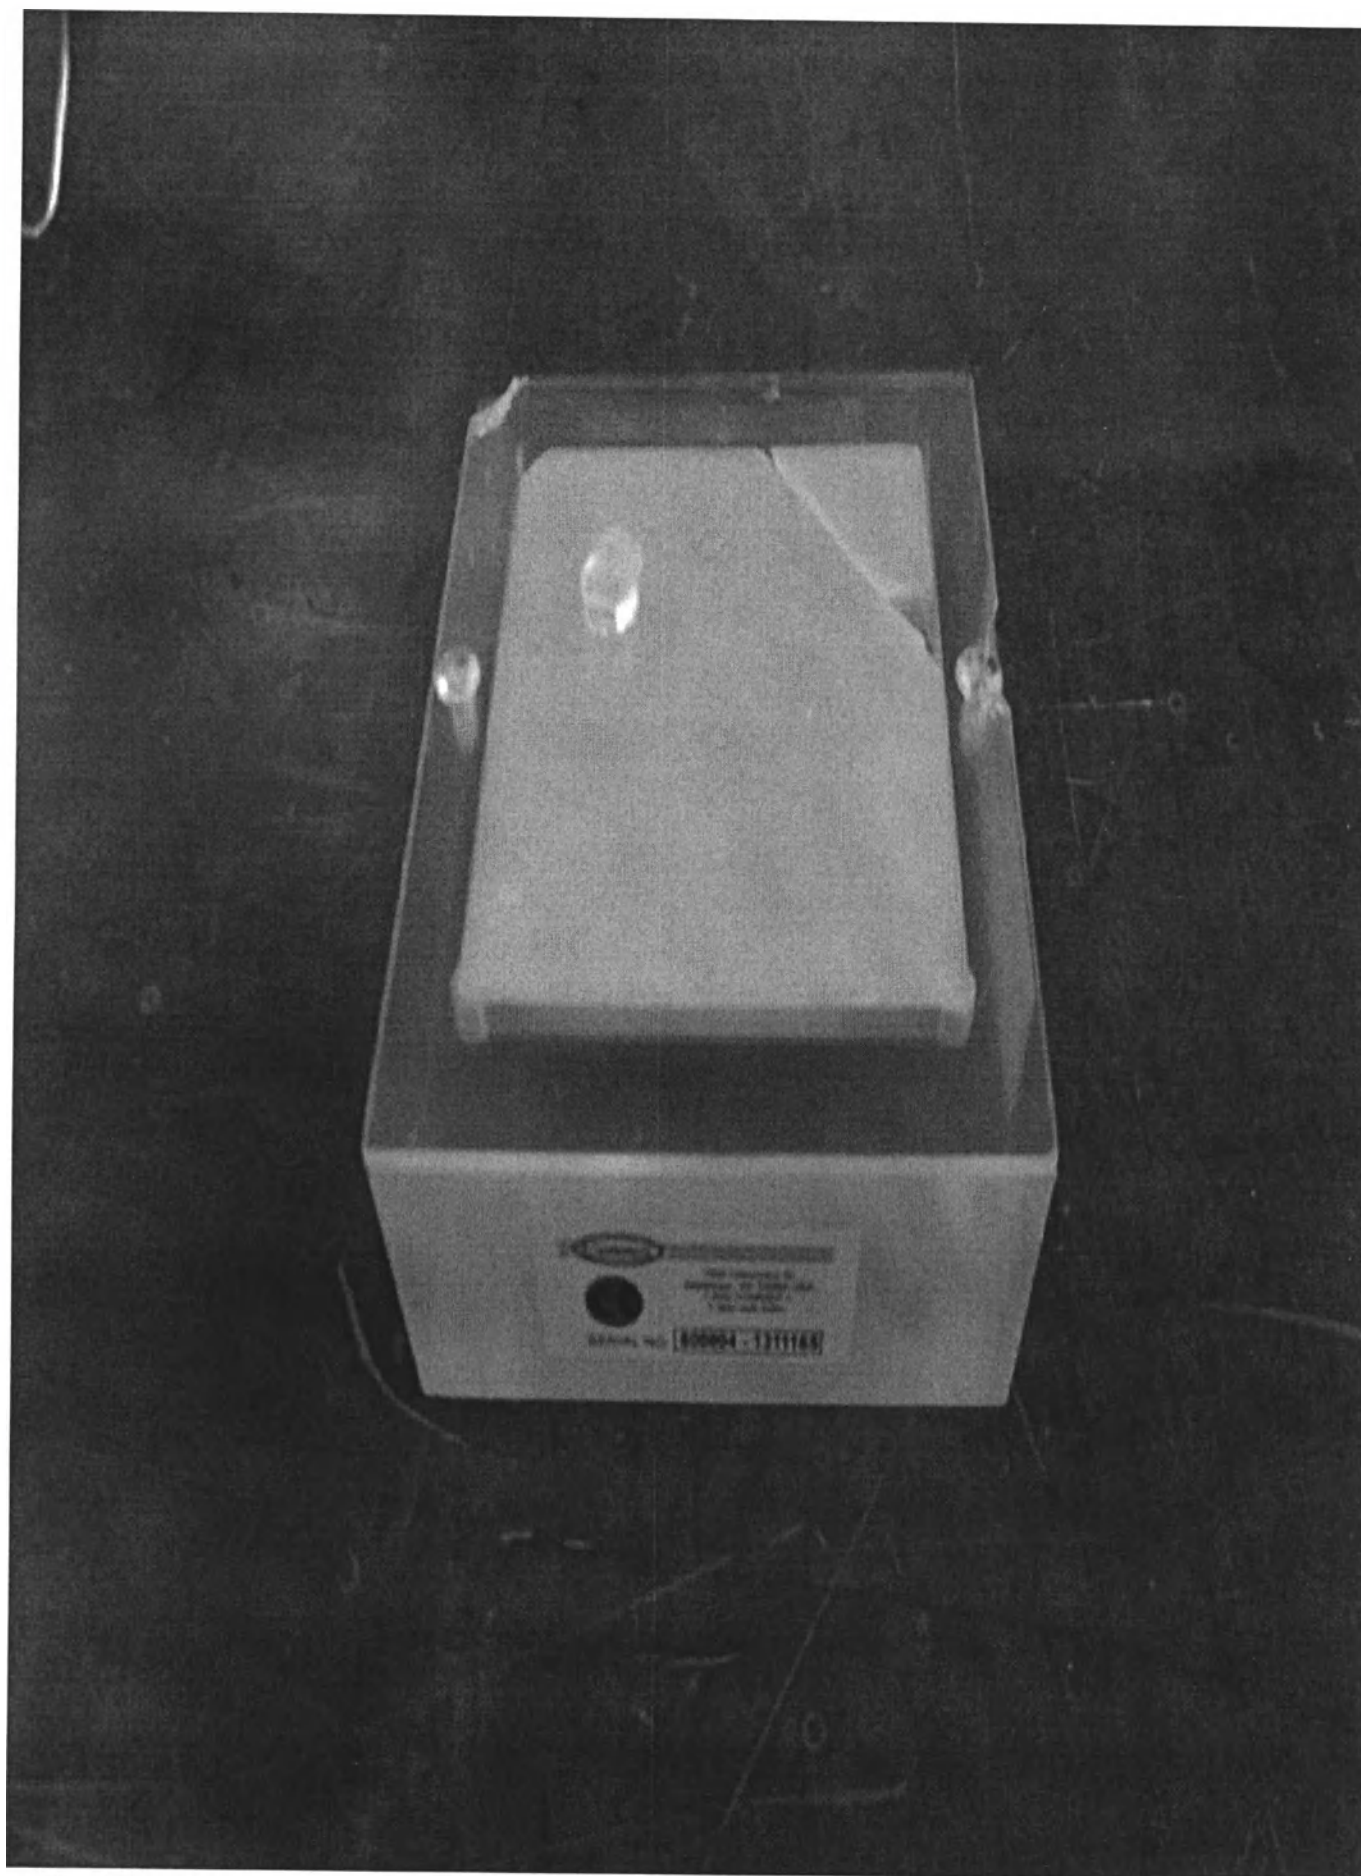


Рис 23. - Фантом для калибровки;

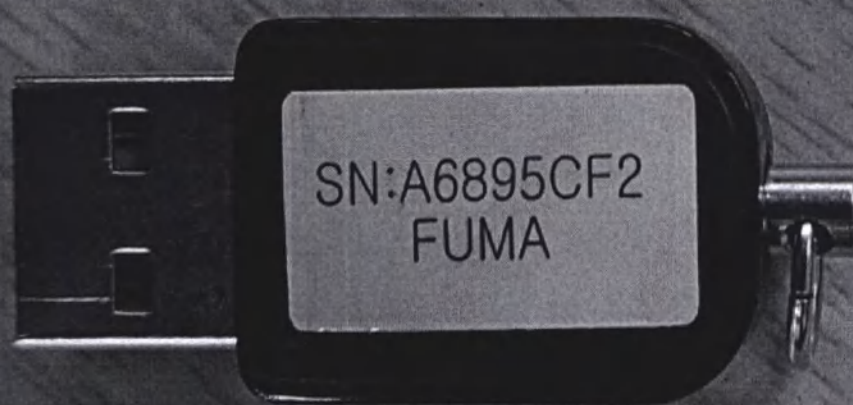



Рис 24. - Ключ активации PACS;

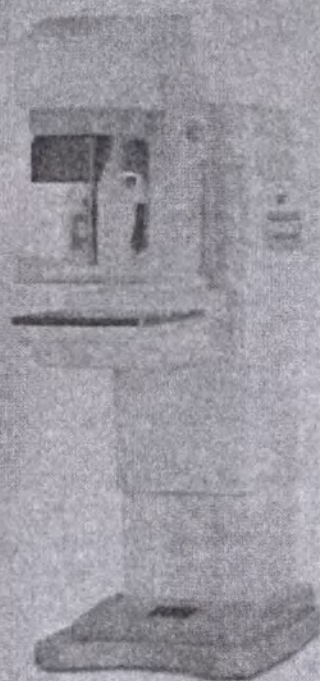


Рис 25. - Блок из двух ножных педалей для управления аппаратом;



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
**СИСТЕМА МАММОГРАФИЧЕСКАЯ
ЦИФРОВАЯ DMX-600**

производства «ДЖЕНОРЭЙ Ко., Лтд.», Корея



Июль 2018 г.

Рис 26. - Руководство по эксплуатации.



пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью всего 32 листов
Генеральный директор
ООО «С.П.ГЕЛПИК»
Самойлов А.Б.