


Фотографические изображения

Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS)

Состав:

- 1.Отрицательный контроль (–) С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.**
- 2. Низкотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 L(+)С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.**
- 3.Высокотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 H(+)С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.**
- 4. Информационная карточка-вкладыш – 1 шт.**

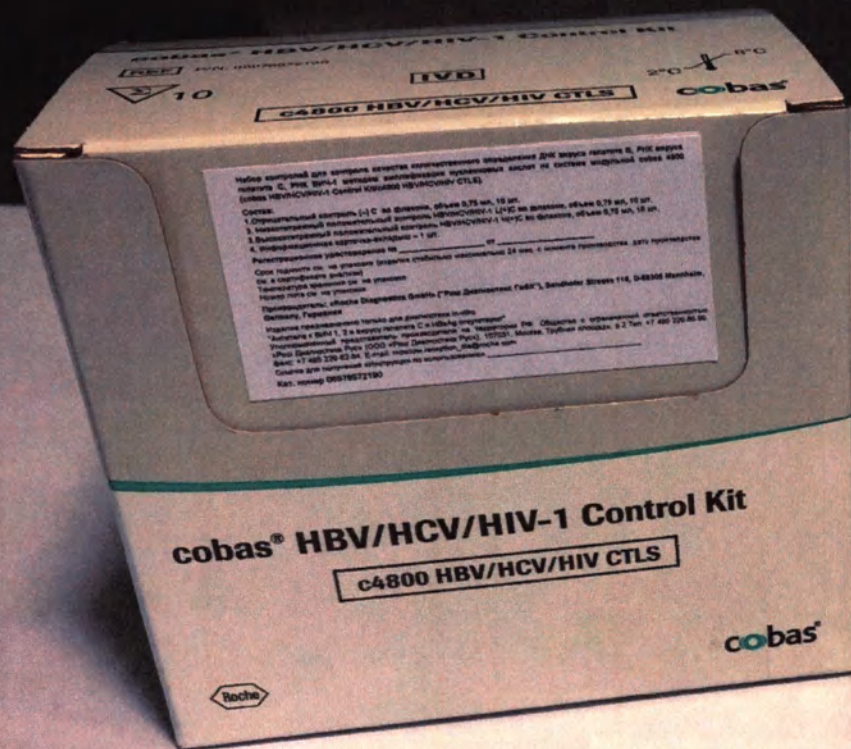

cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit
for use on the cobas® 4800 System
c4800 HBV/HCV/HIV CTLS

KIT **LOT** E11318
2019/06

IVD

LOT
(-) C E11319
HBV/HCV/HIV-1 L(+)C E11320
HBV/HCV/HIV-1 H(+)C E11331



cobas® 4800 system
cobas® HBV, HCV or HIV-1 AP v1.1 or higher
cobas® 4800 system Application Software Version 2.2 or higher

Manufactured in the United States

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68299 Mannheim, Germany

07373945001-02

Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото общего вида

Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS).

Состав:

1. Отрицательный контроль (-) С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.
2. Низкотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 L(+)С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.
3. Высокотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 H(+)С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.
4. Информационная карточка-вкладыш – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

"Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют"


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2 Тел: +7 495 226-69-99, факс: +7 495 226-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979572190

cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit

c4800 HBV/HCV/HIV CTLS



cobas®

Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): маркировка


Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модулей cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото общего вида




Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото общего вида




Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото общего вида

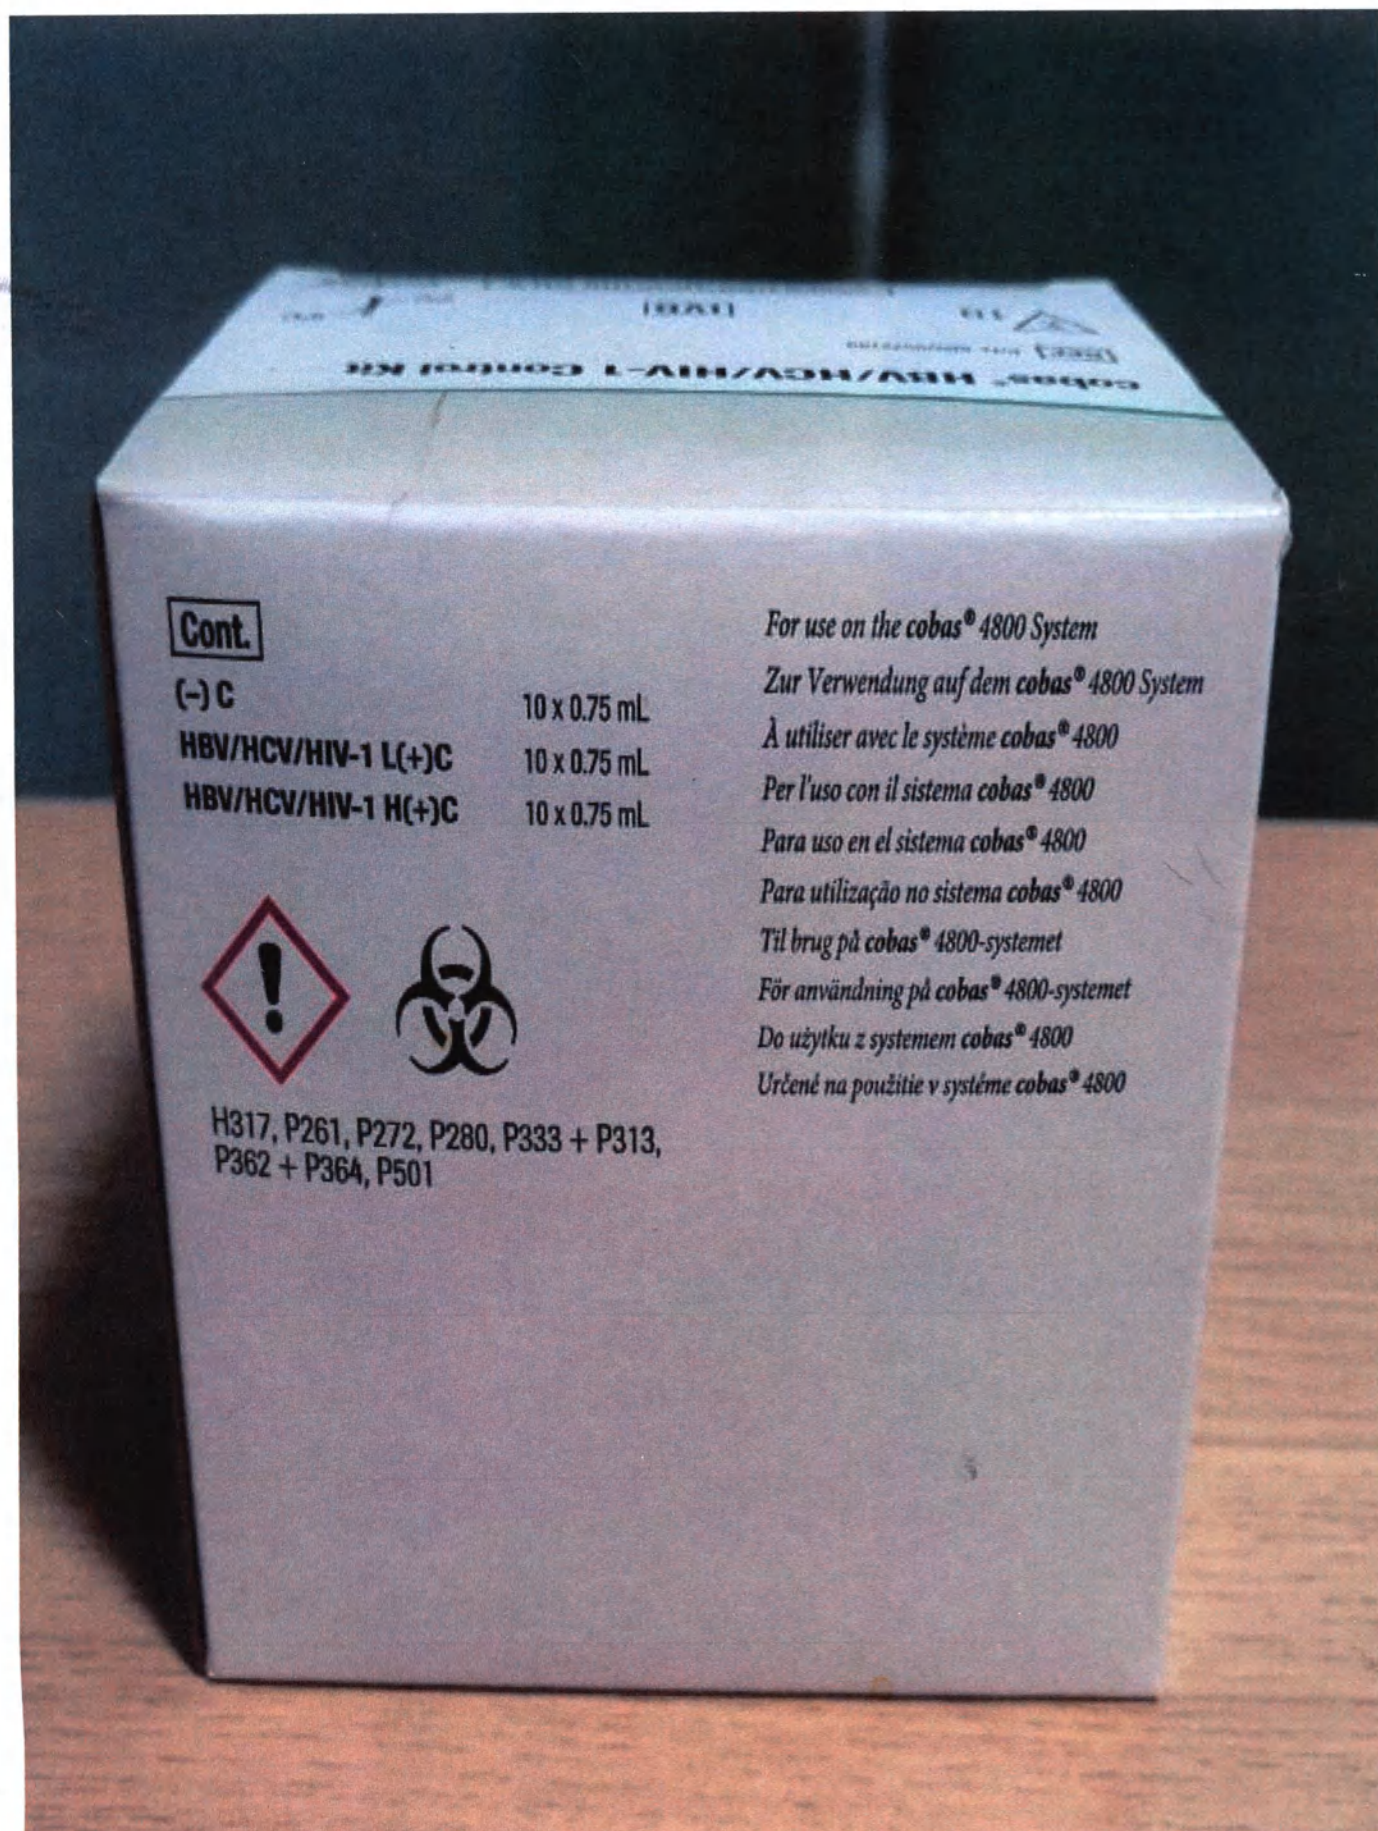

Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото общего вида

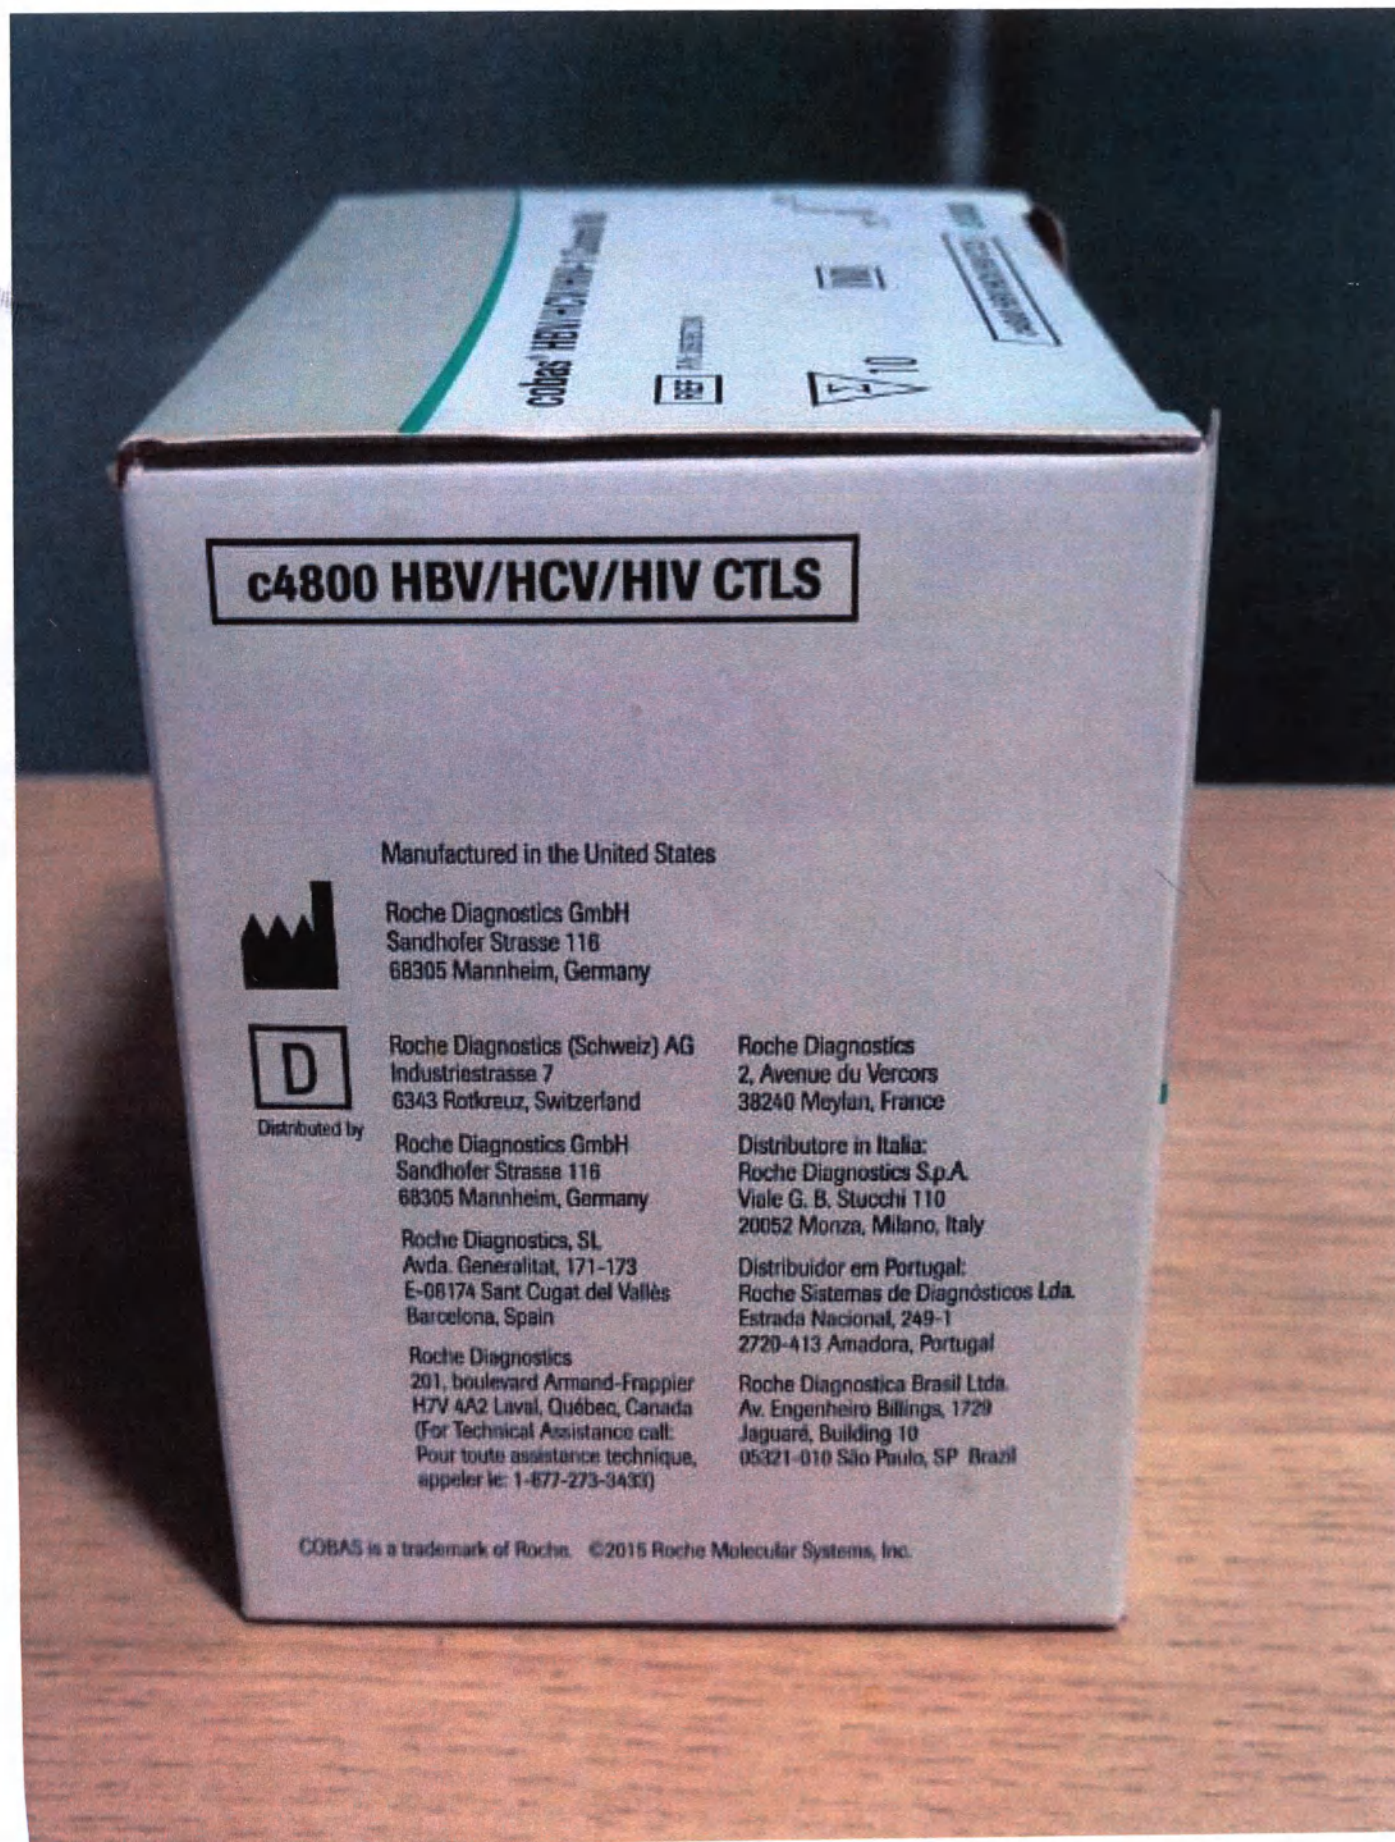

Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото
Отрицательный контроль (-) С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.

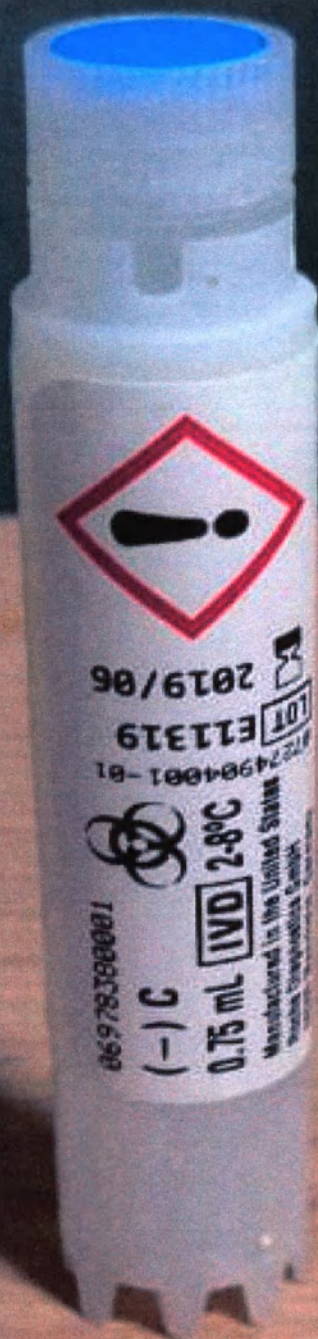

Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото Отрицательный контроль (-) С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.



Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото

Низкотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 L(+)С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.



Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото Низкотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 L(+)С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.



Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото Высокотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 Н(+)/С во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.



Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото Высокотитражный положительный контроль HBV/HCV/HIV-1 H(+)C во флаконе, объем 0,75 мл, 10 шт.



Набор контролей для контроля качества количественного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ-1 методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit/c4800 HBV/HCV/HIV CTLS): фото Информационная карточка-вкладыш – 1 шт.

cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit
for use on the cobas® 4800 System



c4800 HBV/HCV/HIV CTLS

KIT **LOT** E11318



2019/06



LOT

(-) C E11319

HBV/HCV/HIV-1 L(+)C E11320

HBV/HCV/HIV-1 H(+)C E11331



cobas® 4800 system

cobas® HBV, HCV or HIV-1 AP v1.1 or higher

cobas® 4800 system Application Software Version 2.2 or higher

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

07373945001-02

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
читаться (14) листа (ов)

Лучина

Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018

