

Фотографические изображения


**Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800
(cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)**

Вариант поставки на 240 тестов, в составе:

- 1. Реагент 2 (MGP 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.**
- 2. Буфер для элюции 2 (EB 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.**

Вариант поставки на 960 тестов, в составе:

- 1. Реагент 2 (MGP 2) во флаконе, объем 16 мл, 10 шт.**
- 2. Буфер для элюции 2 (EB 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.**

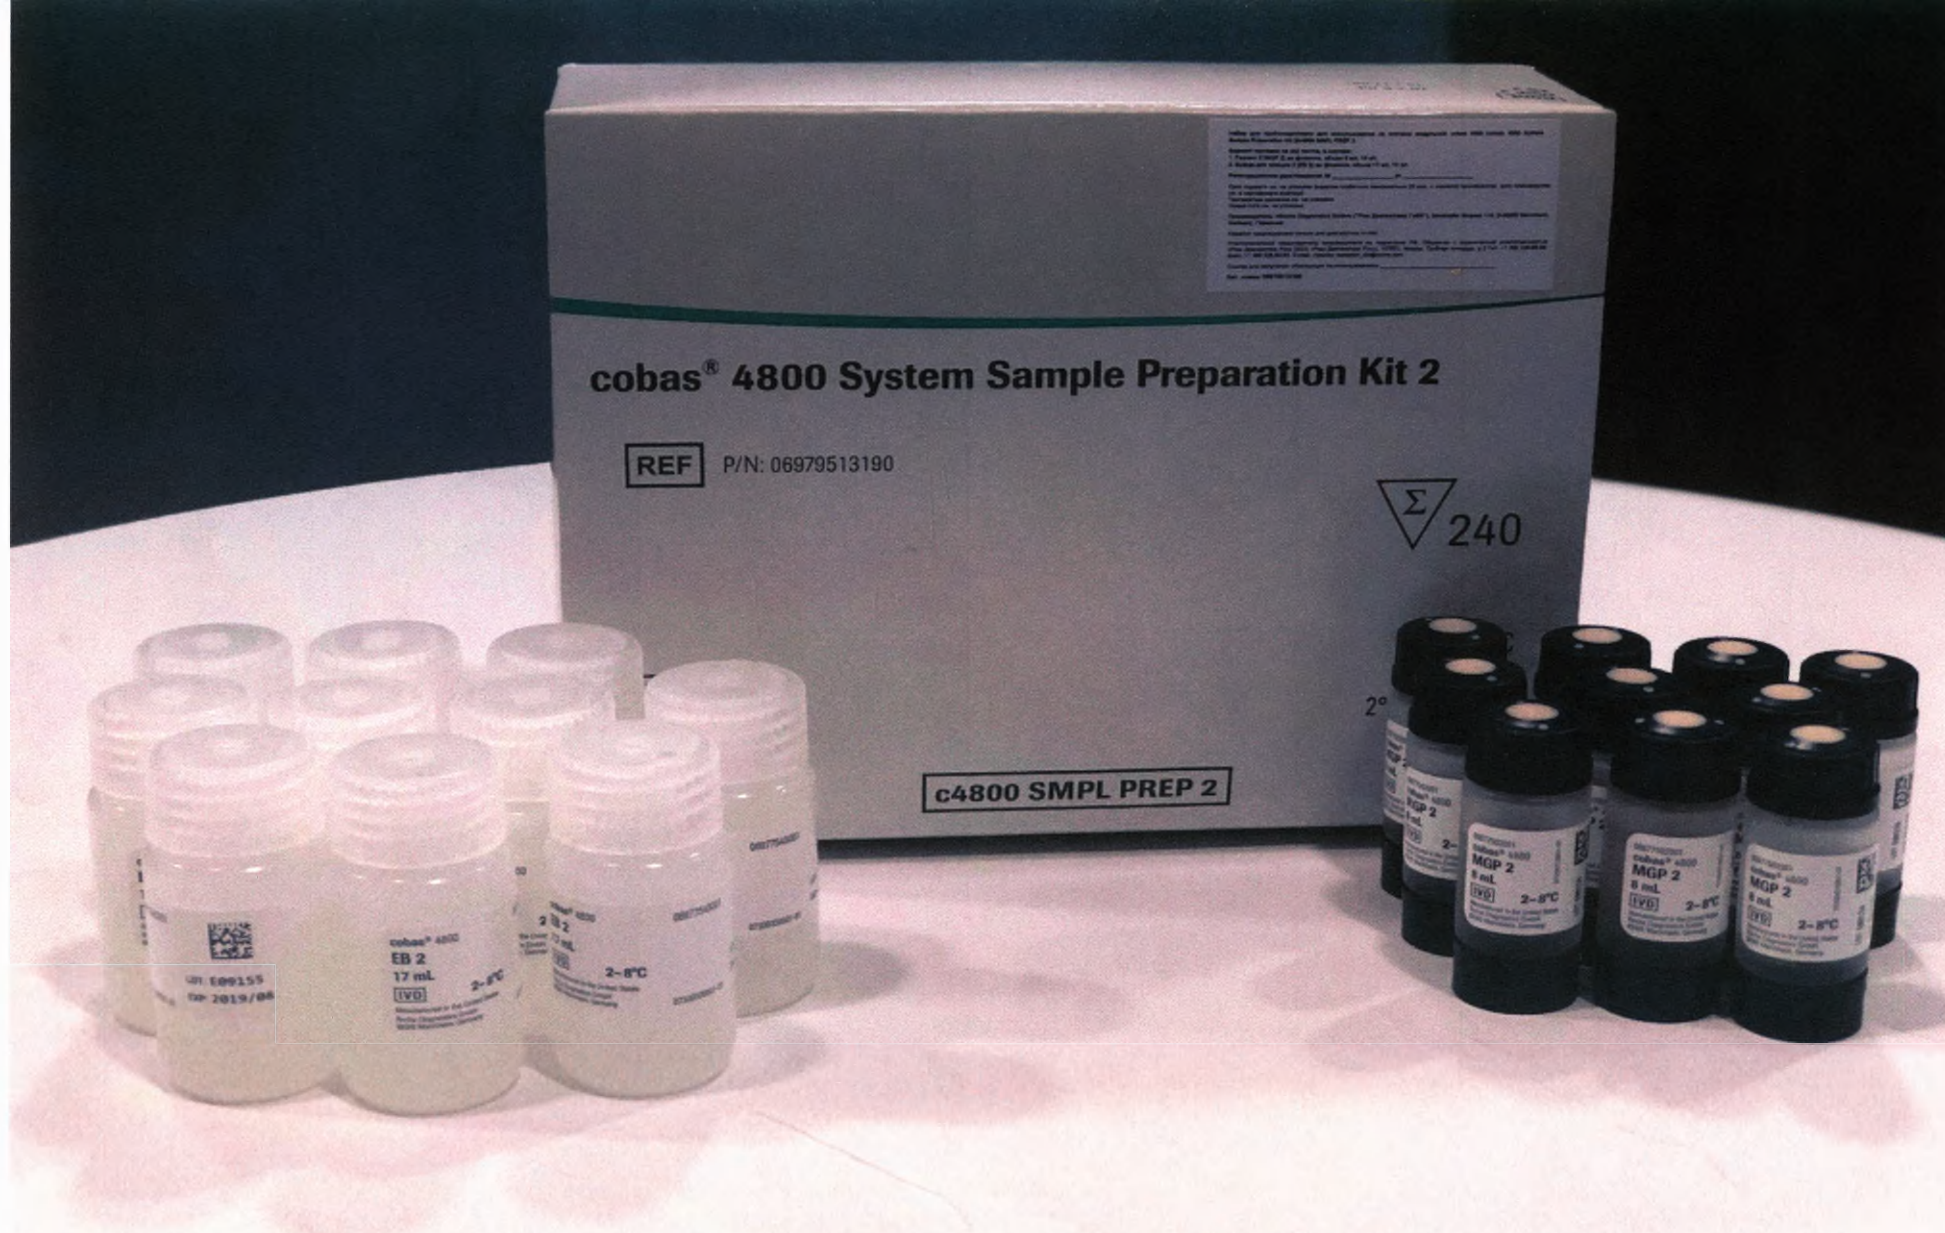

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 240 тестов, в составе:
1. Реагент 2 (R2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.
2. Буфер для элиута 2 (B2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.
Регистрационное удостоверение № _____
Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно минимум 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)
Температура хранения см. на упаковке
Намочить реагент см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 118, D-68305 Mannheim, Германия
Издание предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель, продавец на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь, д. 2 Тел: +7 495 229-60-60, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: rosch@rosch-diag.com
Ссылка для получения информации по использованию _____
Кит, номер 06979513190

cobas[®] 4800 System Sample Preparation Kit 2

REF

P/N: 06979513190

Σ 240

IVD

2°C — 8°C

c4800 SMPL PREP 2

cobas[®]

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)

Вариант поставки на 240 тестов, в составе:

1. Реагент 2 (MGR 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.
2. Буфер для элюции 2 (EB 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979513190

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 240 тестов: фото маркировки

e Preparation Kit 2

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



Distributed by

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, Switzerland

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Roche Diagnostics, SL
Avda. Generalitat, 171-173
E-08174 Sant Cugat del Valles
Barcelona, Spain

Roche Diagnostics
201, boulevard Armand-Frappier
H7V 4A2 Laval, Québec, Canada
(For Technical Assistance call:
Pour toute assistance technique,
appeler le: 1-877-273-3433)

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors
38240 Meylan, France


Distributore in Italia:
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G. B. Stucchi 110
20052 Monza, Milano, Italy

Distribuidor em Portugal:
Roche Sistemas de Diagnósticos Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora, Portugal

Roche Diagnostica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729
Jaguari, Building 10
05321-010 São Paulo, SP Brazil

COBAS is a trademark of Roche. ©2015 Roche Molecular Systems, Inc.

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

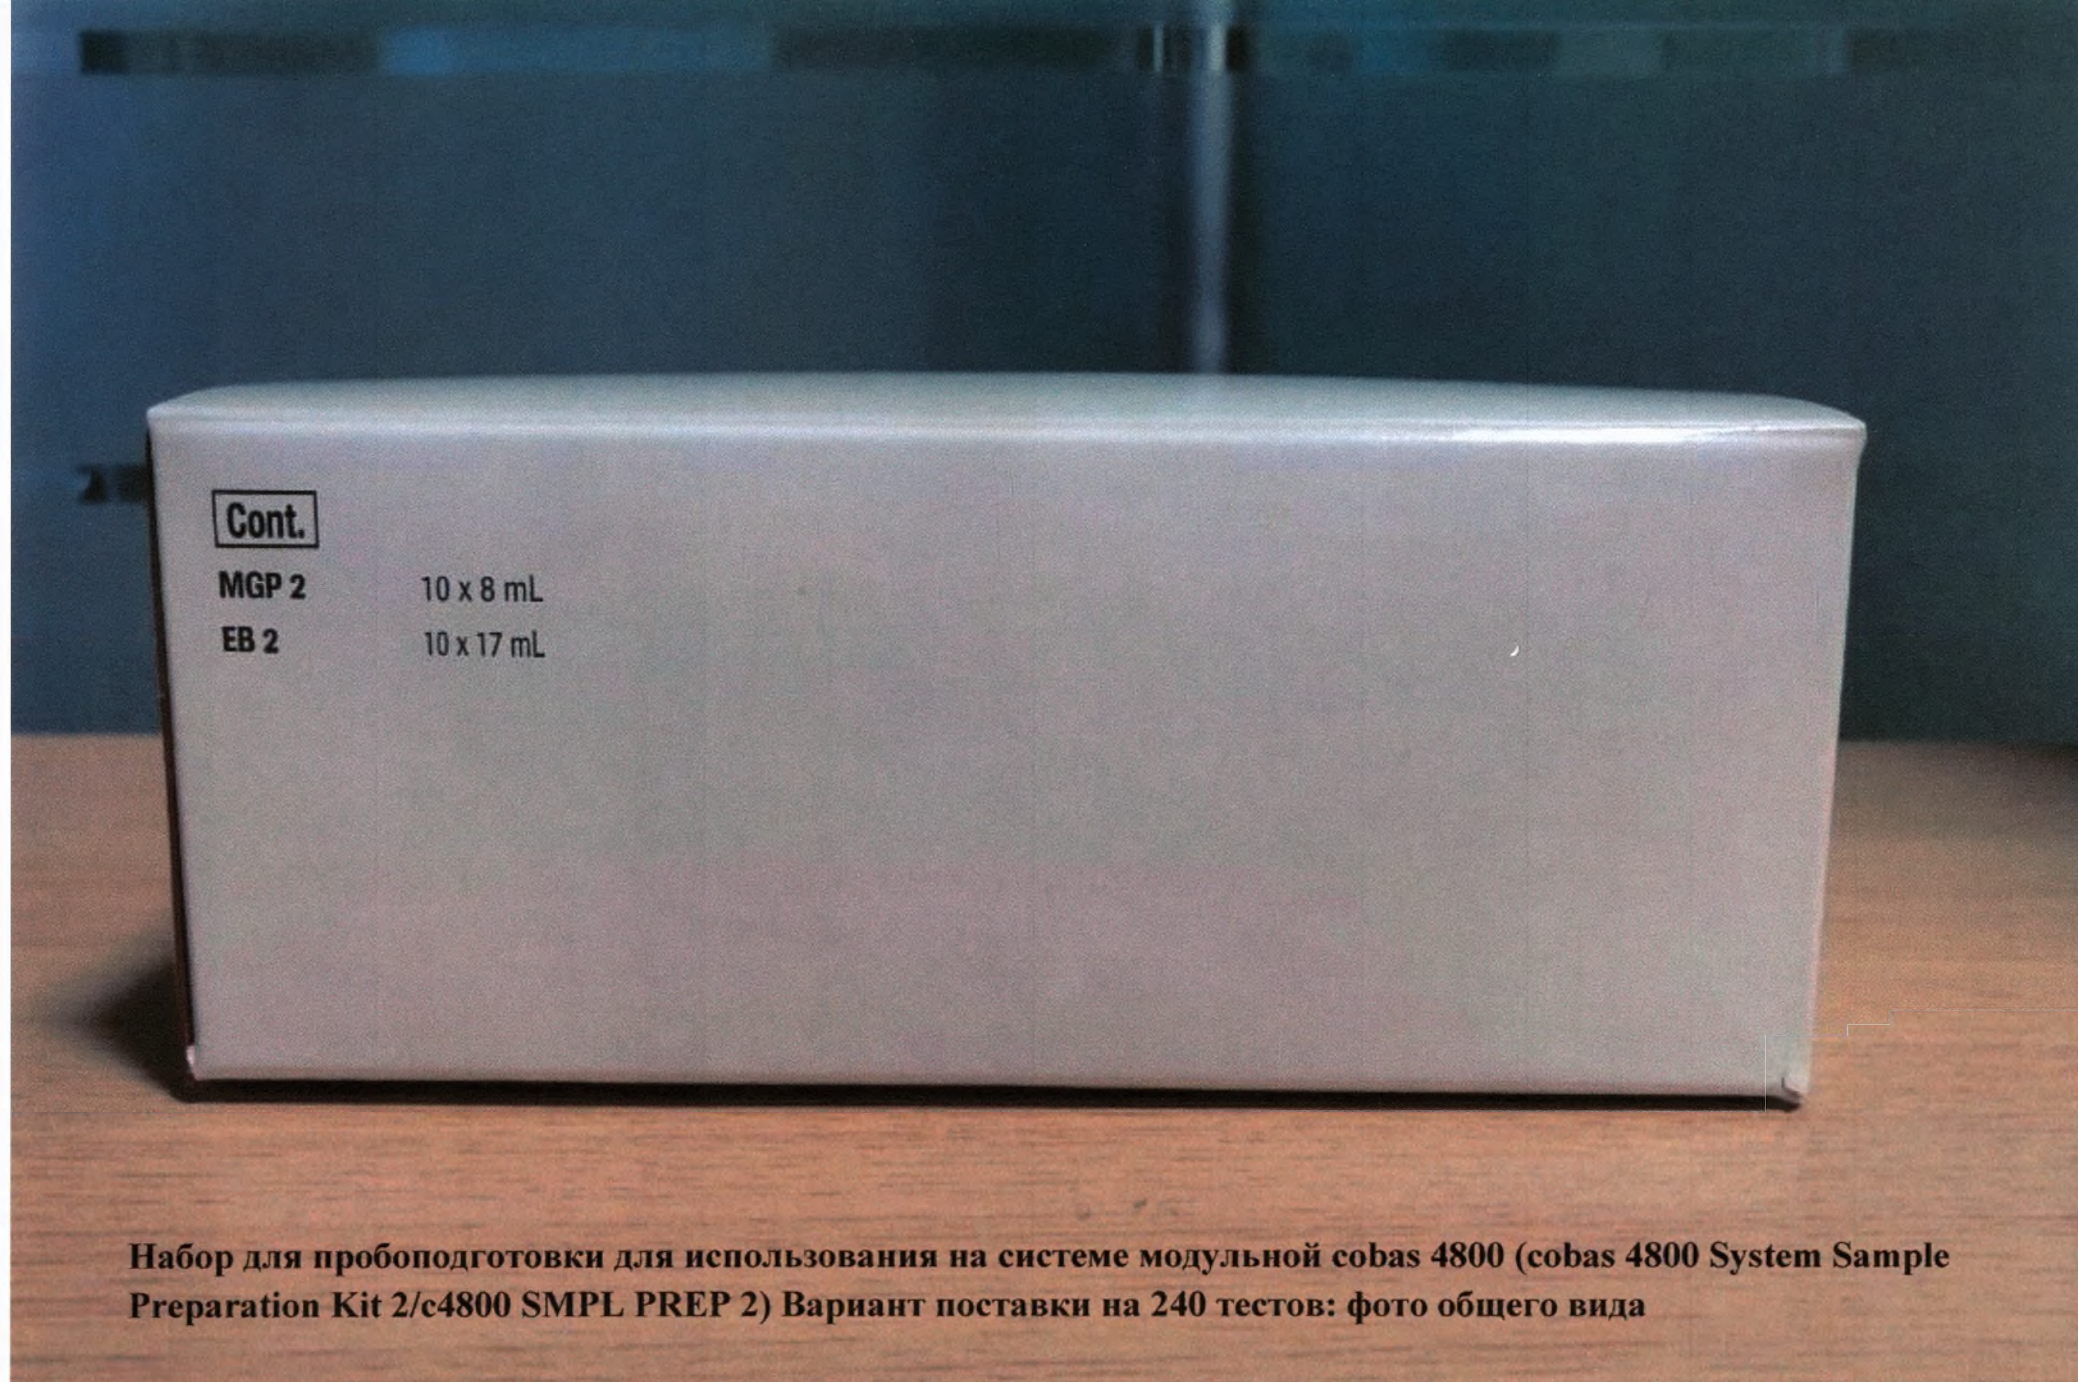

Cont.


MGP 2

10 x 8 mL

EB 2

10 x 17 mL

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

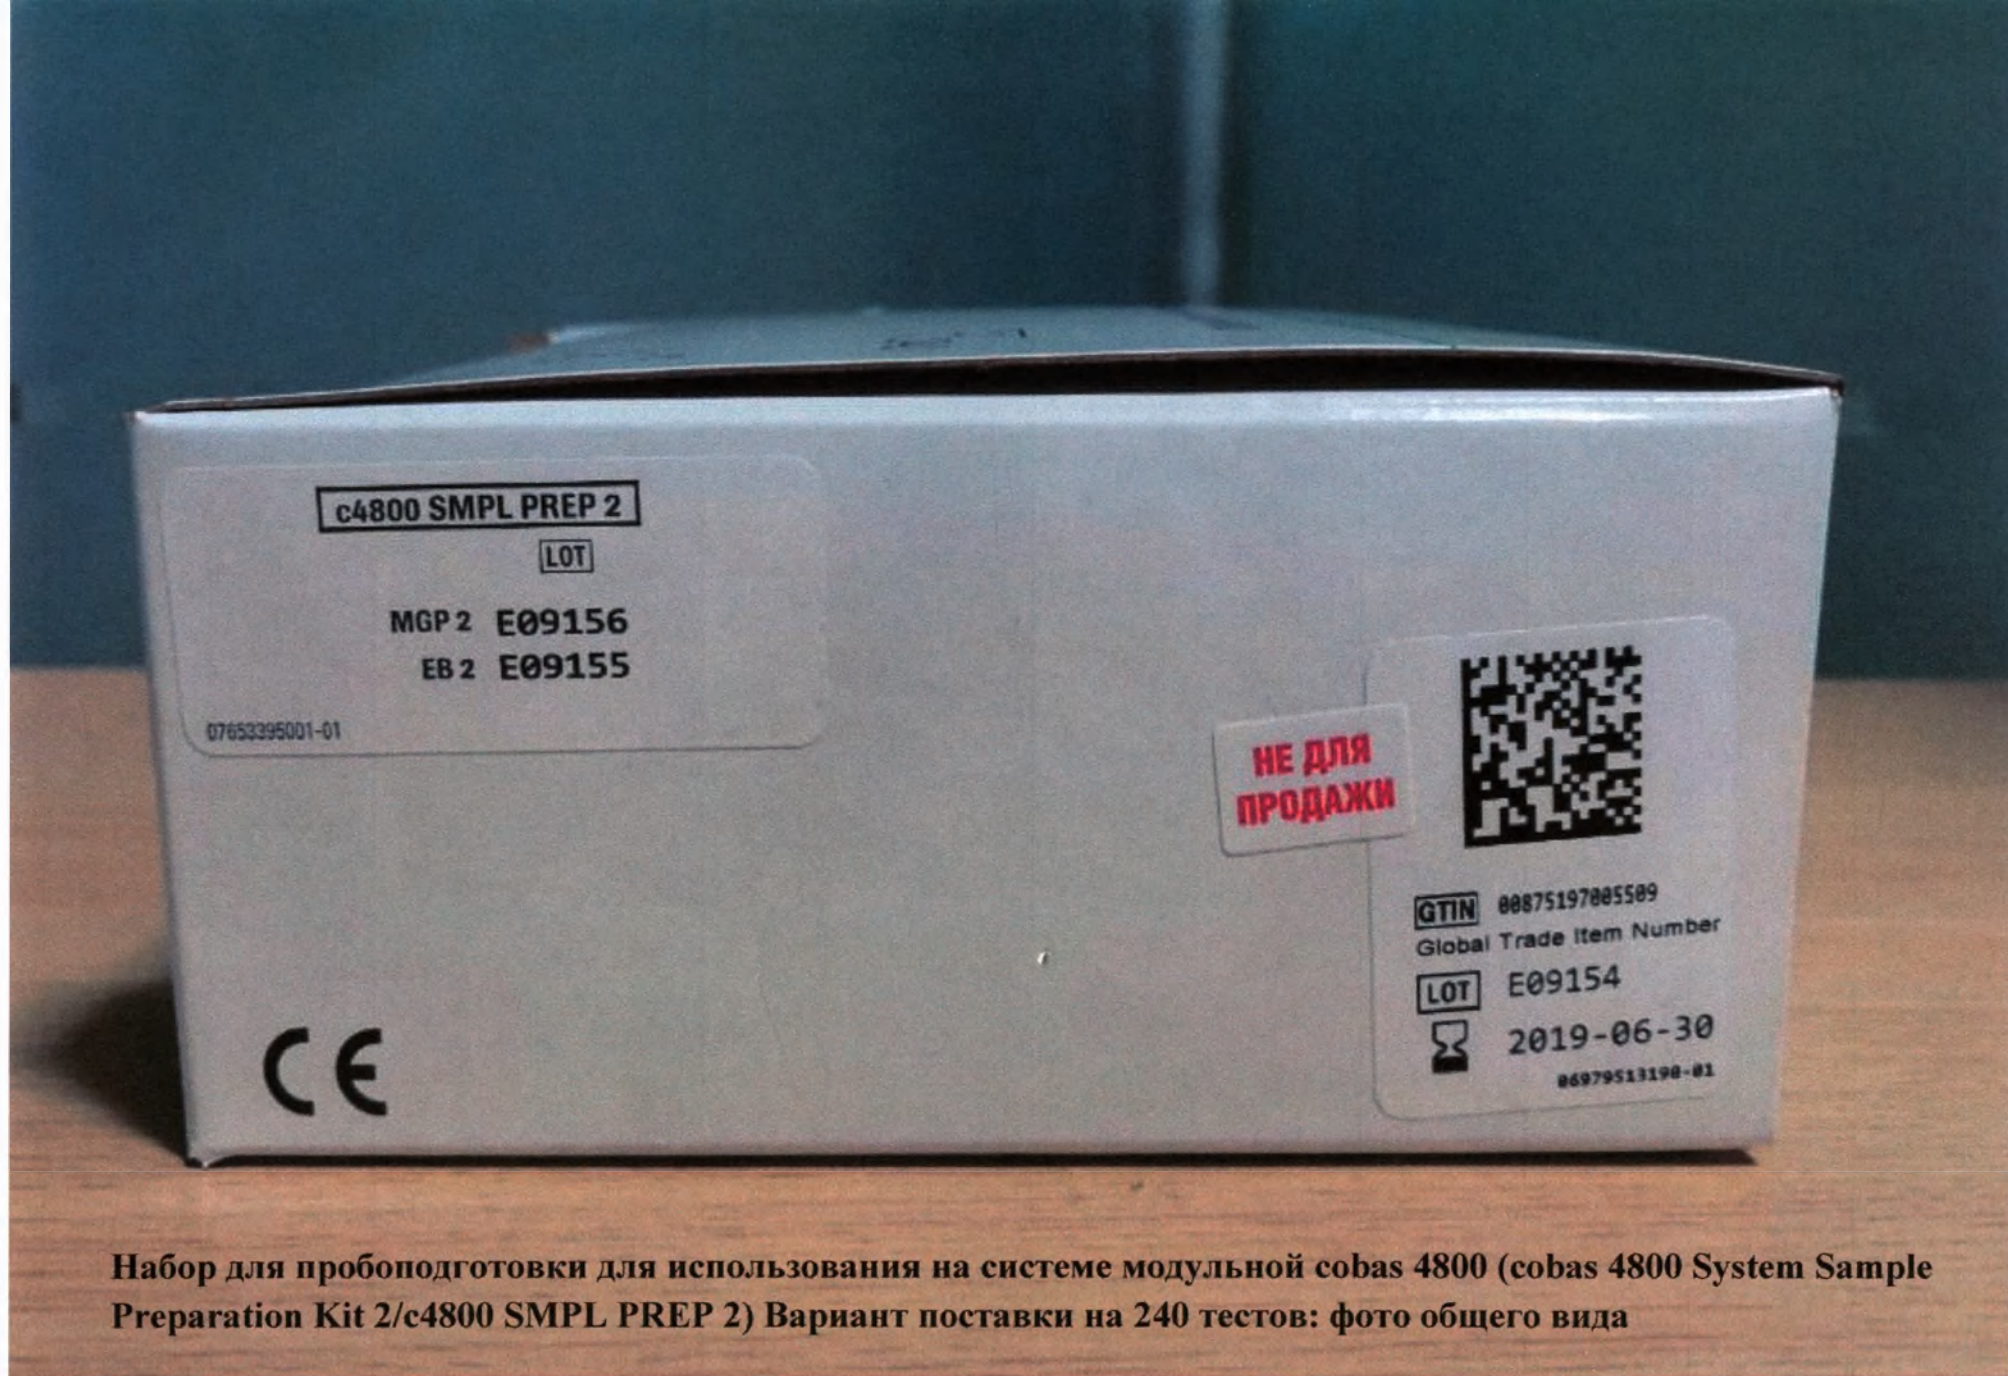

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида


Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 240 тестов: фото Реагент 2 (MGP 2) во флаконе, объем 8 мл, 10 шт.




**Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной
cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 240 тестов: фото Реагент 2 (MGP 2) во флаконе,
объем 8 мл, 10 шт.**




Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 240 тестов: фото Буфер для элюции 2 (EB 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.

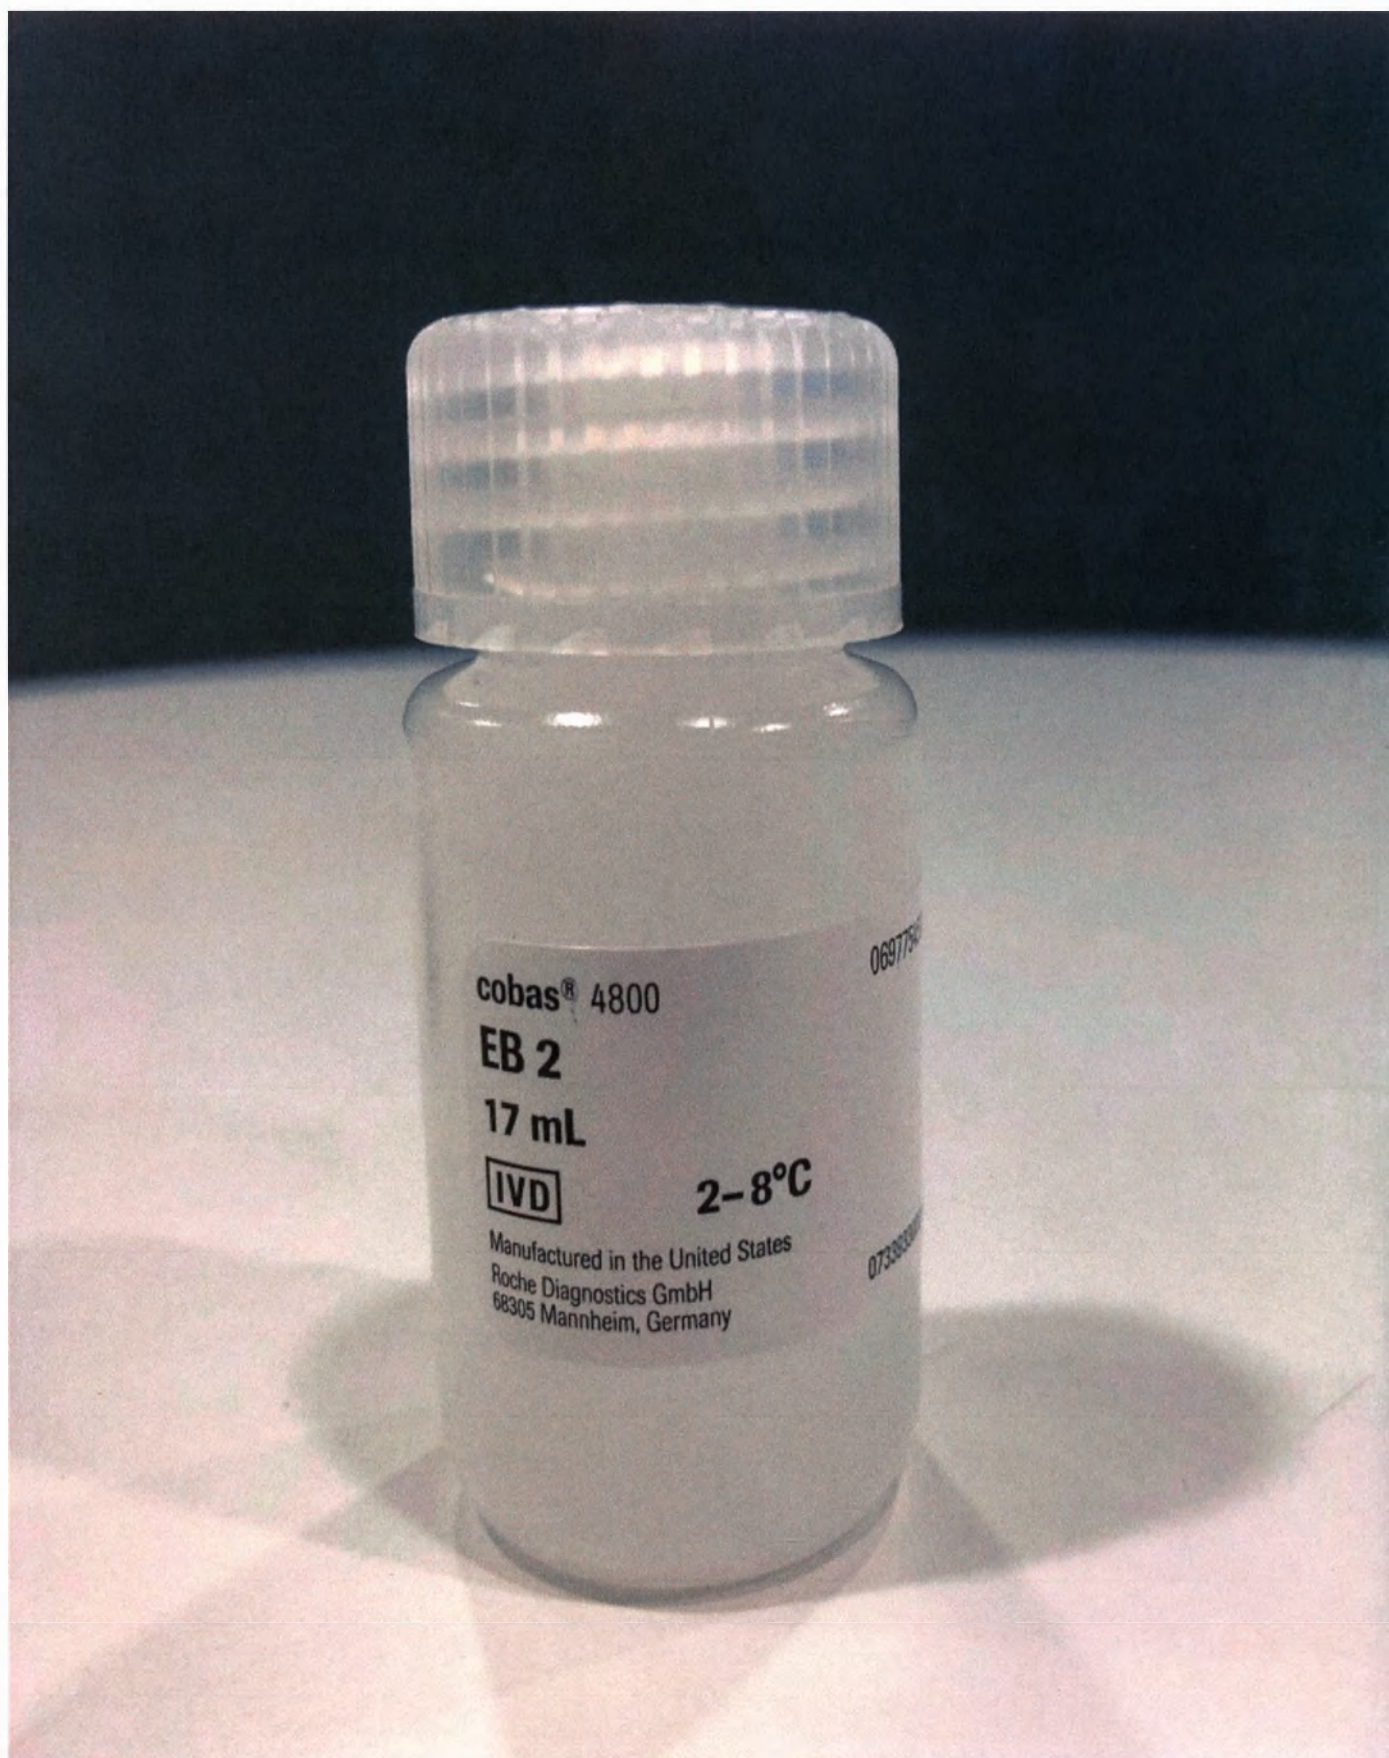

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 240 тестов: фото Буфер для элюции 2 (ЕВ 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.

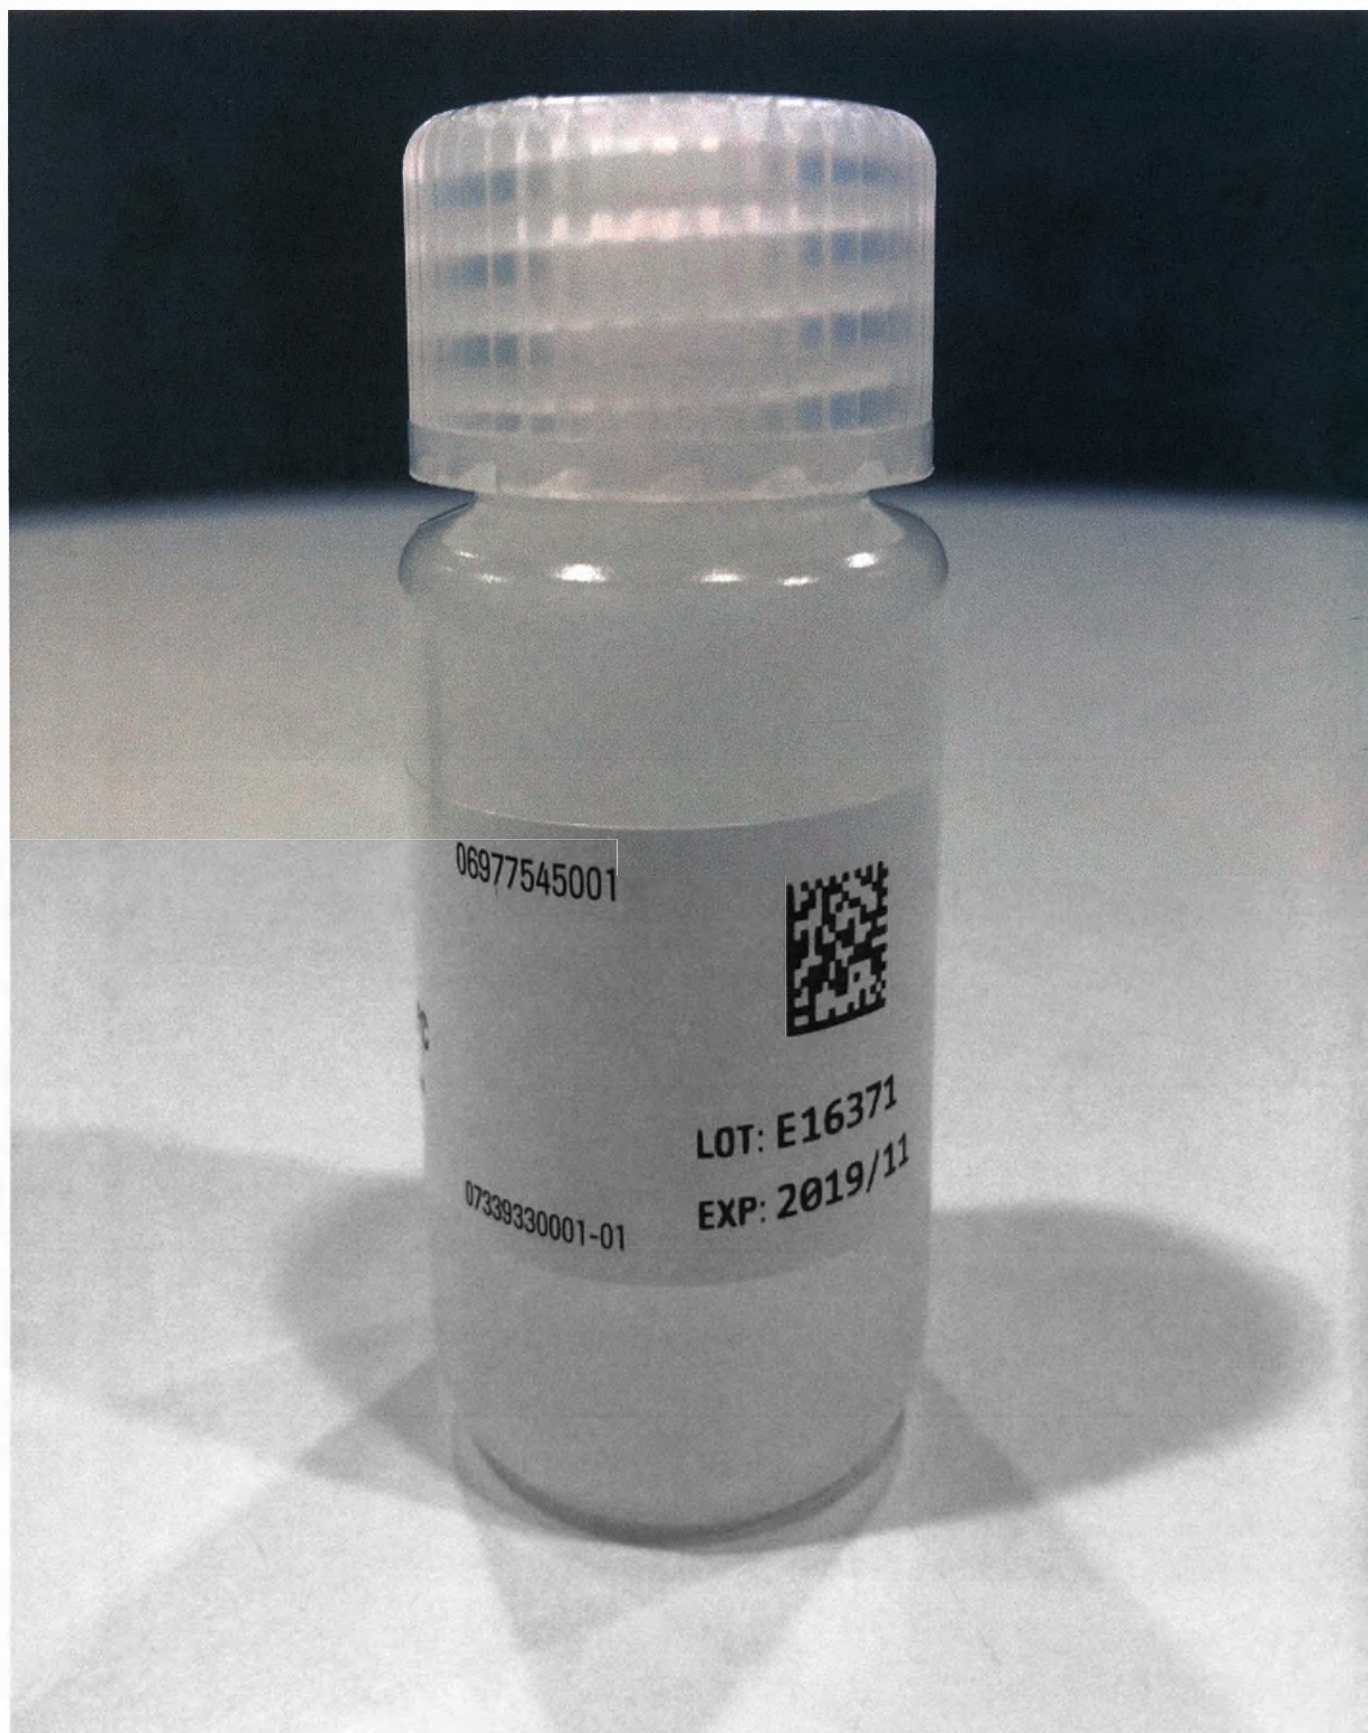

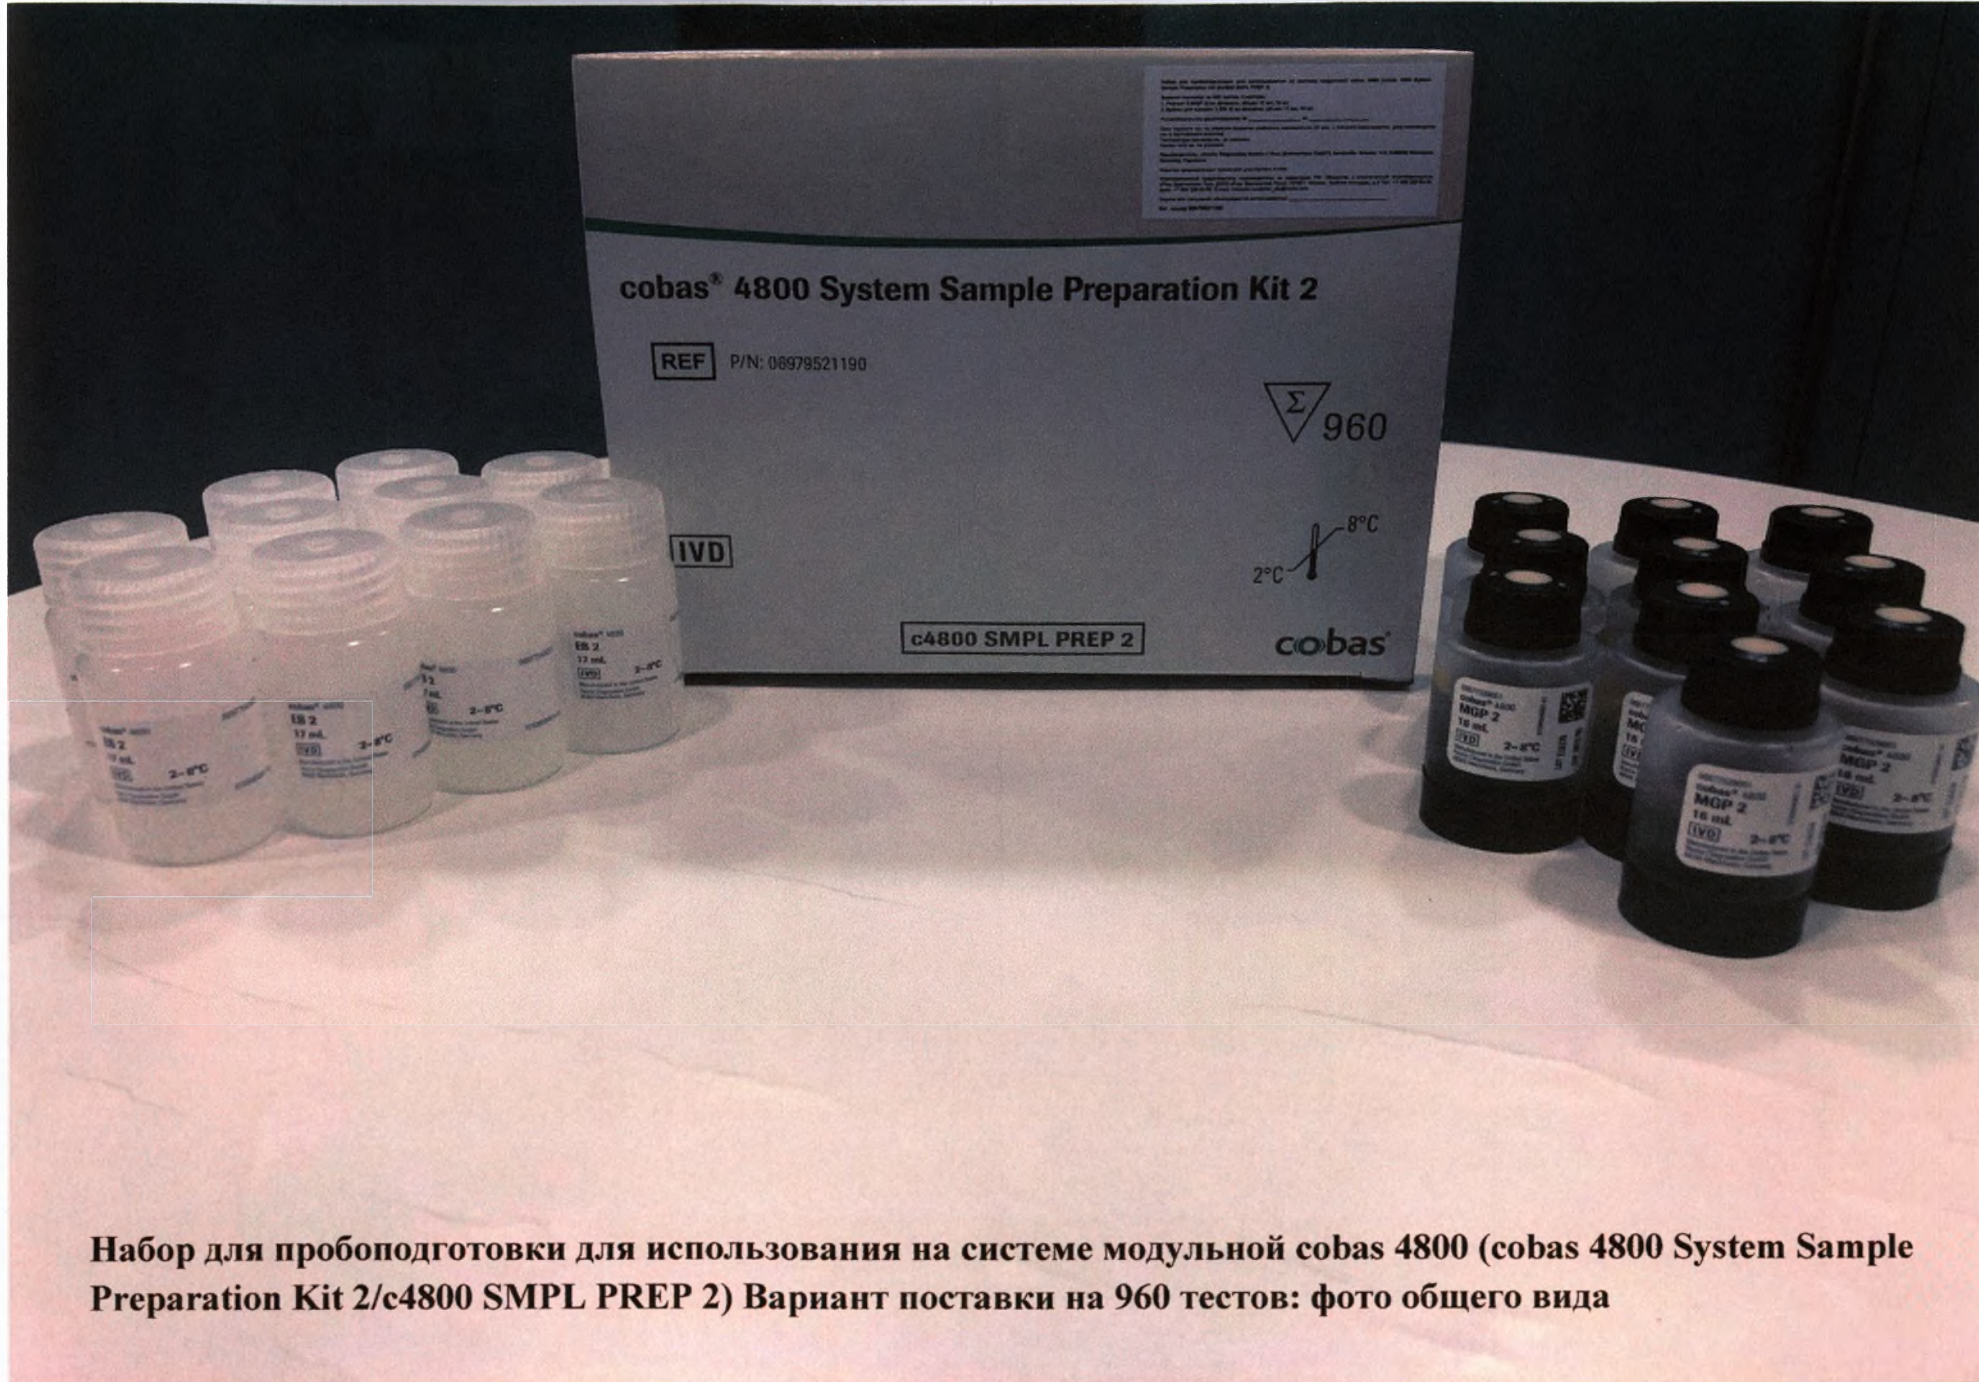

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной
cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)

Вариант поставки на 960 тестов, в системе:

1. Реагент 2 (R2P 2) на флаконе, объем 10 мл, 10 шт.
2. Буфер для инкубации 2 (B2 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (исходный срок годности 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

После чего см. на упаковке

Производитель: «Инда Геантекс Велит» ("Inda Geantex Velit"), Sandhofer Strasse 114, D-88300 Memmingen, Germany, Германия

Надлежащим образом хранить для длительного хранения

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Инда Геантекс Рус» (ООО «Инда Геантекс Рус»), 107001, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495 239-69-88, факс: +7 495 239-62-64, E-mail: info@indageantex.com

Ссылка для получения информации по использованию

Кат. номер 06979521190


cobas[®] 4800 System Sample Preparation Kit 2

REF

P/N: 06979521190

IVD

 960

 2°C — 8°C

c4800 SMPL PREP 2

cobas[®]

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)

Вариант поставки на 960 тестов, в составе:

1. Реагент 2 (MGP 2) во флаконе, объем 16 мл, 10 шт.
2. Буфер для элюции 2 (EB 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-89-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979521190

Preparation Kit 2

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 960 тестов: фото маркировки

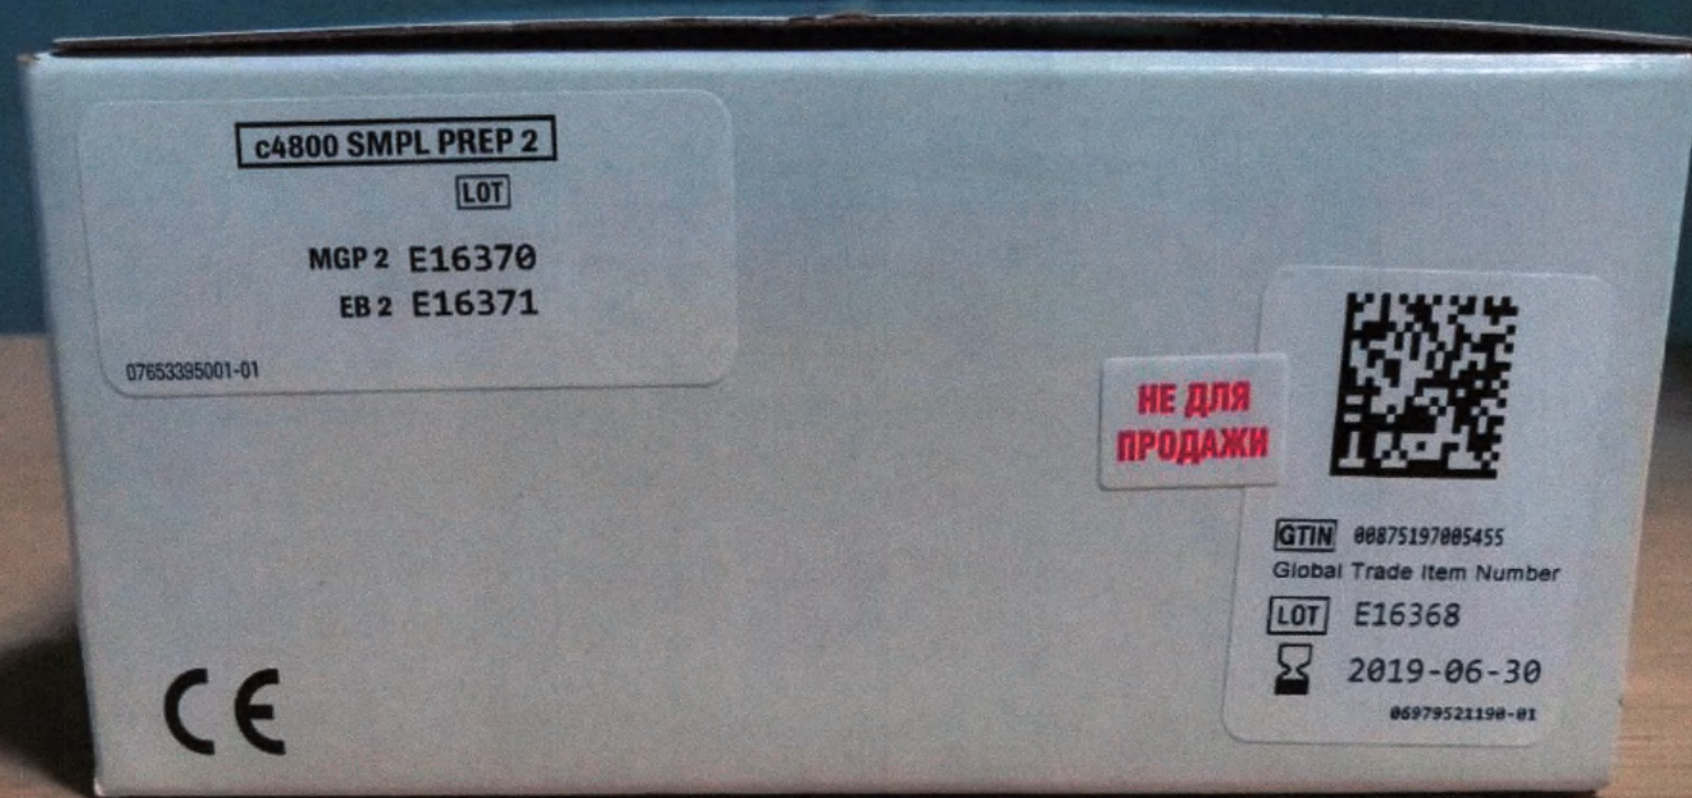

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида

Cont.

MGP 2


10 x 16 mL

EB 2


10 x 17 mL

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2) Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида


Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 960 тестов: фото Реагент 2 (MGP 2) во флаконе, объем 16 мл, 10 шт.

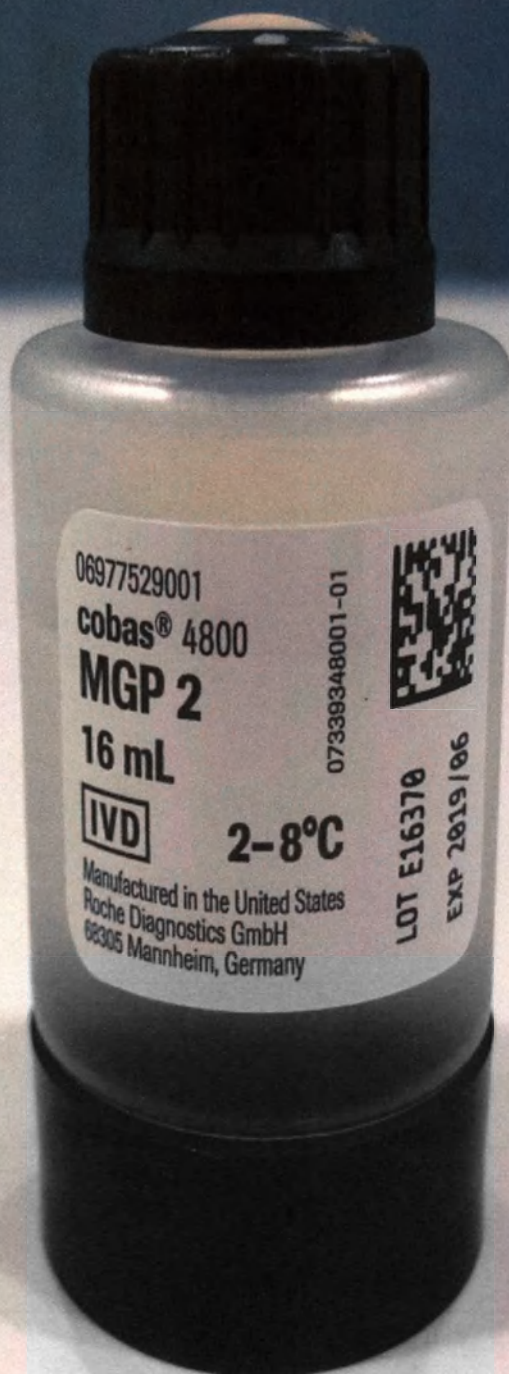

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 960 тестов: фото Буфер для элюции 2 (EB 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.

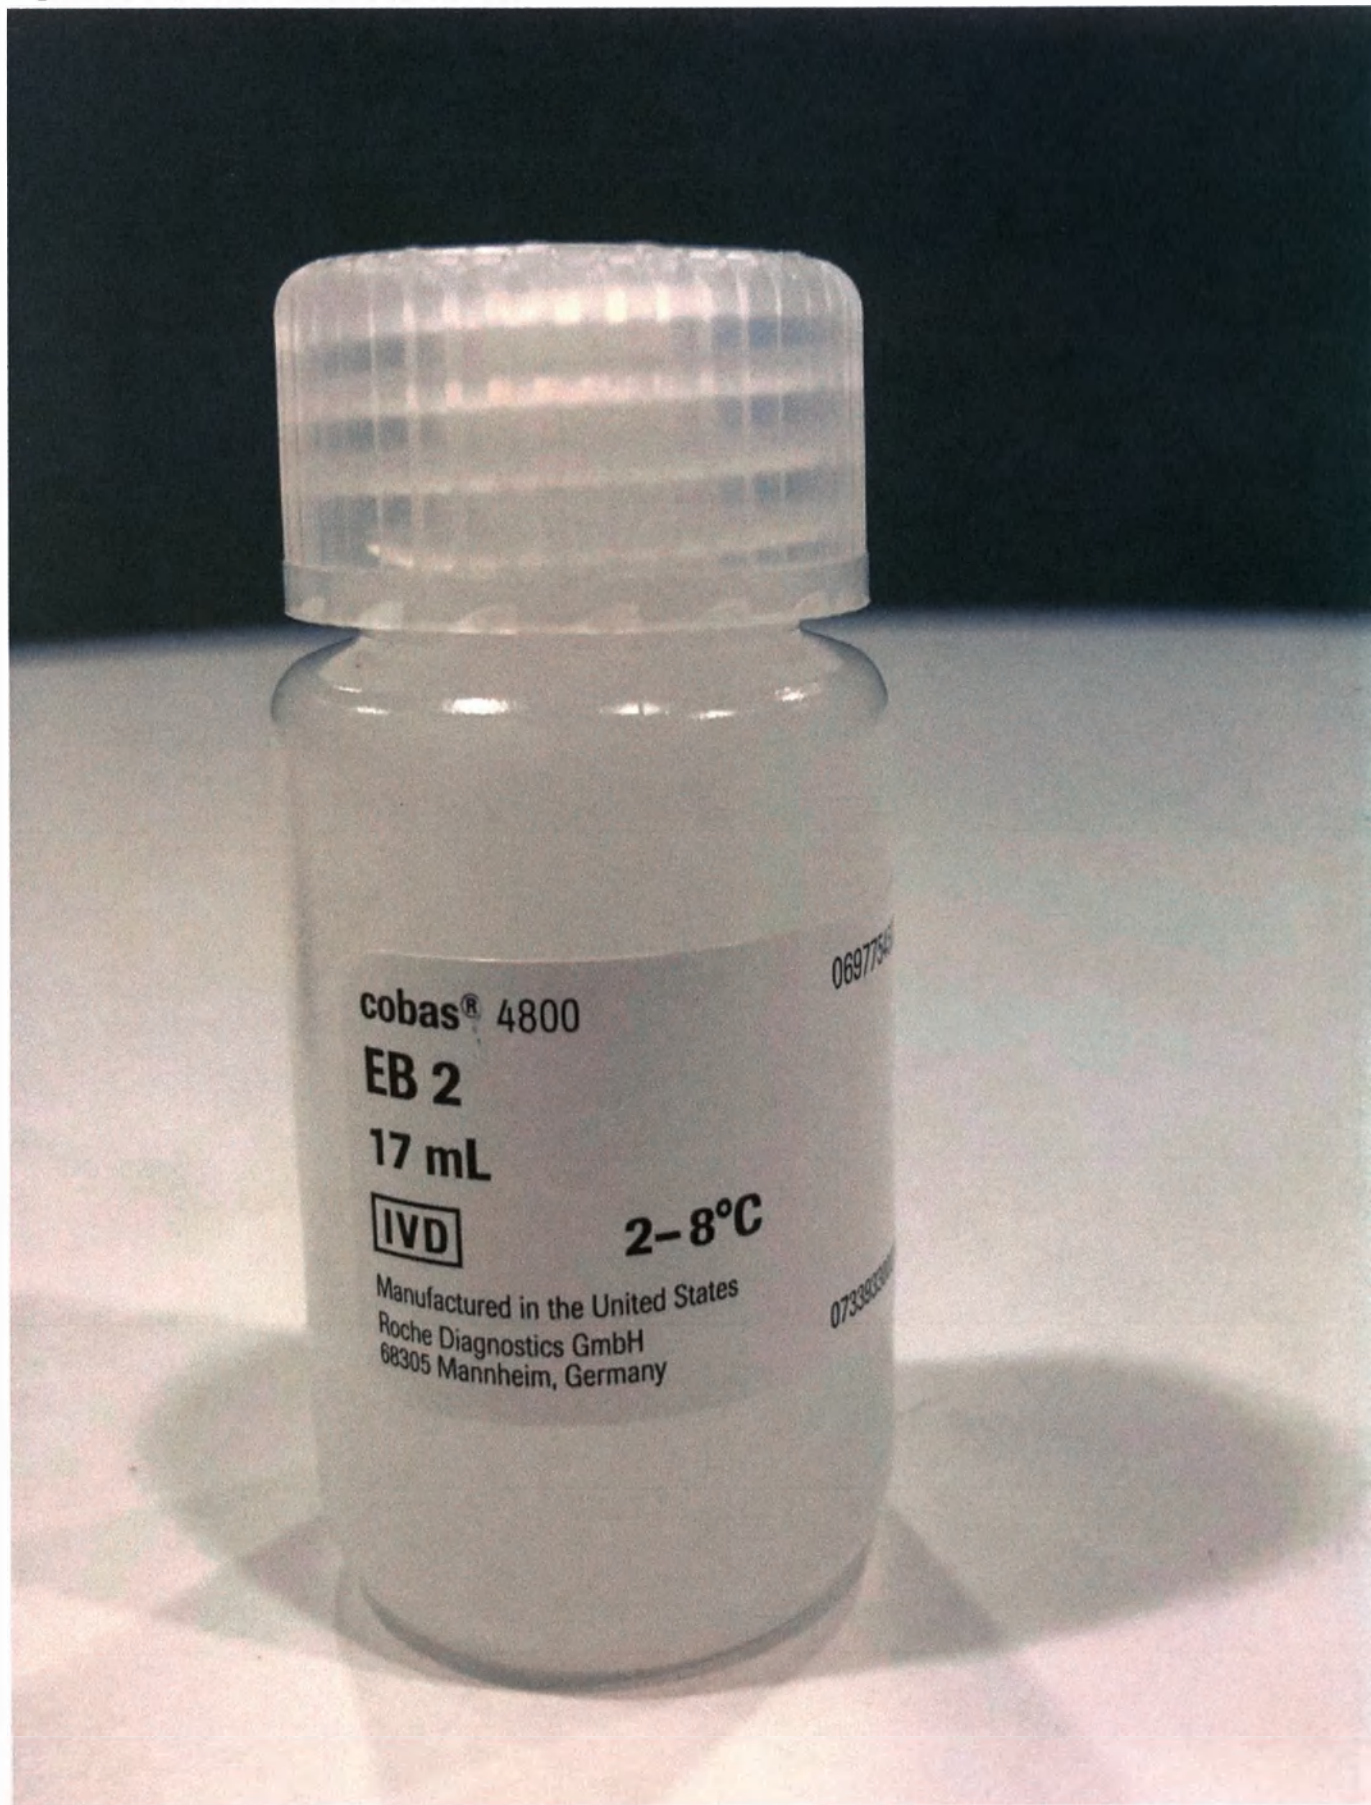

Набор для пробоподготовки для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2/c4800 SMPL PREP 2)
Вариант поставки на 960 тестов: фото Буфер для элюции 2 (ЕВ 2) во флаконе, объем 17 мл, 10 шт.

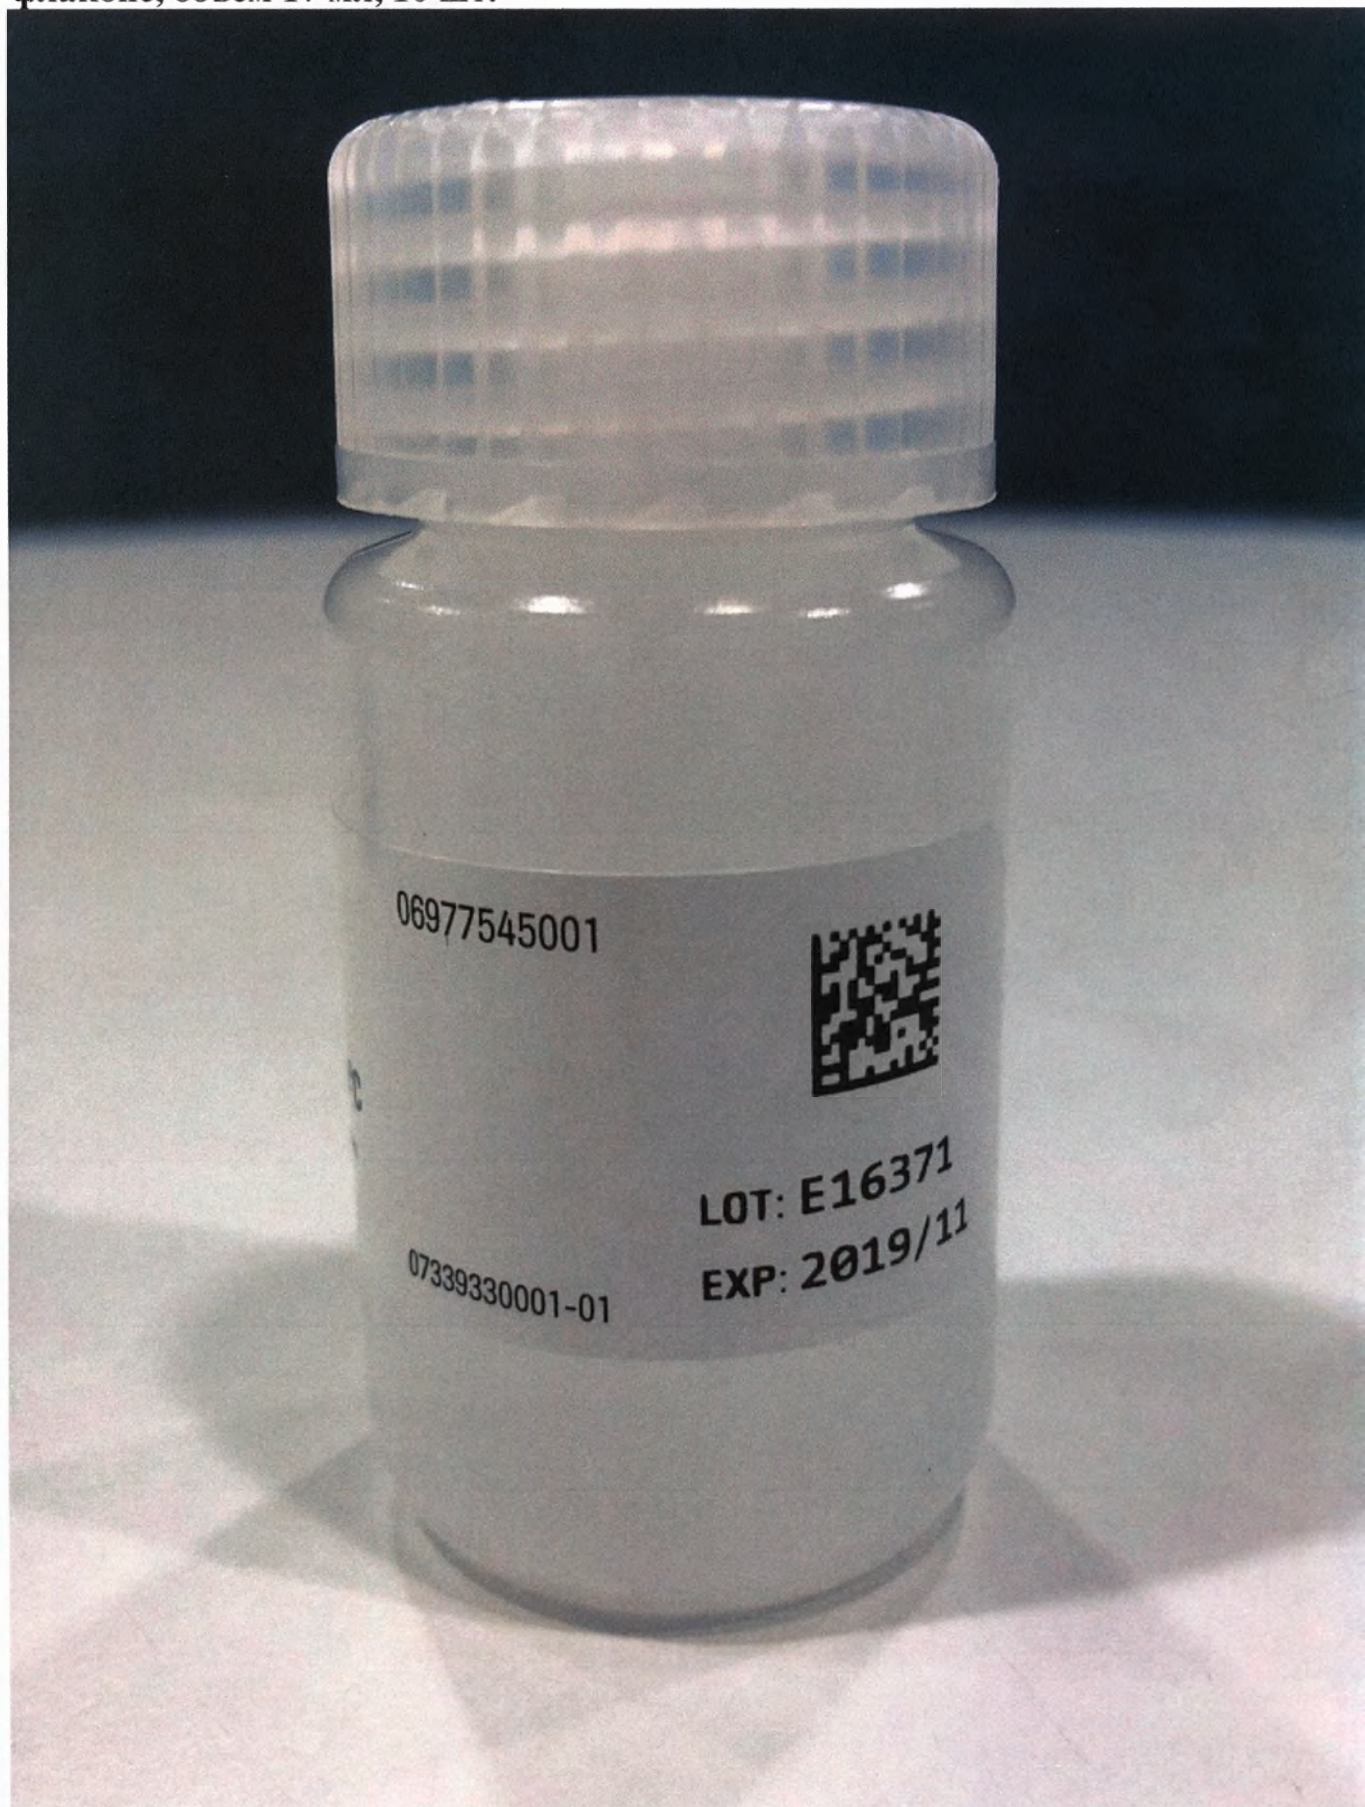

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
девятнадцать (19) листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018