

Фотографические изображения

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800


(cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2)

Вариант поставки на 240 тестов, в составе:

- Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 27 мл, 10 шт.
- Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.

Вариант поставки на 960 тестов, в составе:

- Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 84 мл, 10 шт.
- Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.

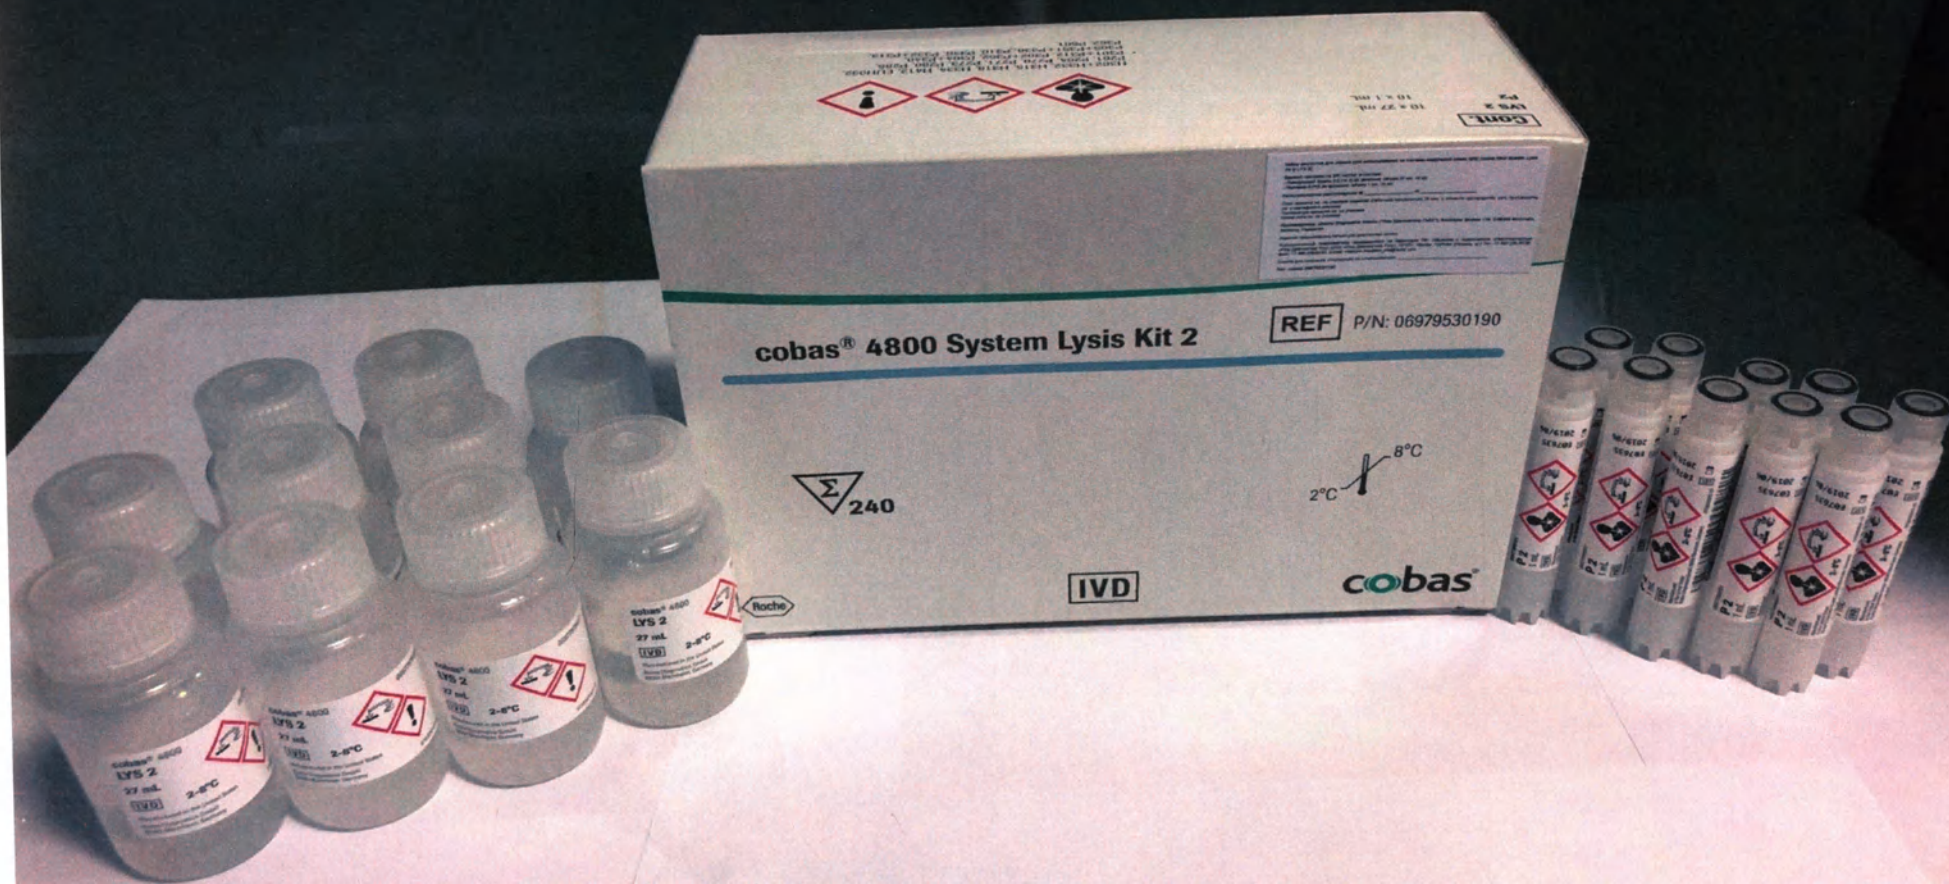

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800
(cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2).

Вариант поставки на 240 тестов, в составе:

- Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 27 мл, 10 шт.
- Препарат 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.

Регистрационный удостоверитель № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (даты истечения срока годности 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сопроводительном документе)

Температура хранения см. на упаковке

Место розлива см. на упаковке

Применяется: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostics GmbH"), Sandhofer Strasse 118, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Идентификация предназначена только для диагностики in-vitro

Уполномоченный производитель продукции на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 121031, Москва, Тульская площадь, д. 2 Тел: +7 495 236-86-86, факс: +7 495 236-82-84 E-mail: rosdiagnostika_ru@roche.com

Ссылка для получения информации по использованию _____

Кат. номер 06979530190

cobas[®] 4800 System Lysis Kit 2

REF

P/N: 06979530190

Σ
240

2°C — 8°C

Roche

IVD

cobas[®]

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2):

Вариант поставки на 240 тестов, в составе:

- Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 27 мл, 10 шт.
- Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com


Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979530190

REF

P/N: 06979530190

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: маркировка

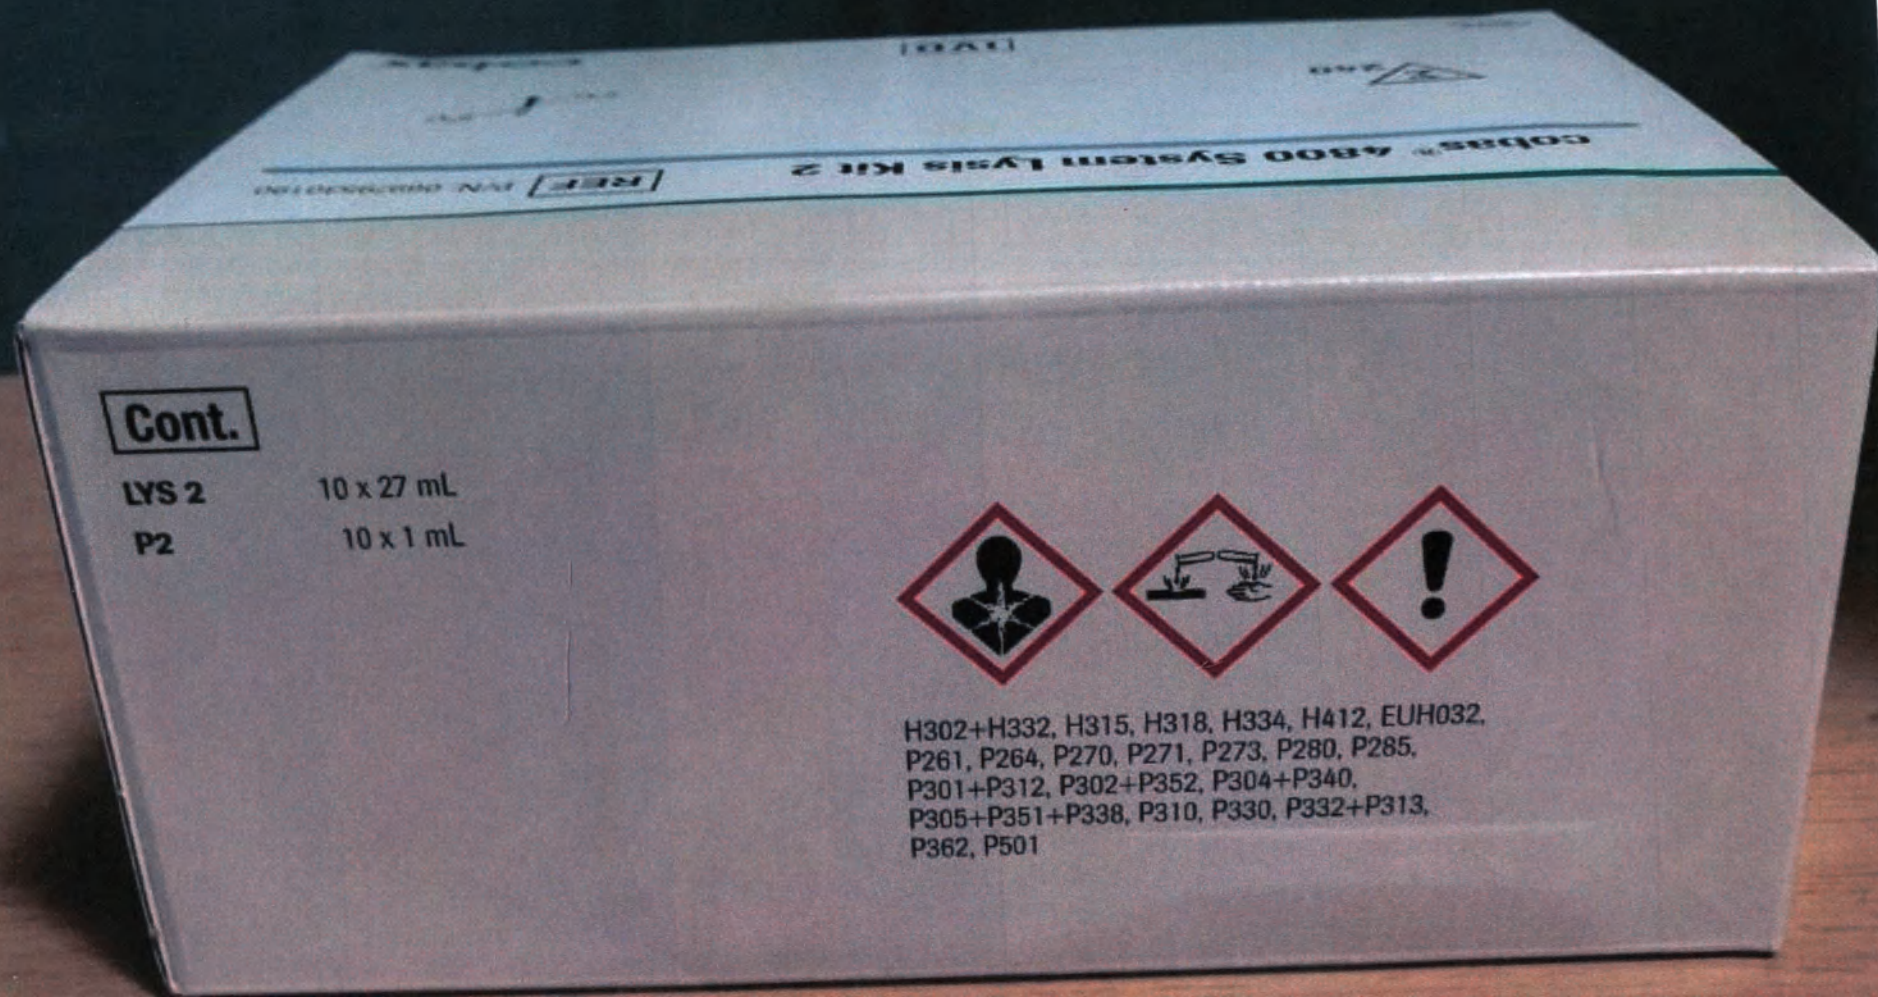


Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида



Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото общего вида

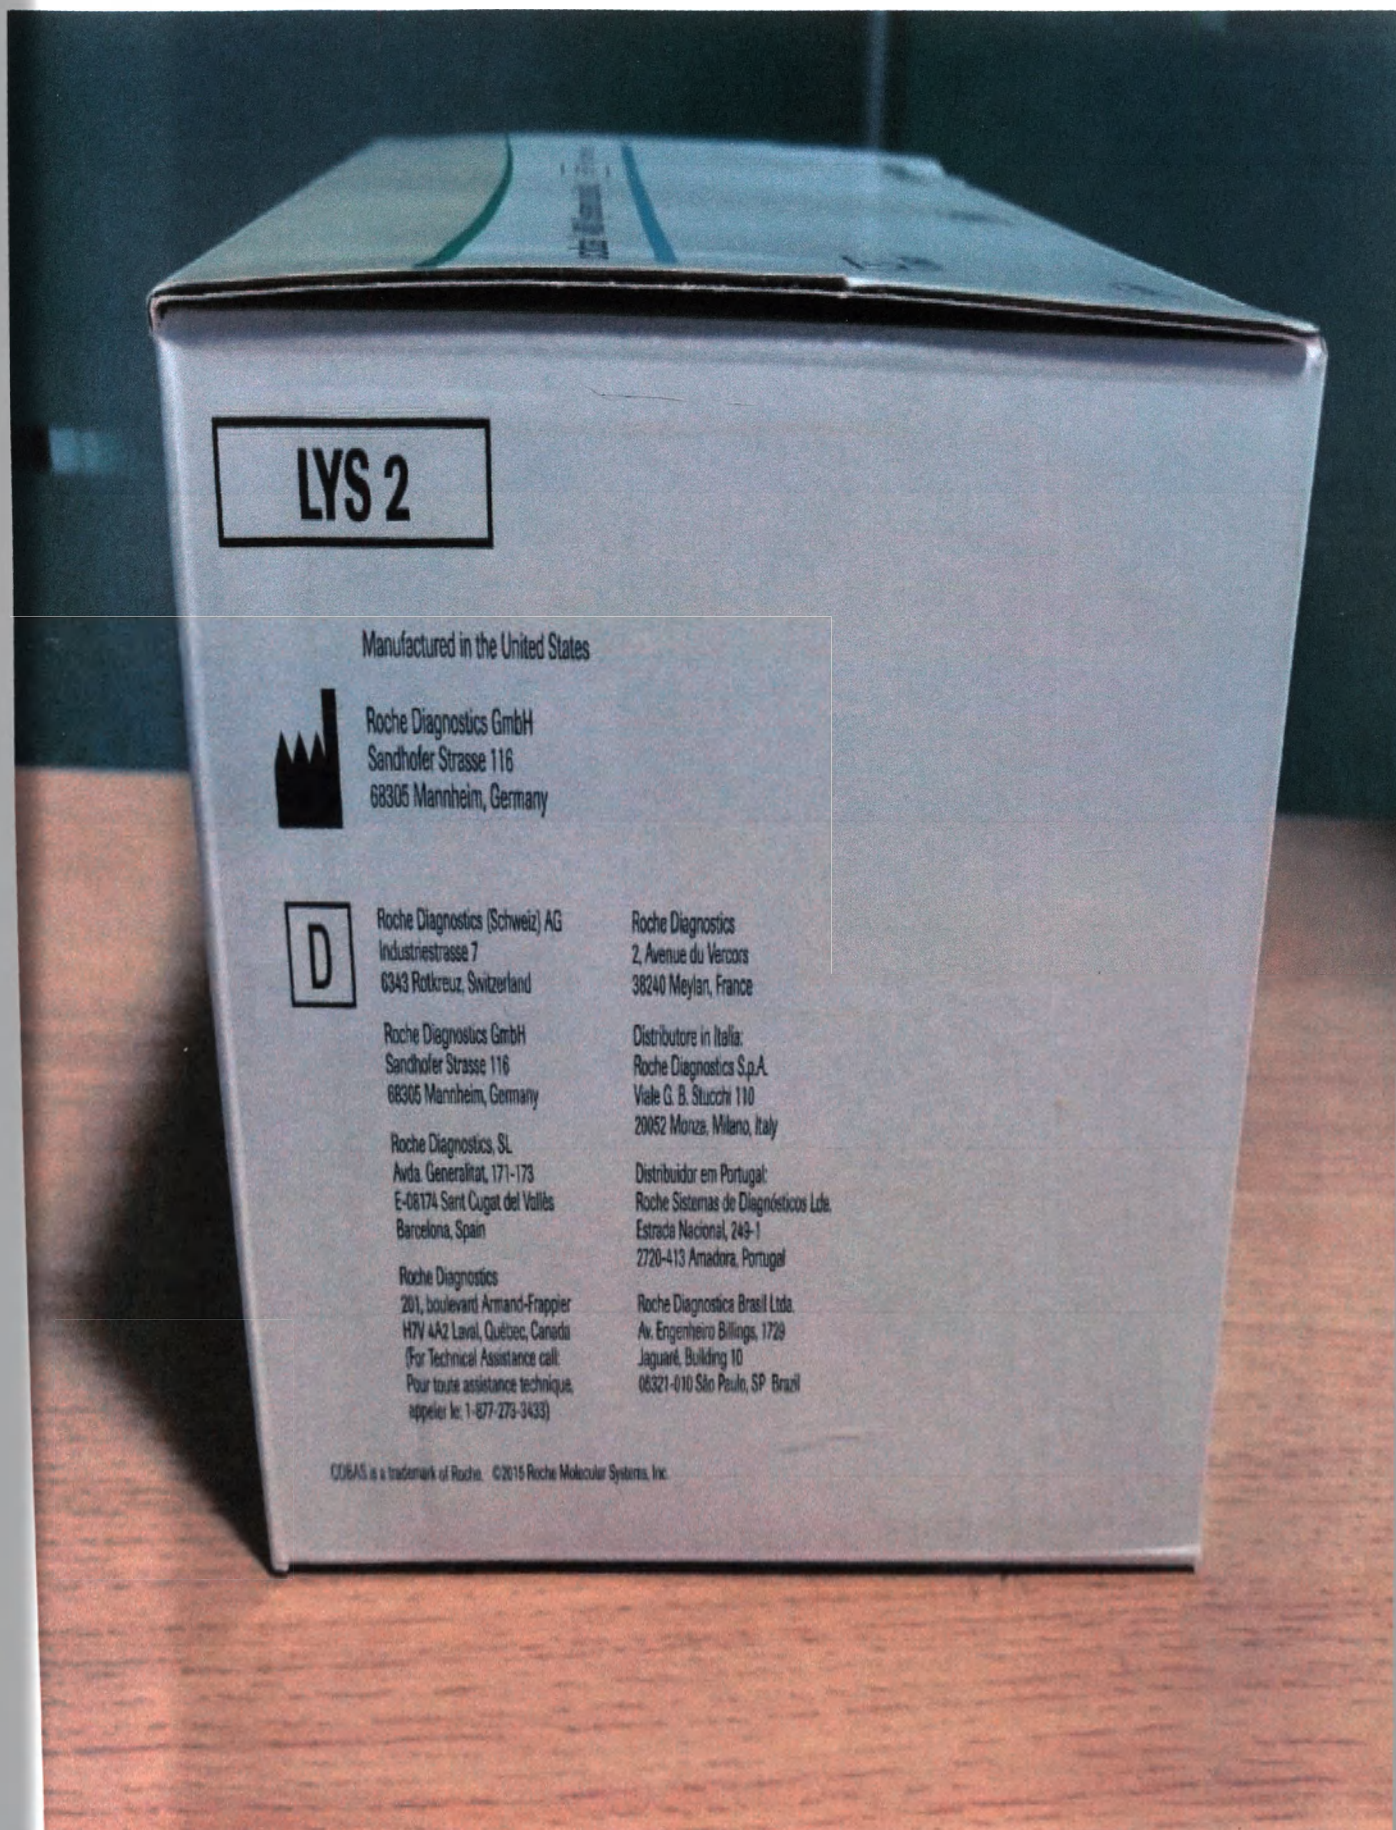


LYS 2

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, Switzerland

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Roche Diagnostics, SL
Avda. Generalitat, 171-173
E-08174 Sant Cugat del Valles
Barcelona, Spain

Roche Diagnostics
201, boulevard Armand-Frappier
HTV 4A2 Laval, Quebec, Canada
(For Technical Assistance call:
Pour toute assistance technique,
appeler le: 1-877-273-3433)

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors
38240 Meylan, France


Distributore in Italia:
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G. B. Stucchi 110
20052 Monza, Milano, Italy

Distribuidor em Portugal:
Roche Sistemas de Diagnósticos Lda
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora, Portugal

Roche Diagnostica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729
Jaguari, Building 10
08321-010 São Paulo, SP, Brazil

COBAS is a trademark of Roche. ©2015 Roche Molecular Systems, Inc.

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 27 мл, 10 шт.

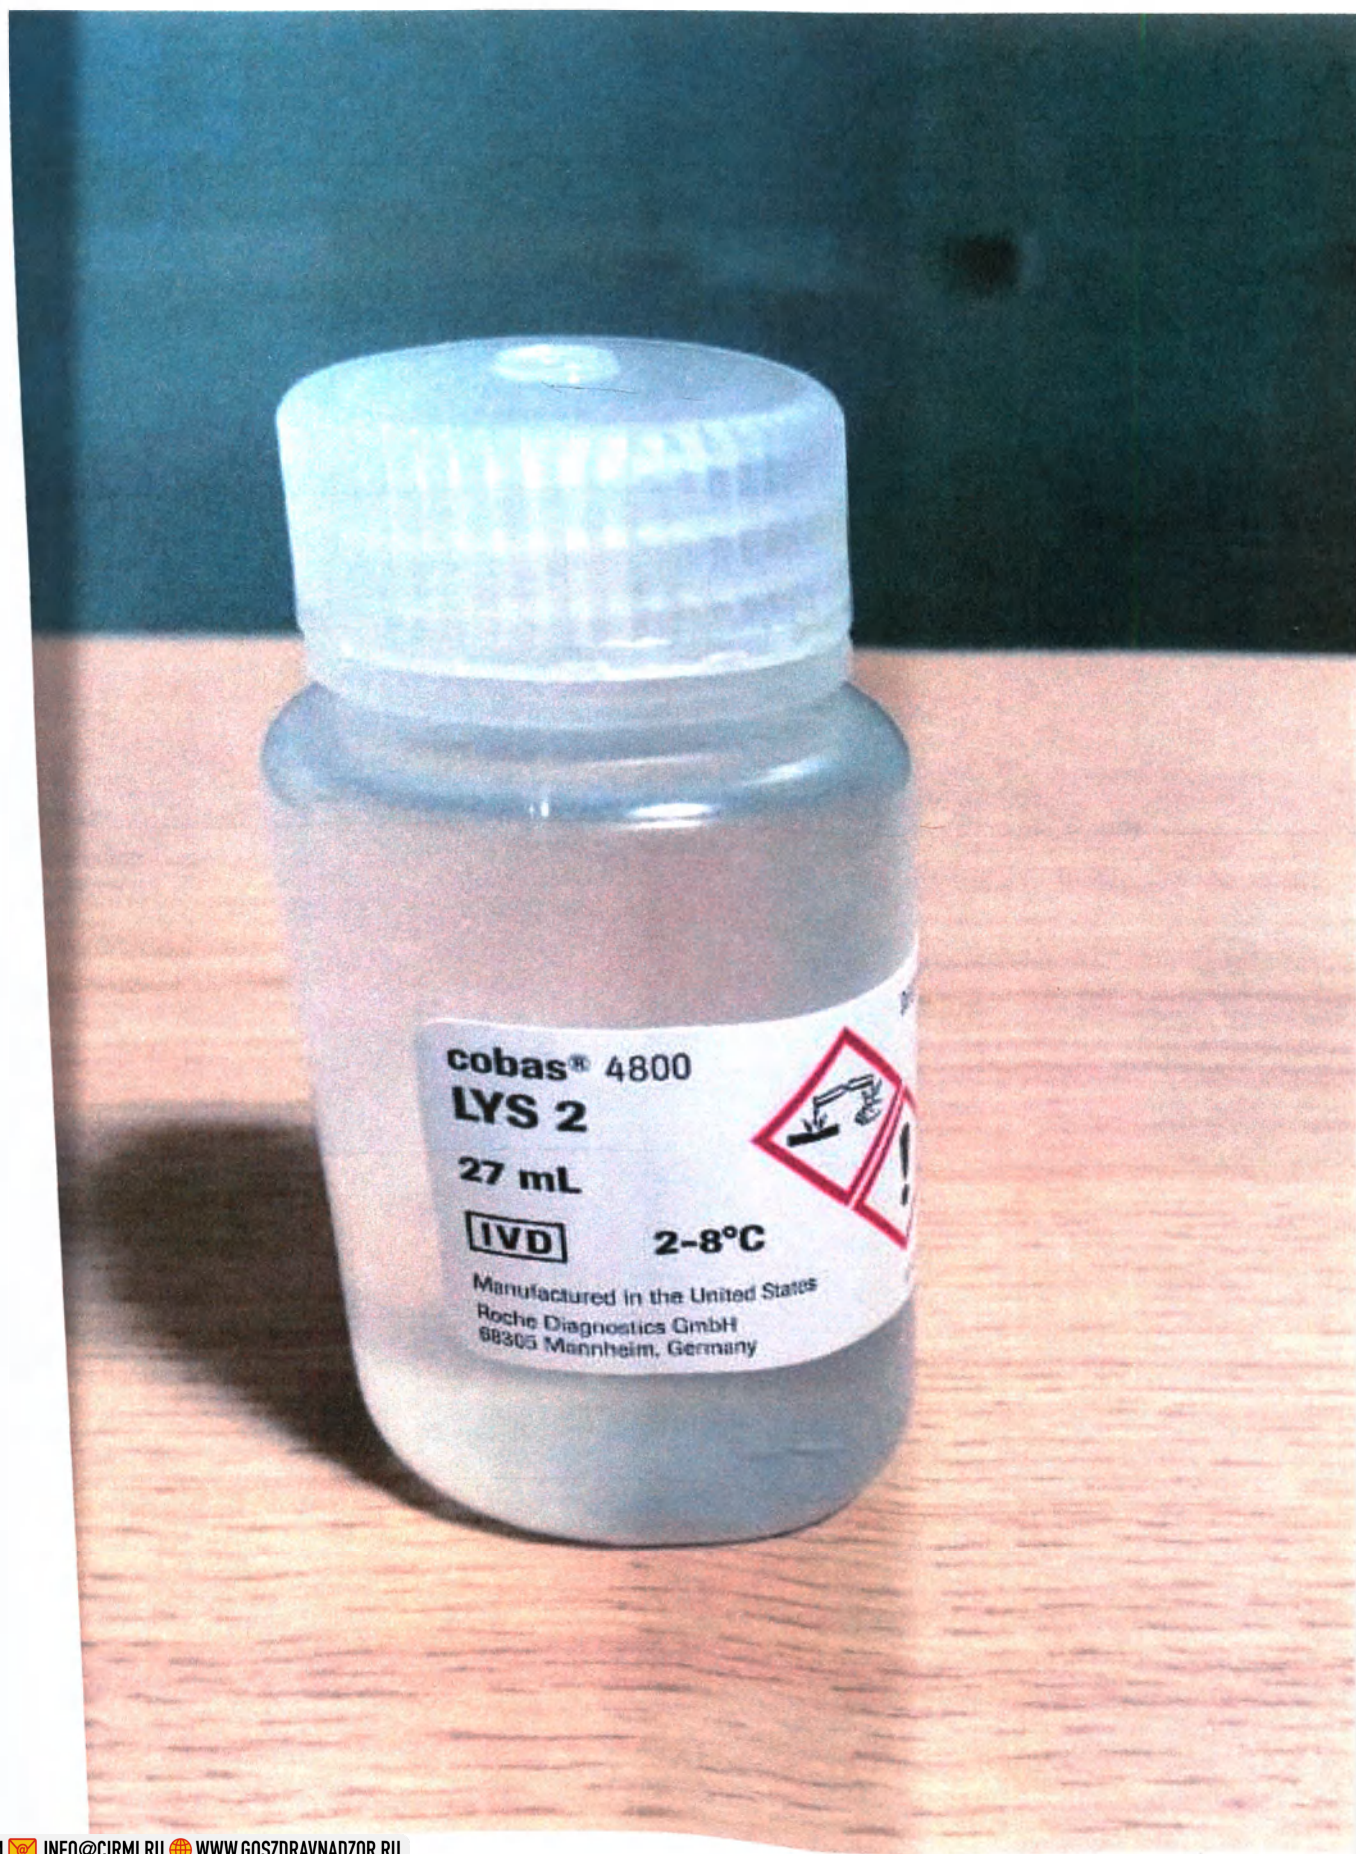


Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 27 мл, 10 шт.



Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.



Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 240 тестов: фото Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.

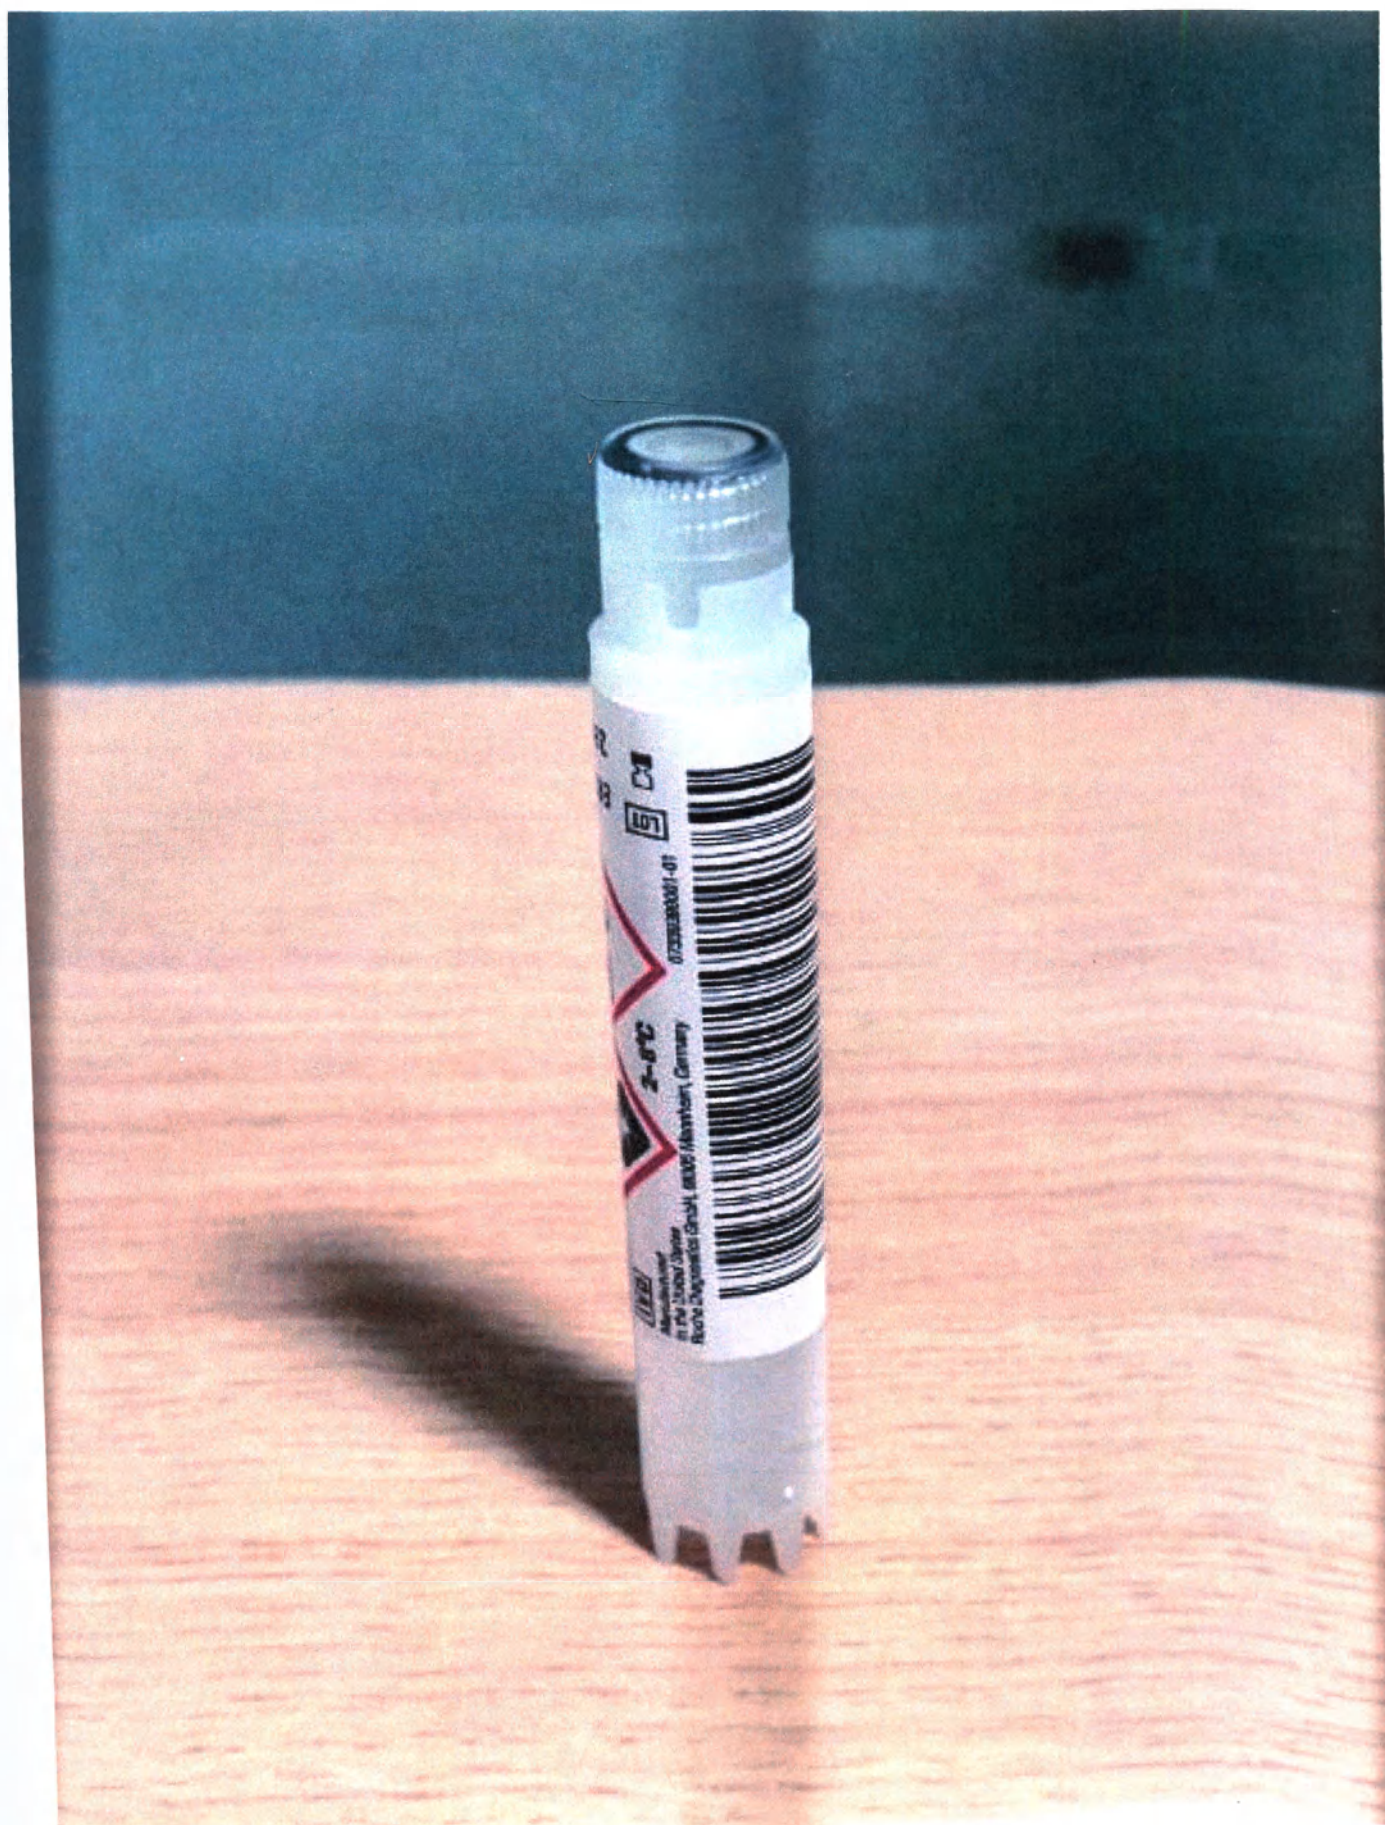





Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2 / LYS 2):
Вариант поставки на 960 тестов, в составе:
- Лизисный буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 84 мл, 10 шт.
- Протокан 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.
Регистрационный удостоверение № _____ от _____
Срок годности см. на упаковке (срок стабильности максимален 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рои Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 118, D-68306 Mannheim, Germany, Германия
Модель предназначена только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рои Диагностика Рус» (ООО «Рои Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трулевая площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-60, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.rosdiagnostika_ua@roche.com
Ссылка для получения инструкции по использованию: _____
Кат. номер 06979548190

cobas[®] 4800 System Lysis Kit 2

REF

P/N: 06979548190



cobas[®]

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2):

Вариант поставки на 960 тестов, в составе:

- Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 84 мл, 10 шт.
- Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979548190

Kit 2

REF



P/N: 06979548190

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото маркировки

cobas[®] 4800 System Lysis Kit 2

REF

P/N: 06979548190



IVD

cobas[®]

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида

LYS 2

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

D

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, Switzerland

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Roche Diagnostics, SL
Avda. Generalitat, 171-173
E-08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain

Roche Diagnostics
201, boulevard Armand-Frappier
H7V 4A2 Laval, Québec, Canada
(For Technical Assistance call:
Pour toute assistance technique,
appelez le: 1-877-273-3433)

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors
38240 Meylan, France

Distributore in Italia:
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G. B. Stucchi 110
20052 Monza, Milano, Italy

Distribuidor em Portugal:
Roche Sistemas de Diagnósticos Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora, Portugal

Roche Diagnostica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729
Jaguari, Building 10
05321-010 São Paulo, SP, Brazil

COBAS is a trademark of Roche. ©2015 Roche Molecular Systems, Inc.

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида

Cont.

LYS 2 10 x 84 mL

P2 10 x 1 mL



H302+H332, H315, H318, H334, H412, EUH032,
P261, P264, P270, P271, P273, P280, P285,
P301+P312, P302+P352, P304+P340,
P305+P351+P338, P310, P330, P332+P313,
P362, P501

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида


cobas[®] 4800 System Lysis Kit 2




cobas[®]

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото общего вида


Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото
Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 84 мл, 10 шт.

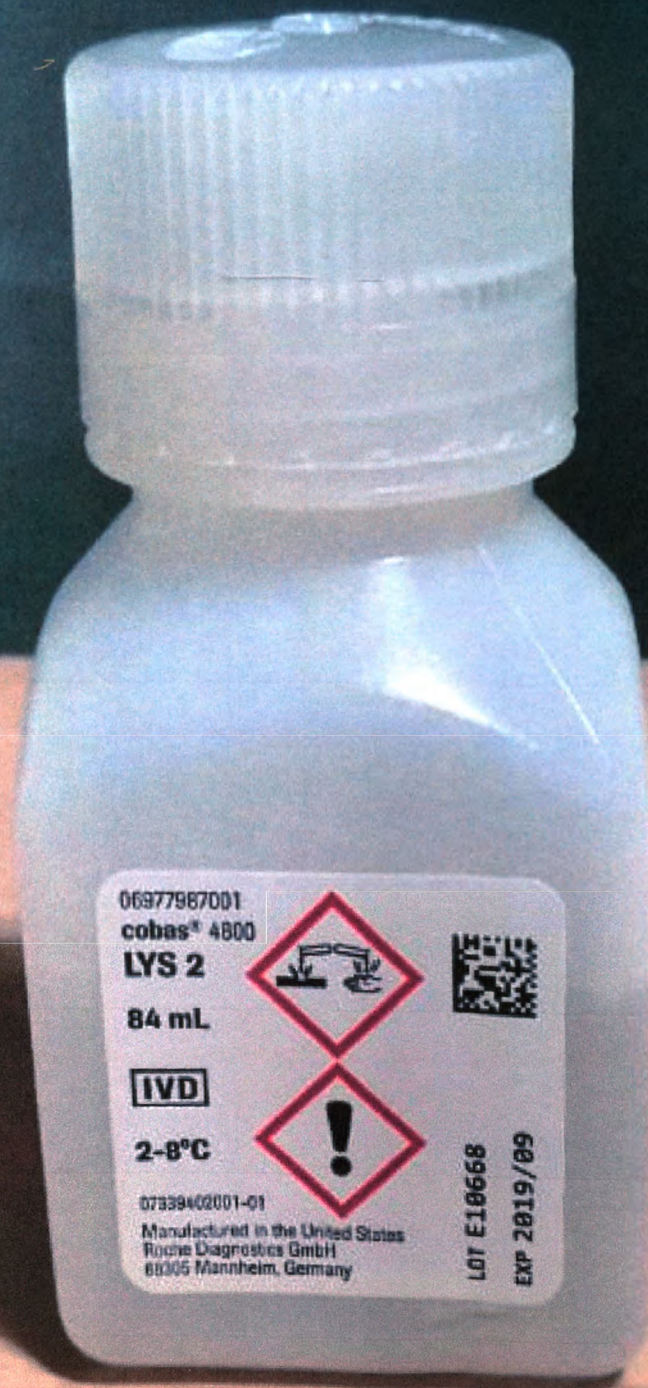

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото
Лизирующий буфер 2 (LYS 2) во флаконе, объем 84 мл, 10 шт.

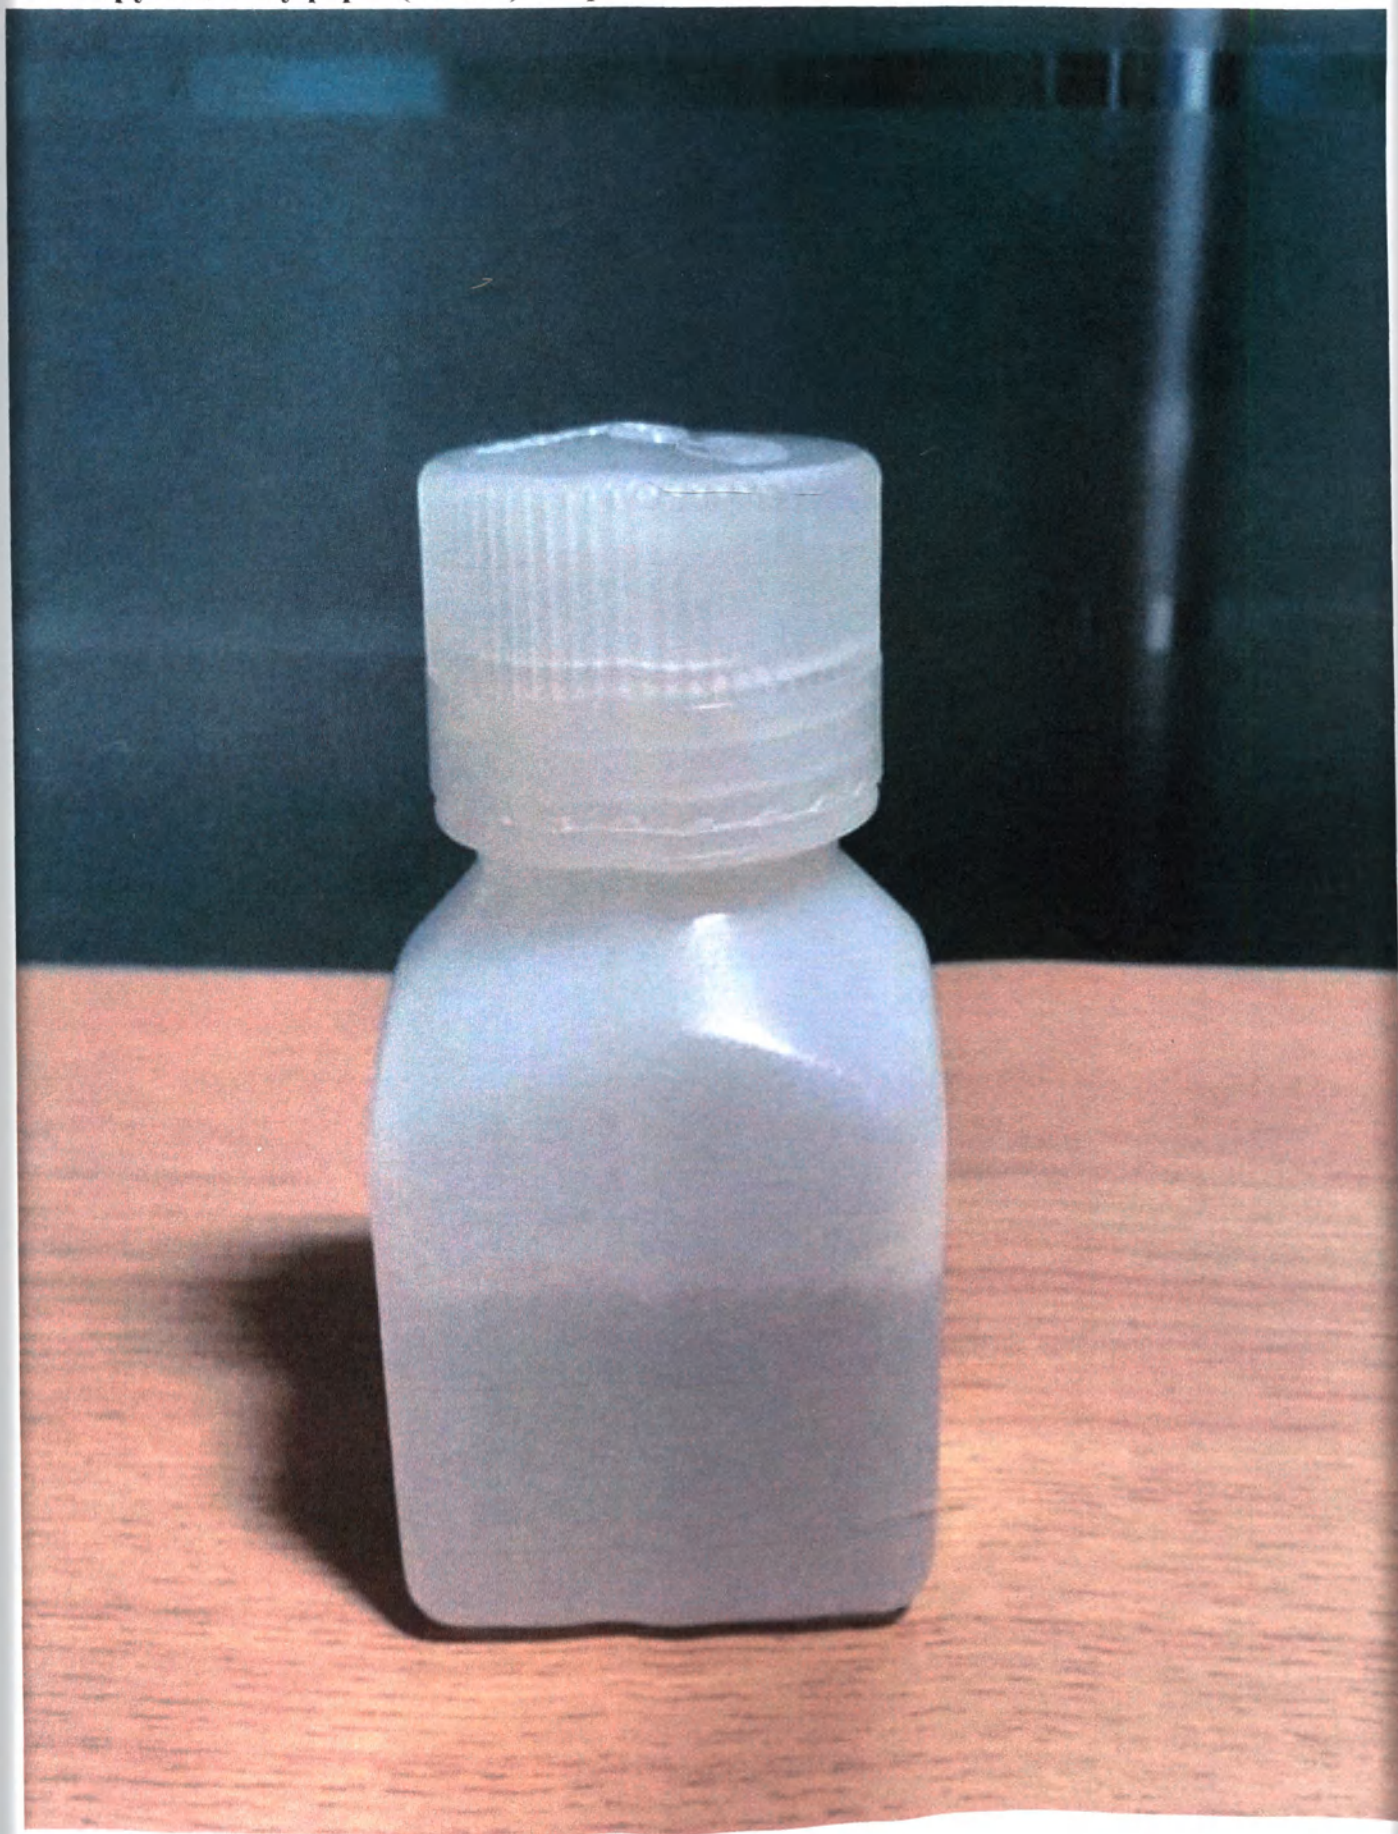

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.

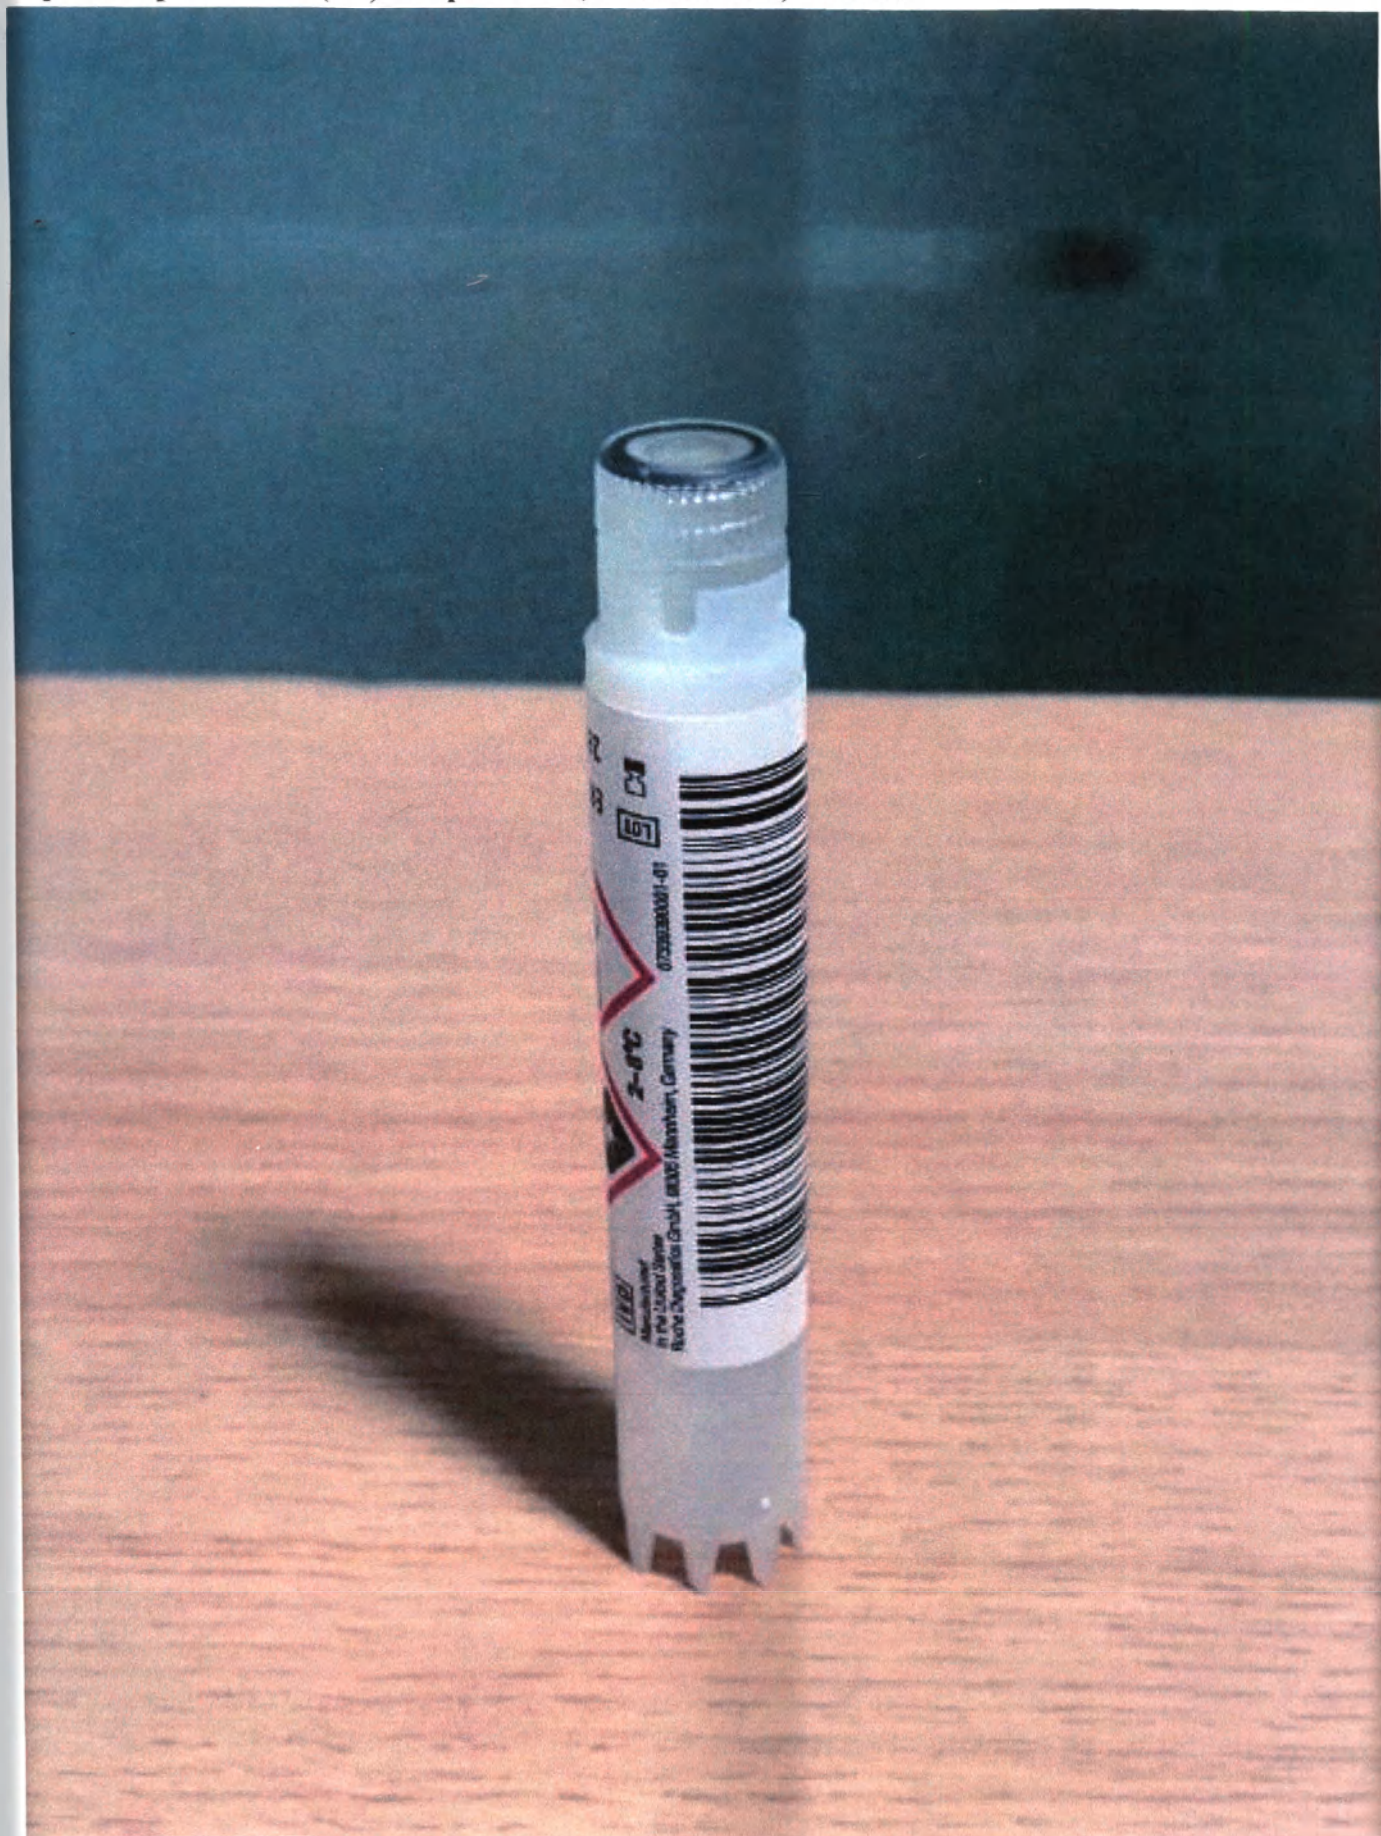

Набор реагентов для лизиса для использования на системе модульной cobas 4800 (cobas 4800 System Lysis Kit 2/ LYS 2), Вариант поставки на 960 тестов: фото Протеаза 2 (P2) во флаконе, объем 1 мл, 10 шт.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

двадцать два (22) листа (ов)

Лучина

Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

0 2 ИЮЛ 2018

