

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2021 г.

## **МАКЕТ МАРКИРОВКИ НАТРИЙ-ВИТАЛ**

**Набор реагентов для определения концентрации натрия  
в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом**

**НАТРИЙ-ВИТАЛ****REF B 27.03**

Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови  
энзиматическим колориметрическим методом

**LOT** Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 41 мл

ТУ 21.20.23-072-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 4,1 мл

РЗН 2019/8856 от 03.09.2019

Реагент №3: 4 флакона

Калибратор 1: 1 x 5 мл

Калибратор 2: 1 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

**EMERGO EUROPE**

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

**EC****REP****НАТРИЙ-ВИТАЛ****REF B 27.03**

41 мл

Буфер

**LOT** xxxx

годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики

**НАТРИЙ-ВИТАЛ****REF B 27.03**

4,1 мл

Стартовый реагент

**LOT** xxxx

годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики

**НАТРИЙ-ВИТАЛ****REF B 27.03****REF B 27.103**

Лиофилизат

Растворить в 10 мл реагента №1

**LOT** xxxx

годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



НАТРИЙ-ВИТАЛ

В 27.03

В 27.103

150 ммоль/л

LOT xxxx

годен до: гггг.мм

+2-8°C

CE Только для in vitro диагностики



НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.03

REF В 27.103

5 мл

150 ммоль/л

LOT xxxx

годен до: гггг.мм

+2-8°C

CE Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР 2

## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.103

Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови  
энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 21 мл

ТУ 21.20.23-072-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 4,1 мл

РЗН 2019/8856 от 03.09.2019

Реагент №3: 2 флакона

Калибратор 1: 1 x 5 мл

Калибратор 2: 1 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

### НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.103

21 мл

Буфер

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



### НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.103

4,1 мл

Стартовый реагент

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



### НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.03

REF В 27.103

Лиофилизат

Растворить в 10 мл реагента №1

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

РЕАГЕНТ 3

И-ВИТАЛ

27.03

В 27.103

0 ммоль/л

LOT XXXX

годен до: гггг.мм

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР 2  
НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.03

REF В 27.103

5 мл

150 ммоль/л

LOT XXXX

годен до: гггг.мм

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови  
энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 23 мл

ТУ 21.20.23-072-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 5 мл

РЗН 2019/8856 от 03.09.2019

Реагент №3: 1 x 2,5 мл

Калибратор 1: 1 x 5 мл

Калибратор 2: 1 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,  
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF B 27.104

23 мл

Буфер

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF B 27.04

REF B 27.104

REF B 27.14

5 мл

Стартовый реагент

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF B 27.104

2,5 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

РЕАГЕНТ 3

КАЛИБРАТОР 2

ВИТАЛ

27.04

27.104

27.14

ммоль/л

LOT XXXX

годен до: гggг.мм

+2-8°C



CE Только для in vitro диагностики

НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF B 27.04

REF B 27.104

REF B 27.14

5 мл

150 ммоль/л

LOT XXXX

годен до: гggг.мм

+2-8°C



CE Только для in vitro диагностики

## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.04

Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови  
энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 45 мл

Реагент №2: 1 x 5 мл

Реагент №3: 1 x 5 мл

Калибратор 1: 1 x 5 мл

Калибратор 2: 1 x 5 мл

ТУ 21.20.23-072-94568735-2019

РЗН 2019/8856 от 03.09.2019



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,  
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

### НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.04

45 мл

Буфер

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



### НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.04

REF В 27.104

REF В 27.14

5 мл

Стартовый реагент

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



### НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.04

5 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

РЕАГЕНТ 3

КАЛИБРАТОР 2  
-ВИТАЛ

27.04

В 27.104

В 27.14

мл

100 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.04

REF В 27.104

REF В 27.14

5 мл

150 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови  
фотометрическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 3 x 23 мл

ТУ 21.20.23-072-94568735-2019

Реагент №2: 3 x 5 мл

РЗН 2019/8856 от 03.09.2019

Реагент №3: 3 x 2,5 мл

Калибратор 1: 3 x 5 мл

Калибратор 2: 3 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



5010232954236

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.14

23 мл

Буфер

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.04

REF В 27.104

REF В 27.14

5 мл

Стартовый реагент

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



## НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.14

2,5 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



И-ВИТАЛ

27.04

В 27.104

В 27.14

мл

00 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.04

REF В 27.104

REF В 27.14

5 мл

150 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+2-8°C



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР 2

Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью

Всего 11 листа(ов)

Генеральный директор

Плехов А.Г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО  
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF B 27.03

Набор реагентов для определения концентрации натрия  
в сыворотке крови  
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 41 мл  
Реагент №2: 1 x 4,1 мл  
Реагент №3: 4 флакона  
Калибратор 1: 1 x 5 мл  
Калибратор 2: 1 x 5 мл

ТУ 21.20.23-072-84588735-2019  
РЗН 2019/8856 от 03.09.2019

LOT

Серия:  
XXXX



Дата выпуска:  
ГГГГ.ММ



Годен до:  
ГГГГ.ММ

Защитка для in vitro диагностики


АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия  
196199 Санкт-Петербург, Дорога в Кандалакшу  
800 30 00000 0


EC REP

ИЗДАНИЕ 1.0 (2019)  
ПРИМЕНЕНИЕ: для определения концентрации натрия в сыворотке крови



370321003002788

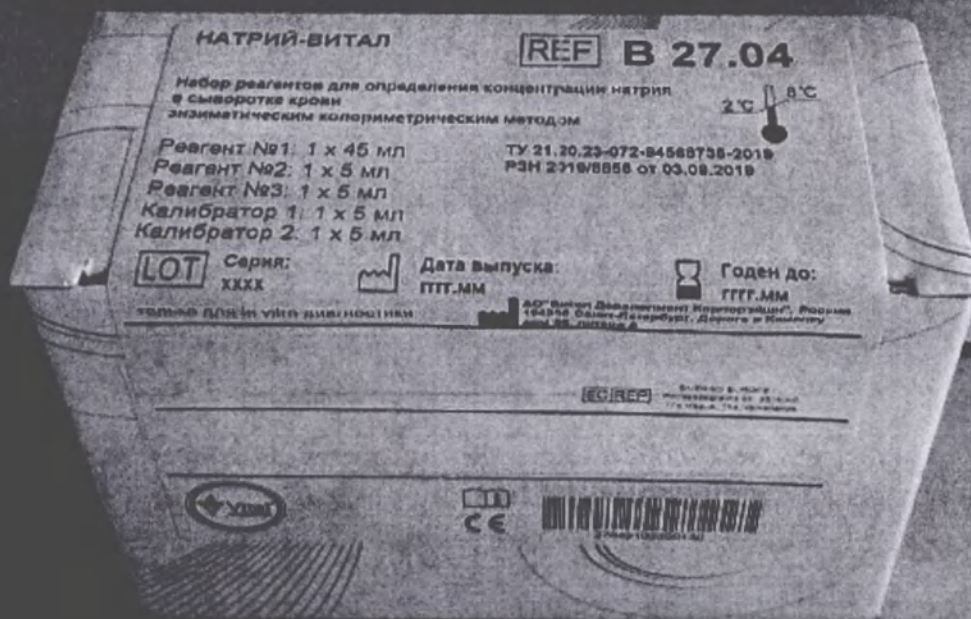


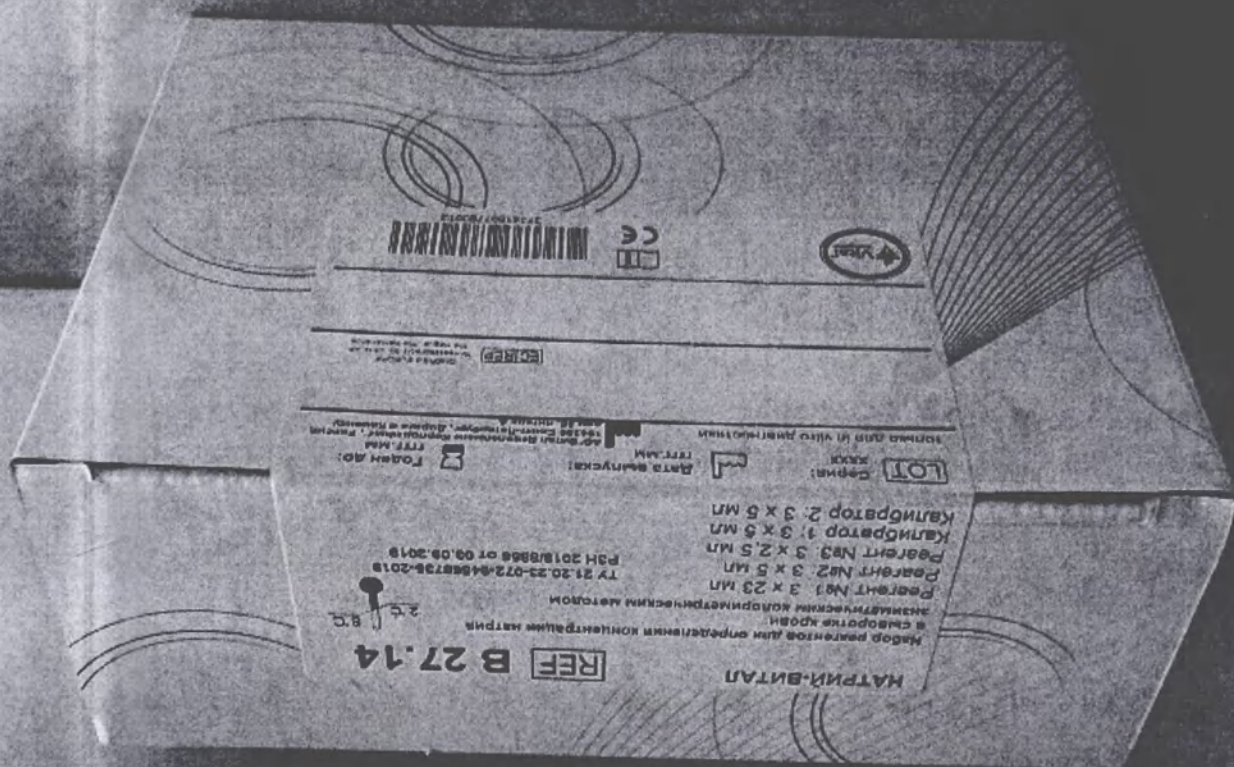

НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.103

Набор реагентов для определения концентрации натрия  
в сыворотке крови  
энзиматическим колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 21 мл  
Реагент №2: 1 x 4,1 мл  
Реагент №3: 2 флакона  
Калибратор 1: 1 x 5 мл  
Калибратор 2: 1 x 5 мл

TU 21.20.23-072-04668735-2019  
РЗН 2019/0556 от 03.09.2019

LOT

Серия:  
XXXX



Дата выпуска:  
ГГГГ.ММ



Годен до:  
ГГГГ.ММ

ТОЛЬКО ДЛЯ ИП ЧИГО ДИВНОСТИКИ

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия  
194355 Санкт-Петербург, Дворца в Канонеру  
АДМ 55, линия 5

ECIRP


СМЕРЬ ВЕЩНОСТЬ  
В-РЕАКЦИЯ 20, 20 x 4,1  
The product is for laboratory use



37132103300209



7

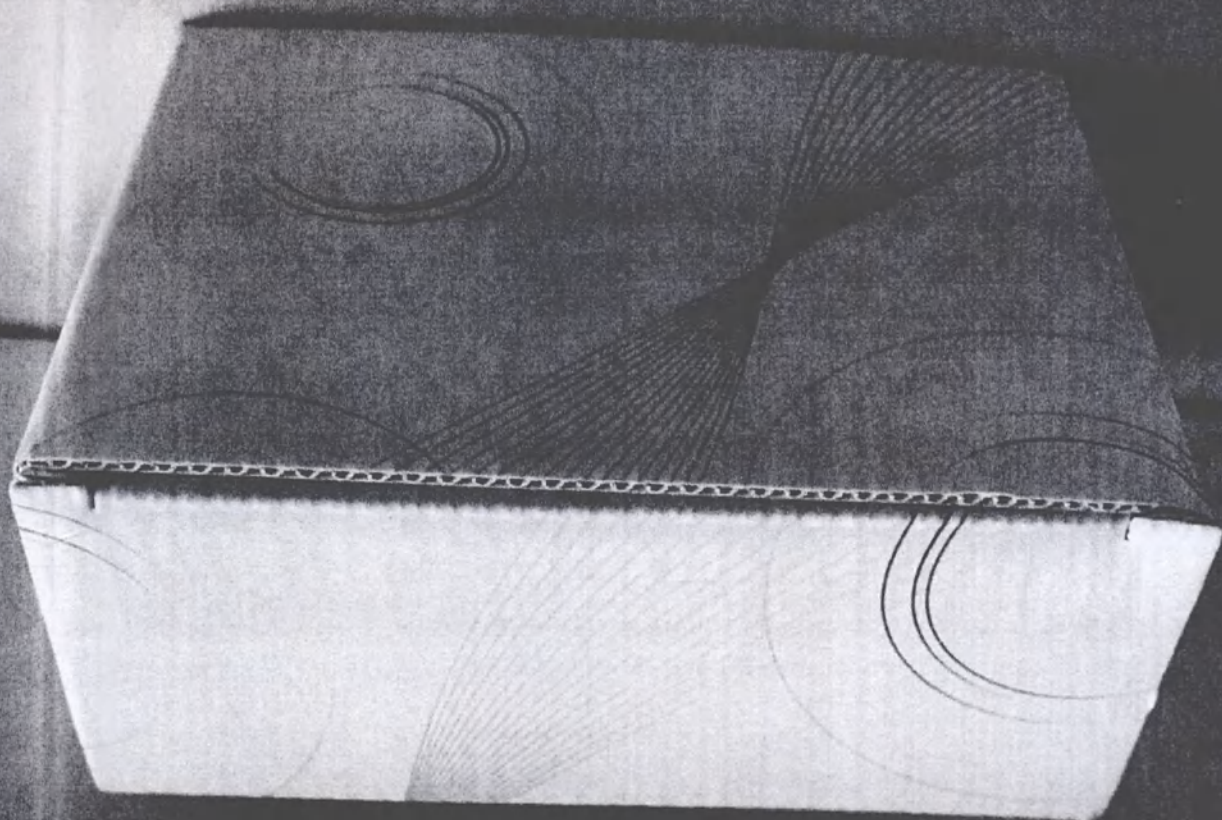

Протокол, пронумеровано,  
и скреплено печатью



Всего

Ген. директор

7  
листа(ов)

Плехов А.Г.