

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Ю.С. Лебедин

2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител
к антигенам эхинококка в сыворотке (плазме) крови
«Эхинококк IgG-ИФА»»**



Instruction for use




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ IgG АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ ЭХИНОКОККА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ «Эхинококк IgG-ИФА»

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам эхинококка в сыворотке (плазме) крови «Эхинококк IgG-ИФА»

REF	К175	Серия	582	Изготовлен	2018-10	Гарантийный срок до	2029-04	п. №	96
Состав набора:									
Пластины	1 шт/пач	CONT		LOT					
Определительный контроль	1 x 2,0 ml/ml	SORS MTP		P175Z		502			
Положительный контроль	1 x 1,5 ml/ml	CONTROL -		CM175Z		502			
Конъюгат	1 x 14 ml/ml	CONTROL -		CP175Z		502			
ИФА-буфер	1 x 50 ml/ml	CONJ HRP		T175Z		502			
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	1 x 14 ml/ml	DL SPE		S01124		502			
Концентрат отмывающего раствора	1 x 22 ml/ml	SUBS TMB		R065Z		502			
Стоп-реагент	1 x 14 ml/ml	BLUF WASH 26X		S008Z		502			
Буфера для замачивания пластины	2 шт/пач	STOP		R060Z		502			
Инструкция по применению	1 шт/пач			N003					
Паспорт контроля качества	1 шт/пач			K175I					
«Антигена и ВМЧ 1, 2 к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют». Сыворотка, входящая в состав компонентов набора, инaktivирована. ТУ № 21.20.23-175-1861 9450-3019, РУ №									

143912, МО, г. Балашиха, ул. Трубетцкая, д.28
Trubetskaya st., 28, Balashikha, Moscow reg., 143912, Russia

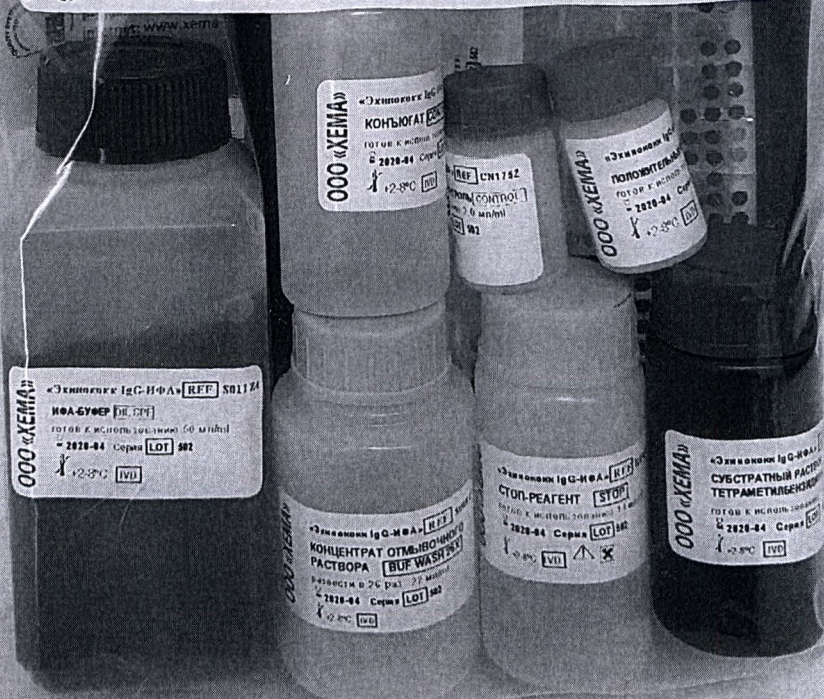

ООО «ХЕМА»

«Эхинокорк IgG-ИФА» REF P175Z

ПЛАНШЕТ SORB MTP


ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2020-04 Серия LOT 582


+2-8°C

IVD



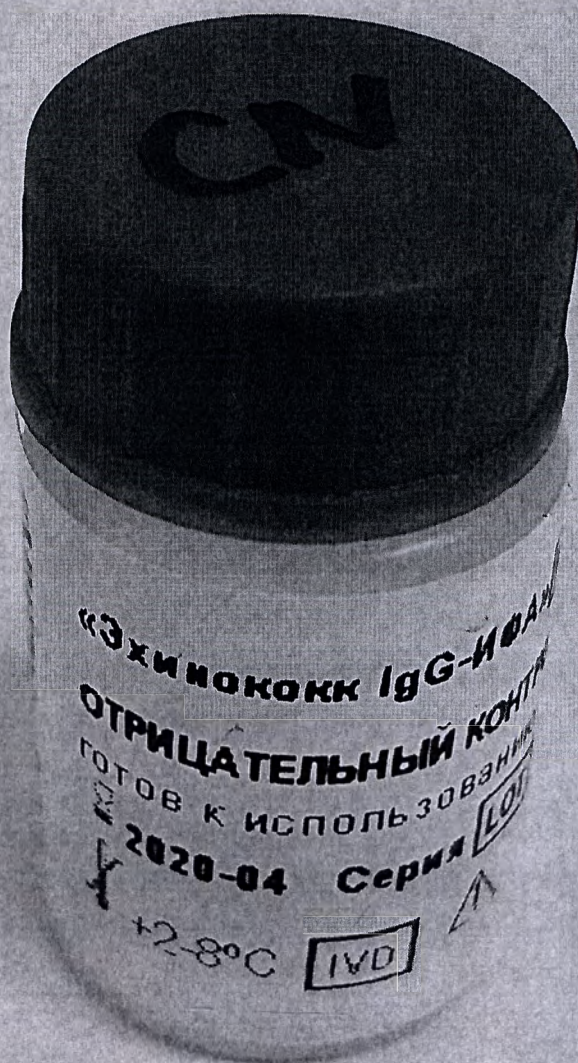



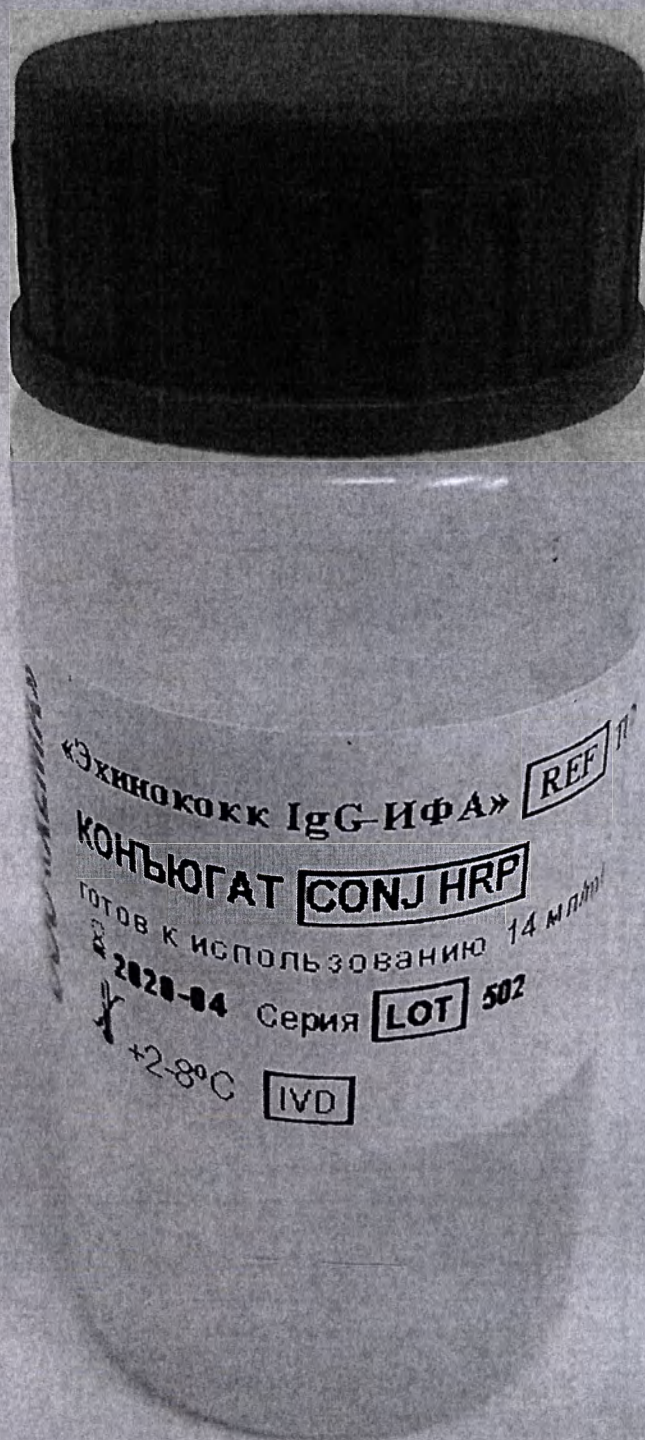

ООО «ХЕМА»


«Эккикокс IgG-ИФА» REF S011 Z4

ИФА-БУФЕР DIL SPE

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 50 мл/мл

2020-04 Серия LOT 502



+2-8°C IVD

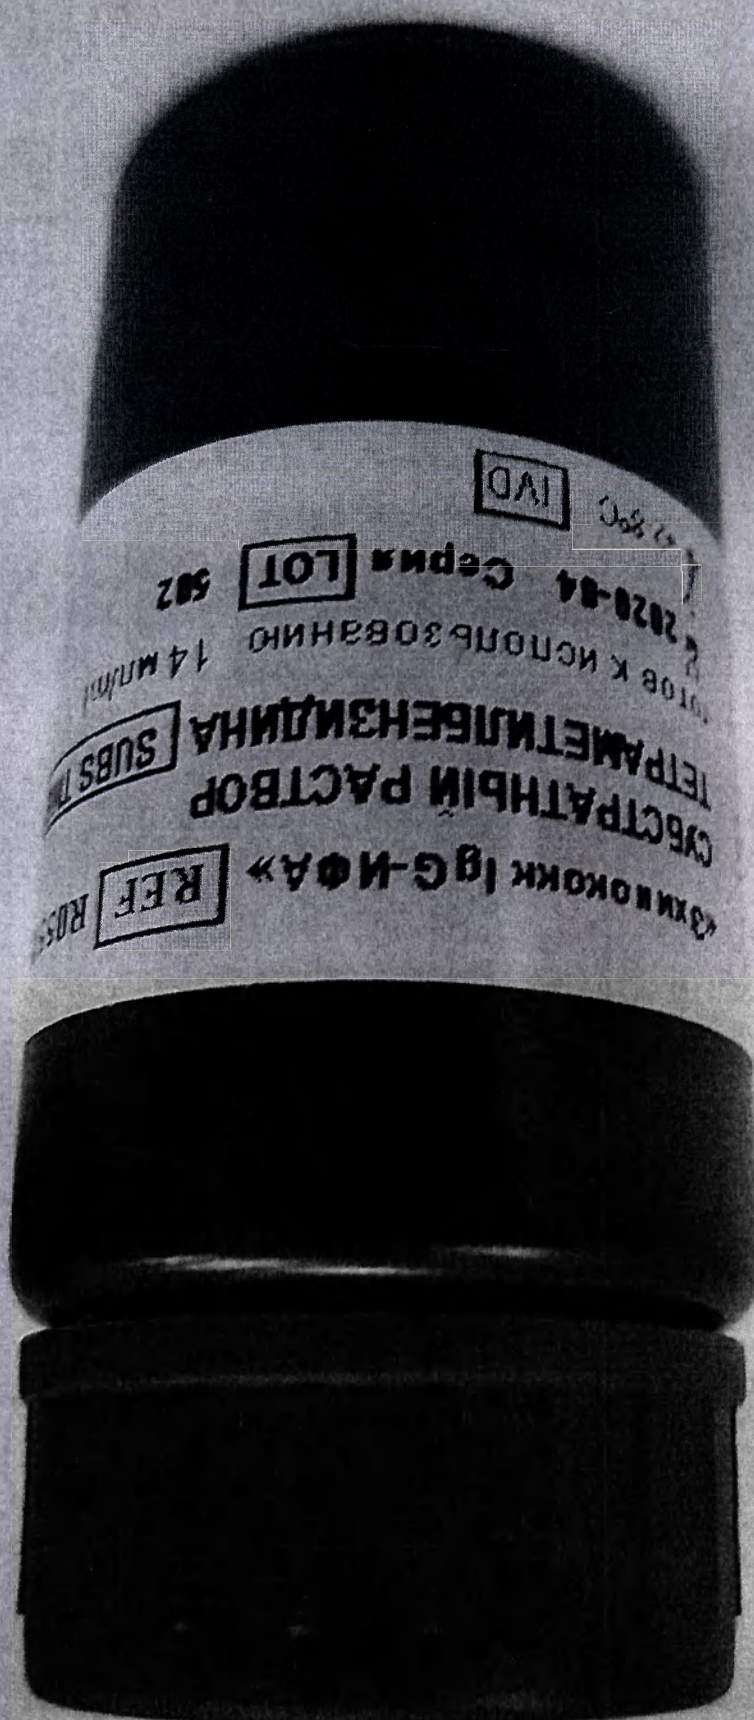

«Эпинококк IgG-ИФА»
РЕФ S0082
КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА
BUF WASH 26X
развести в 26 раз 22 мл/мл
серия LOT 502
2020-04
IVD

«Эпиноксик ИГ-ИФА»
СТОП-РЕАГЕНТ
ГОТОВ К ИСПОЛЪЗОВАНИЮ 14 МЕСЯЦЕВ
2020-04 Серия LOT 502
+2-8°C IVD
X i

81

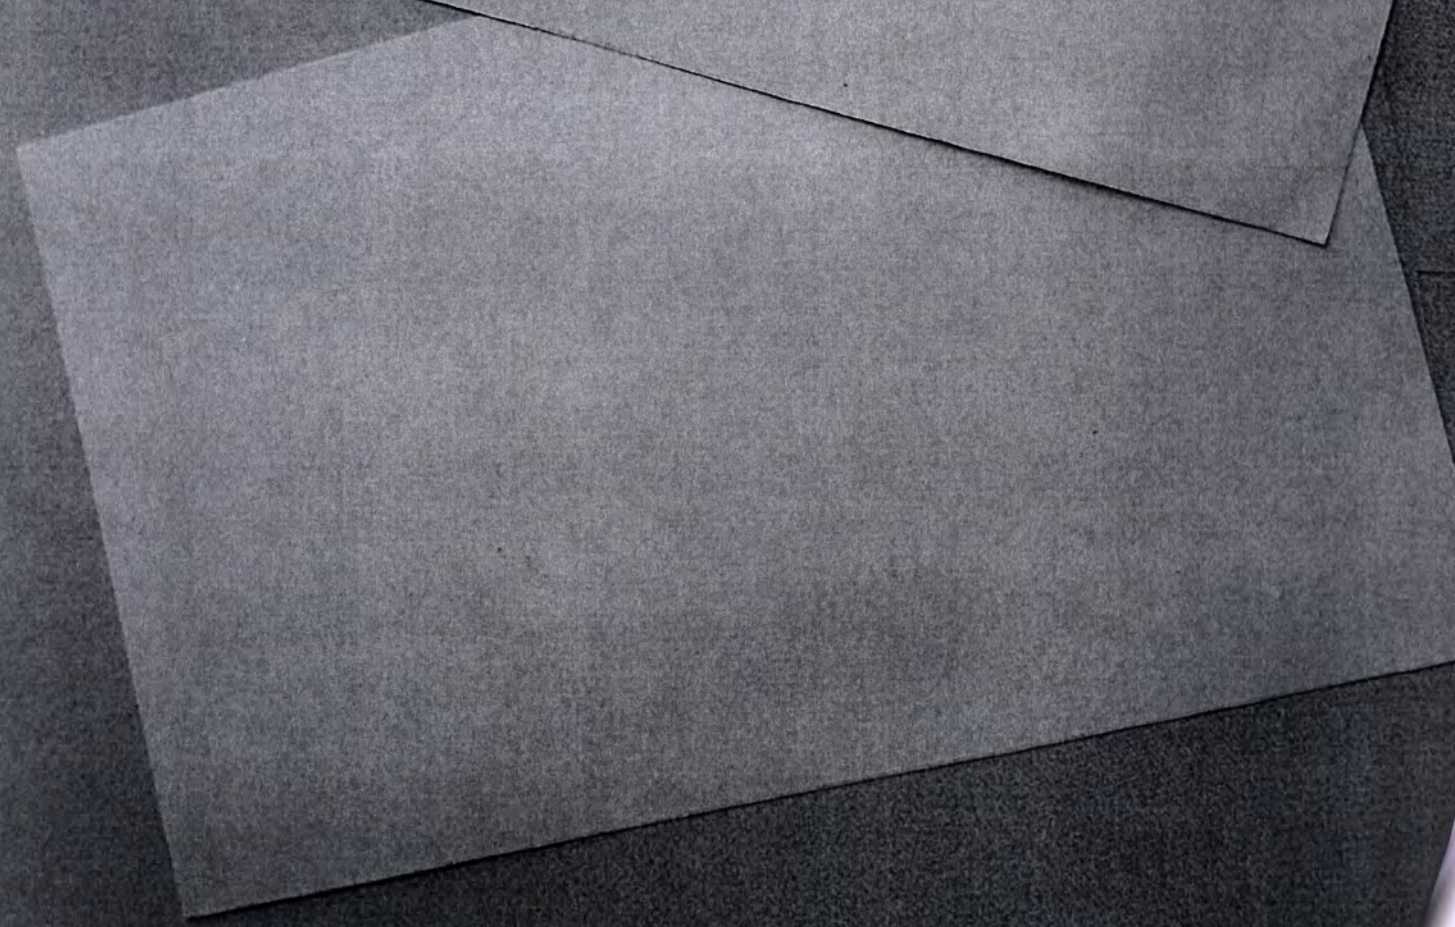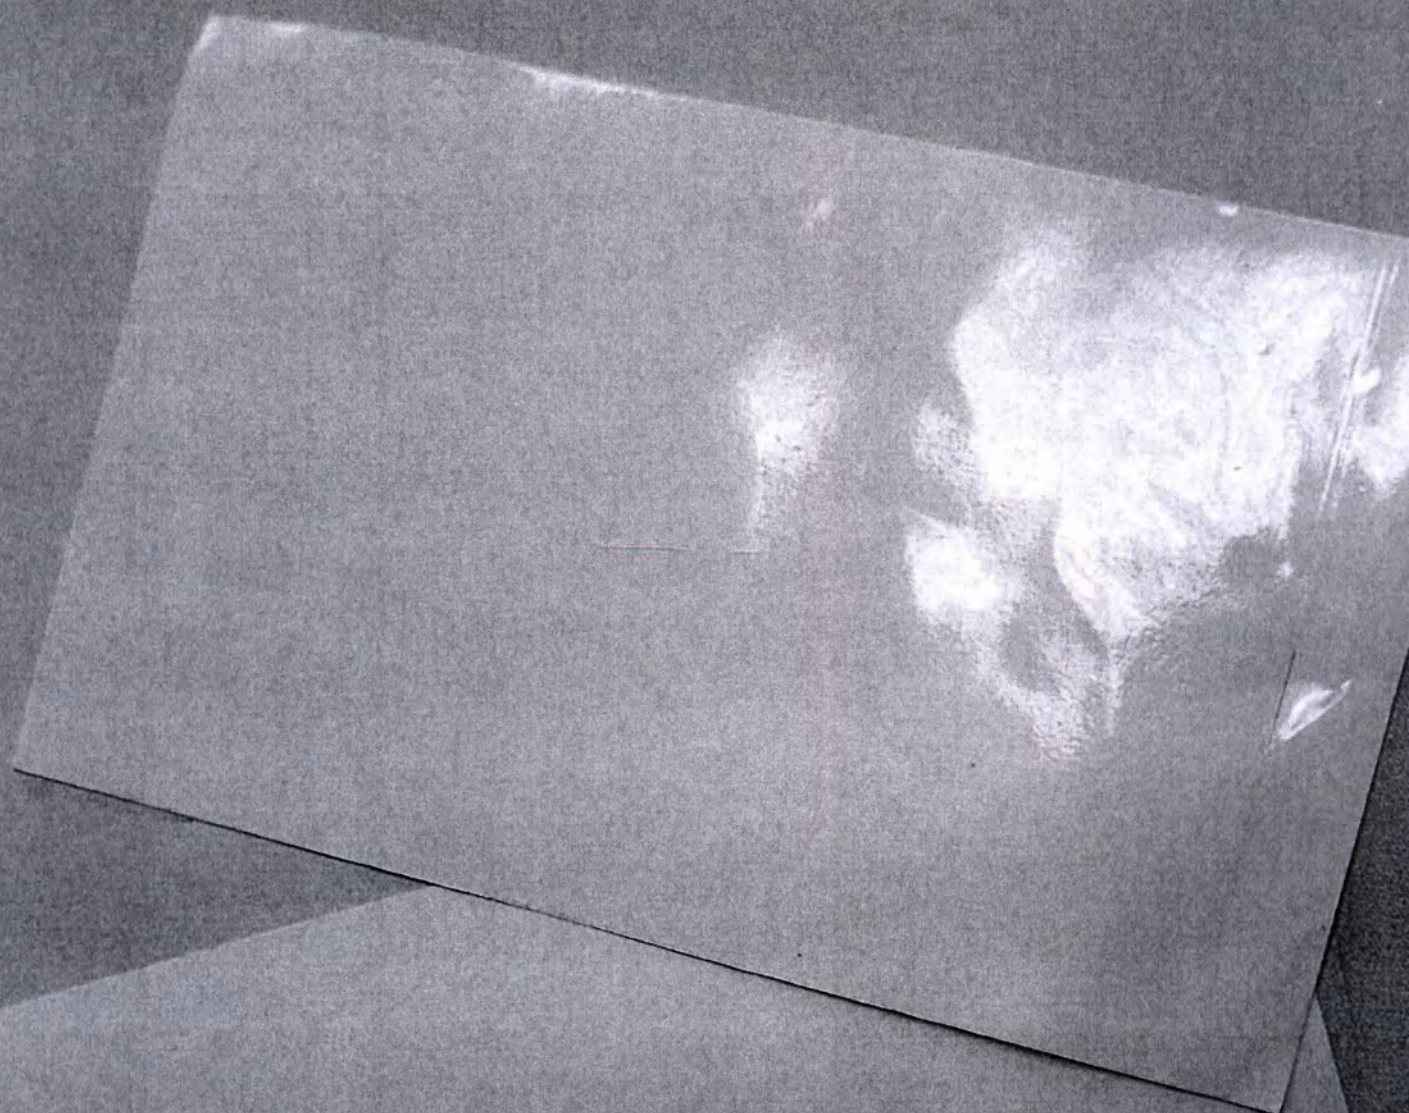

ПРОШУ
В КОЛИЧЕСТВЕ 12 ЛИСТОВ
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин

