

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин
«13» _____ 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**«Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител
к антигенам трематод в сыворотке (плазме) крови
«Трематоды IgG-ИФА»»**

Кат. №	Сокращенное наименование	Серия	К-во в серии	Дата изг. (год-мес)	Годен до (год-мес)
K176	«Трематоды IgG-ИФА»	806	10	2018-10	2020-04
Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам трематод в сыворотке (плазме) крови «Трематоды IgG-ИФА»					



Instruction for use



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ IgG АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ ТРЕМАТОД
В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
«Трематоды IgG-ИФА»**

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам трематод в сыворотке (плазме) крови «Трематоды IgG-ИФА»


REF	Серия	Наименование	Годен до	Годен до	Годен до
K176	806	Иммунотест	2018-10	2020-04	2020-04

Состав набора:

Наименование	Количество	Срок годности	Срок годности	Срок годности
Планшет	1 шт/пачка	2018-10	2020-04	2020-04
Отрицательный контроль	1 x 2.0 ml/ml	2018-10	2020-04	2020-04
Положительный контроль	1 x 1.5 ml/ml	2018-10	2020-04	2020-04
Конъюгат	1 x 14 ml/ml	2018-10	2020-04	2020-04
ИФА-буфер	1 x 50 ml/ml	2018-10	2020-04	2020-04
Субстратный раствор	1 x 14 ml/ml	2018-10	2020-04	2020-04
Тетраэтилбензидин (ТМБ)	1 x 22 ml/ml	2018-10	2020-04	2020-04
Концентрат отмывочного раствора	1 x 14 ml/ml	2018-10	2020-04	2020-04
Стоп-реагент	2 шт/пачка	2018-10	2020-04	2020-04
Бумага для замоченных планшетов	1 шт/пачка	2018-10	2020-04	2020-04
Инструкция по применению	1 шт/пачка	2018-10	2020-04	2020-04
Паспорт контроля качества	1 шт/пачка	2018-10	2020-04	2020-04

«Антитела к BPC 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют». Сыворотка, входящая в состав компонентов набора, неактивирована. ТУ № 21.20.23-176-18619450-2019, 1/9 №

143912, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д.28
Trubetskaya st, 28, Balashikha, Moscow reg, 143912, Russia

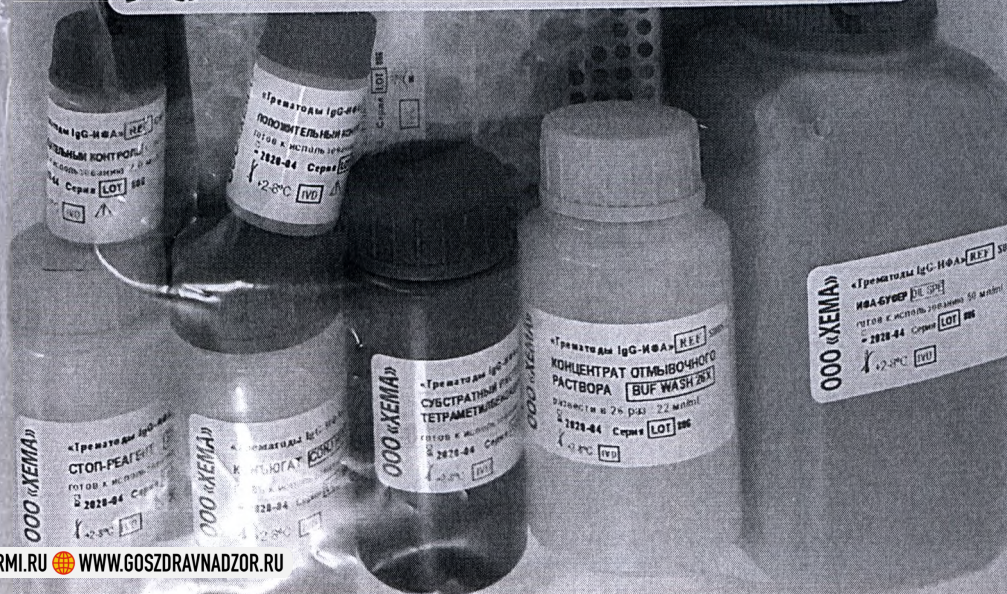

ООО «ХЕМА»
ОБО «ХЕМА»
ПАСПОРТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ХЕМА СО., LTD.
QUALITY CONTROL SHEET

Общество с ограниченной ответственностью «ХЕМА»
Паспорт контроля качества № 176/806

Кат. №	Сокращенное наименование	Серия	К-во в серии	Дата изг. (год-мес)	Годен до (год-мес)
K176	«Трематоды IgG-ИФА»	806	10	2018-10	2020-04


Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам трематод в сыворотке (плазме) крови «Трематоды IgG-ИФА»



 **Instruction for use**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ IgG АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ ТРЕМАТОД
В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
«Трематоды IgG-ИФА»**

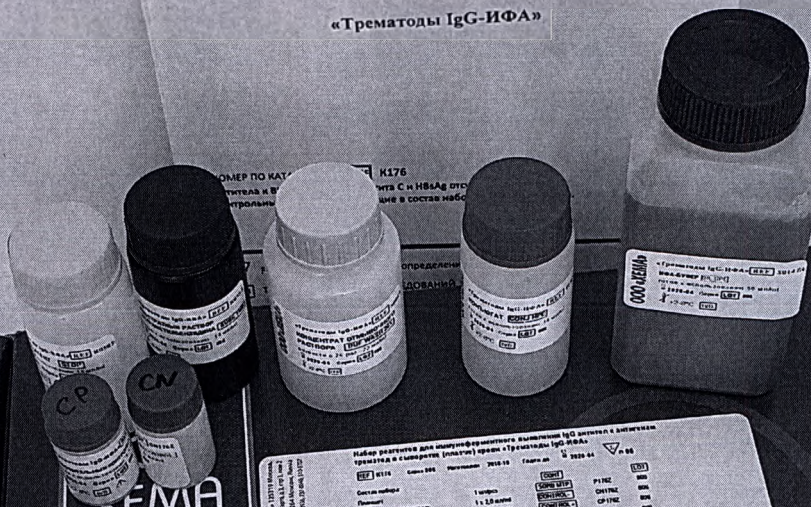

Индикатор развития для измерения мышечных выносливости (ИРС) состоит из выносливости триатлета и выносливости (ИРС) для триатлета

15 3000 41


Сектор	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
Сектор 1000	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90
Сектор 1500	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95
Сектор 2000	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00
Сектор 2500	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05
Сектор 3000	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10
Сектор 3500	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15
Сектор 4000	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20
Сектор 4500	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25
Сектор 5000	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30
Сектор 5500	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35
Сектор 6000	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40
Сектор 6500	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45
Сектор 7000	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50
Сектор 7500	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55
Сектор 8000	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60
Сектор 8500	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65
Сектор 9000	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70
Сектор 9500	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75

143917, МО, г. Балашиха, ул. Тургеневская, д. 28

Телефон 8 (495) 310-10-10, 310-10-11, 310-10-12


143917, МО, г. Балашиха, ул. Тургеневская, д. 28


Телефон 8 (495) 310-10-10, 310-10-11, 310-10-12

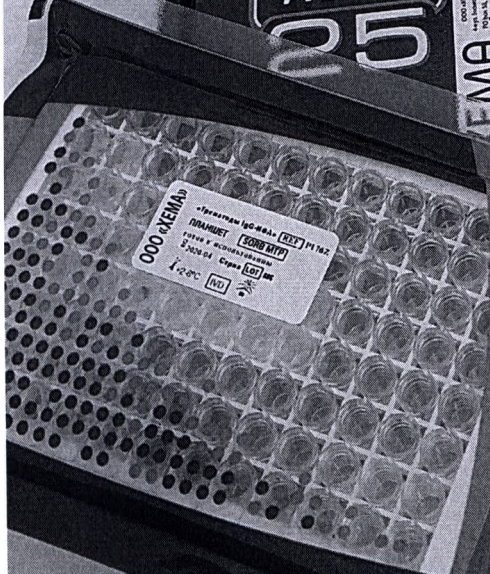






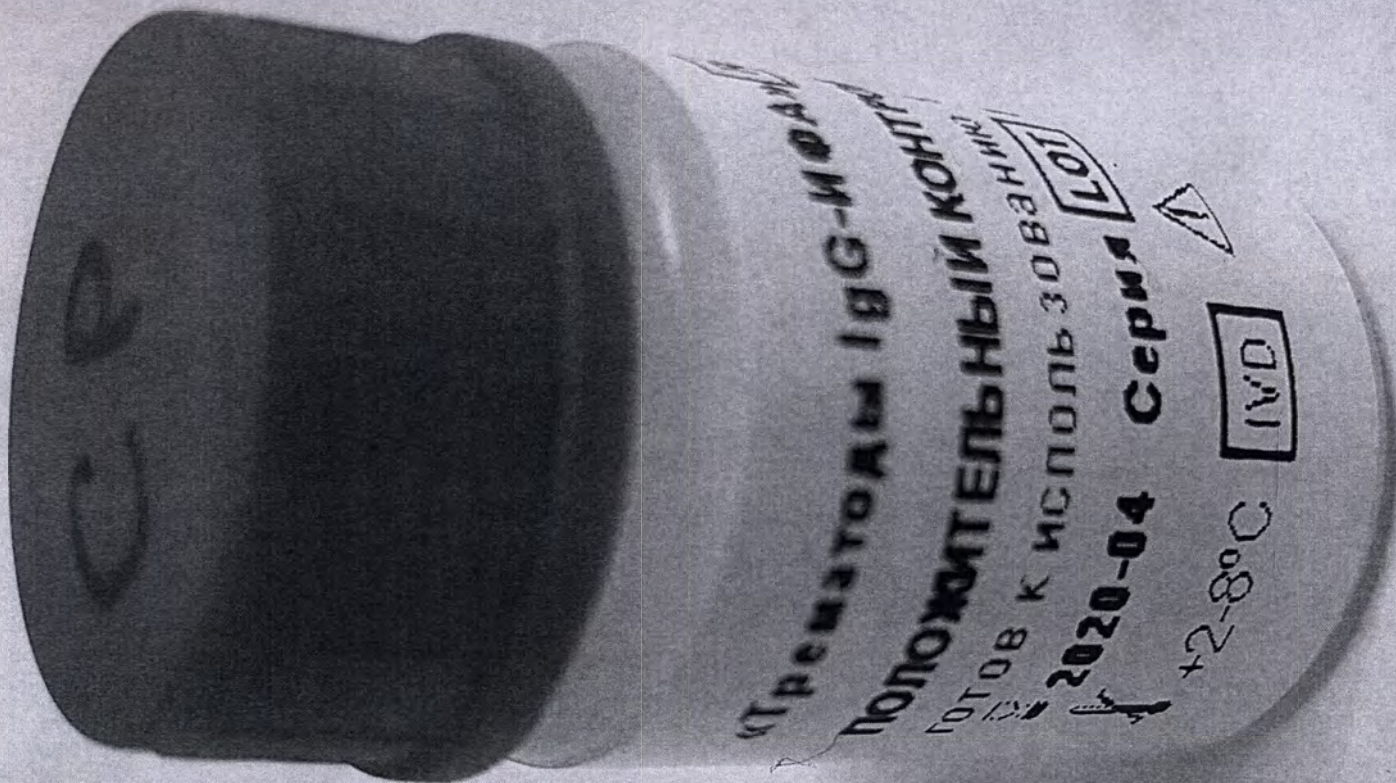

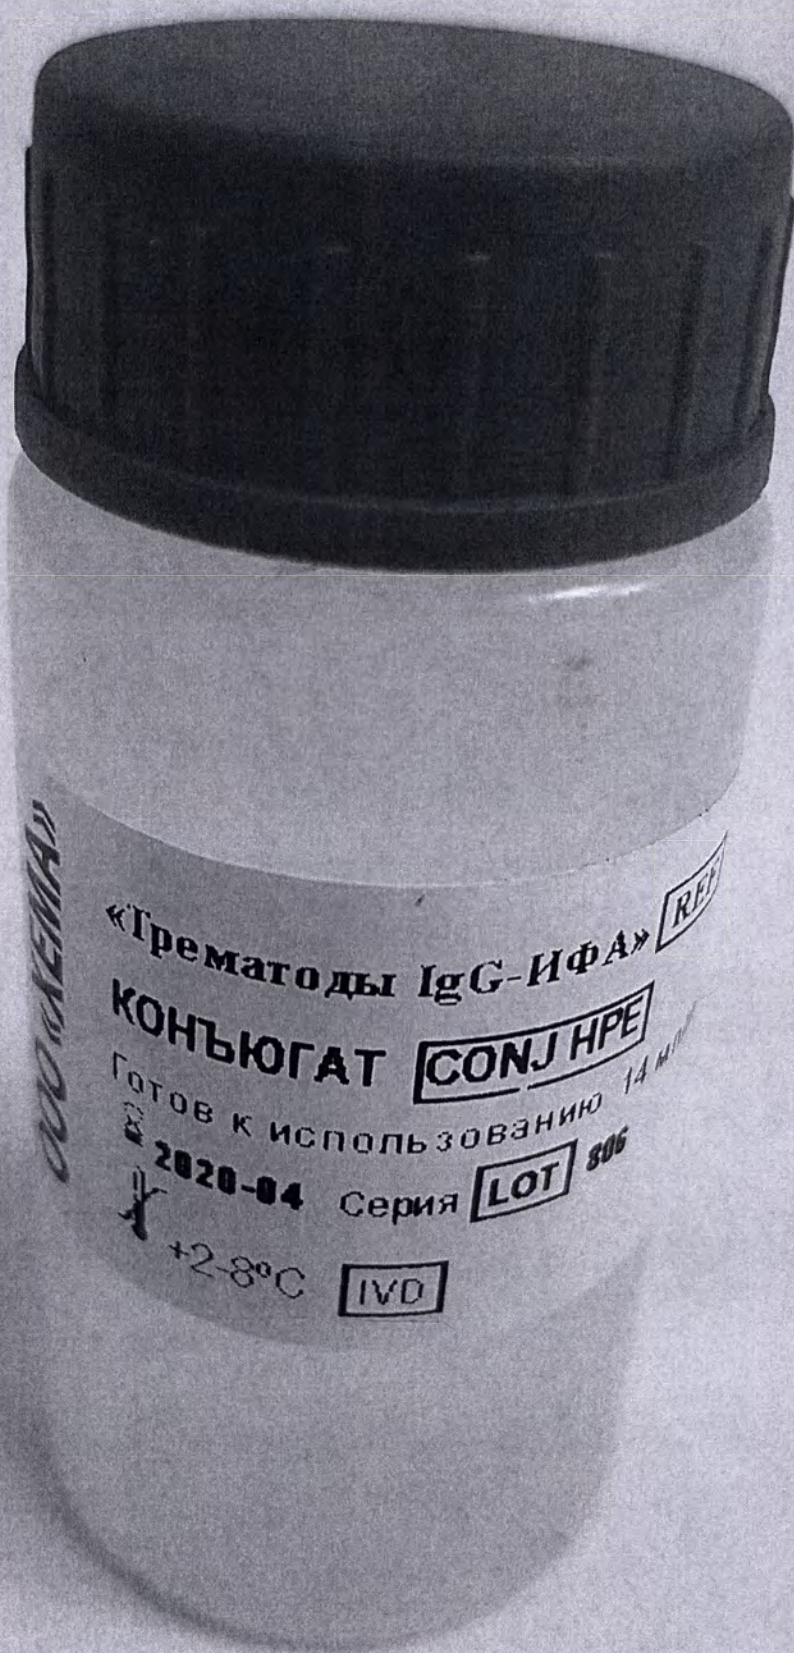

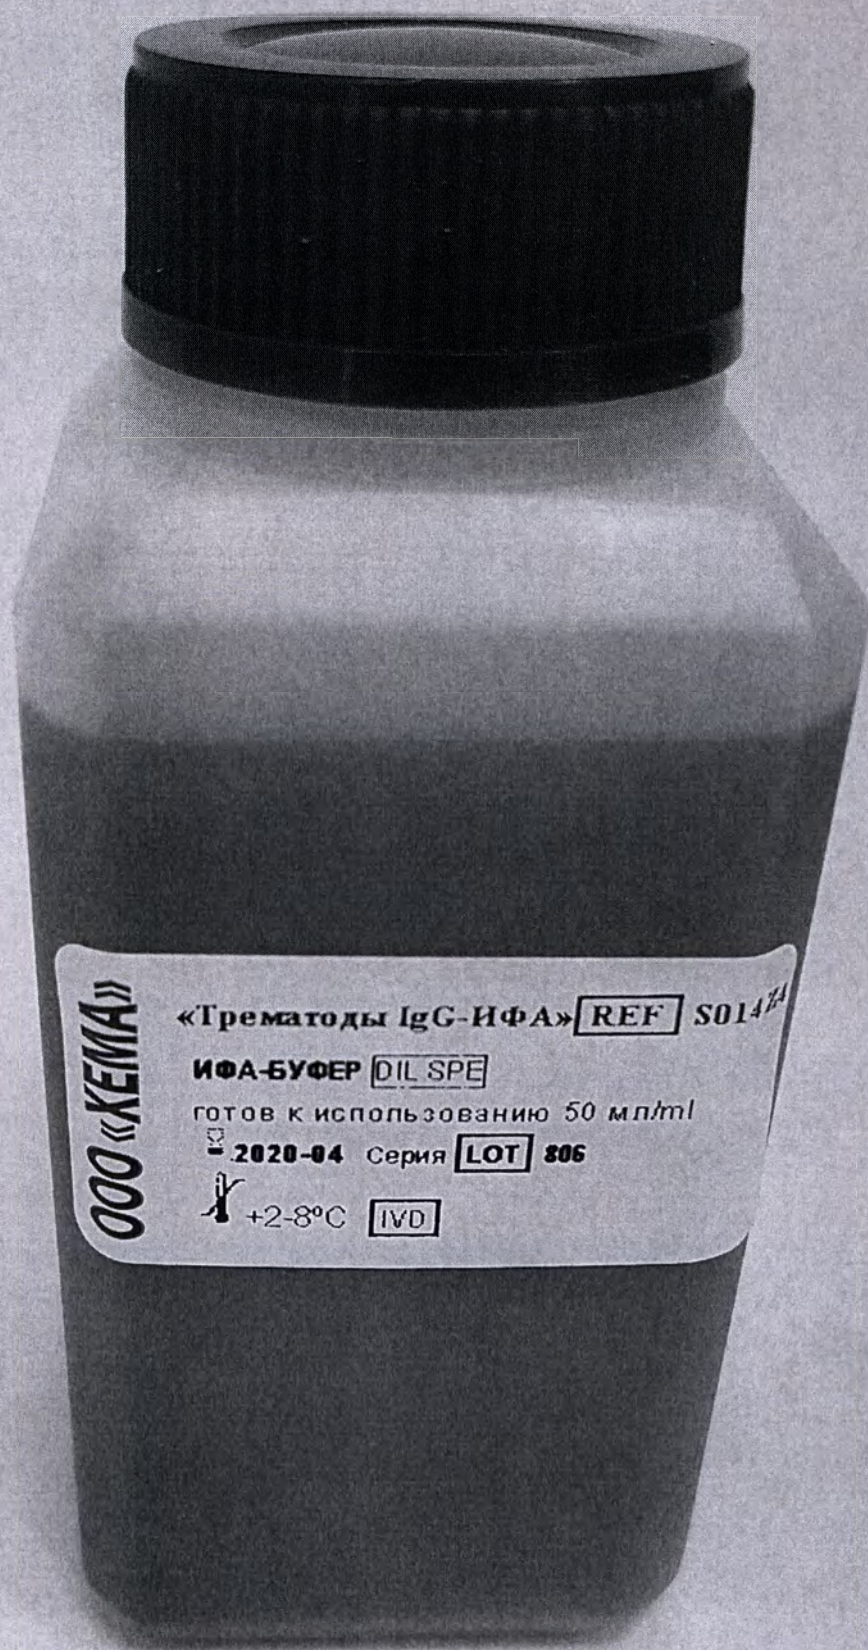

ООО «КЕМА»

«Трематоды IgG-ИФА» REF S01424

ИФА-БУФЕР DIL SPE


готов к использованию 50 мл/мл

2020-04 Серия LOT 806



+2-8°C


IVD

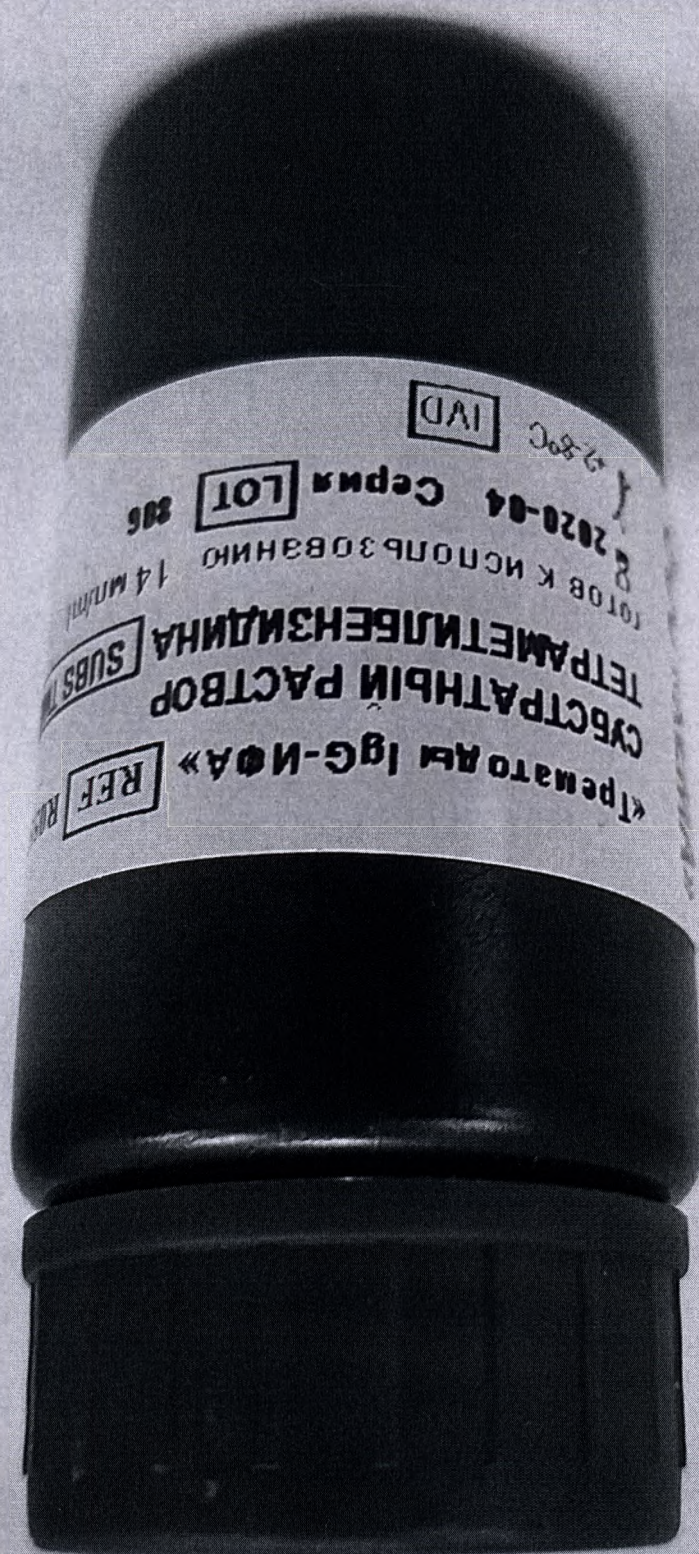



«Препарат IgG-НОА»
КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА
БУФ WASH 26X
развести в 26 раз 22 мл/мл
2020-04 Серия LOT 886
IVD

11

«Препарат IgG-НОА»
СТОП-РЕАГЕНТ
ГОТОВ К ИСПОЛНЕНИЮ 30 ВАНН 14 МЛ/ВАНН
2020-04 Серия LOT 306
LVD
i
X

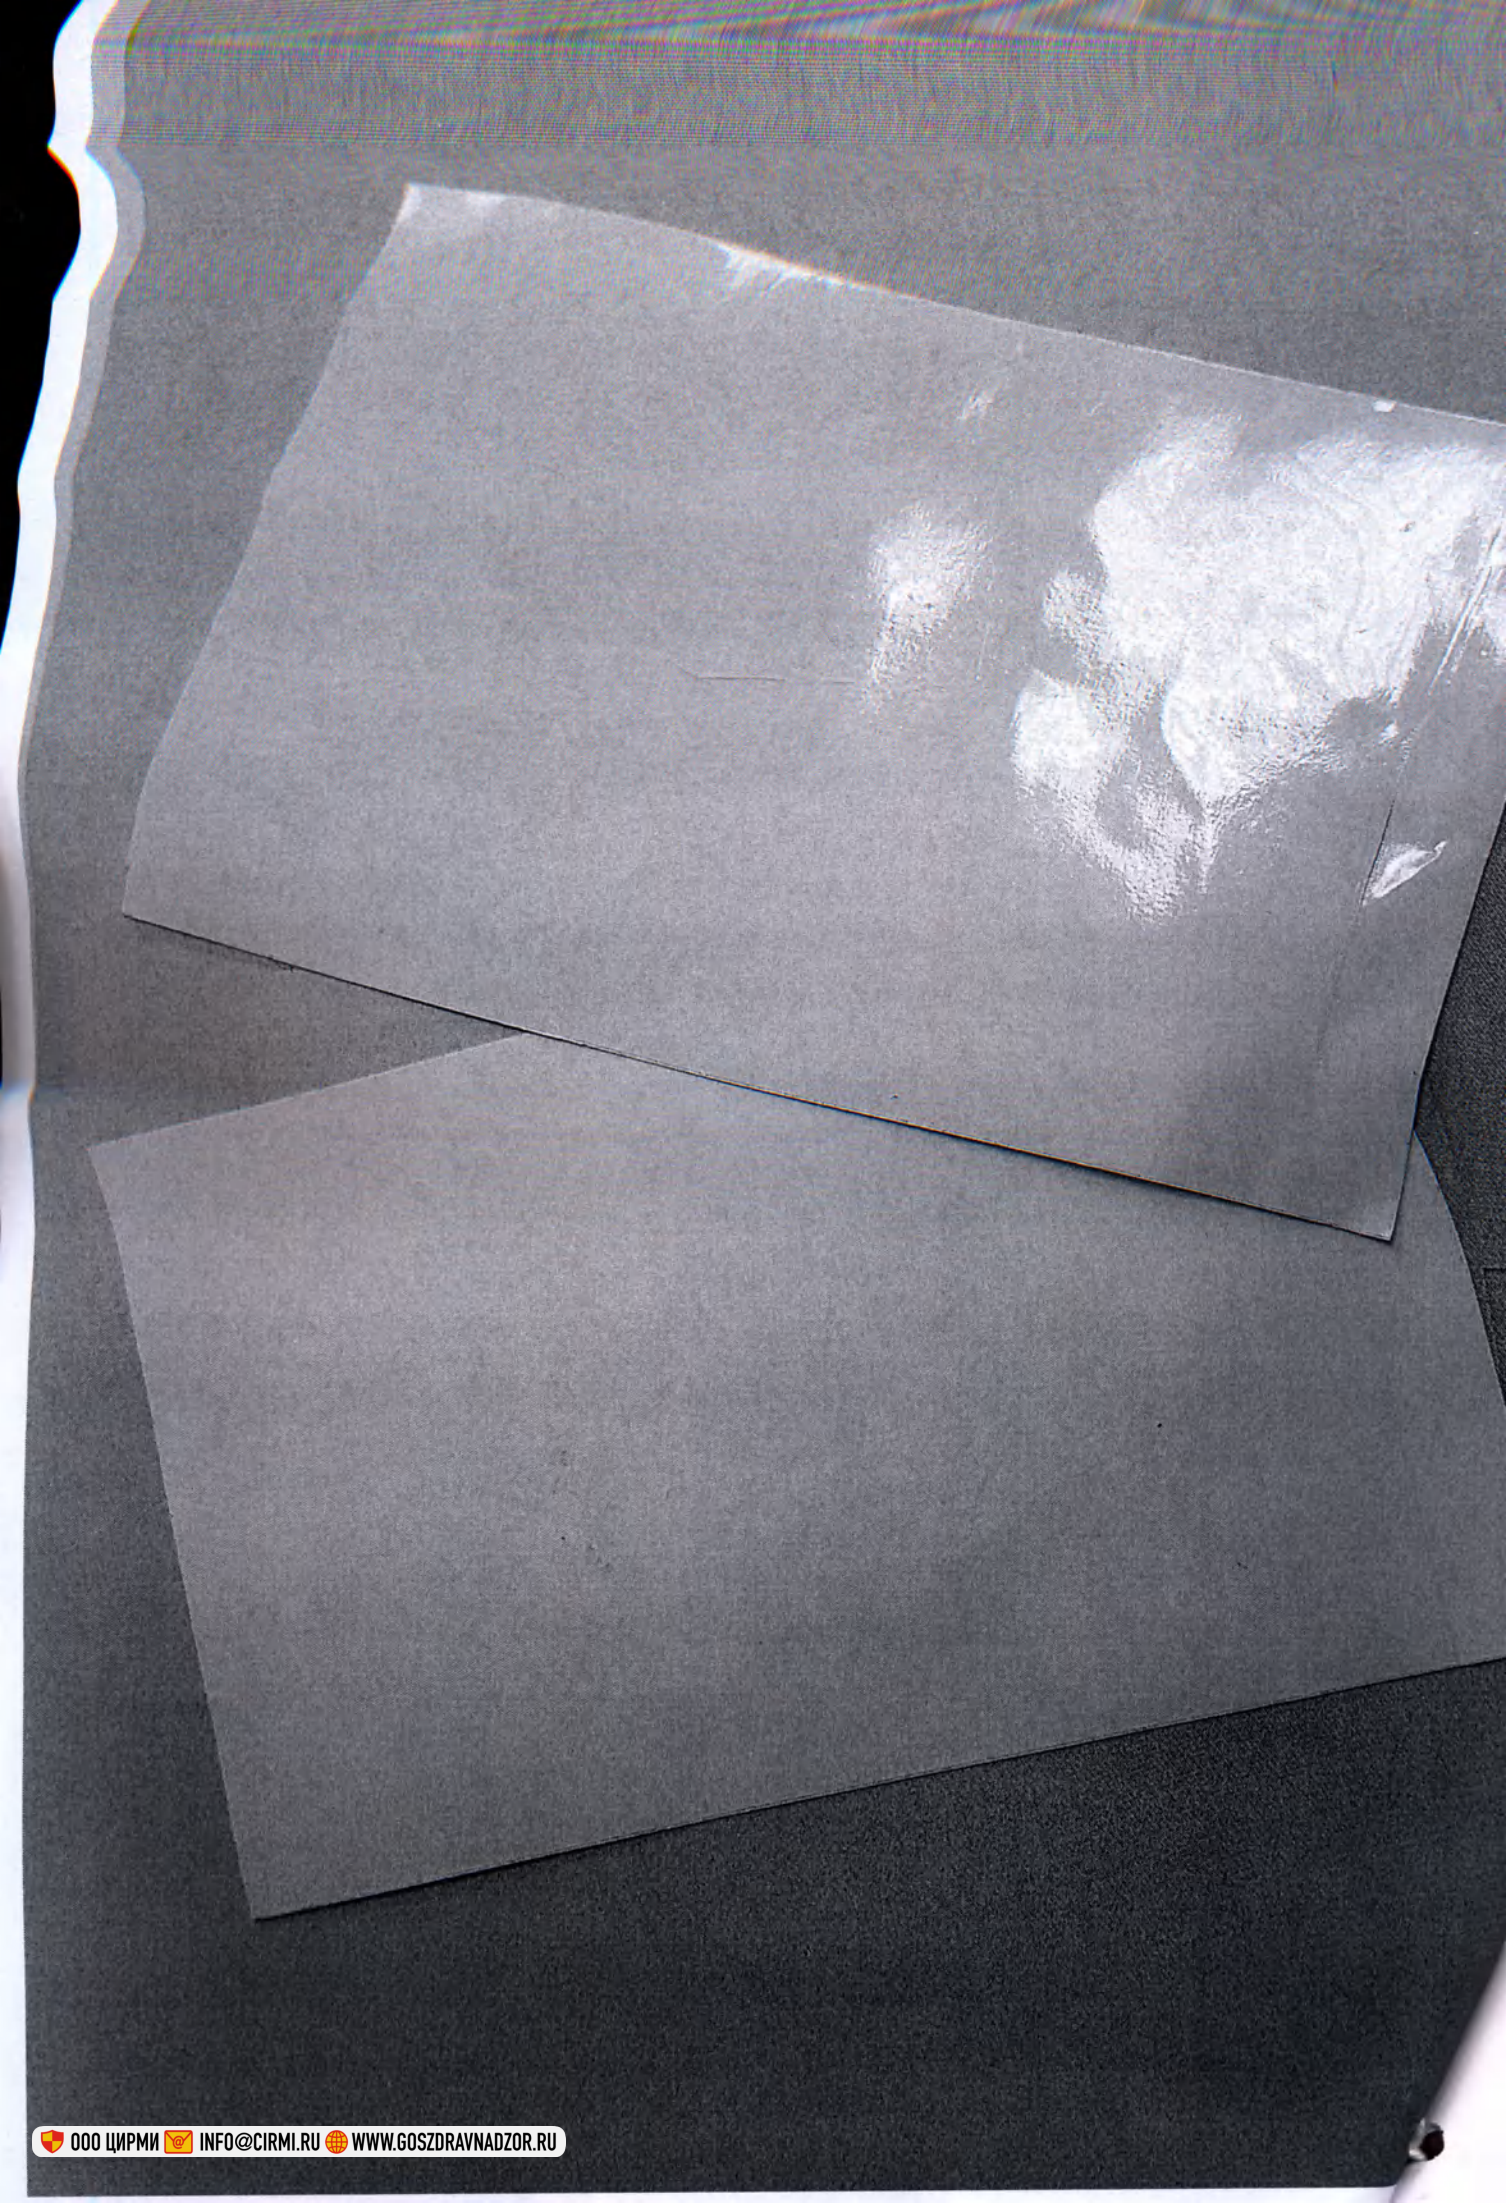

12

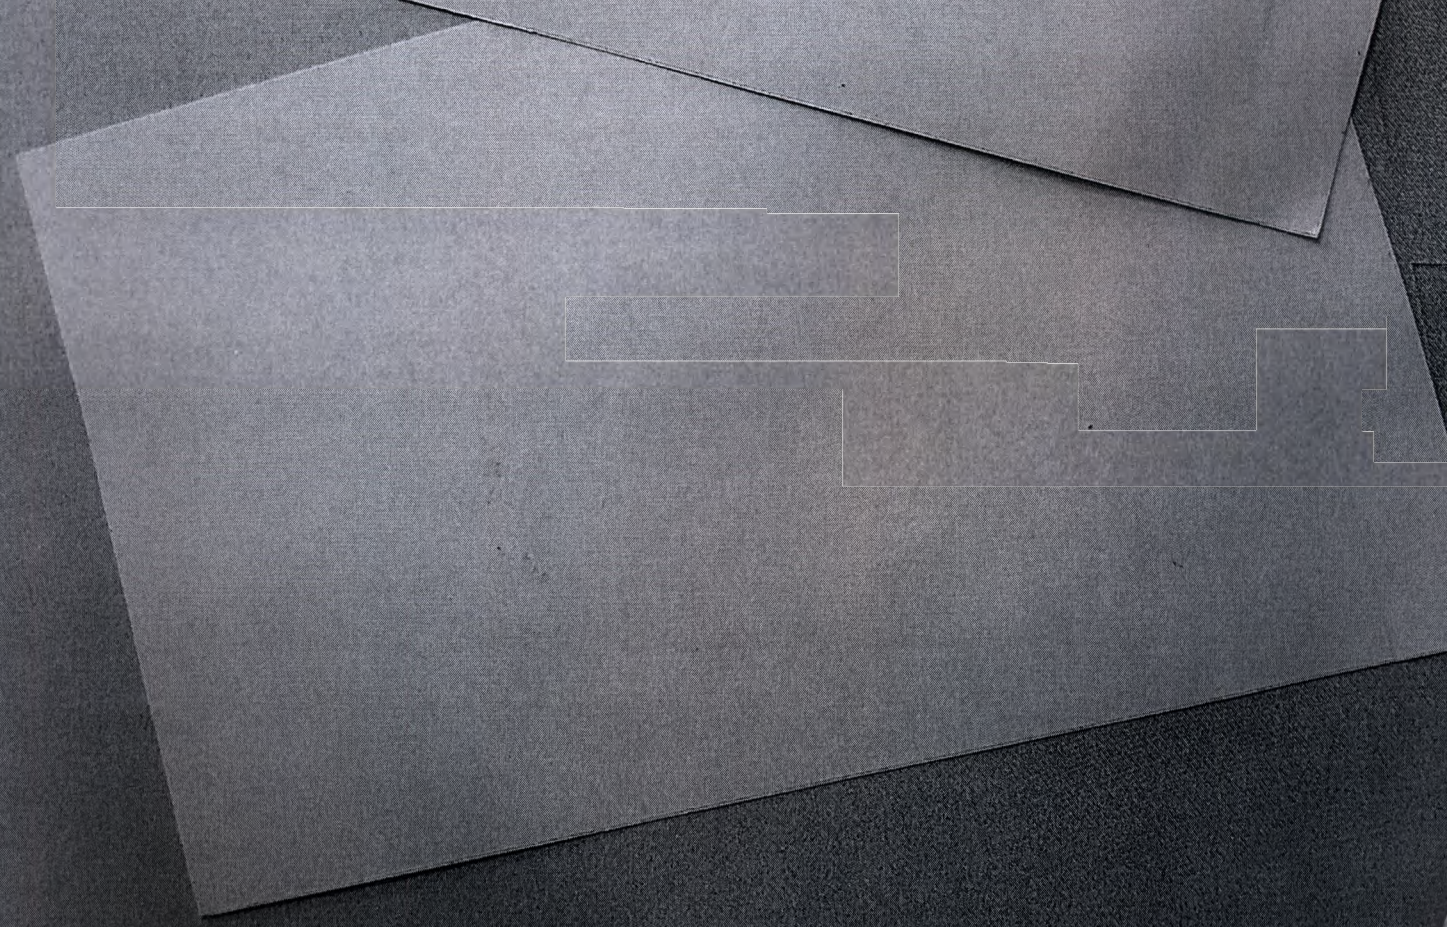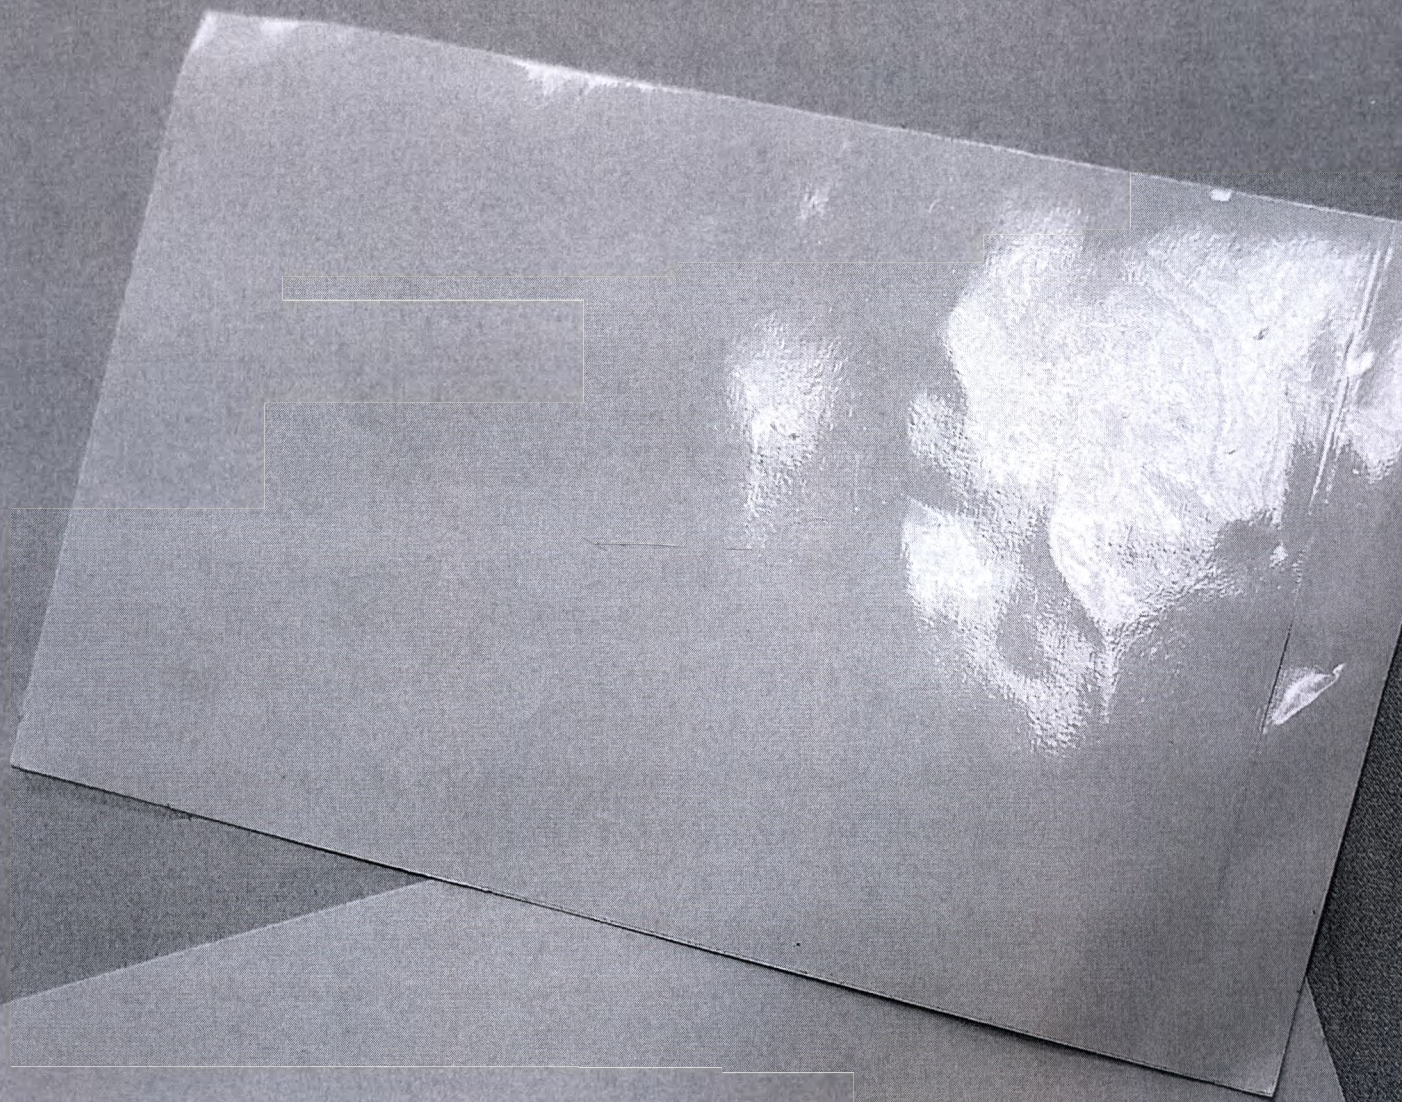

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 12 ЛИСТОВ
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин

