

Фотографические изображения

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET)

Состав:

- 1. Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.**
- 2. Реагент HBV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.**
- 3. Количественный стандарт ДНК (DNA QS) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.**
- 4. Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.**

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото общего вида



Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET).

- Состав: 1. Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.
2. Реагент HBV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.
3. Количественный стандарт ДНК (DNA QS) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.
4. Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства, дату производства см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-88-99, факс: +7 495 229-82-84, E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер 06979564190

cobas® HBV

*Quantitative nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System*

c4800 HBV AMP/DET




cobas®

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): маркировка


cobas® HBV

REF P/N: 06979564190

*Quantitative nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System*

 120

IVD

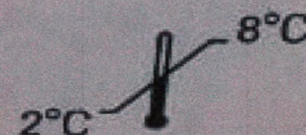 2°C 8°C

c4800 HBV AMP/DET

cobas®

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото общего вида



c4800 HBV AMP/DET

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



Distributed by

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
8343 Rotkreuz, Switzerland

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

Roche Diagnostics, SL
Avda. Generalitat, 171-173
E-08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain

Roche Diagnostics
201, boulevard Armand-Frappier
H7V 4A2 Laval, Québec, Canada
(For Technical Assistance call:
Pour toute assistance technique,
appeler le: 1-877-273-3433)

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors
38240 Meylan, France


Distributore in Italia:
Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G. B. Stucchi 110
20052 Monza, Milano, Italy

Distribuidor em Portugal:
Roche Sistemas de Diagnósticos Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora, Portugal

Roche Diagnostica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729
Jaguari, Building 10
05321-010 São Paulo, SP, Brazil

COBAS is a trademark of Roche. ©2015 Roche Molecular Systems, Inc.

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото общего вида

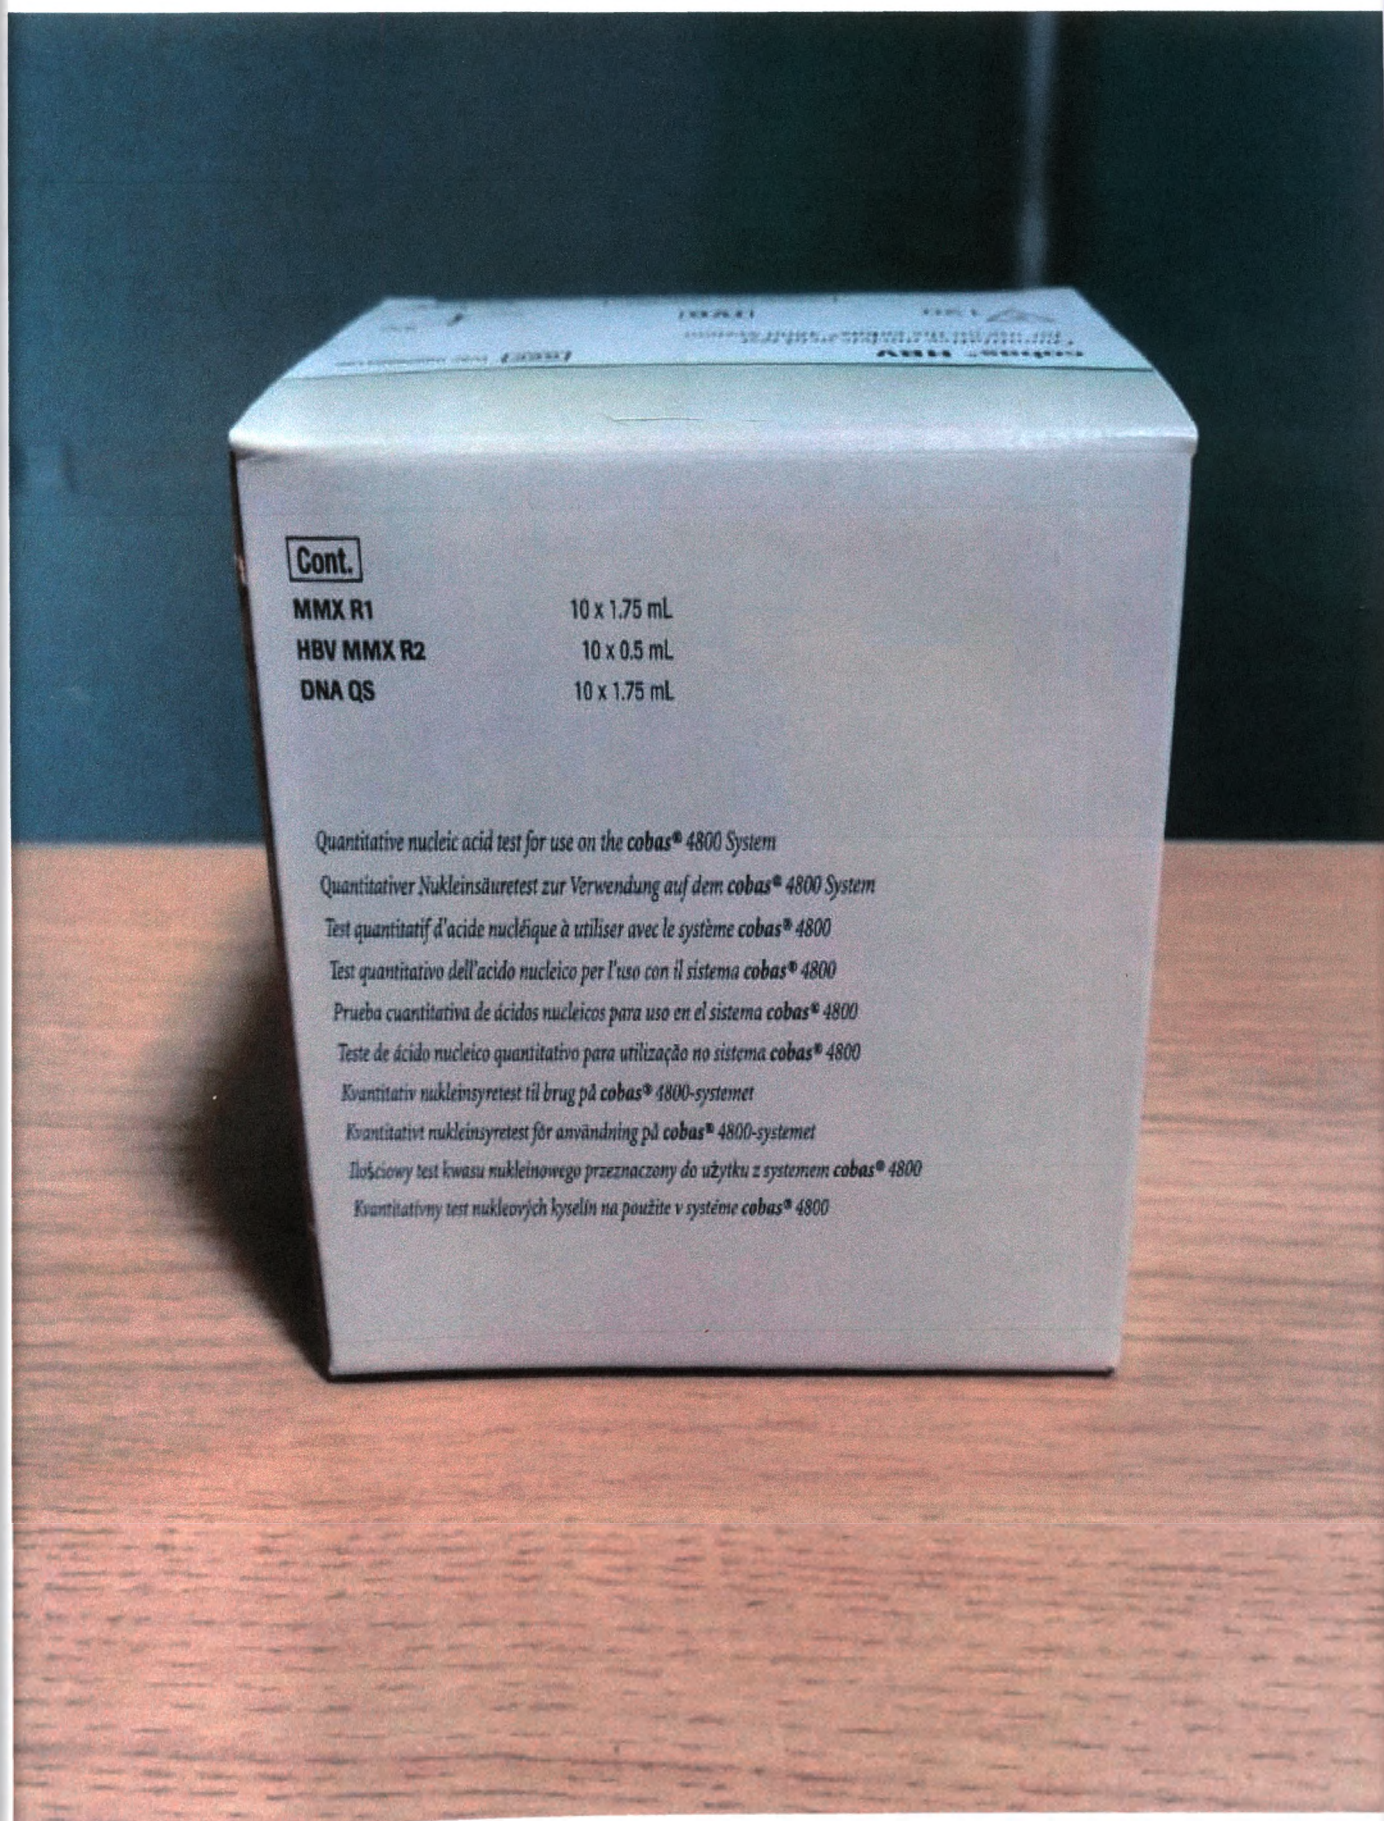

Cont.

MMX R1	10 x 1.75 mL
HBV MMX R2	10 x 0.5 mL
DNA QS	10 x 1.75 mL

Quantitative nucleic acid test for use on the cobas® 4800 System

Quantitativer Nukleinsäuretest zur Verwendung auf dem cobas® 4800 System

Test quantitatif d'acide nucléique à utiliser avec le système cobas® 4800

Test quantitativo dell'acido nucleico per l'uso con il sistema cobas® 4800

Prueba cuantitativa de ácidos nucleicos para uso en el sistema cobas® 4800

Teste de ácido nucleico quantitativo para utilização no sistema cobas® 4800


Kvantitativ nukleinsyretest til brug på cobas® 4800-systemet

Kvantitativt nukleinsyretest för användning på cobas® 4800-systemet


Ilościowy test kwasu nukleinowego przeznaczony do użyciu z systemem cobas® 4800

Kvantitatívny test nukleových kyselín na použitie v systéme cobas® 4800

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото общего вида

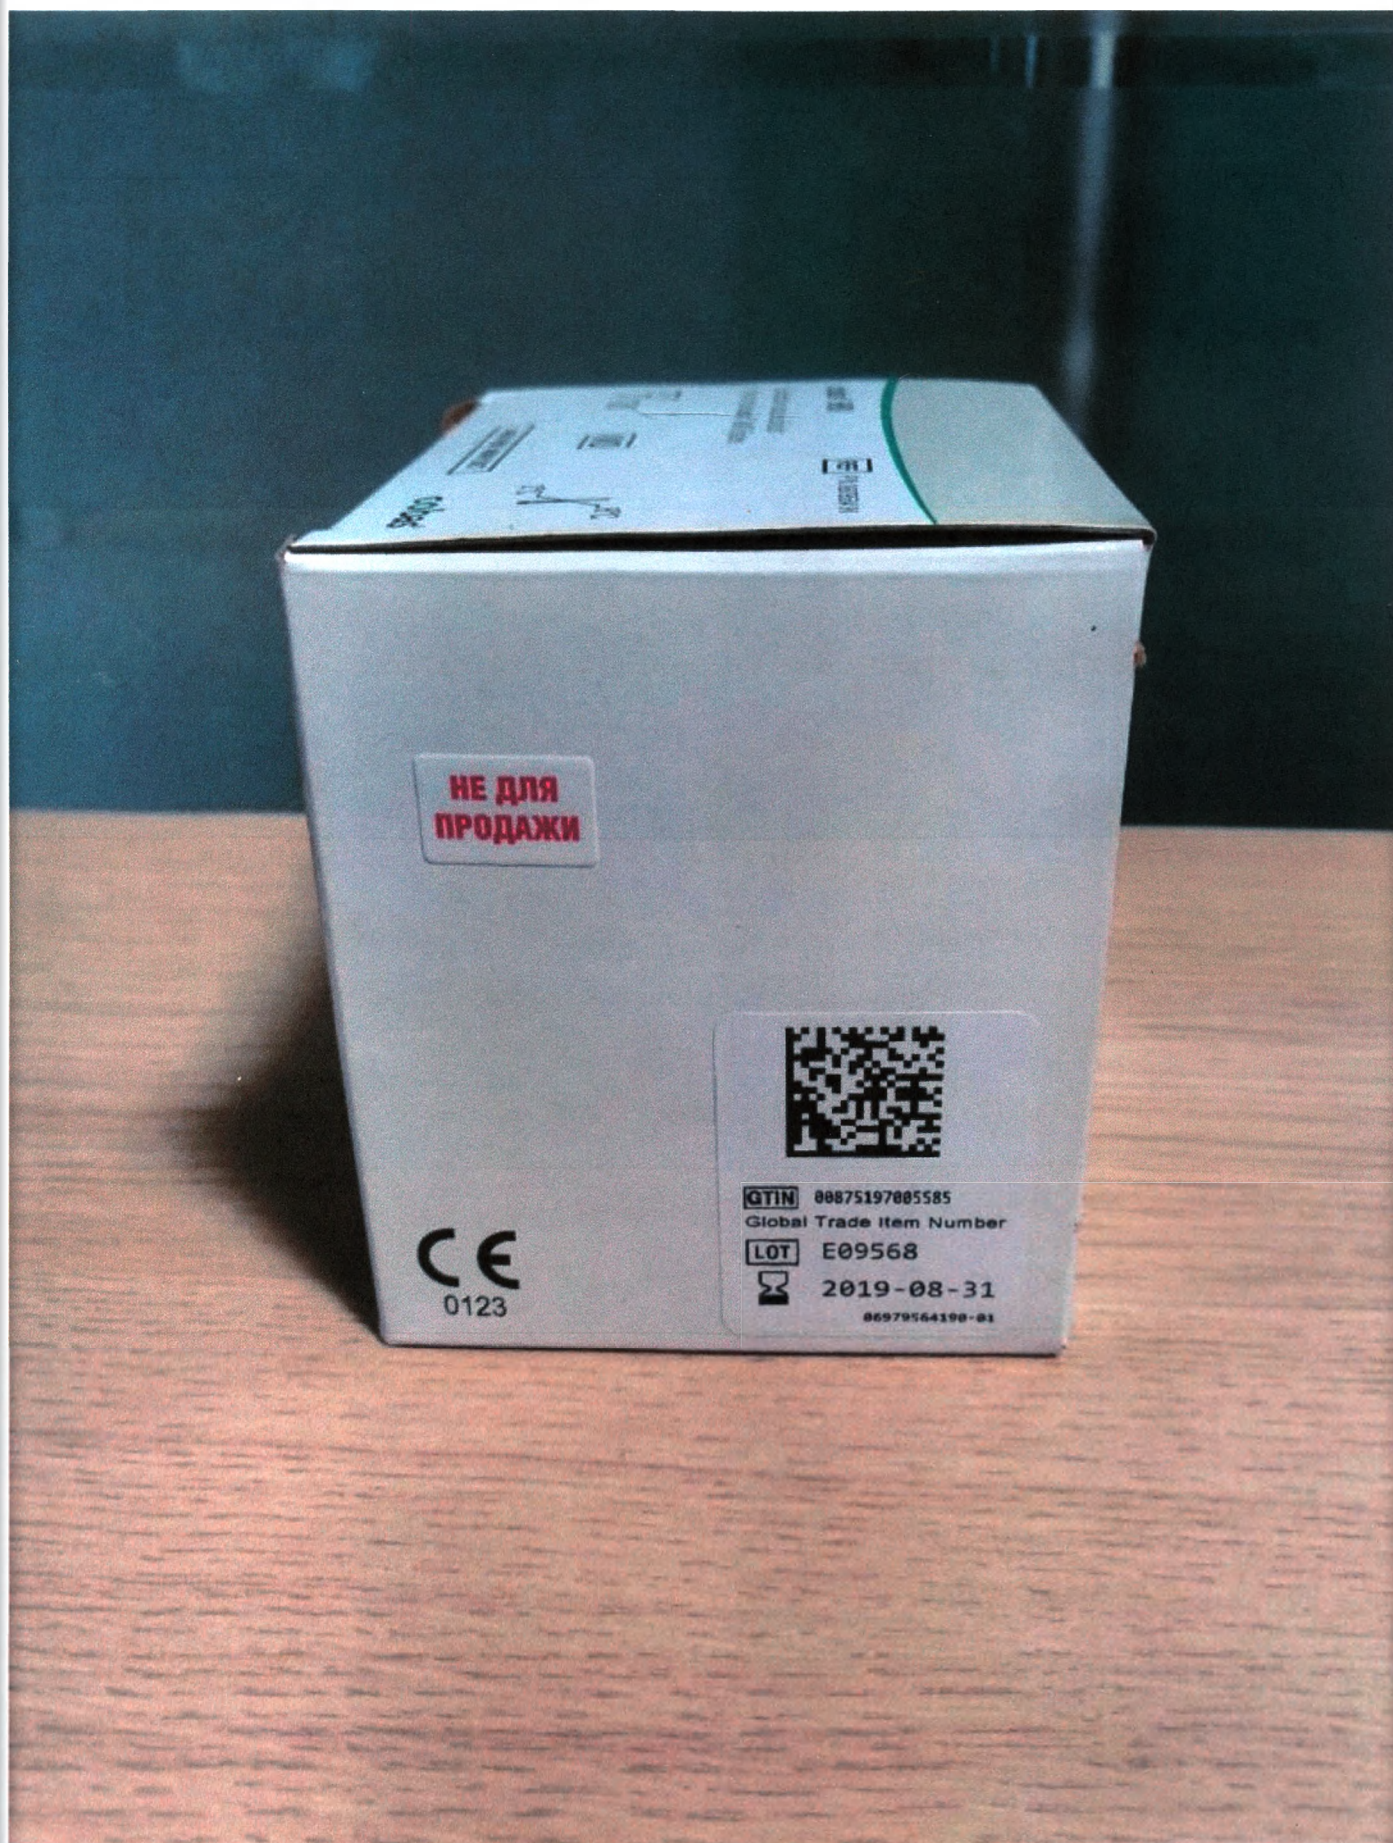


Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.

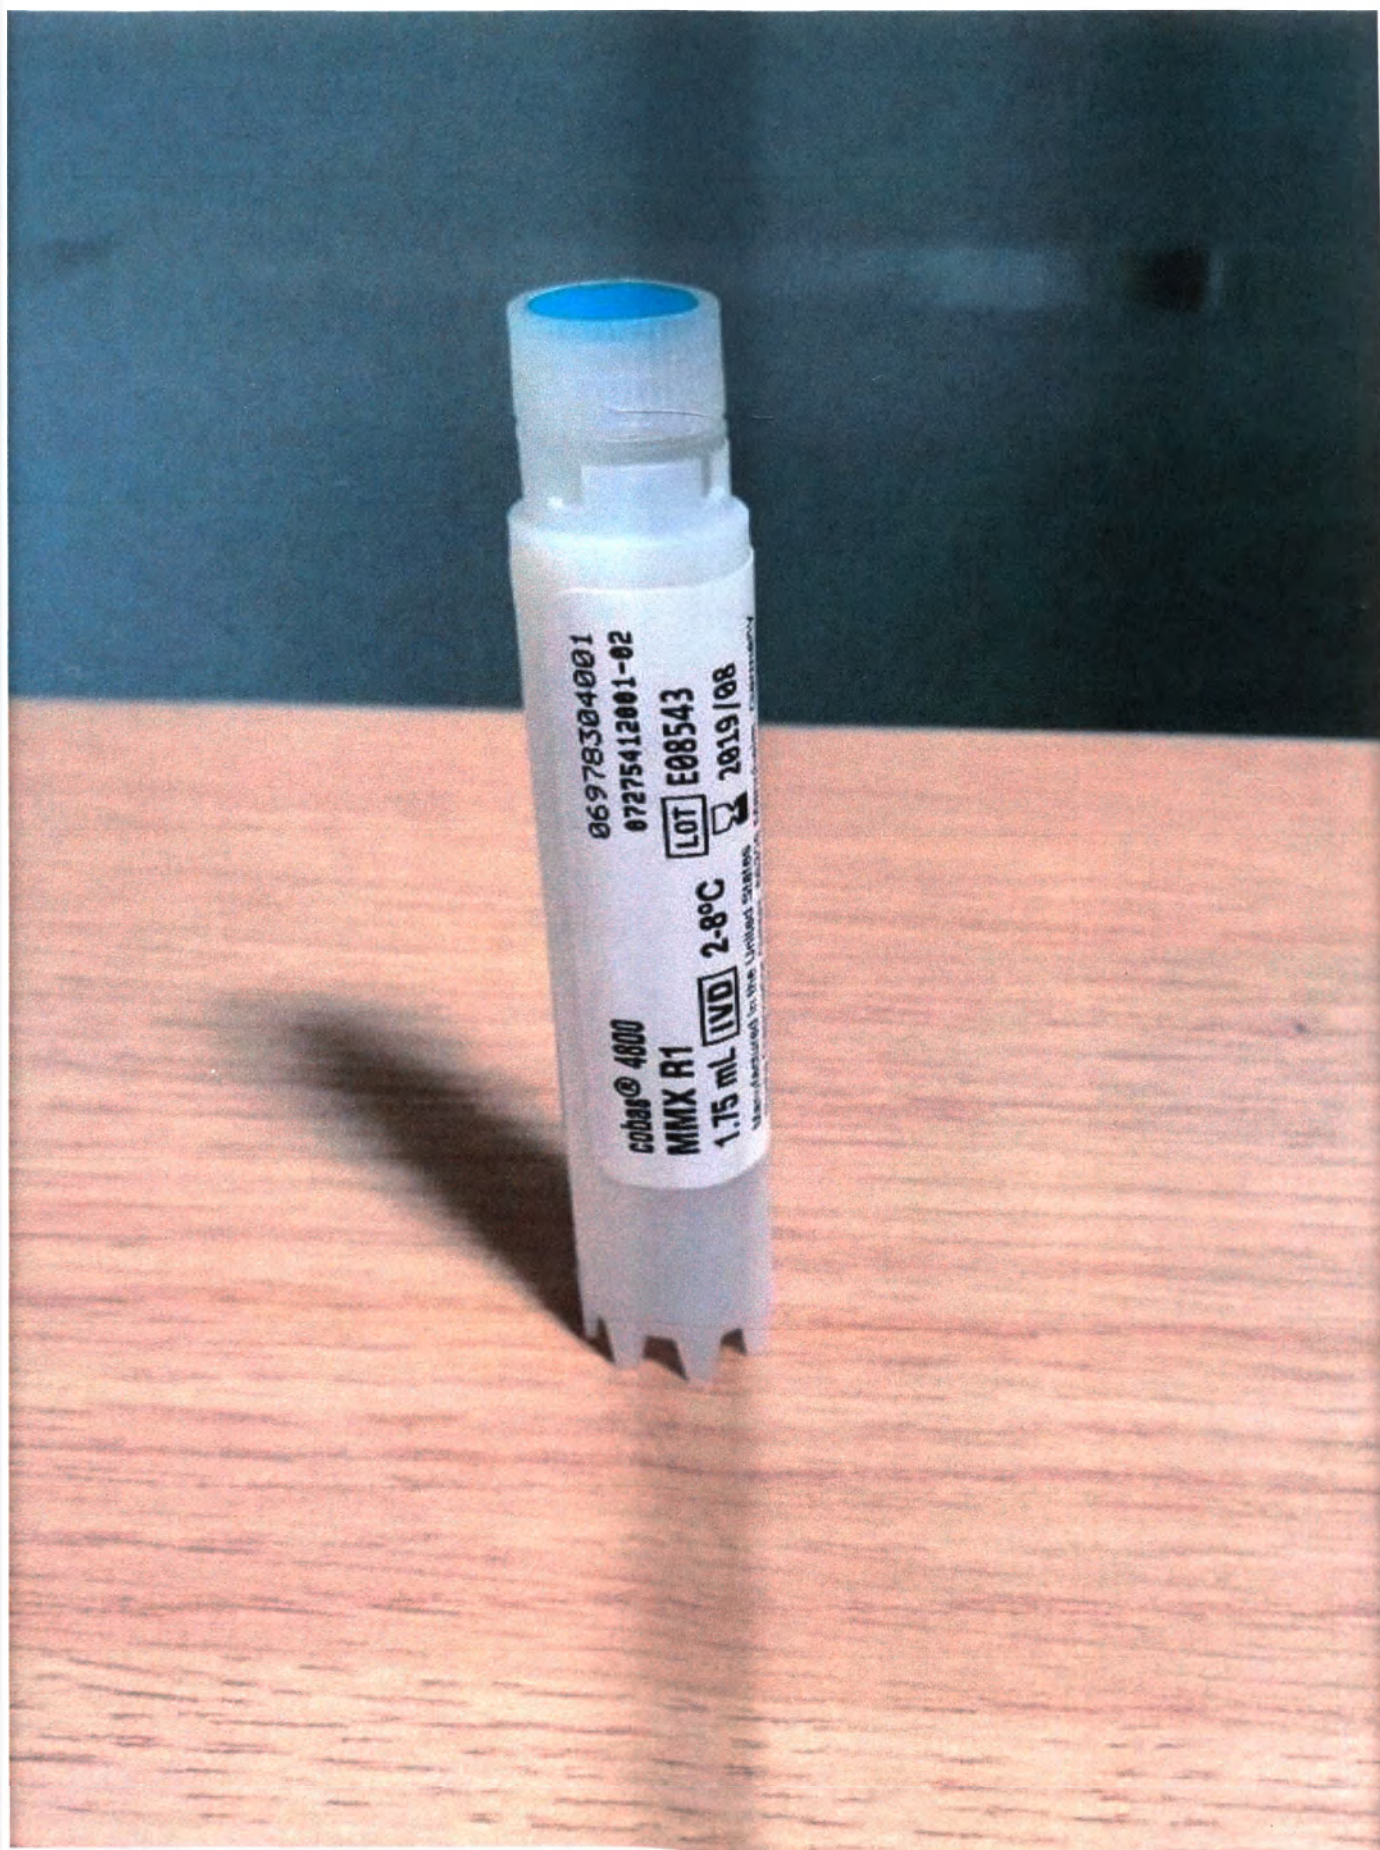


Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): Реагент MMX R1 во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.




Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото Реагент HBV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.

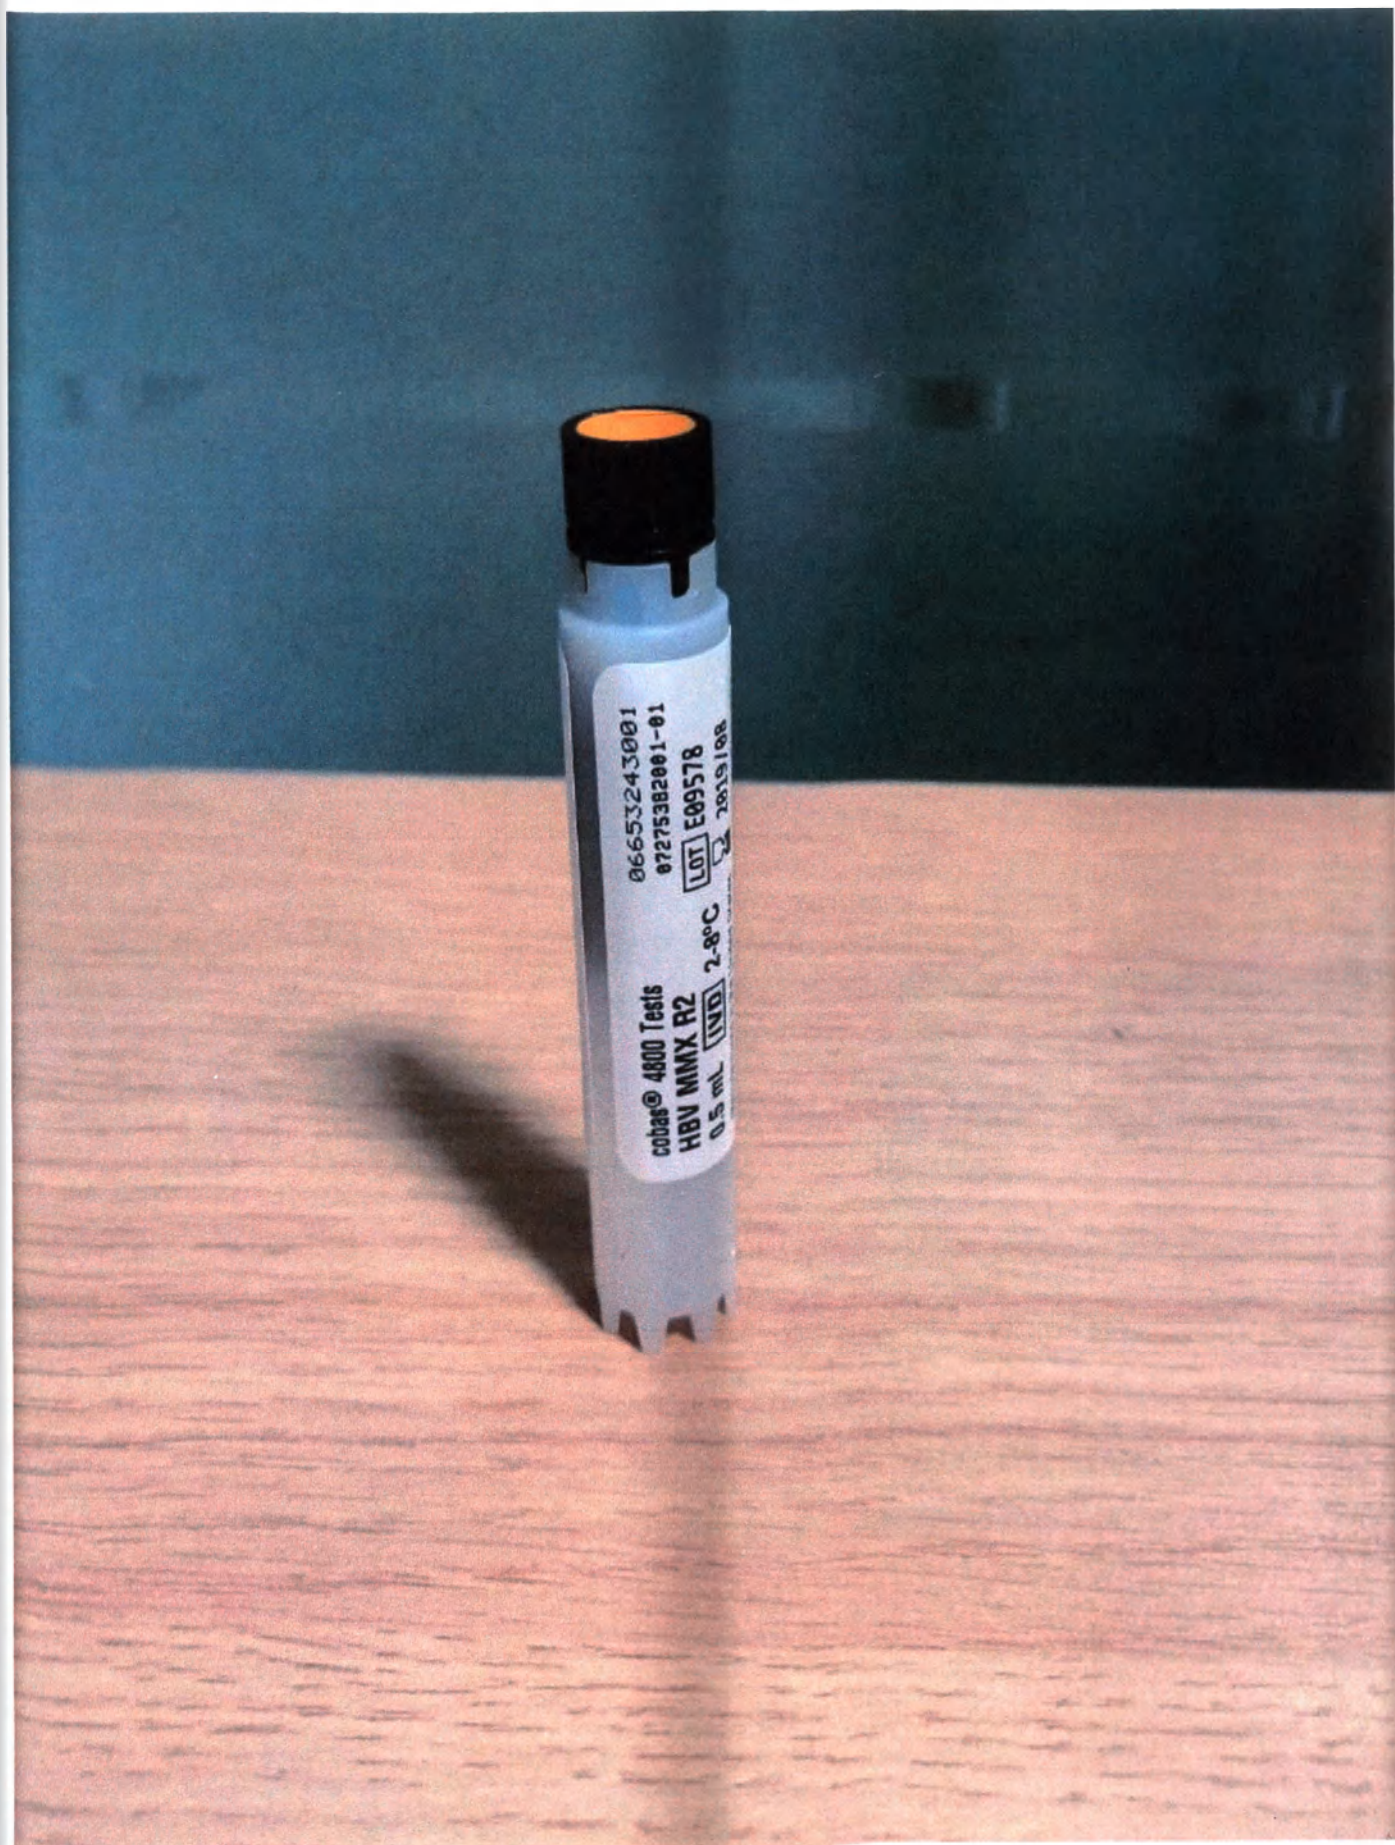

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото Реагент HBV MMX R2 во флаконе, объем 0,5 мл, 10 шт.

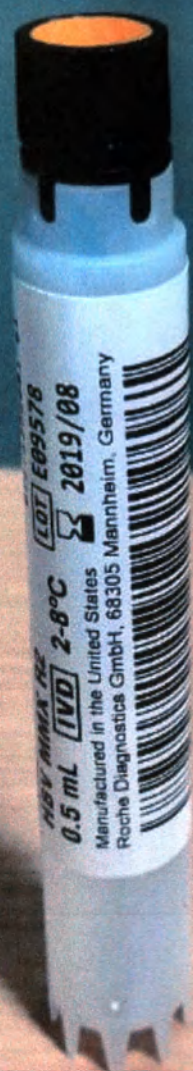

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото Количественный стандарт ДНК (DNA QS) во флаконе, объем 1,75 мл, 10 шт.

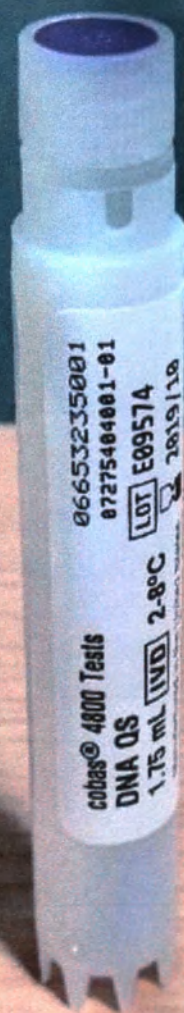

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото Количественный стандарт ДНК (DNA QS) во флаконе, объем 1,7 мл, 10 шт.



Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.

cobas® HBV Quantitative nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System

c4800 HBV AMP/DET



KIT **LOT** E09568



2019/08

LOT

IVD

MMX R1 E08543

HBV MMX R2 E09578

DNA QS E09574



cobas® 4800 system

cobas® HBV AP v1.1 or higher

cobas® 4800 system Application Software Version 2.2 or higher

Manufactured in the United States



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

07373902001-02

Набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В в образцах плазмы и сыворотки крови человека методом амплификации нуклеиновых кислот на системе модульной cobas 4800 (cobas HBV/c4800 HBV AMP/DET): фото Информационная карточка-вкладыш – 2 шт.

IVD

cobas® HBV
Quantitative nucleic acid test
for use on the cobas® 4800 System

c4800 HBV AMP/DET

KIT LOT
E09568

MMX R1	LOT E08543
HBV MMX R2	E09578
DNA QS	E09574

cobas® 4800 system
cobas® HBV AP v1.1 or higher
cobas® 4800 system Application
Software Version 2.2 or higher

website: <http://e-labdoc.roche.com>
Method Sheet Catalog No.: 06979564190
Doc Rev. 4.0

Please contact your local Roche affiliate if you require a printed copy free of charge or need technical support to access the package insert. / Bei Ihrer zuständigen Roche-Vertretung erhalten Sie einen kostenfreien Ausdruck oder technische Unterstützung für den Zugriff auf die Packungsbeilage. / Veuillez contacter votre société Roche locale pour obtenir un exemplaire papier gratuit ou une assistance technique pour accéder à la notice. / Contattare il rappresentante Roche locale per ottenere gratuitamente una copia stampata o richiedere istruzioni per reperire il foglio illustrativo. / Póngase en contacto con su filial local de Roche si necesita una copia impresa gratuita o ayuda del servicio técnico para acceder al boletín técnico. / Se desejar uma cópia impressa gratuita ou necessitar de assistência técnica para aceder ao folheto informativo, entre em contacto com o representante local da Roche. / Kontakt den lokale Roche-representant, hvis du ønsker en gratis skriftlig kopi eller har brug for teknisk support for at få adgang til indlægssedlen. / Kontakta din Roche-representant om du vill ha en pappersversion kostnadsfritt eller om du behöver teknisk support för att komma åt bipacksedeln. / Aby otrzymać darmową drukowaną wersję lub jeśli zaistniały problemy techniczne z dostępem do ulotki dołączonej do opakowania, należy skontaktować się z miejscowym oddziałem firmy Roche. / Ak potrebujete bezplatnú vytlačení kópiu alebo ak potrebujete technickú pomoc ohľadne prístupu k príbalovým letákom, obráťte sa na miestne zastúpenie spoločnosti Roche.

Manufactured in the United States

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

07702345001-04

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
пятидесят (15) листа (ов)

Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 июля 2018

