

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ИНТЕРОН»



Пархоменко А.А.

2019 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

«Стол� медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 в вариантах исполнения»

производства ООО «ИНТЕРОН», Россия

Фотографии

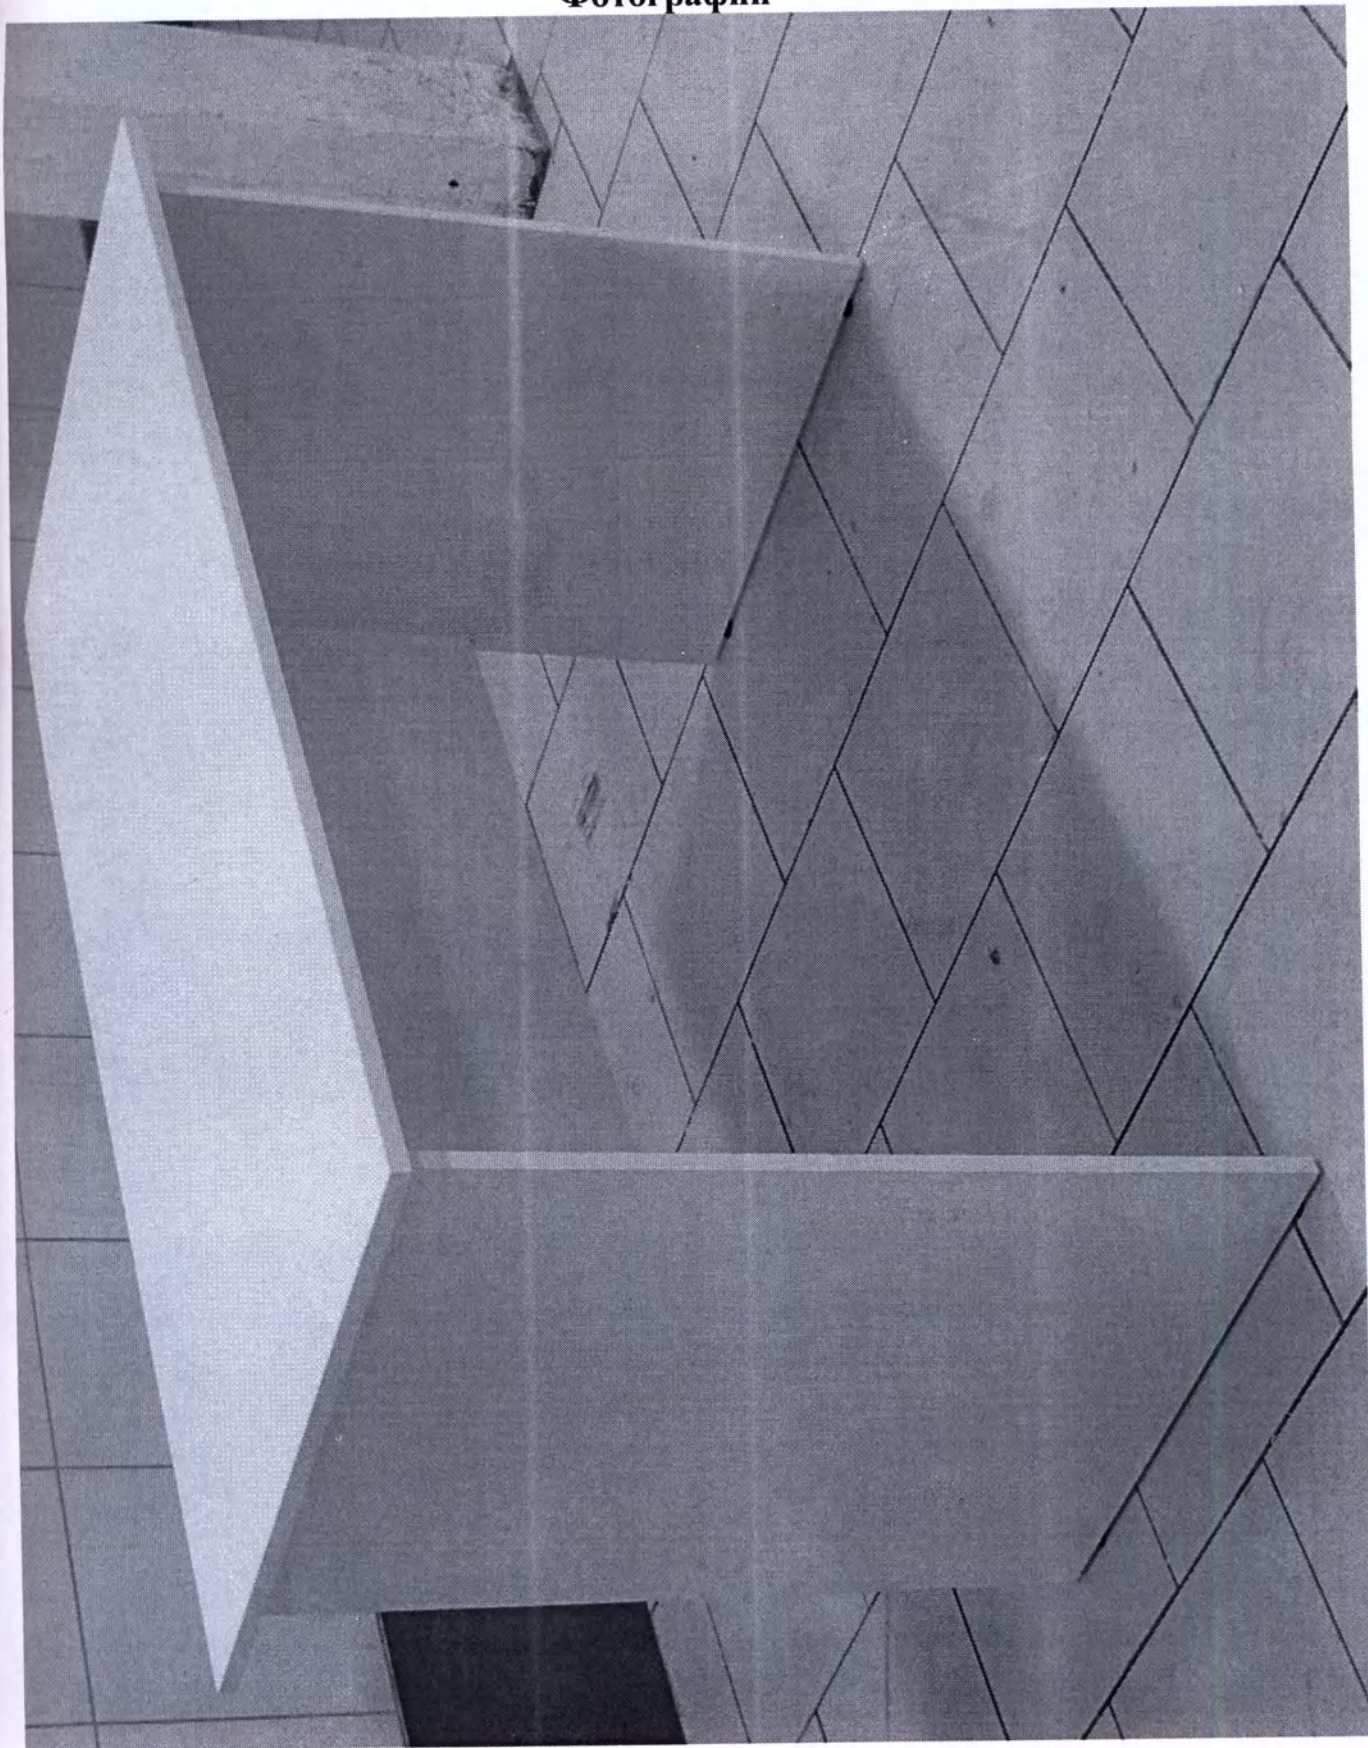


Фото 1 - Стол медицинский С-101

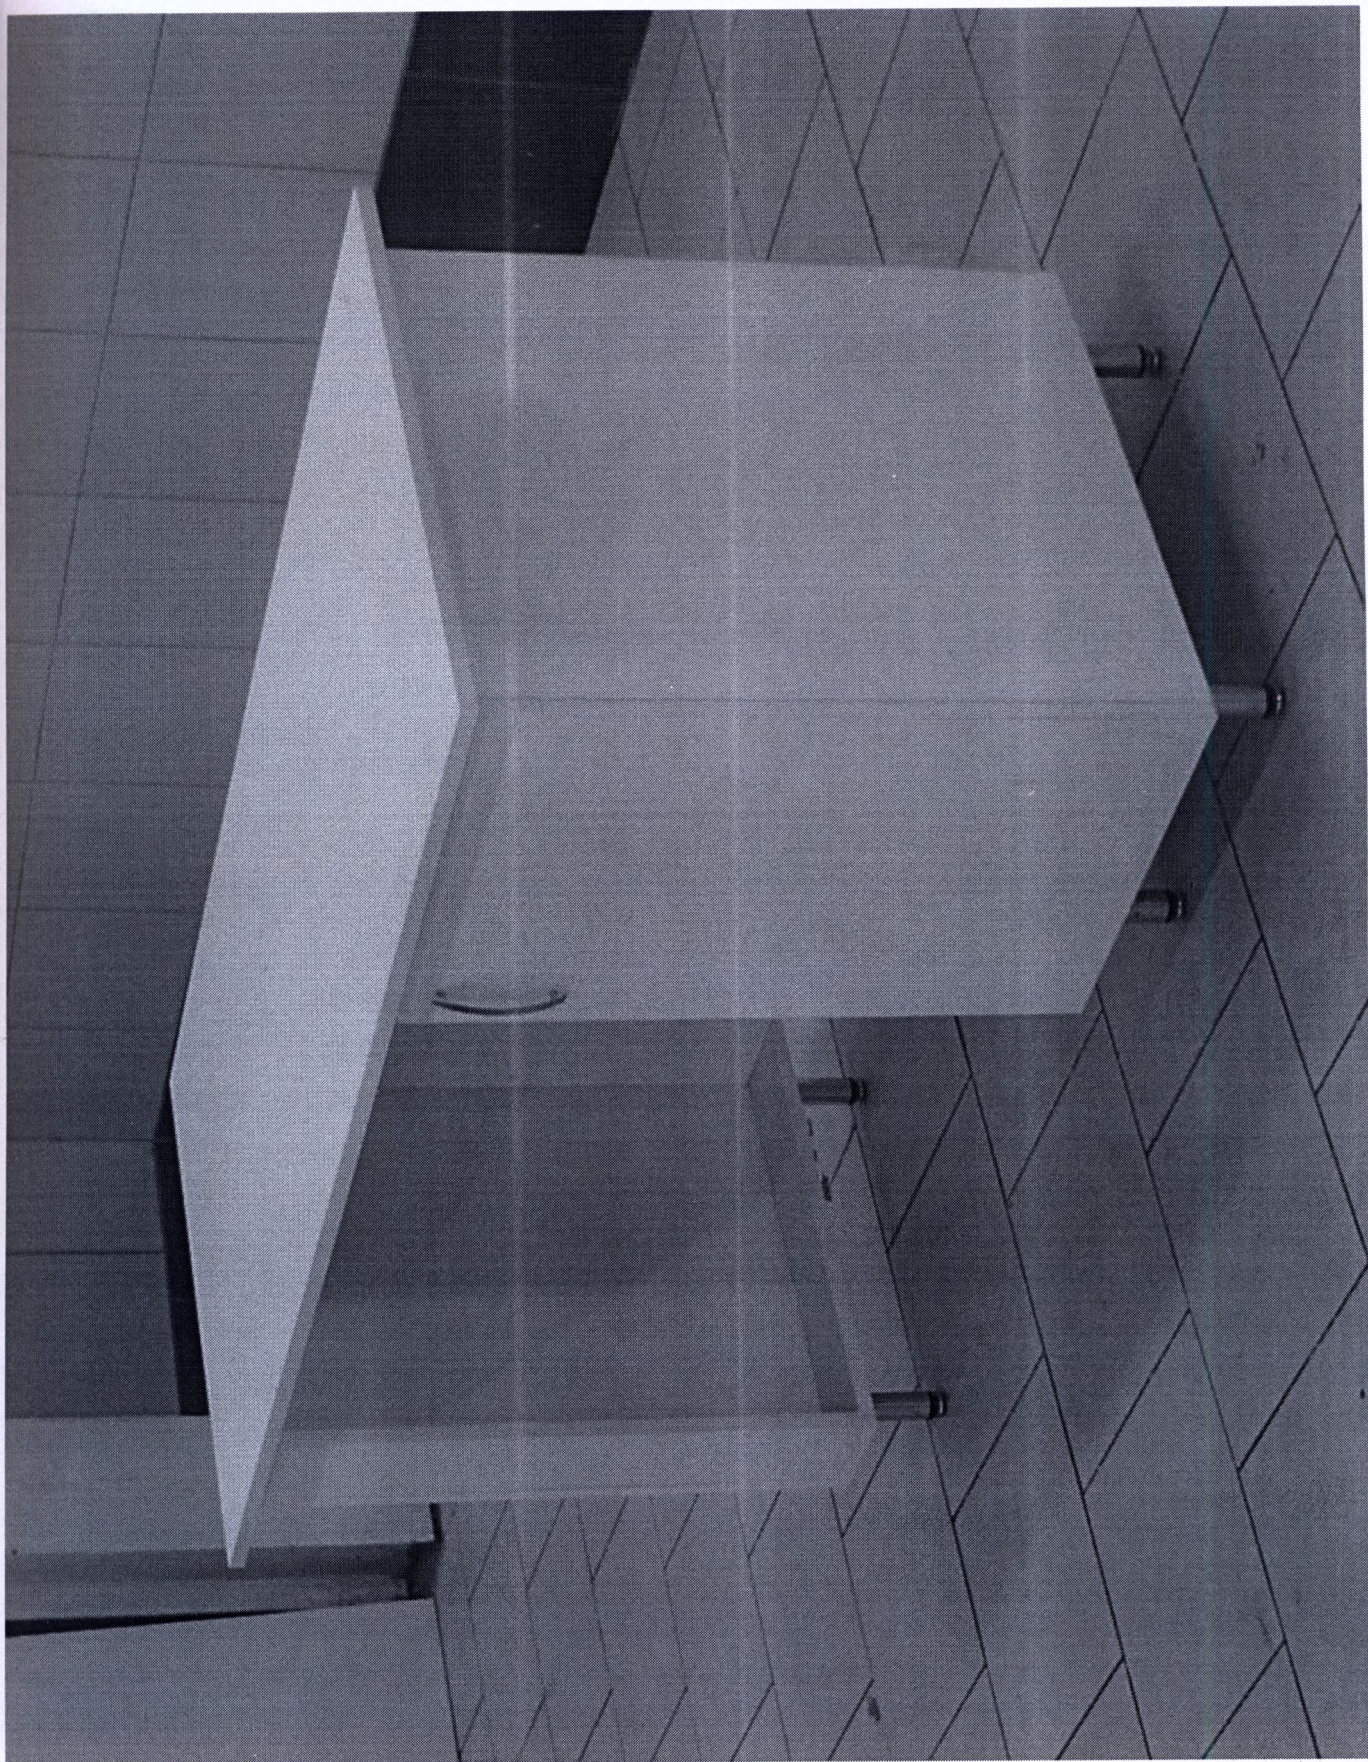


Фото 2 - Стол медицинский С-102

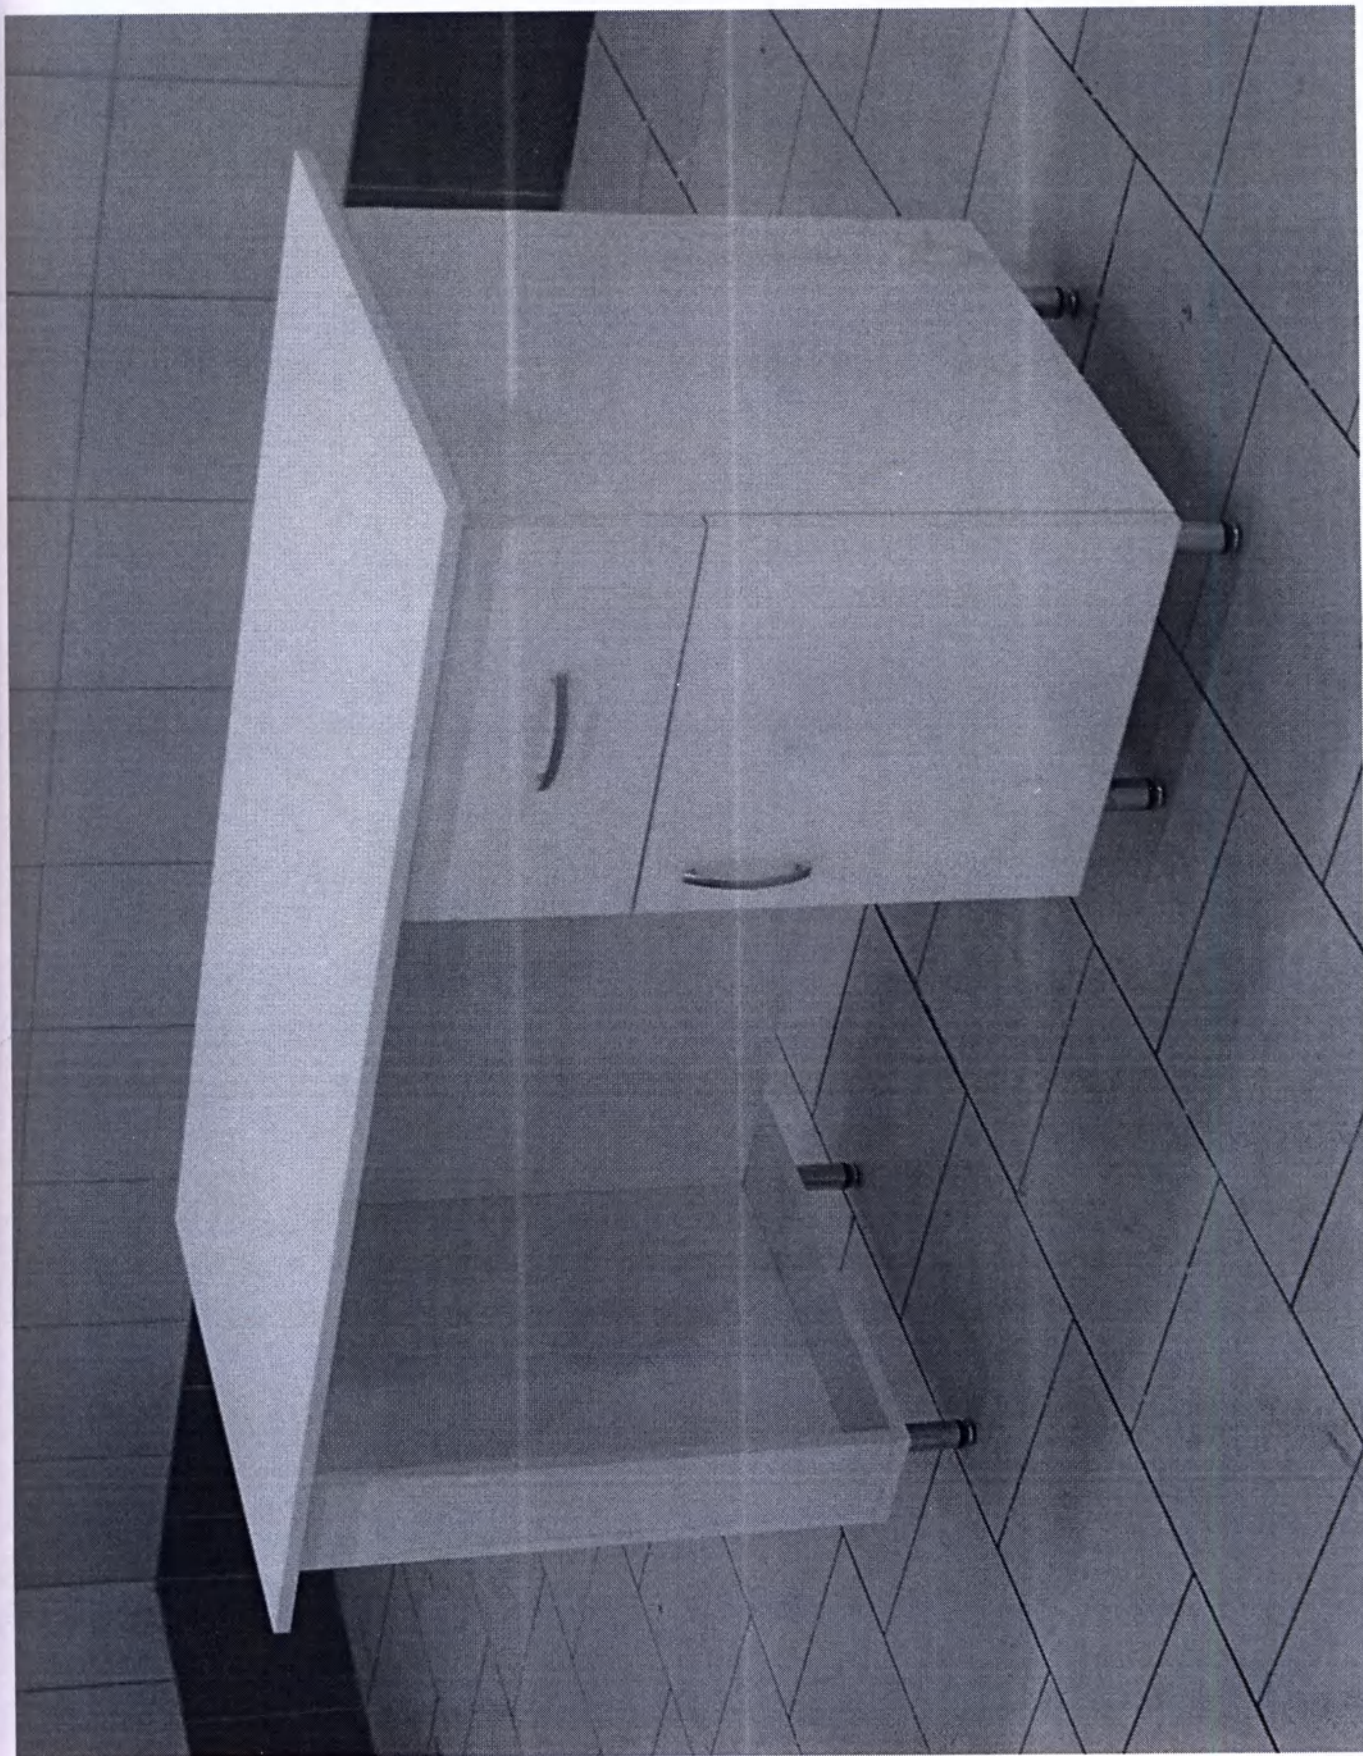


Фото 3 - Стол медицинский С-103

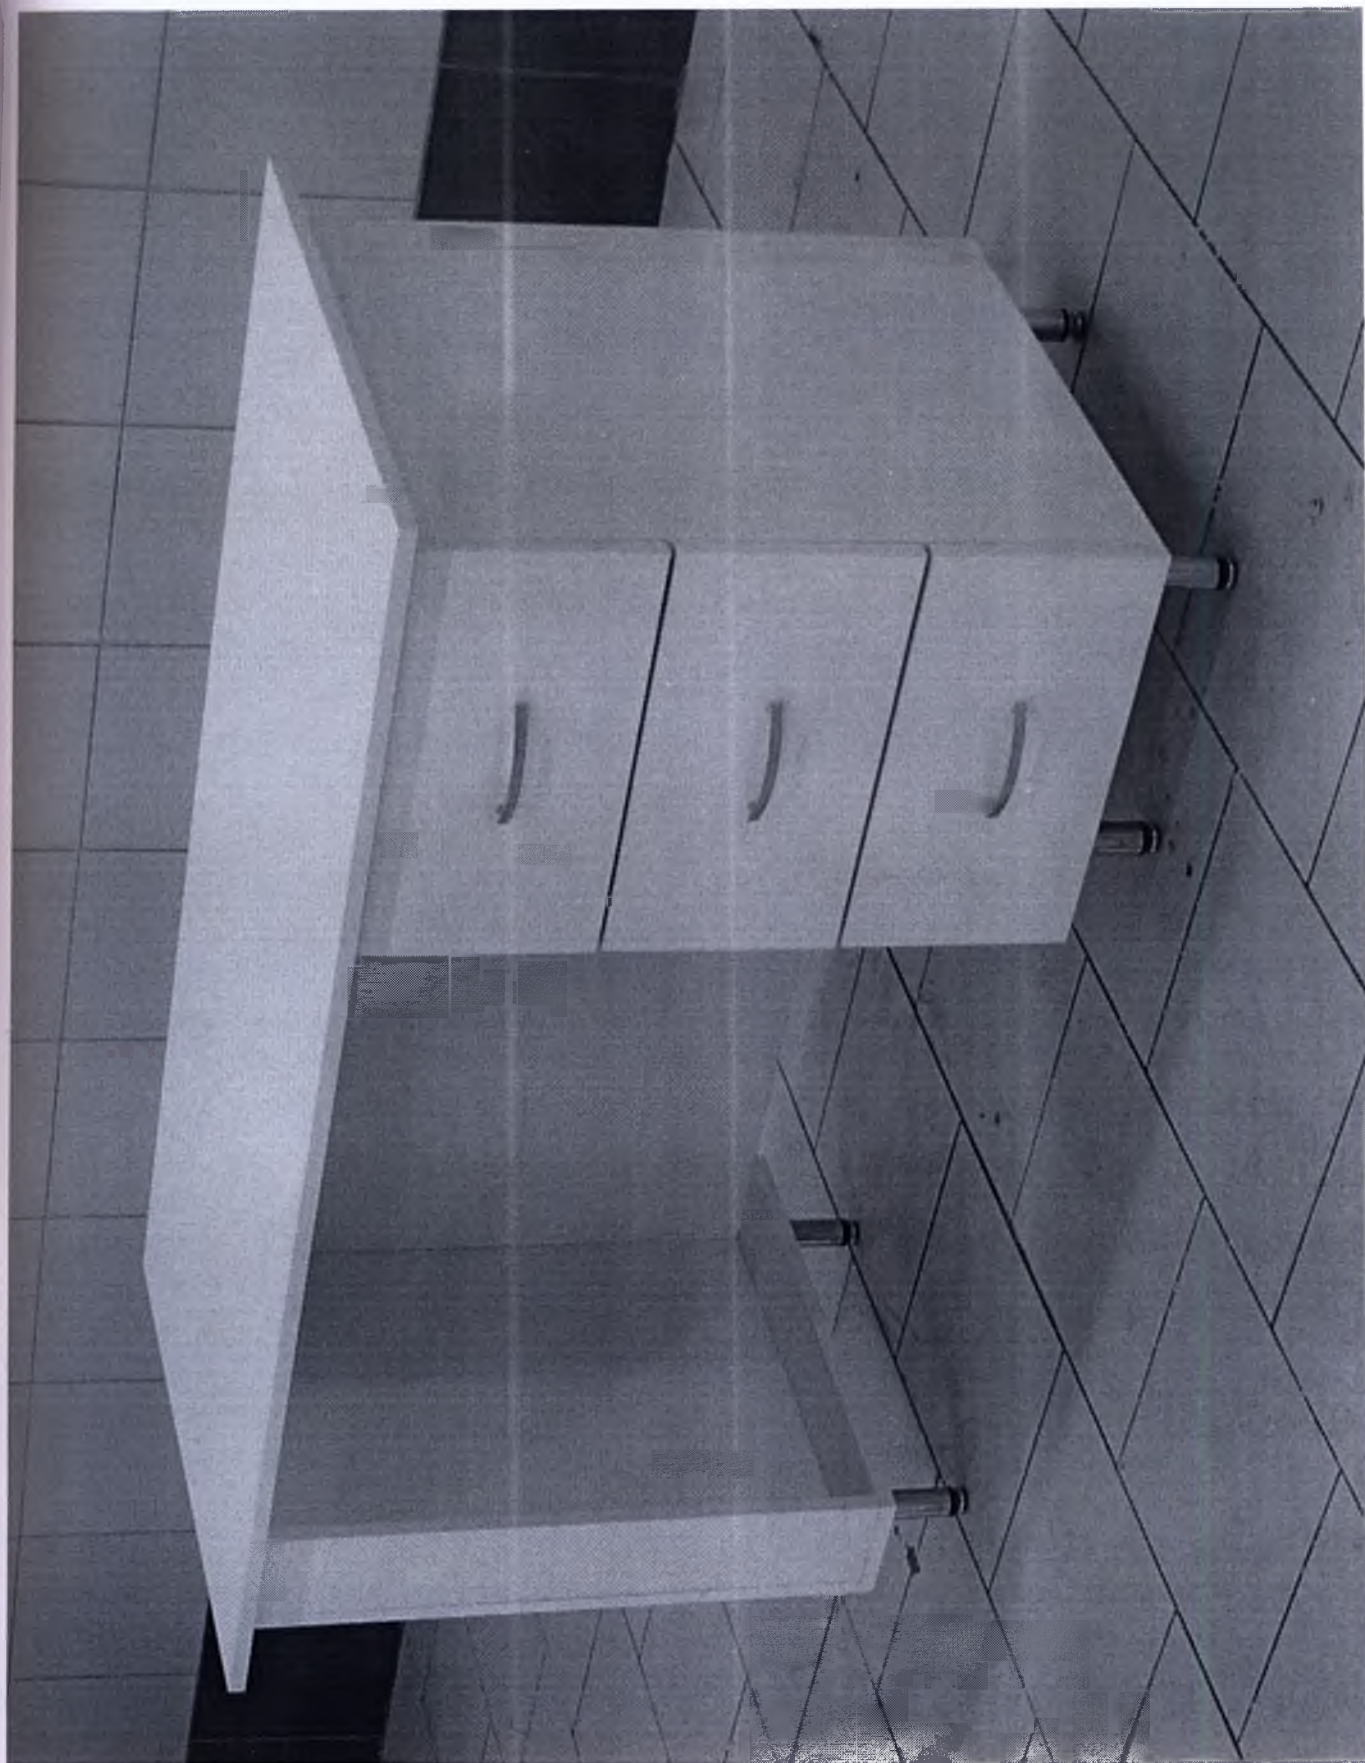


Фото 4 - Стол медицинский С-104

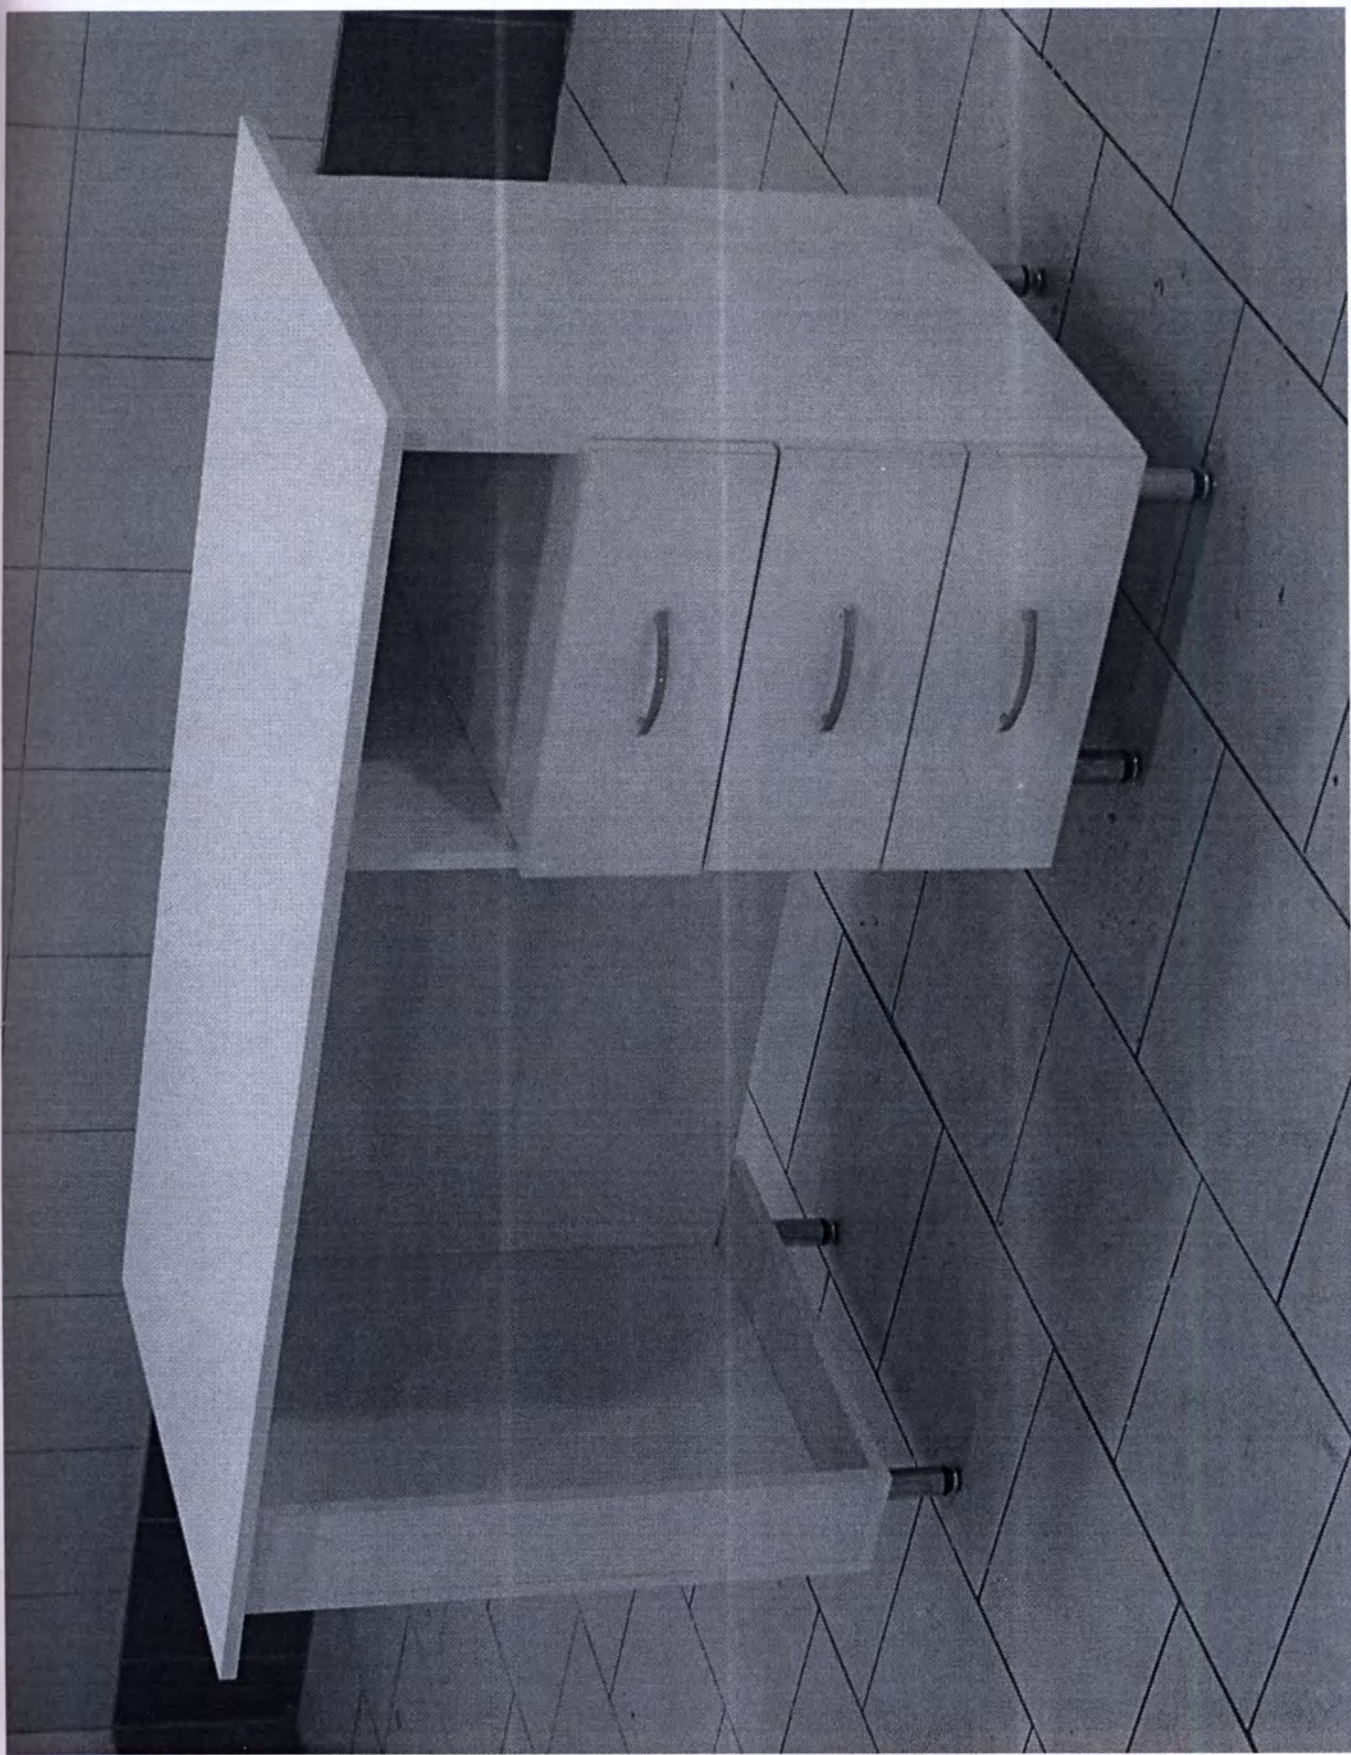


Фото 5 - Стол медицинский С-105

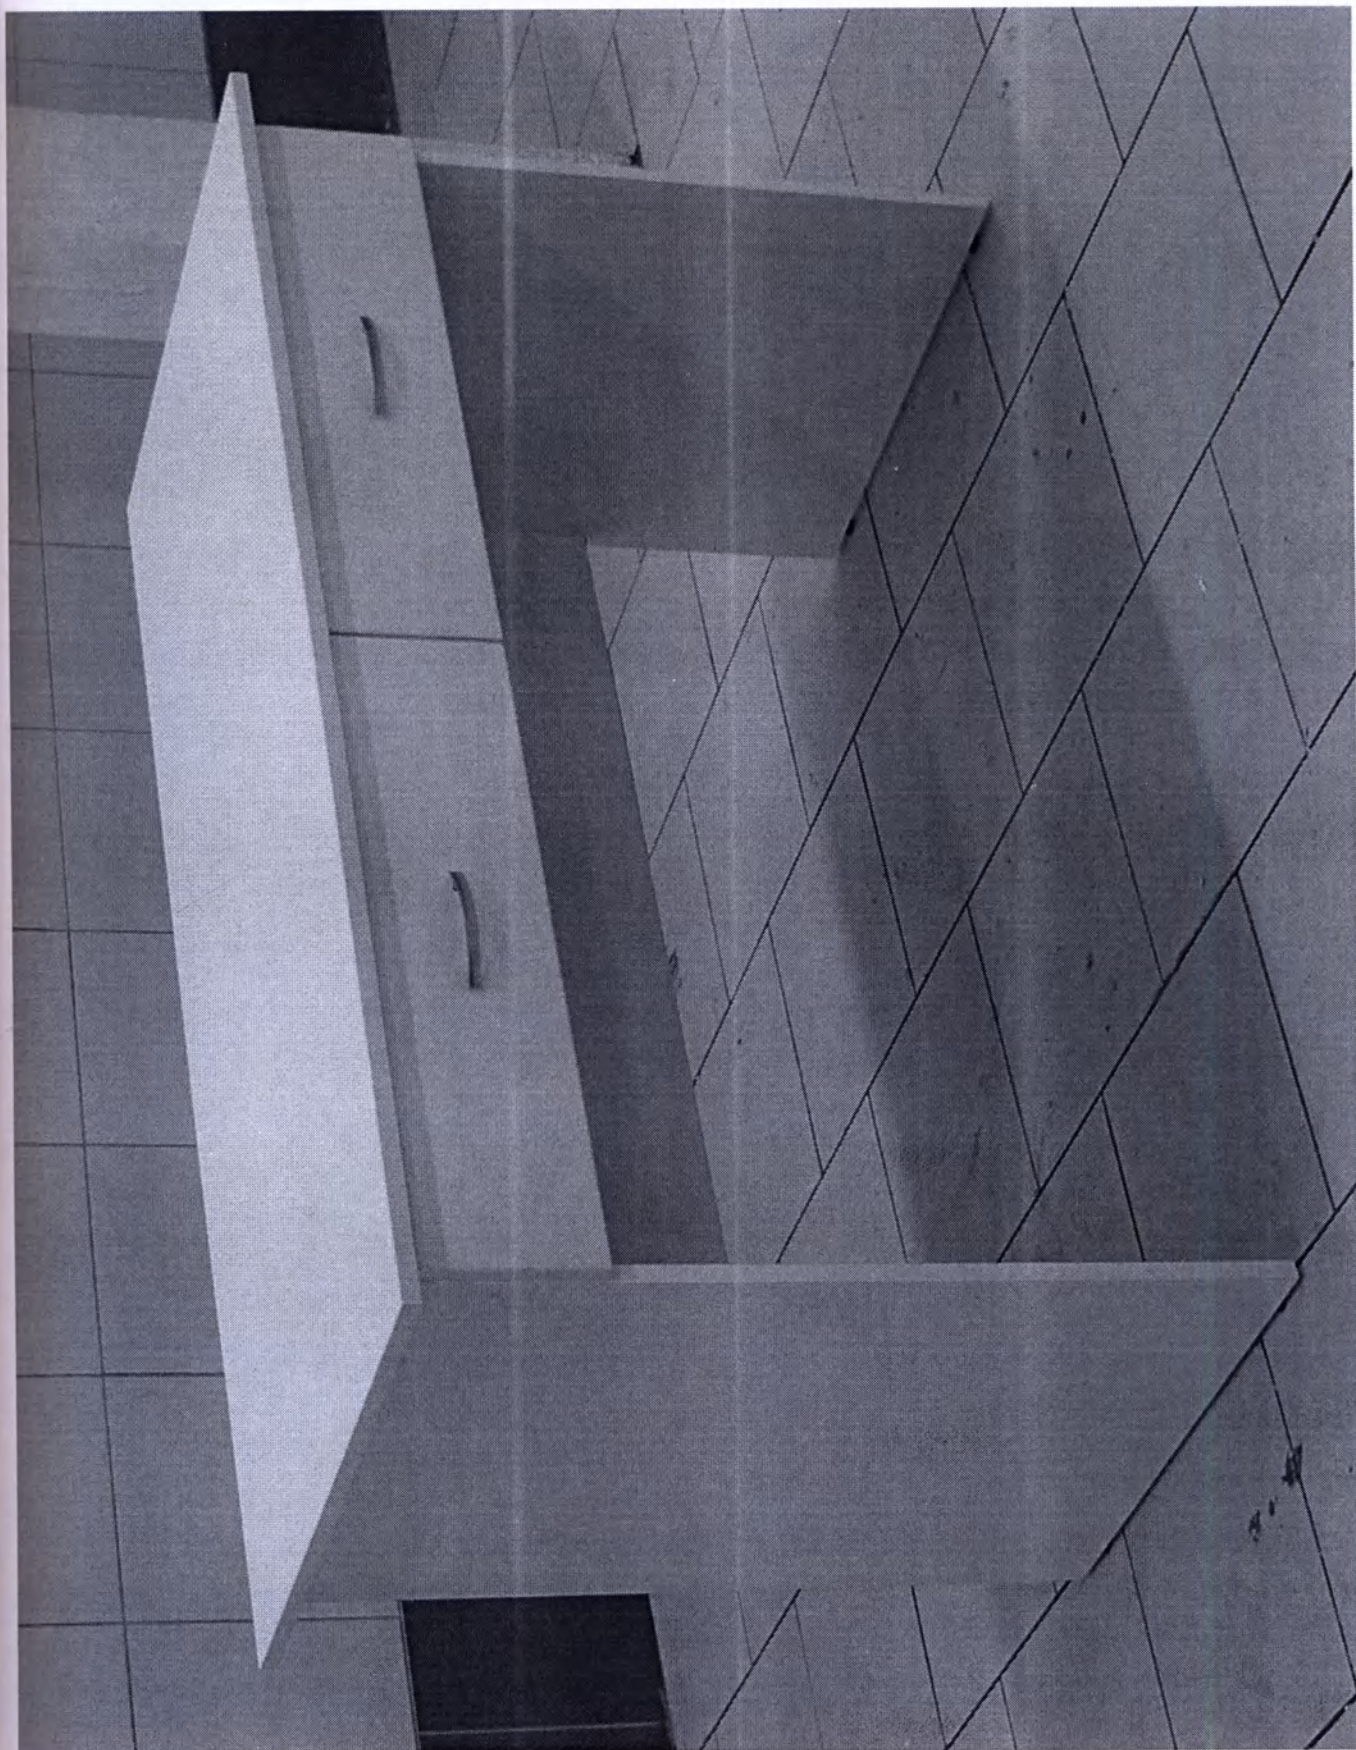


Фото 6 - Стол медицинский С-106

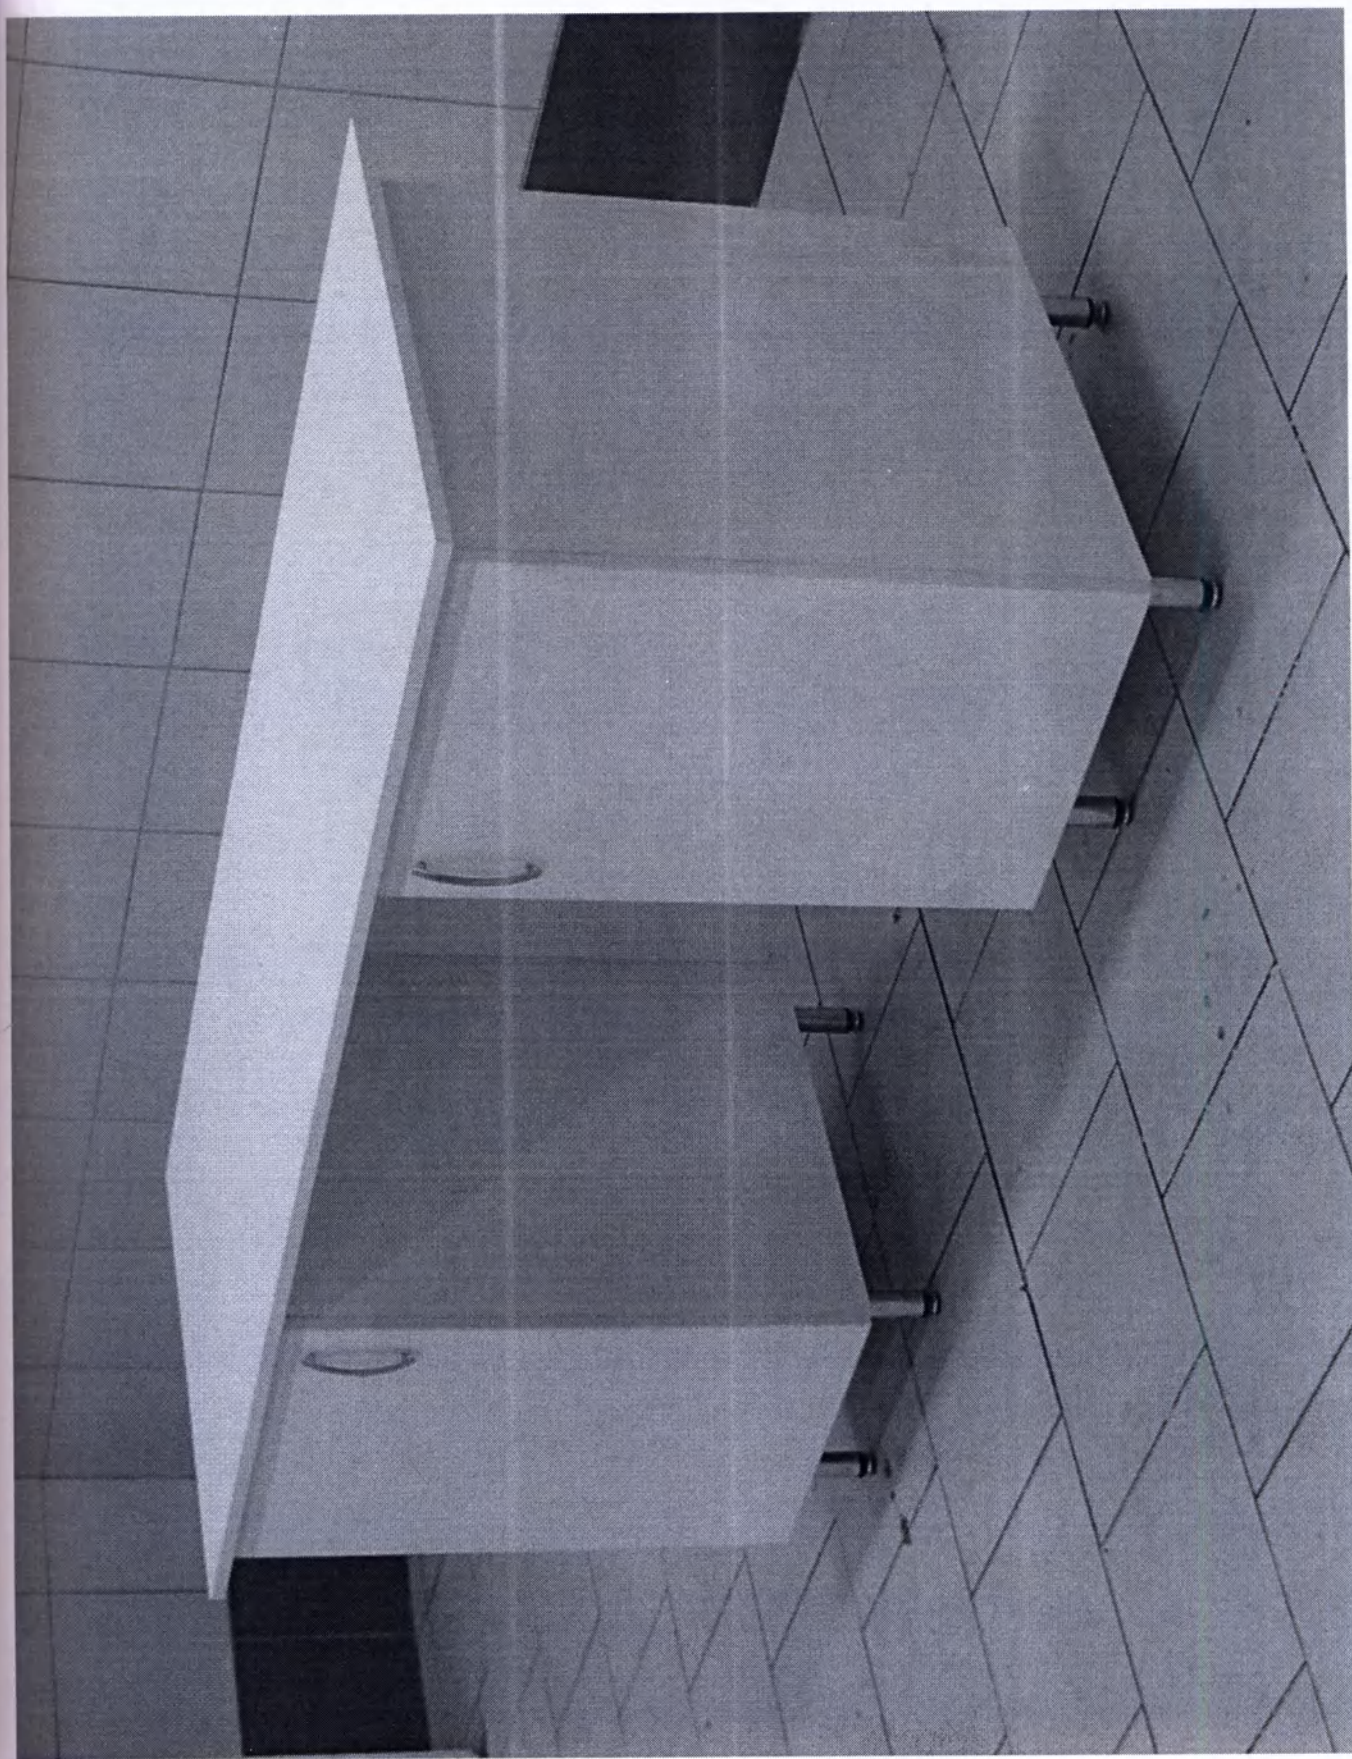


Фото 7 - Стол медицинский С-107

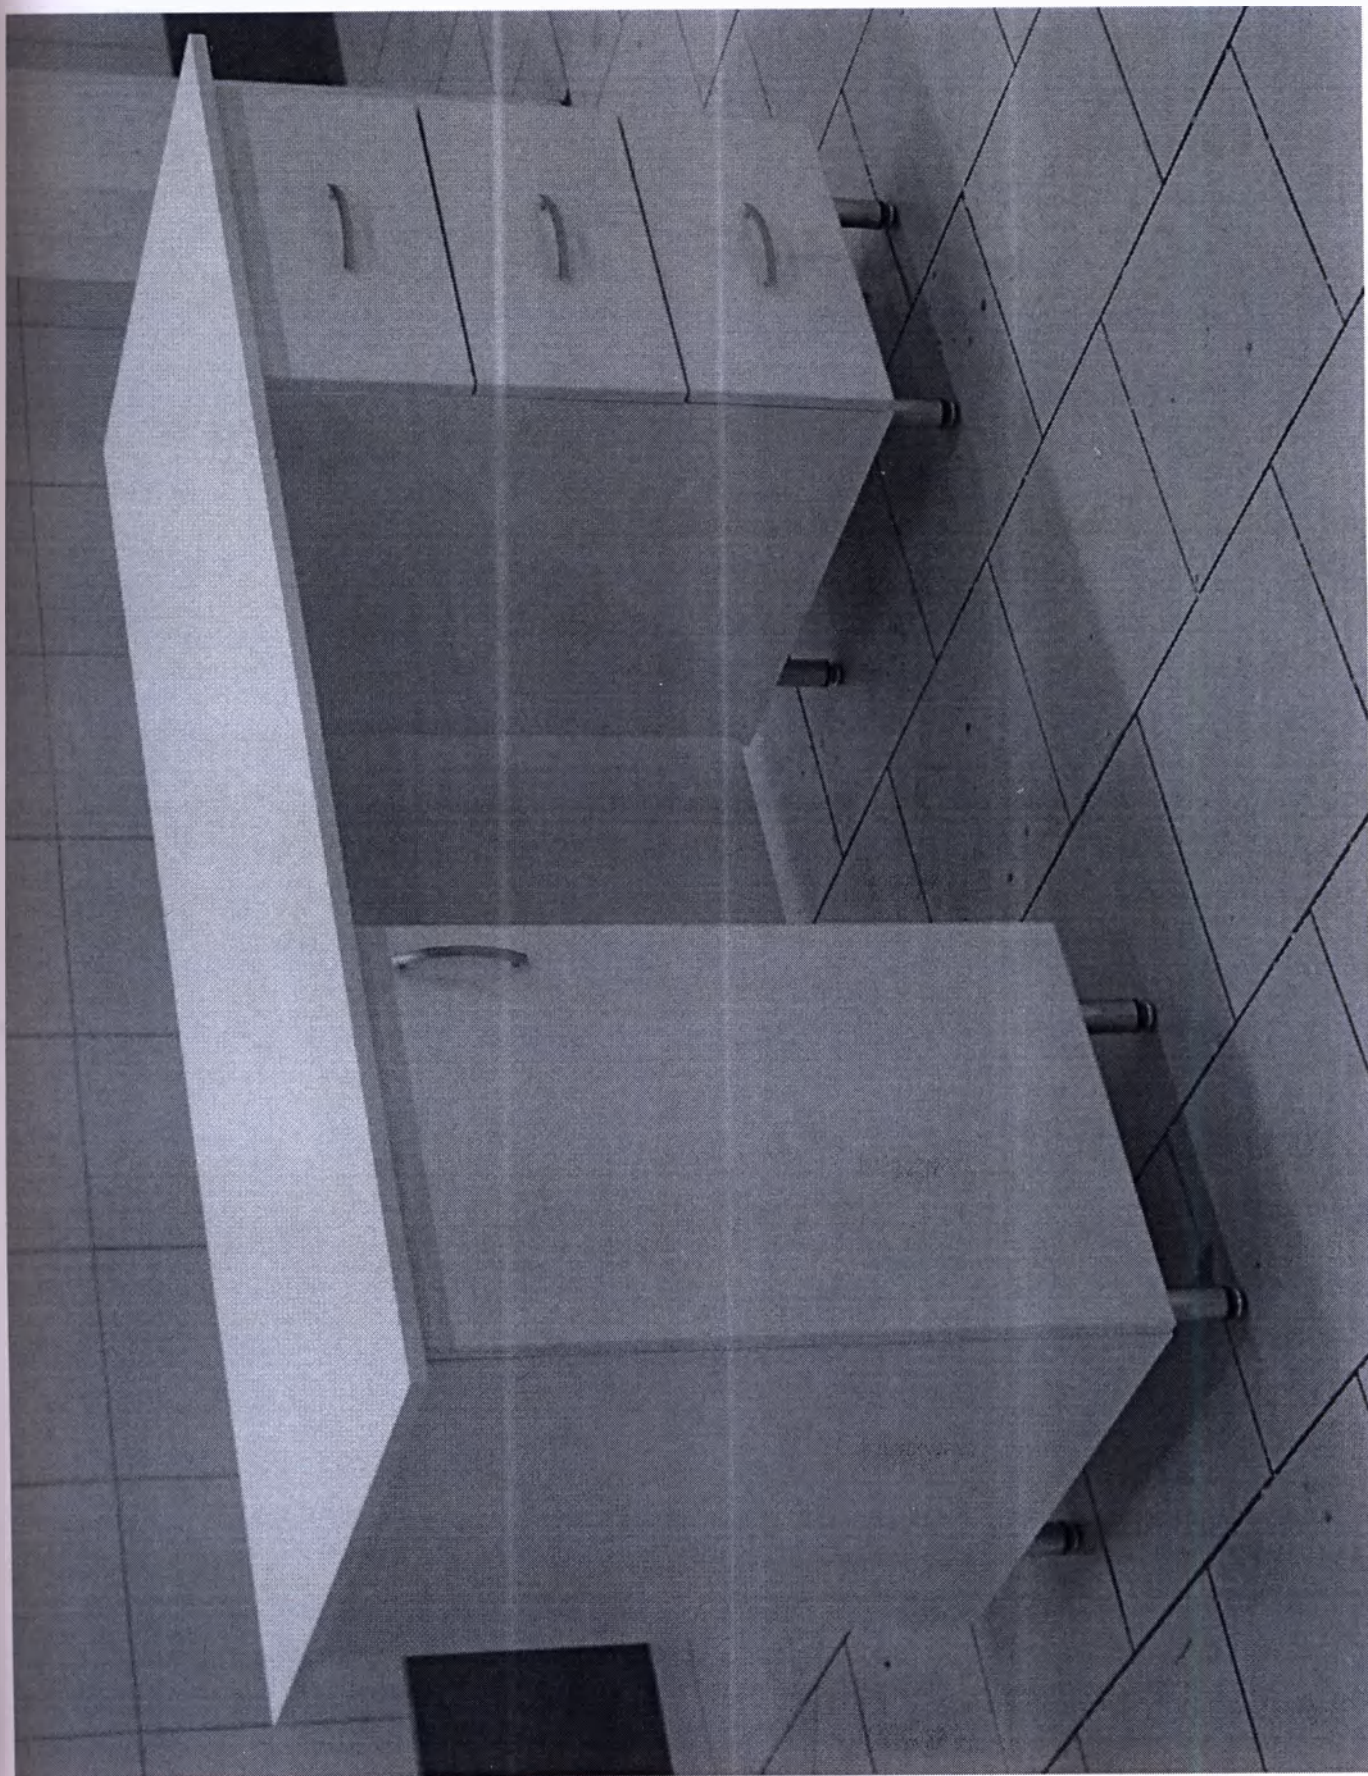


Фото 8 - Стол медицинский С-108

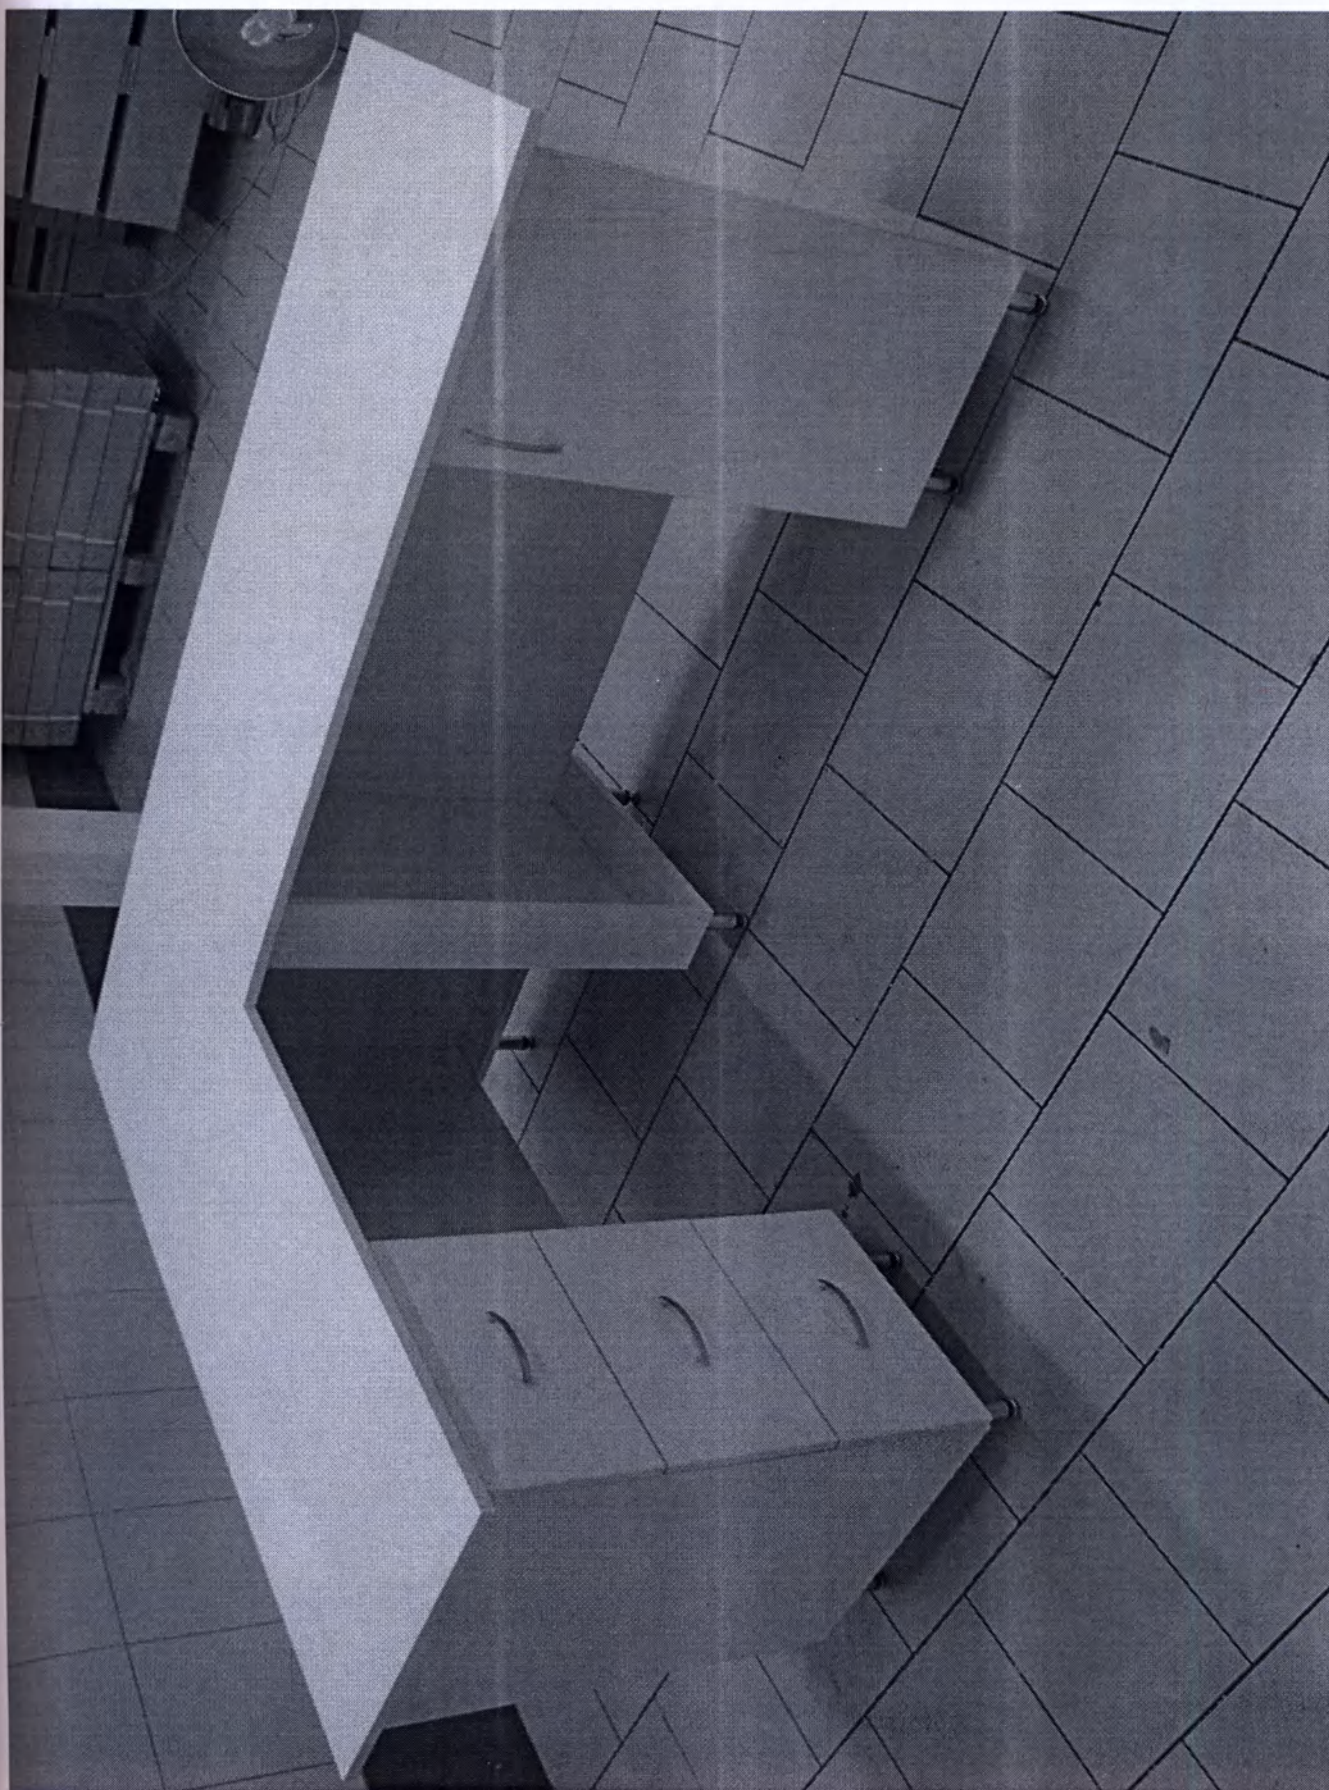


Фото 9 - Стол медицинский С-109

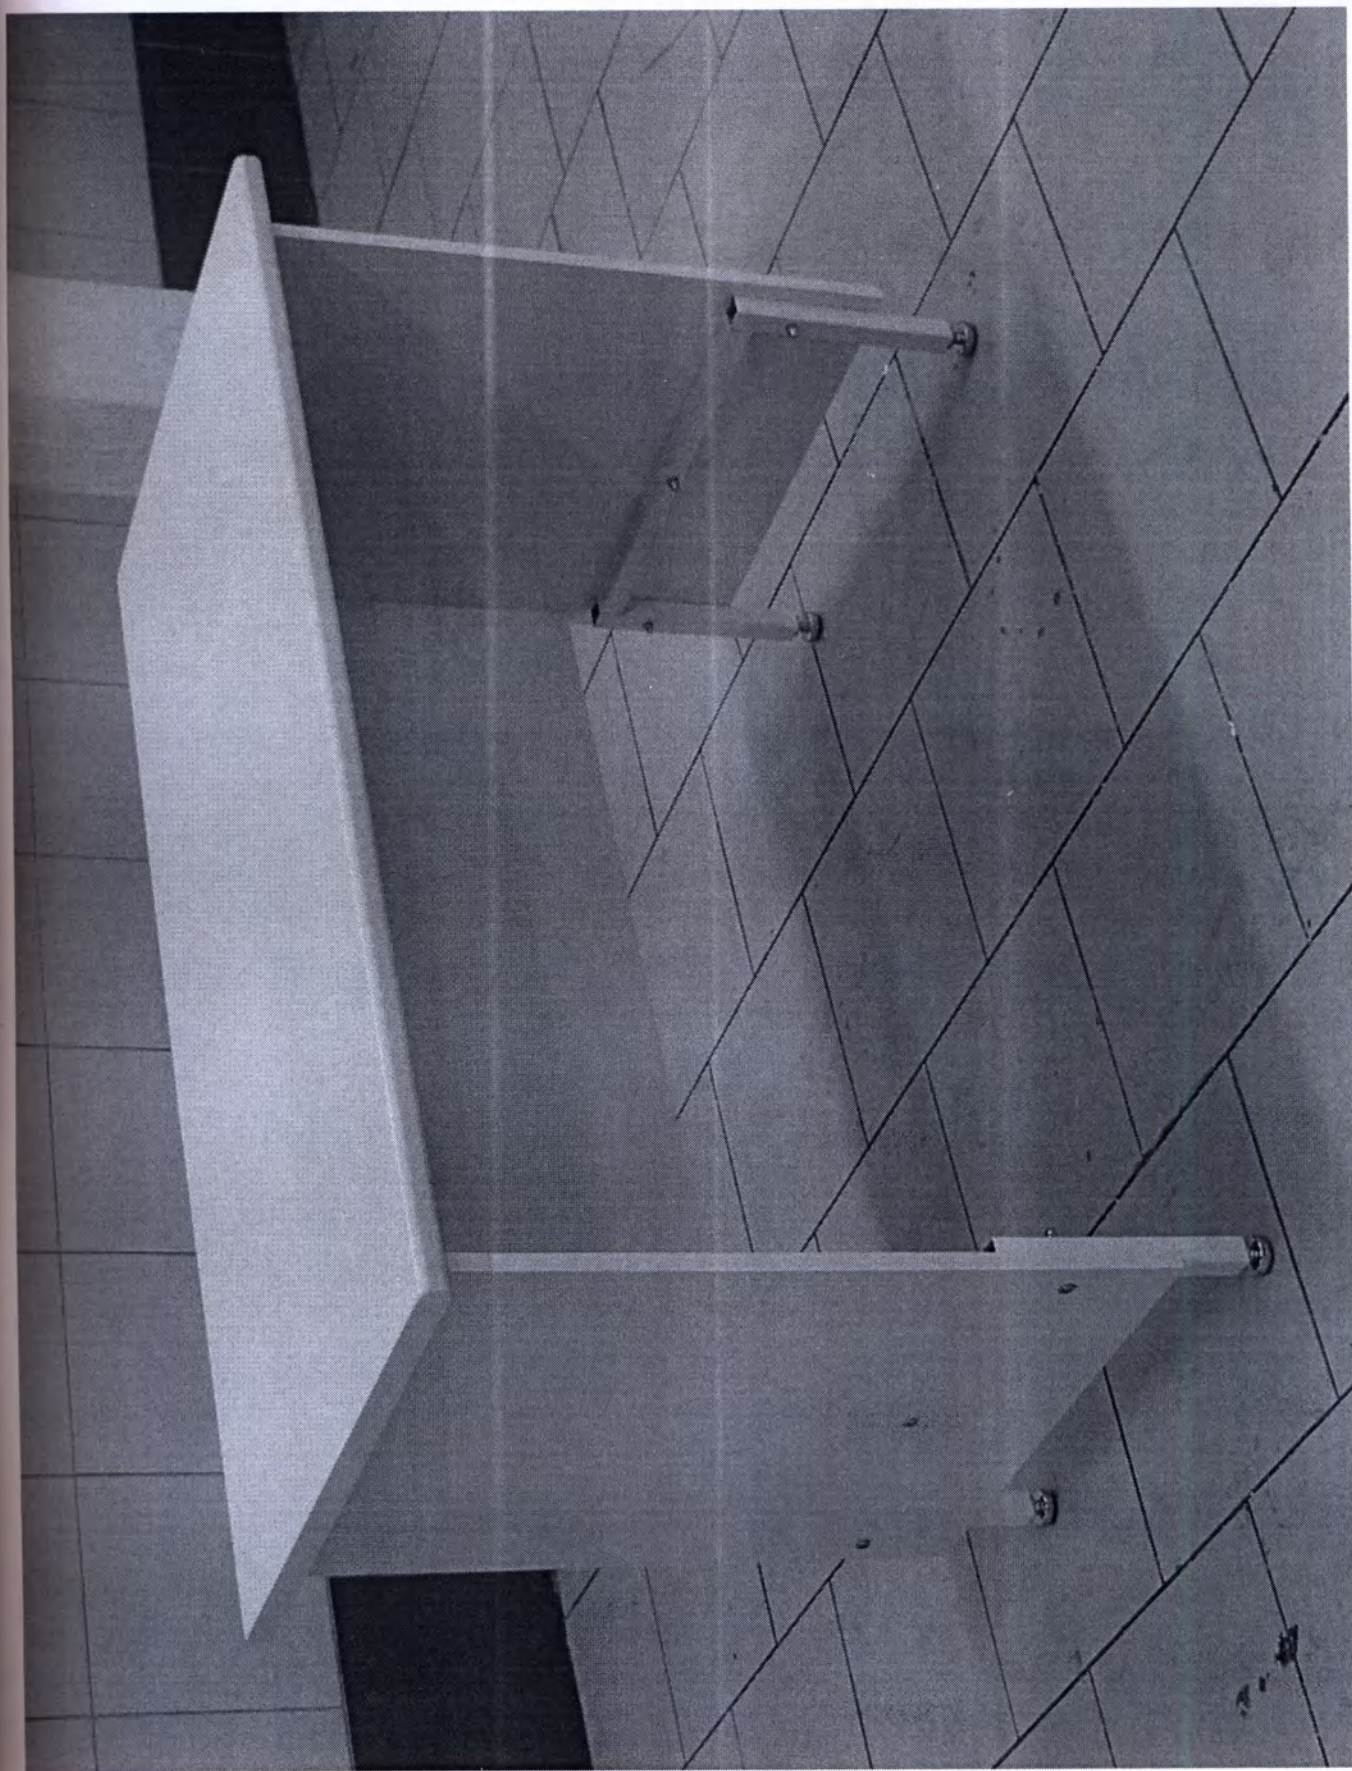


Фото 10 - Стол медицинский С-201

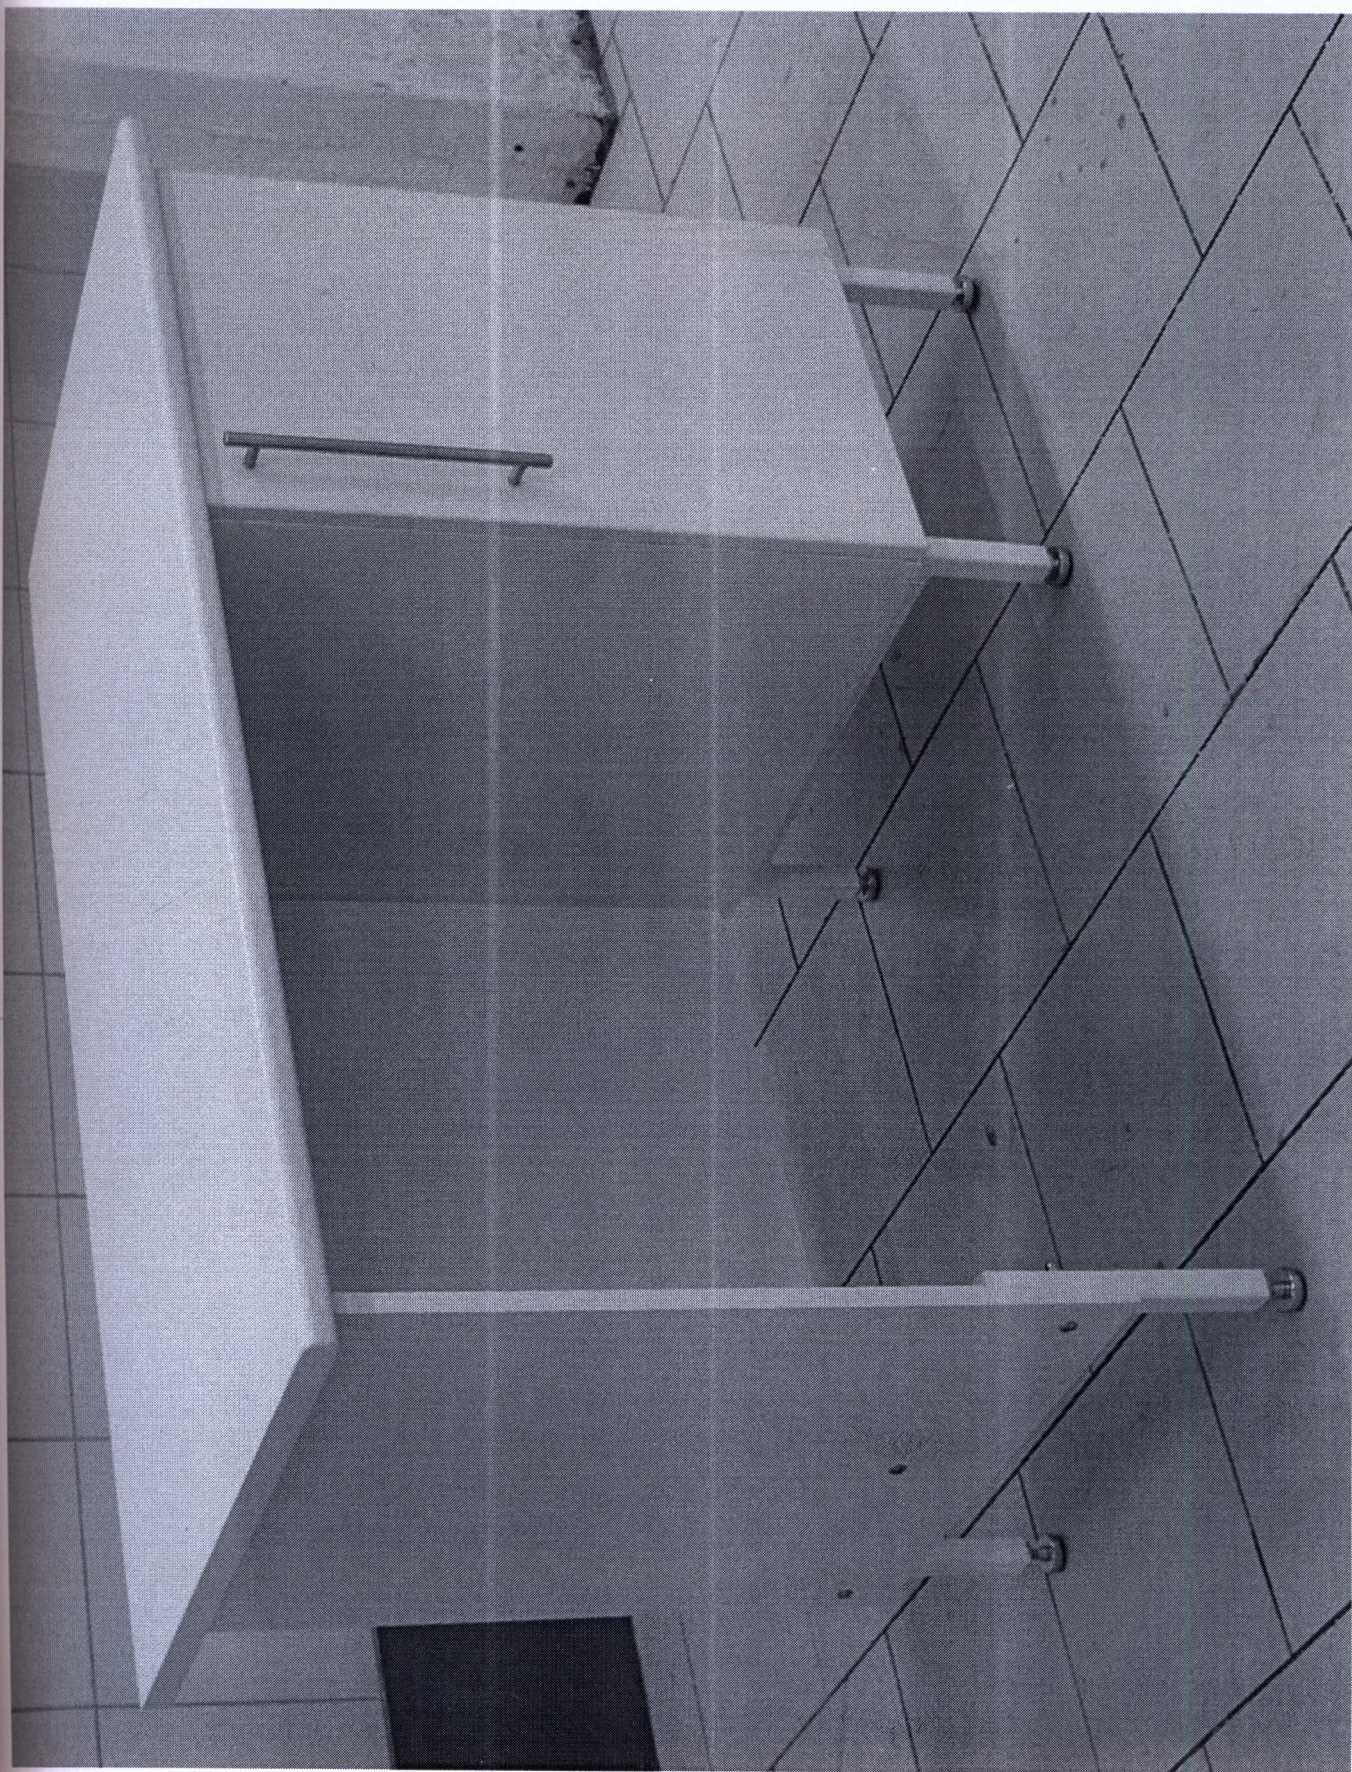


Фото 11 - Стол медицинский С-202

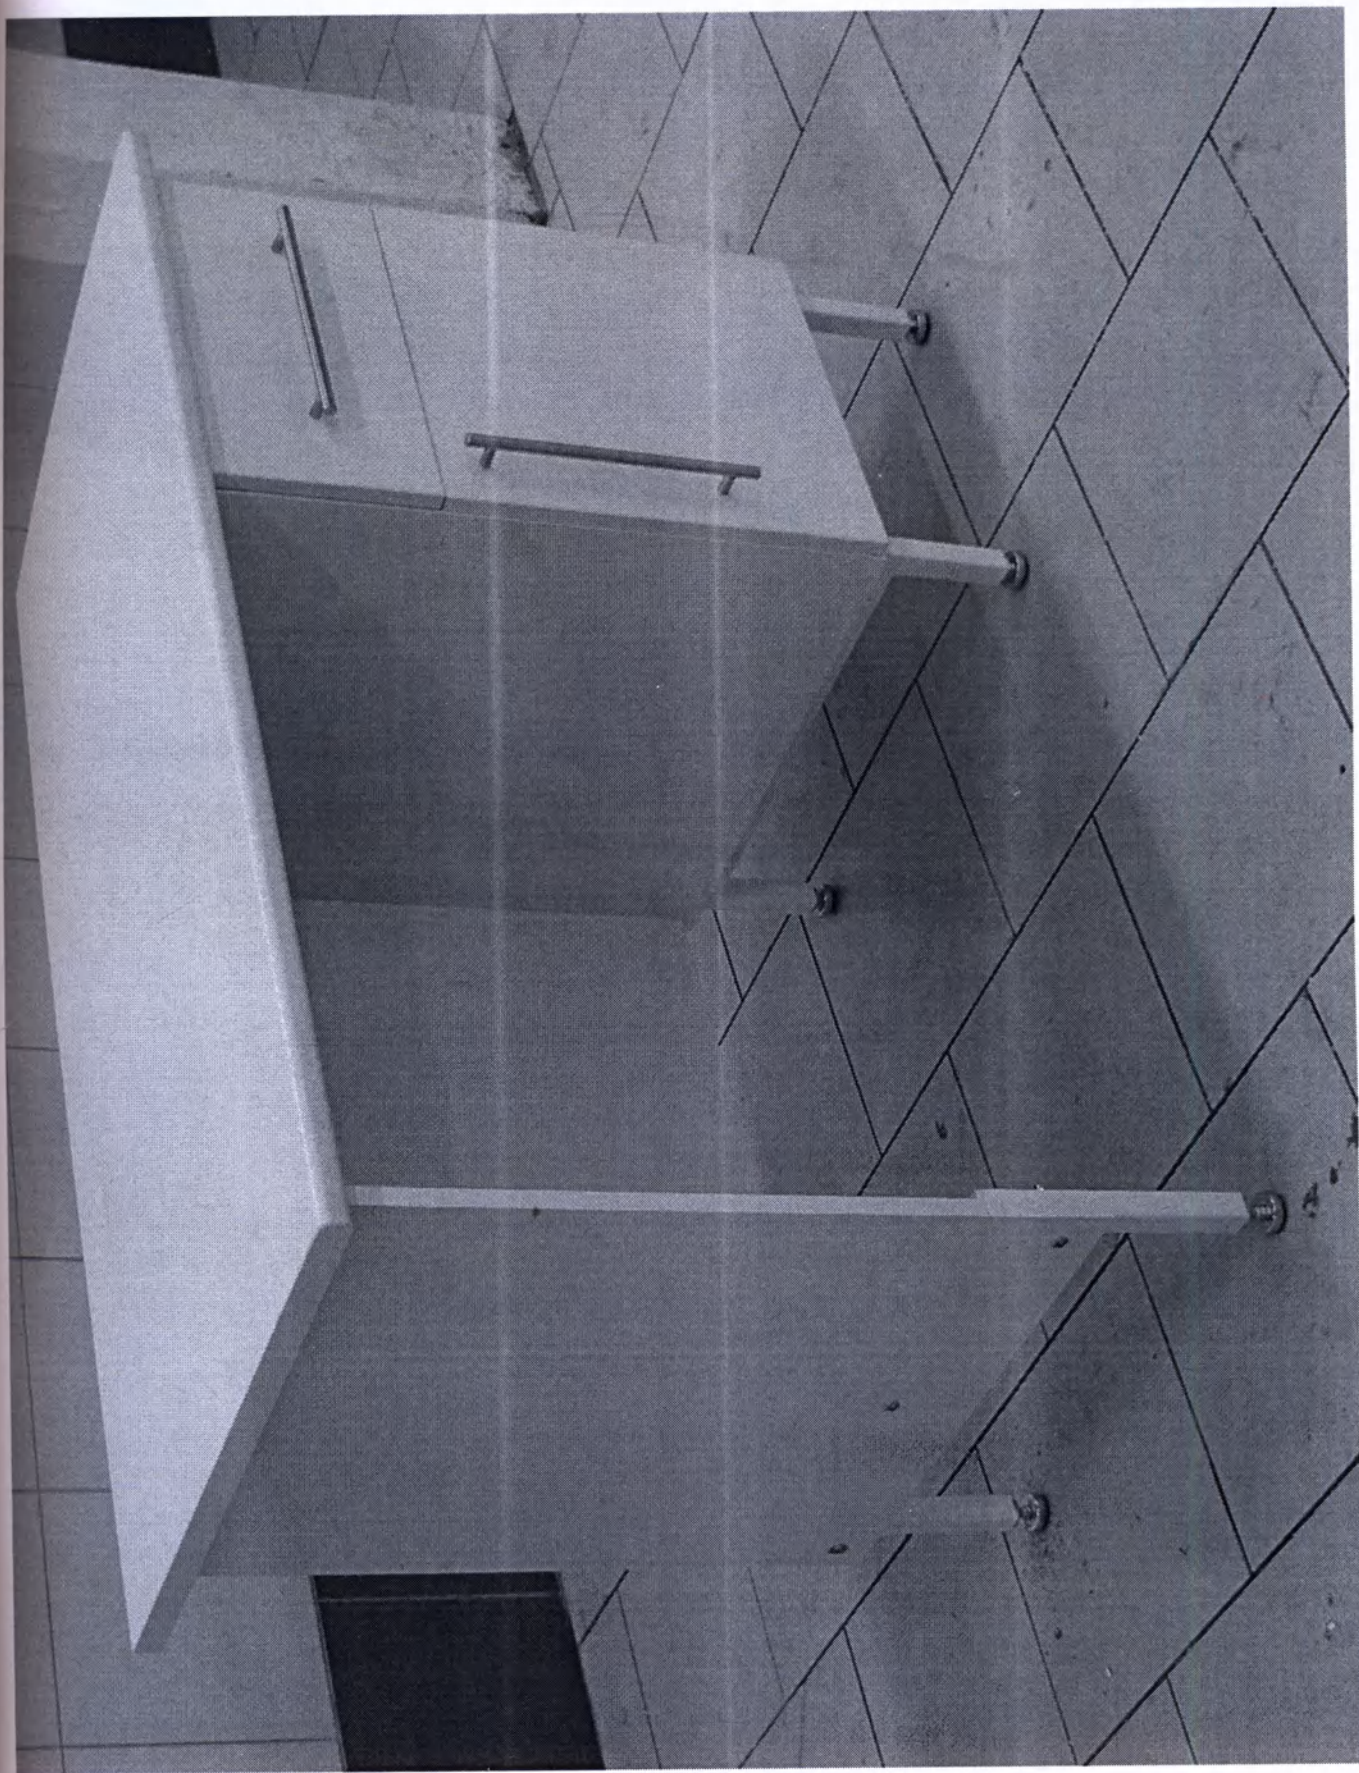


Фото 12 - Стол медицинский С-203

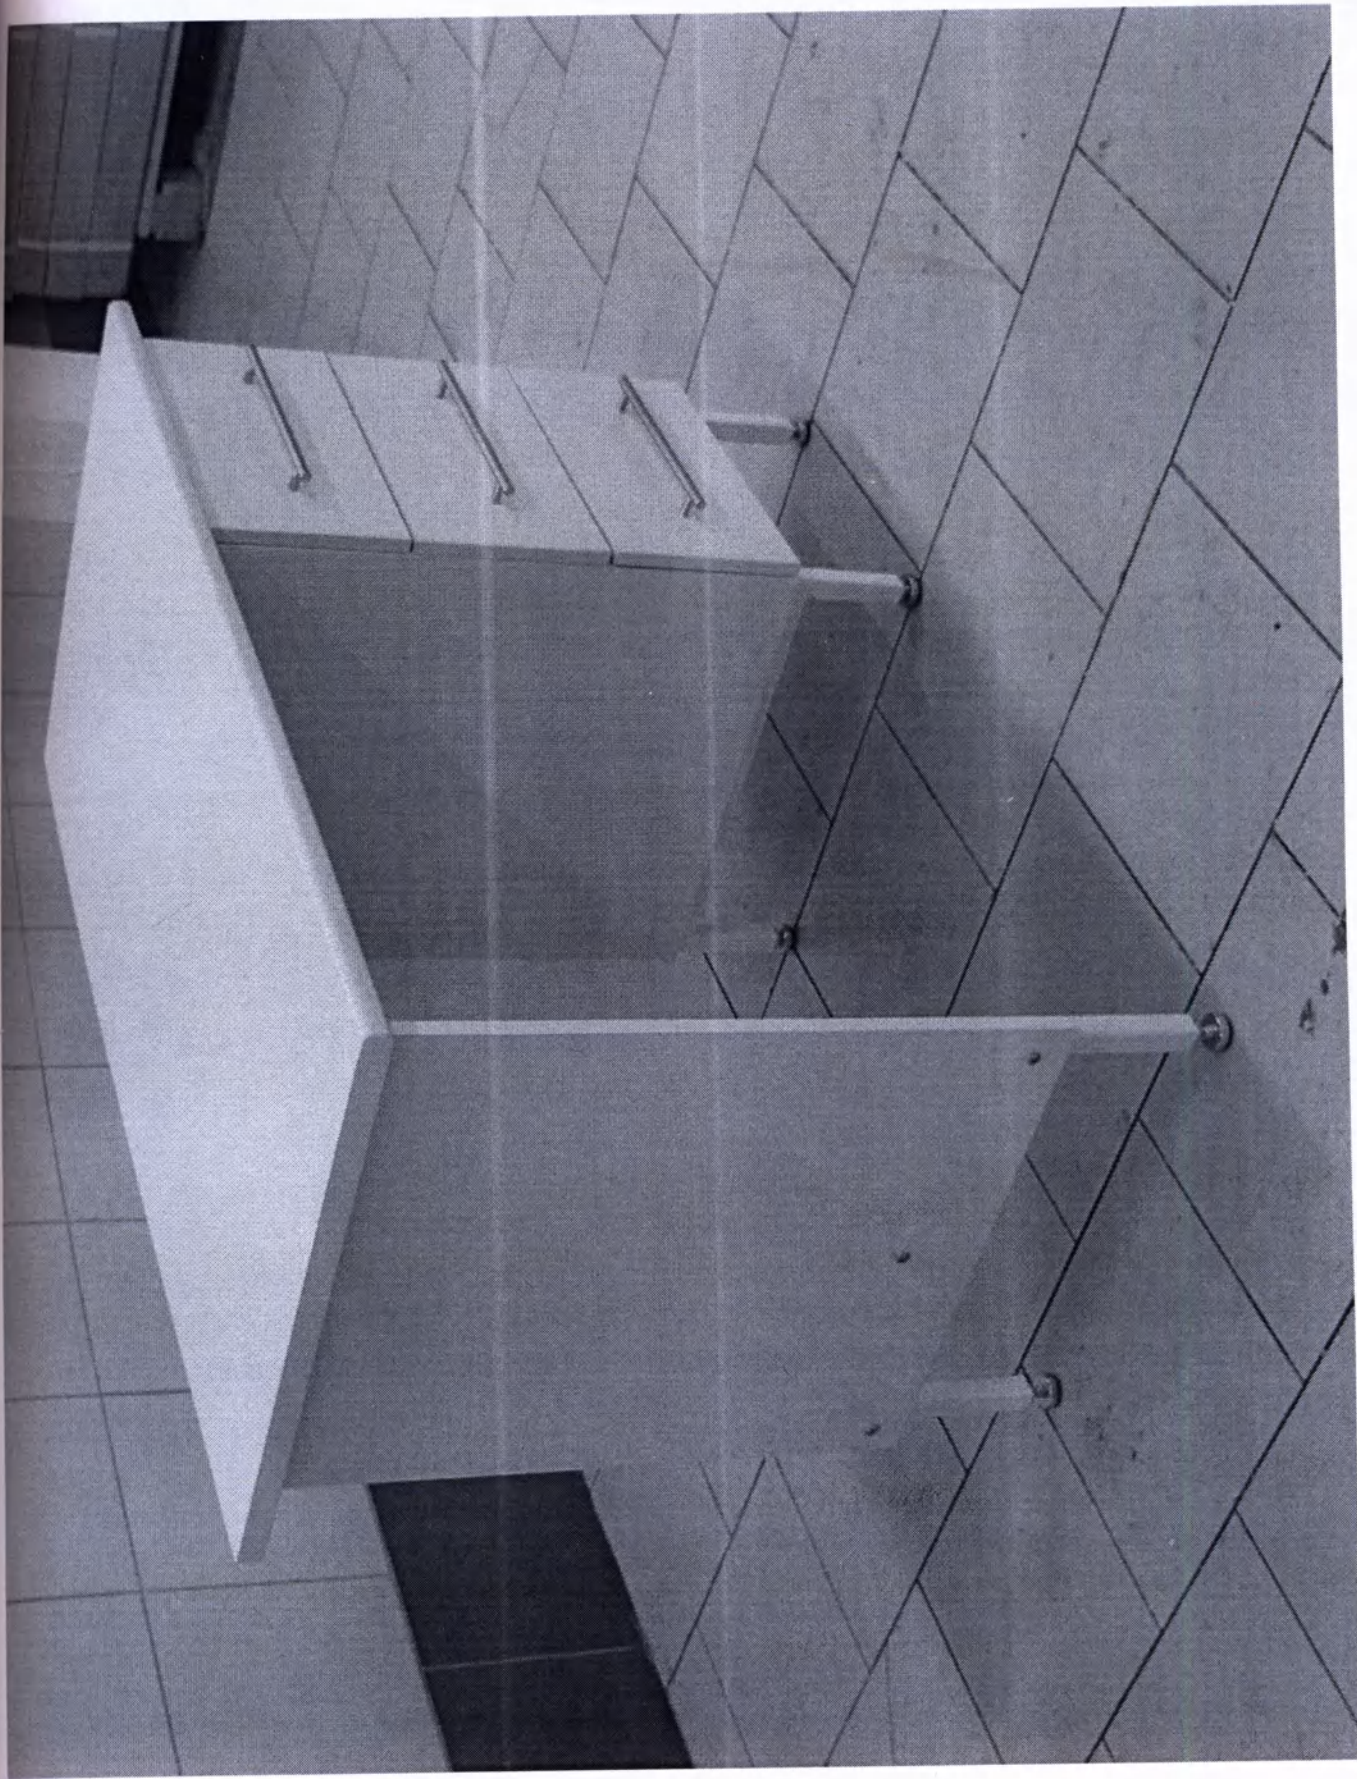


Фото 13 - Стол медицинский С-204

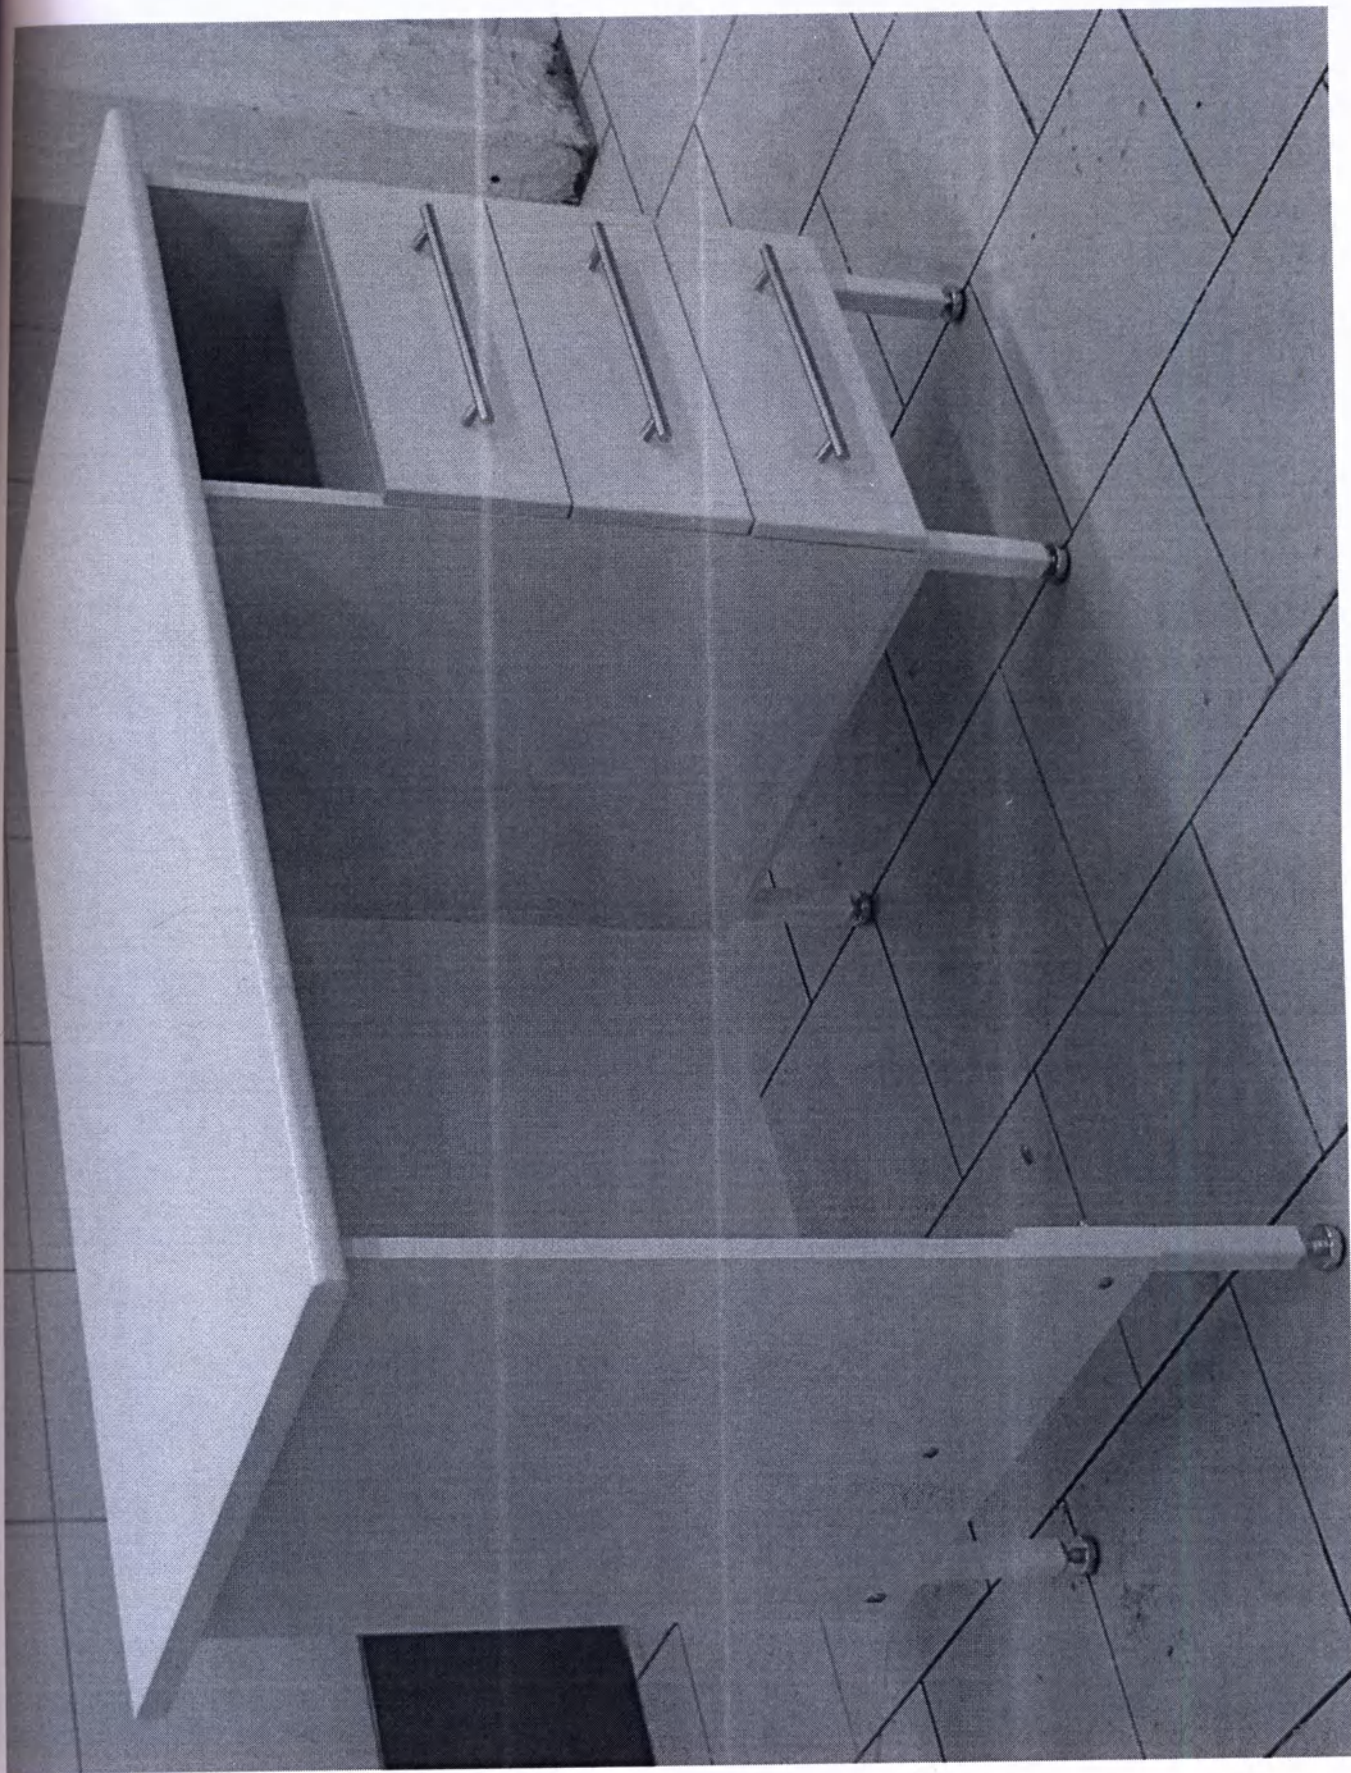


Фото 14 - Стол медицинский С-205

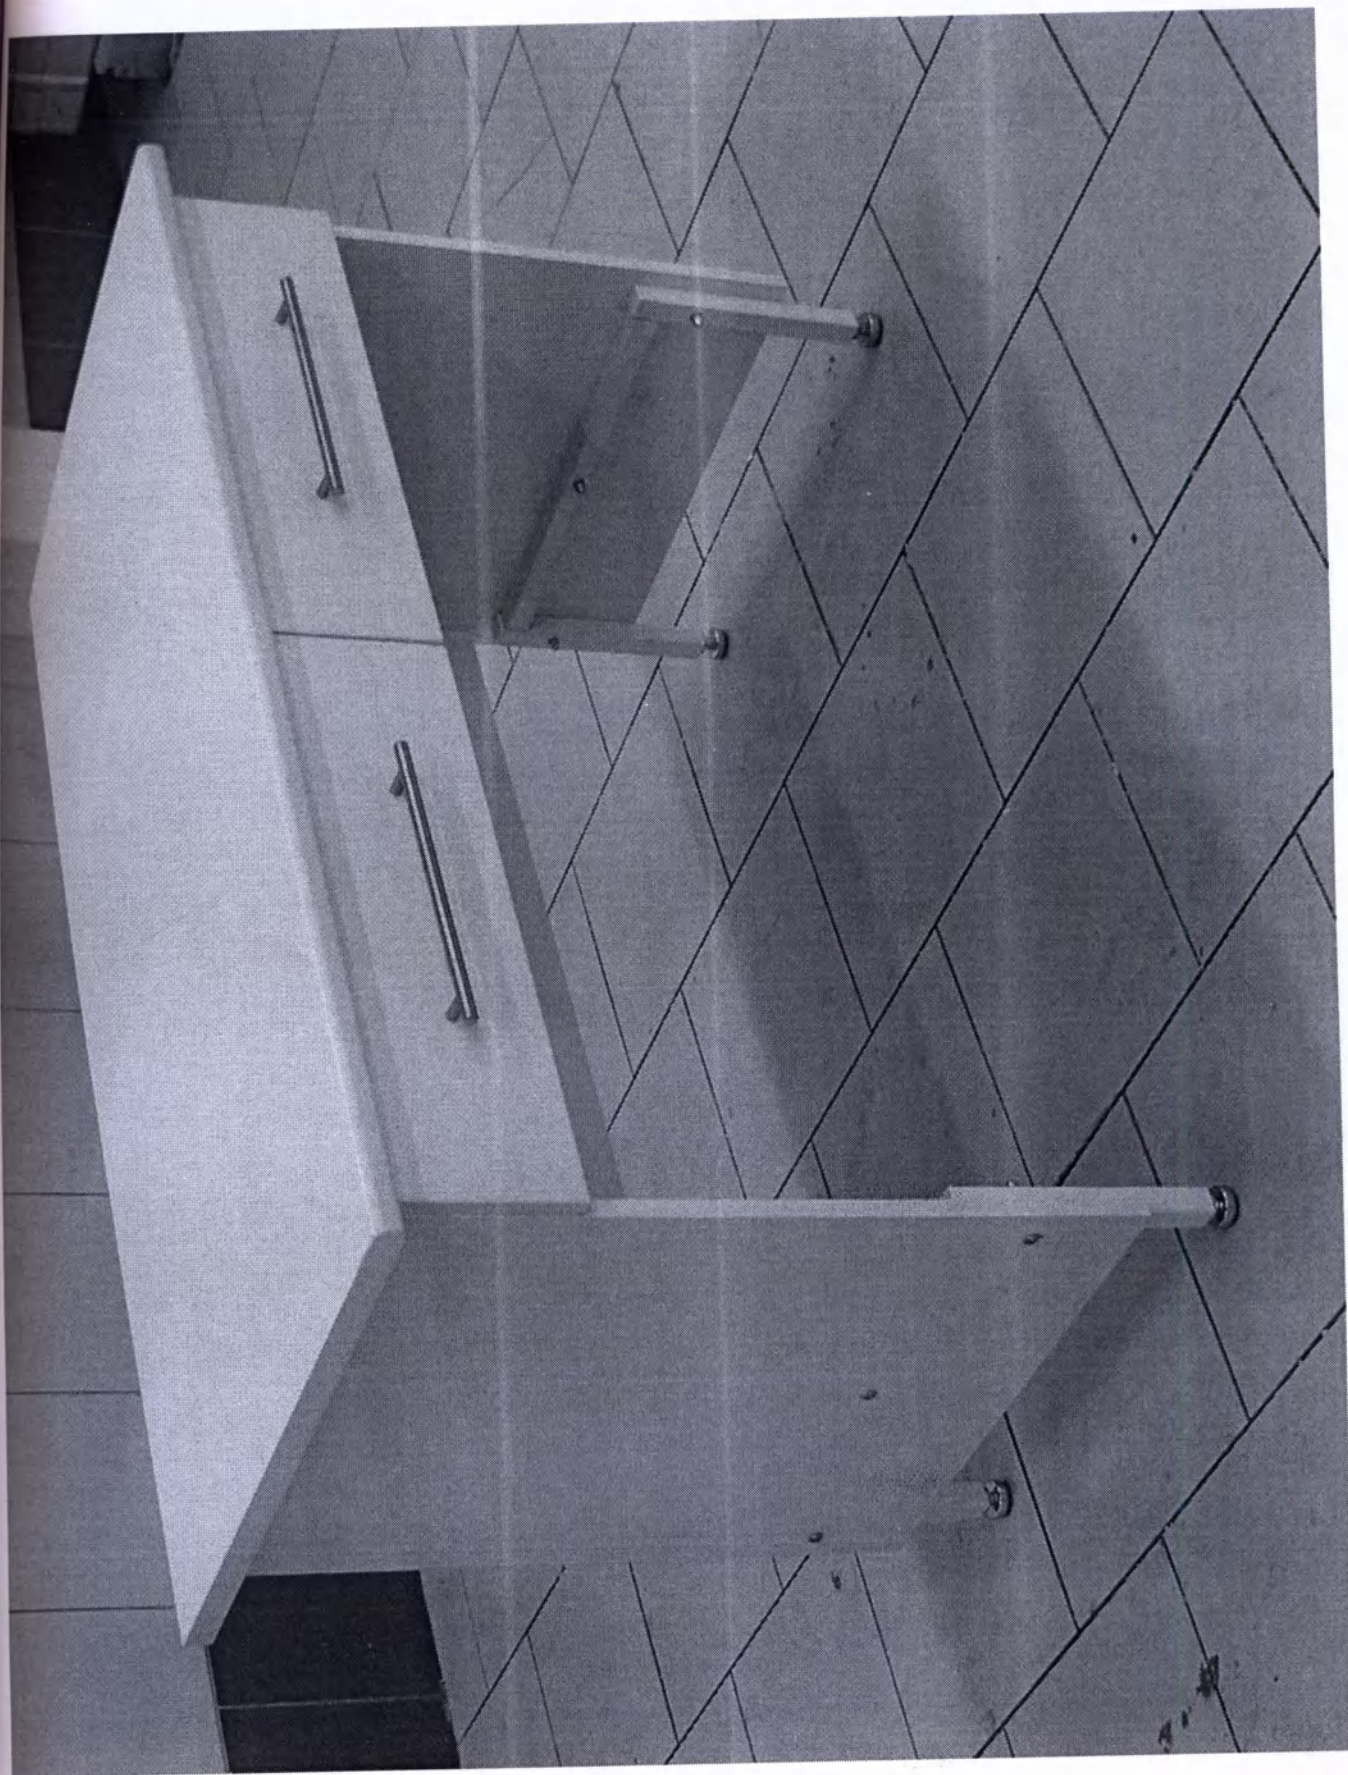


Фото 15 - Стол медицинский С-206

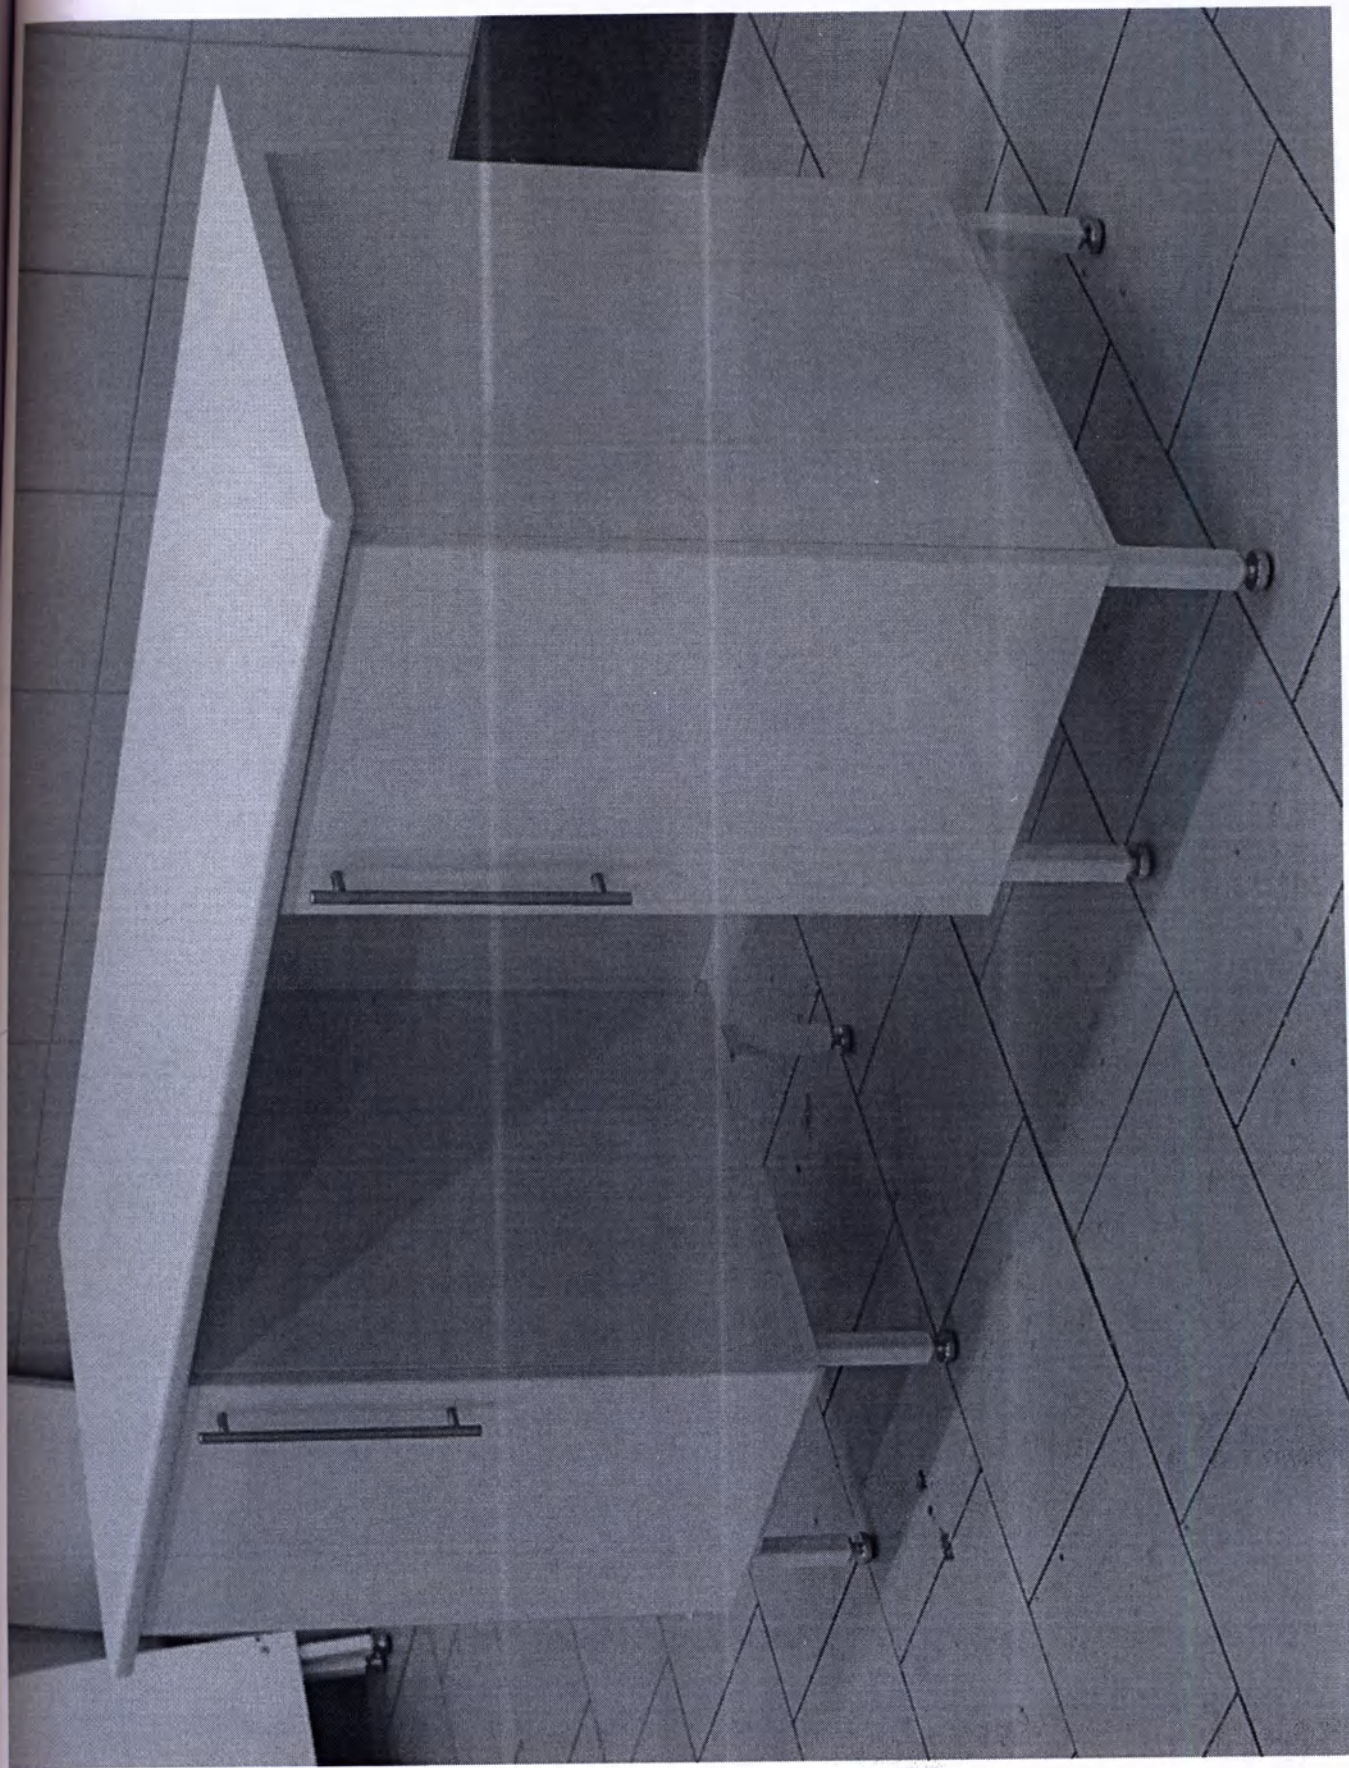


Фото 16 - Стол медицинский С-207

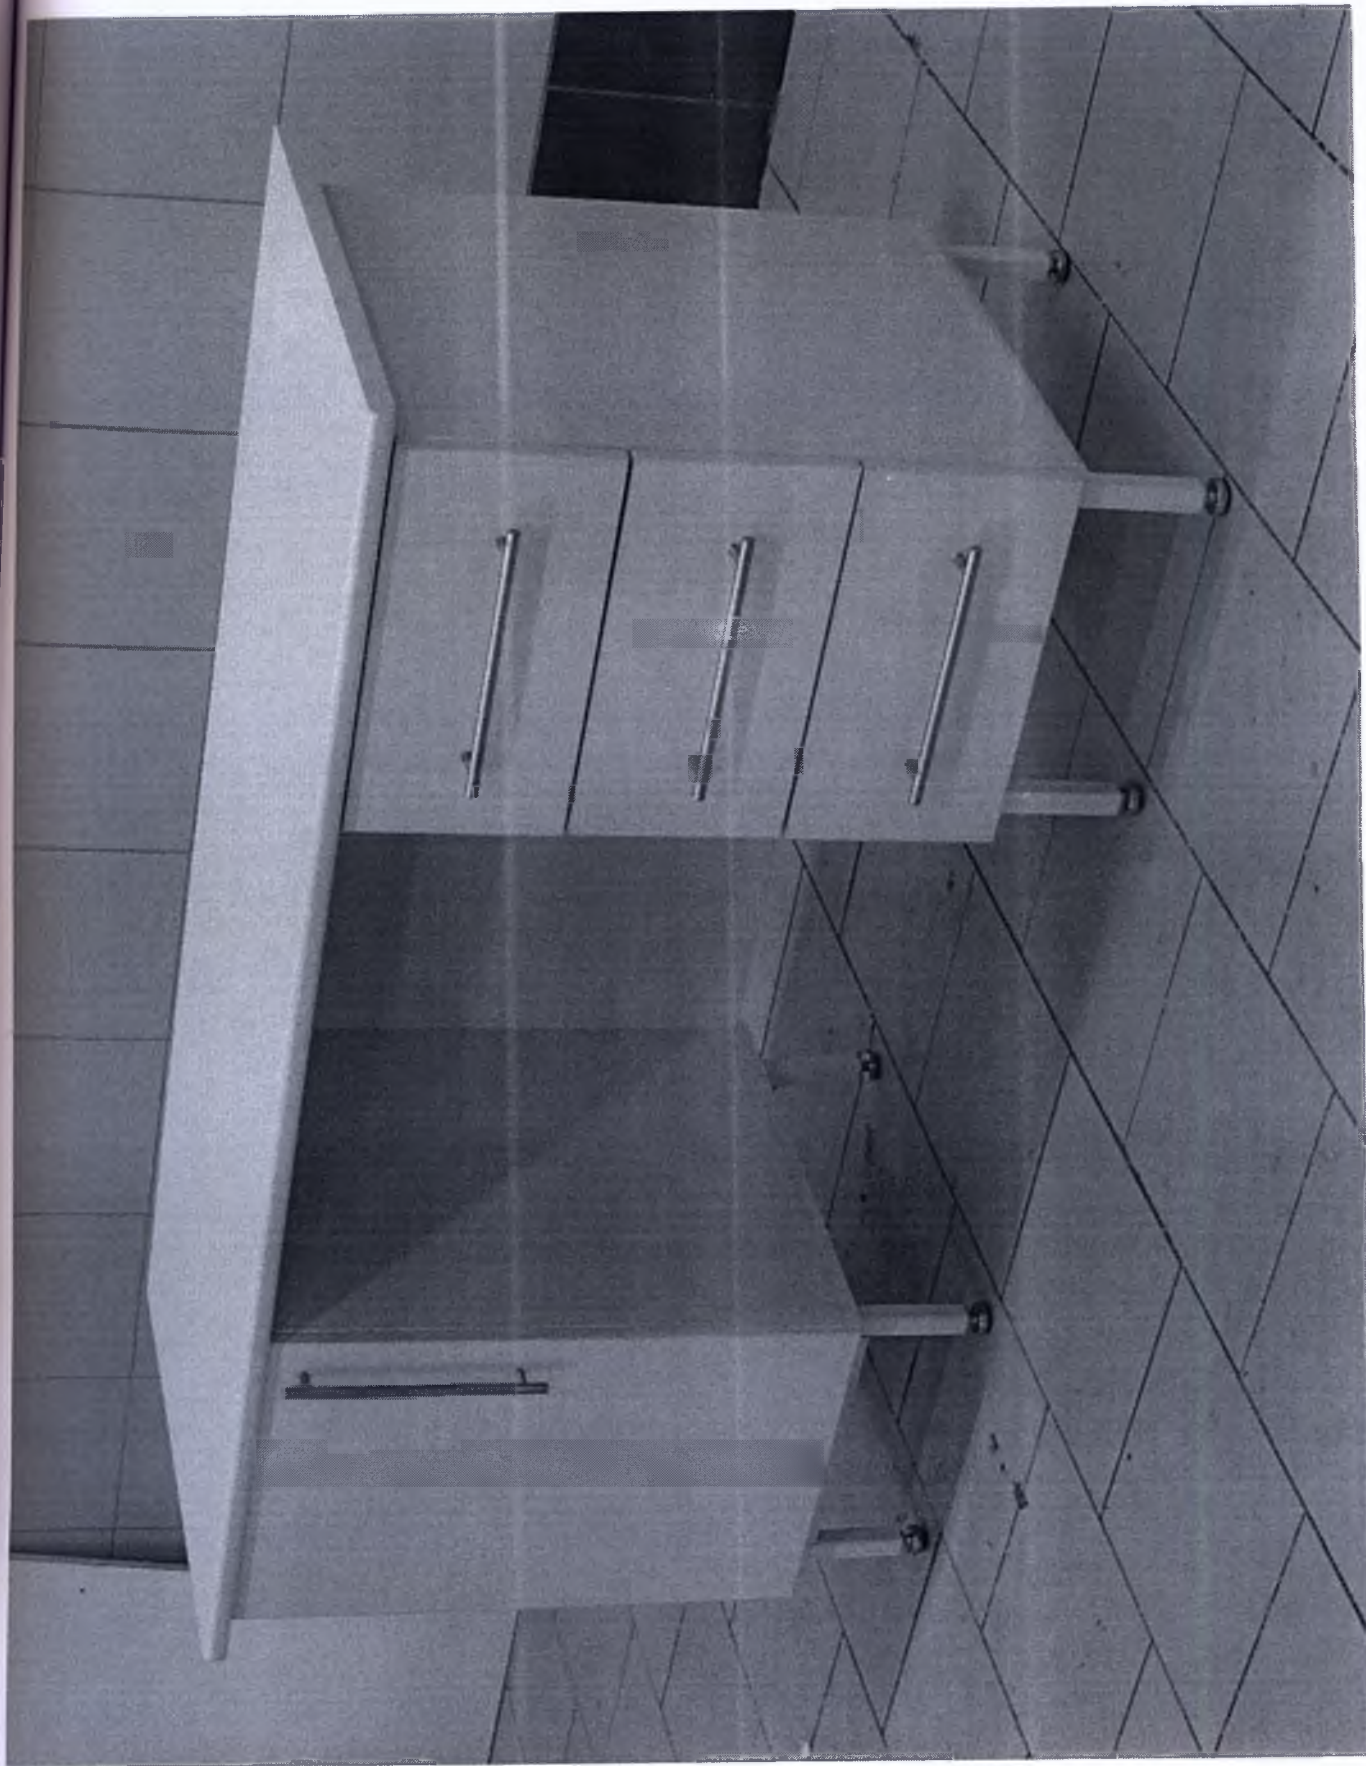


Фото 17 - Стол медицинский С-208

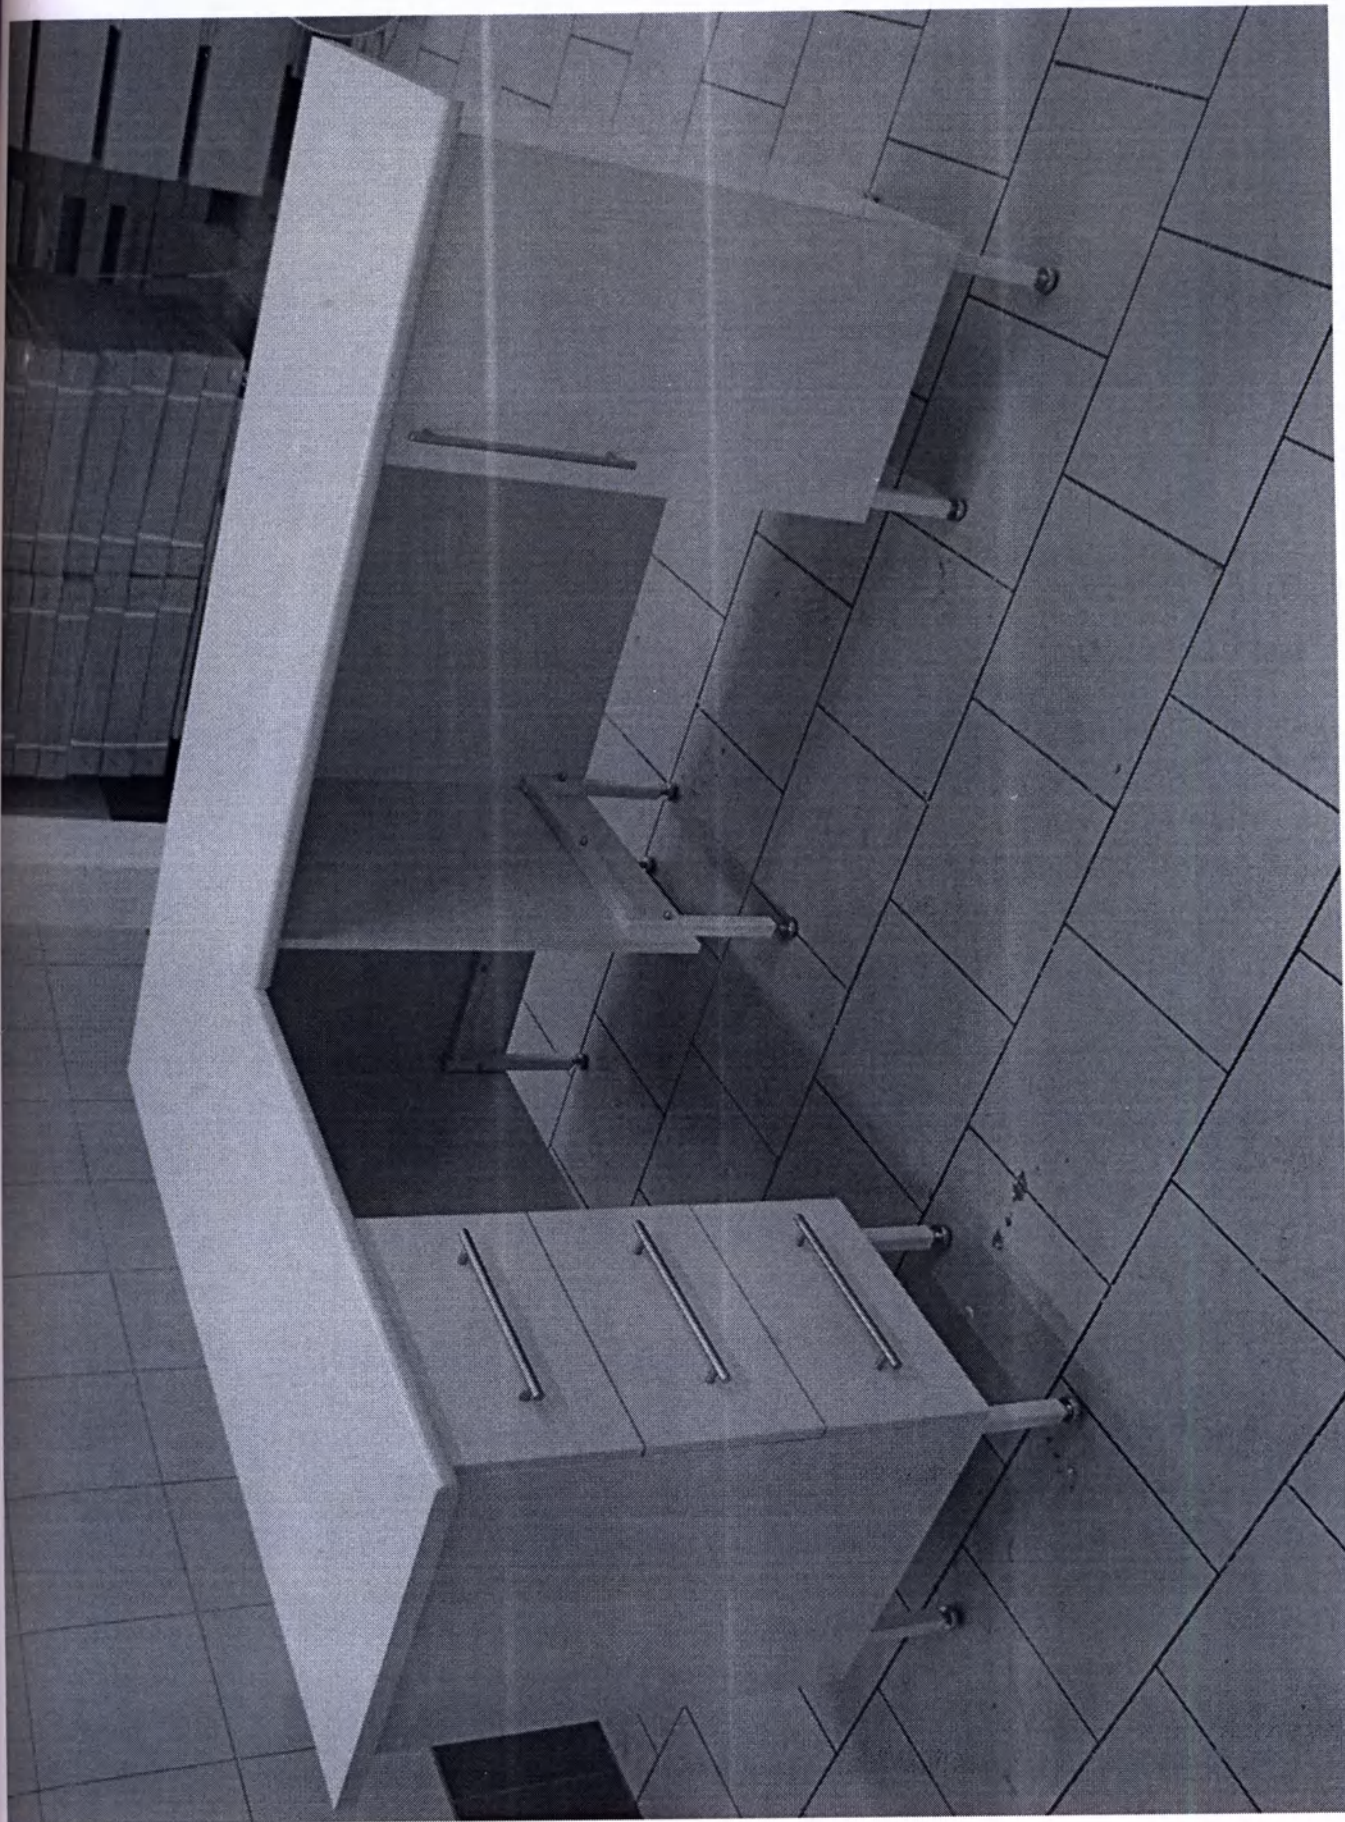


Фото 18 - Стол медицинский С-209

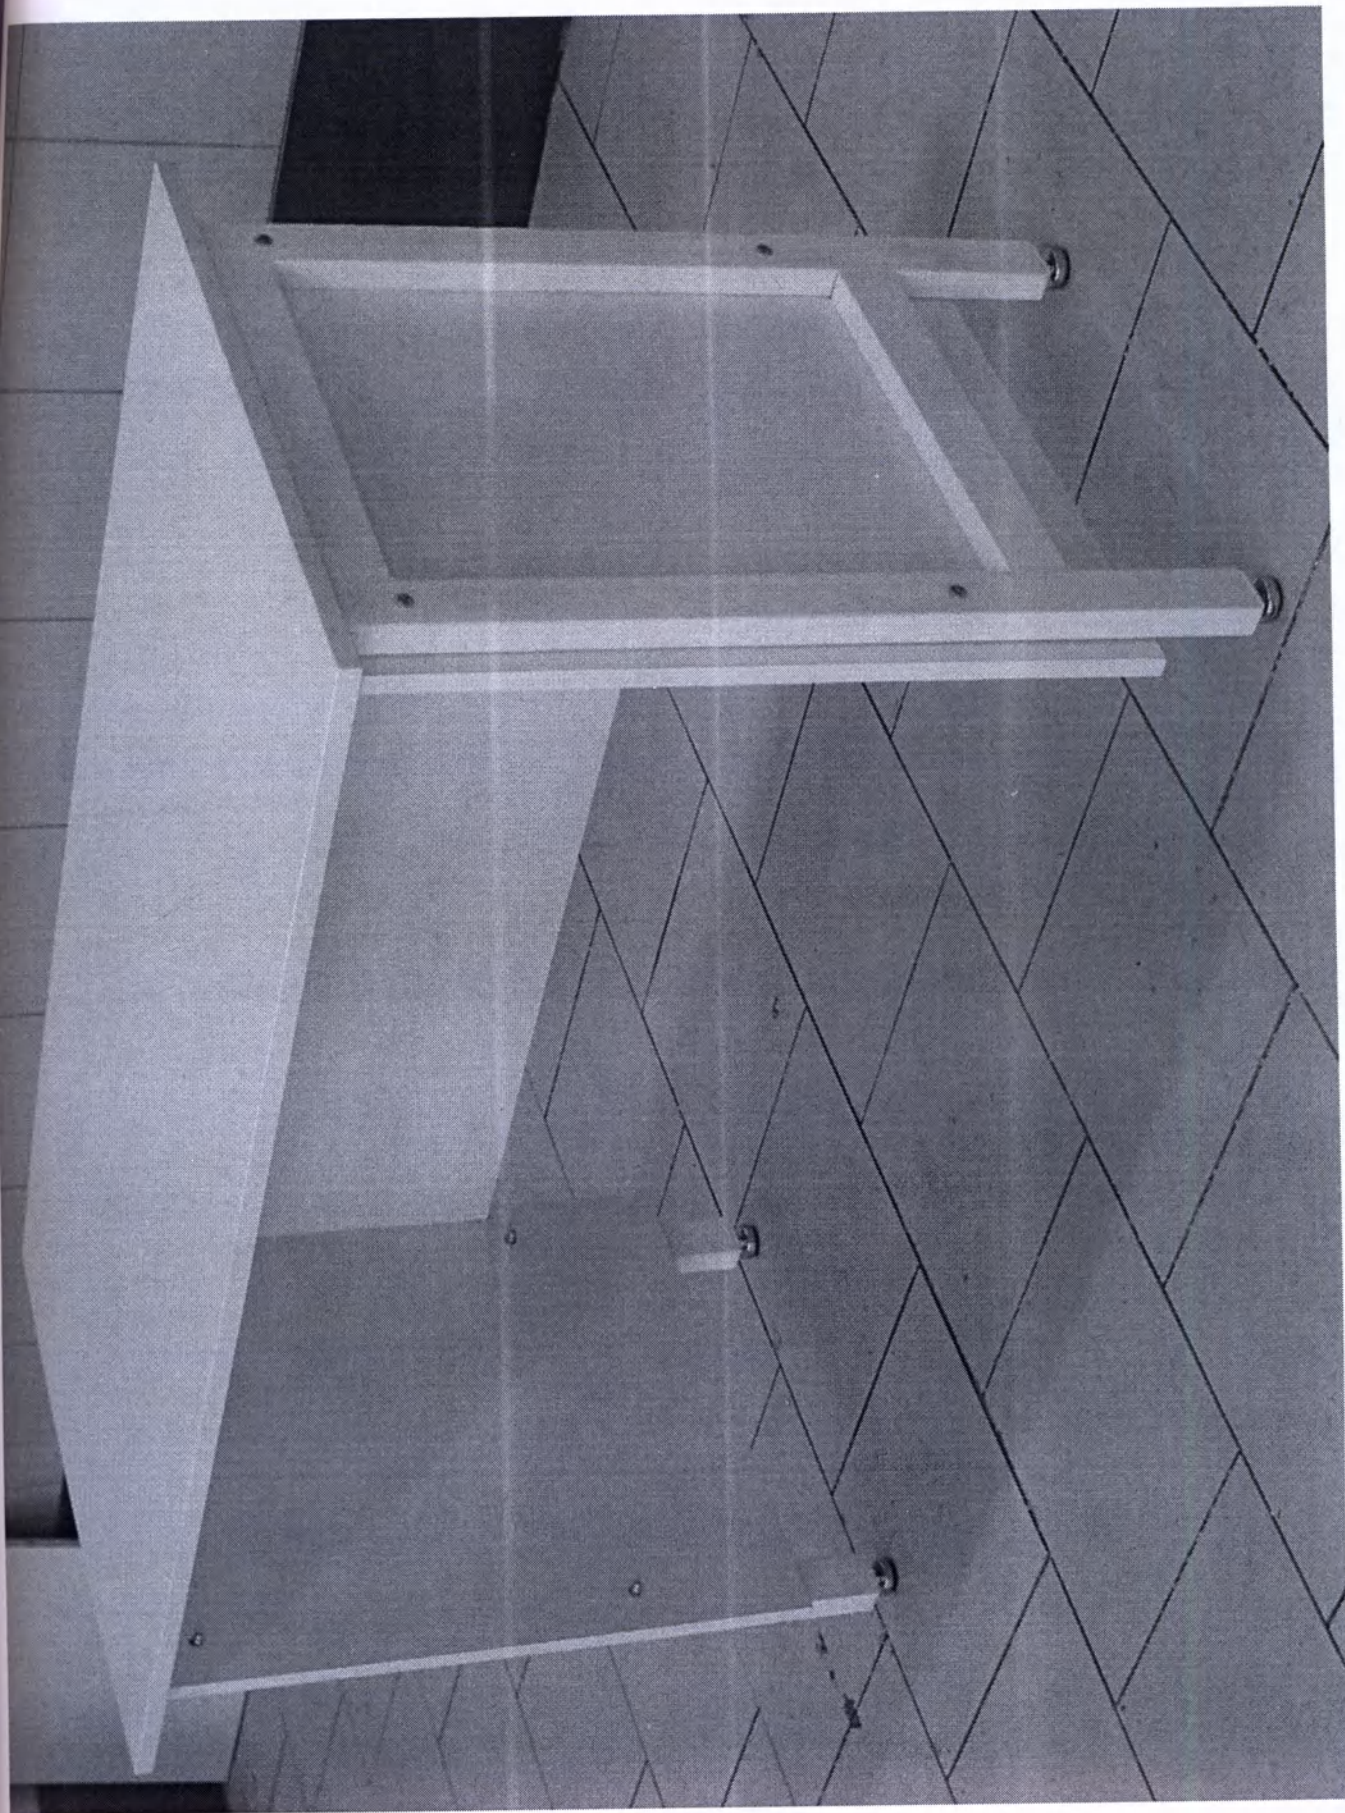


Фото 19 - Стол медицинский С-301

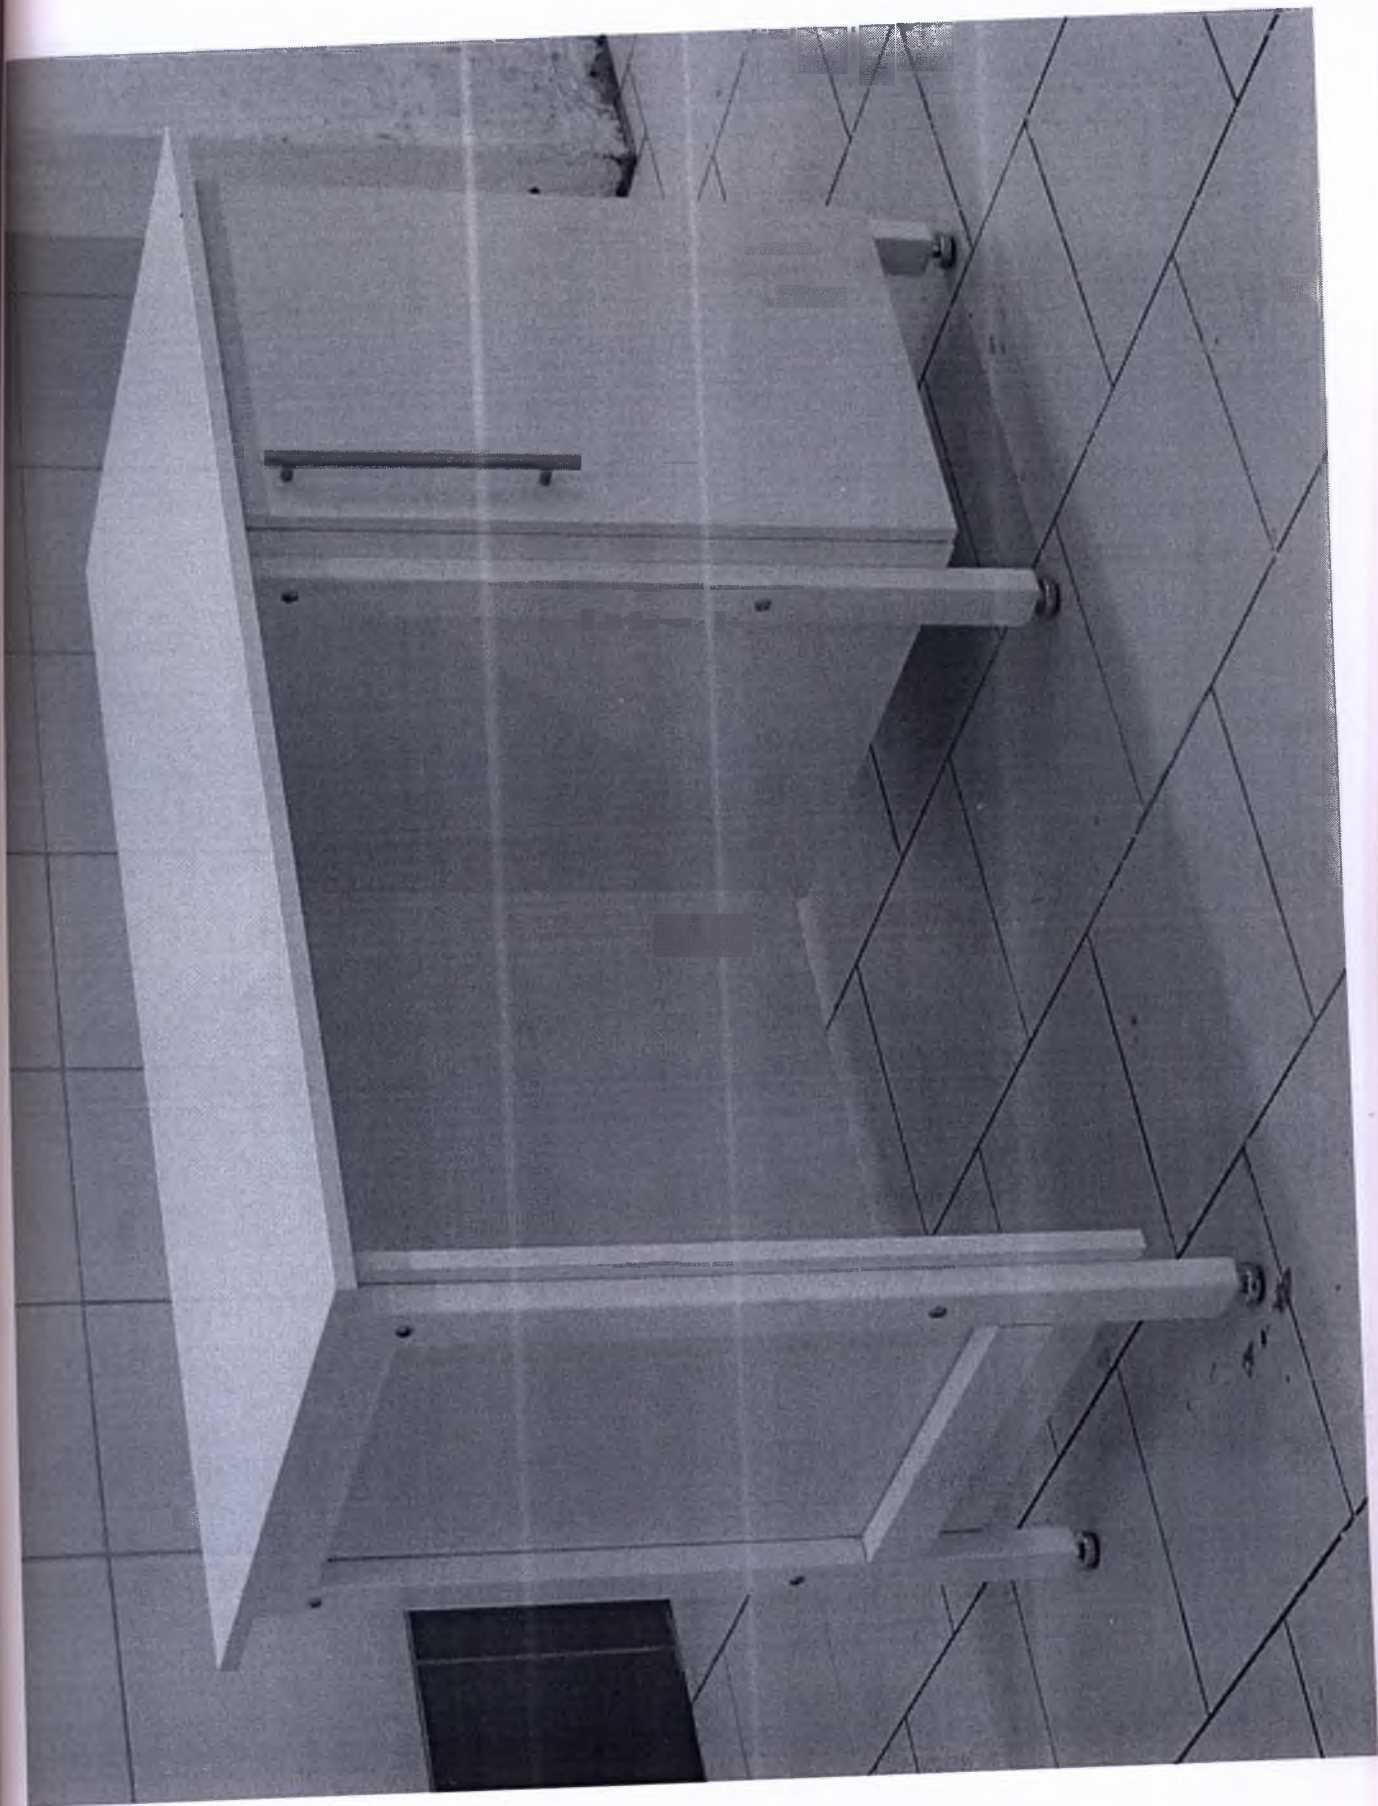


Фото 20 - Стол медицинский С-302

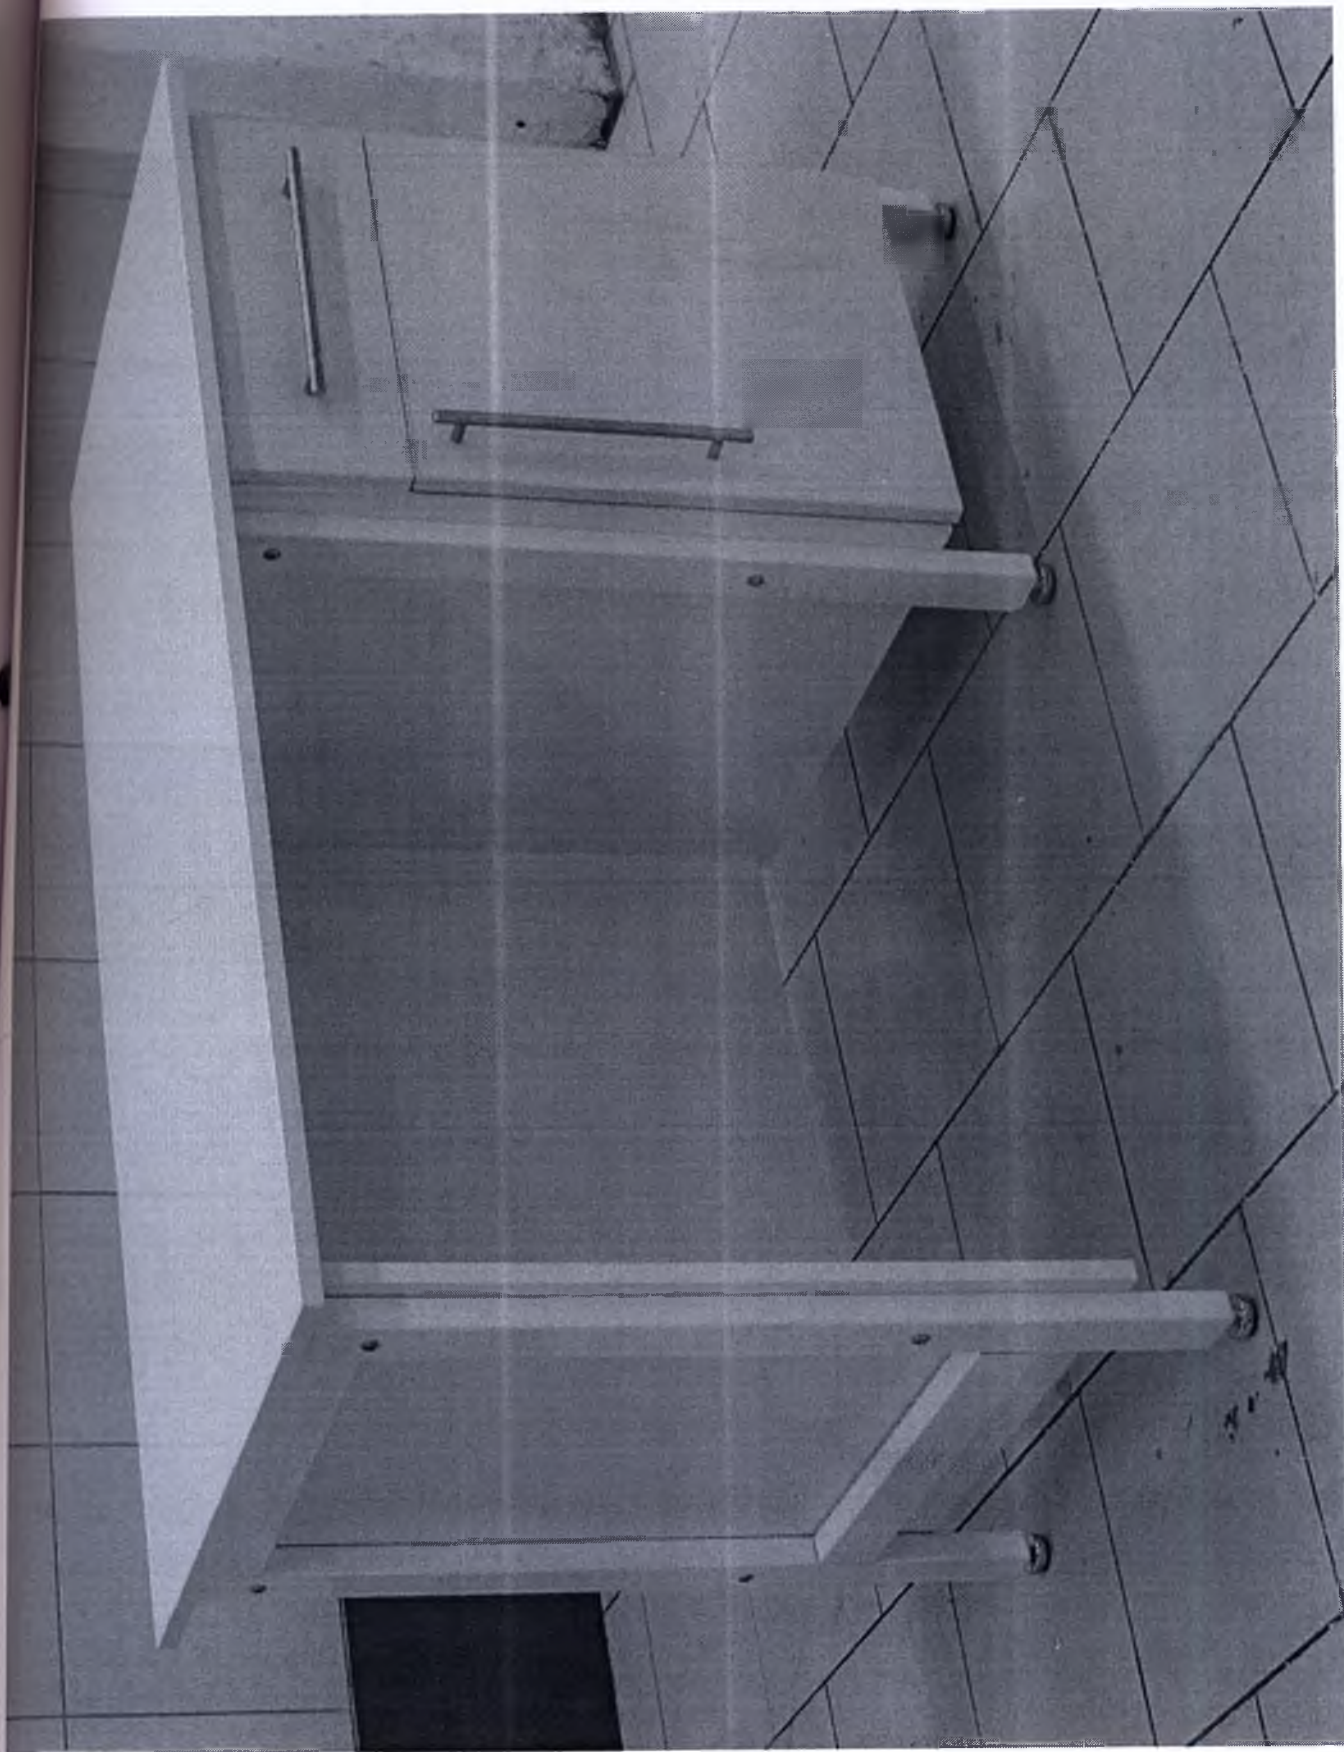


Фото 21 - Стол медицинский С-303

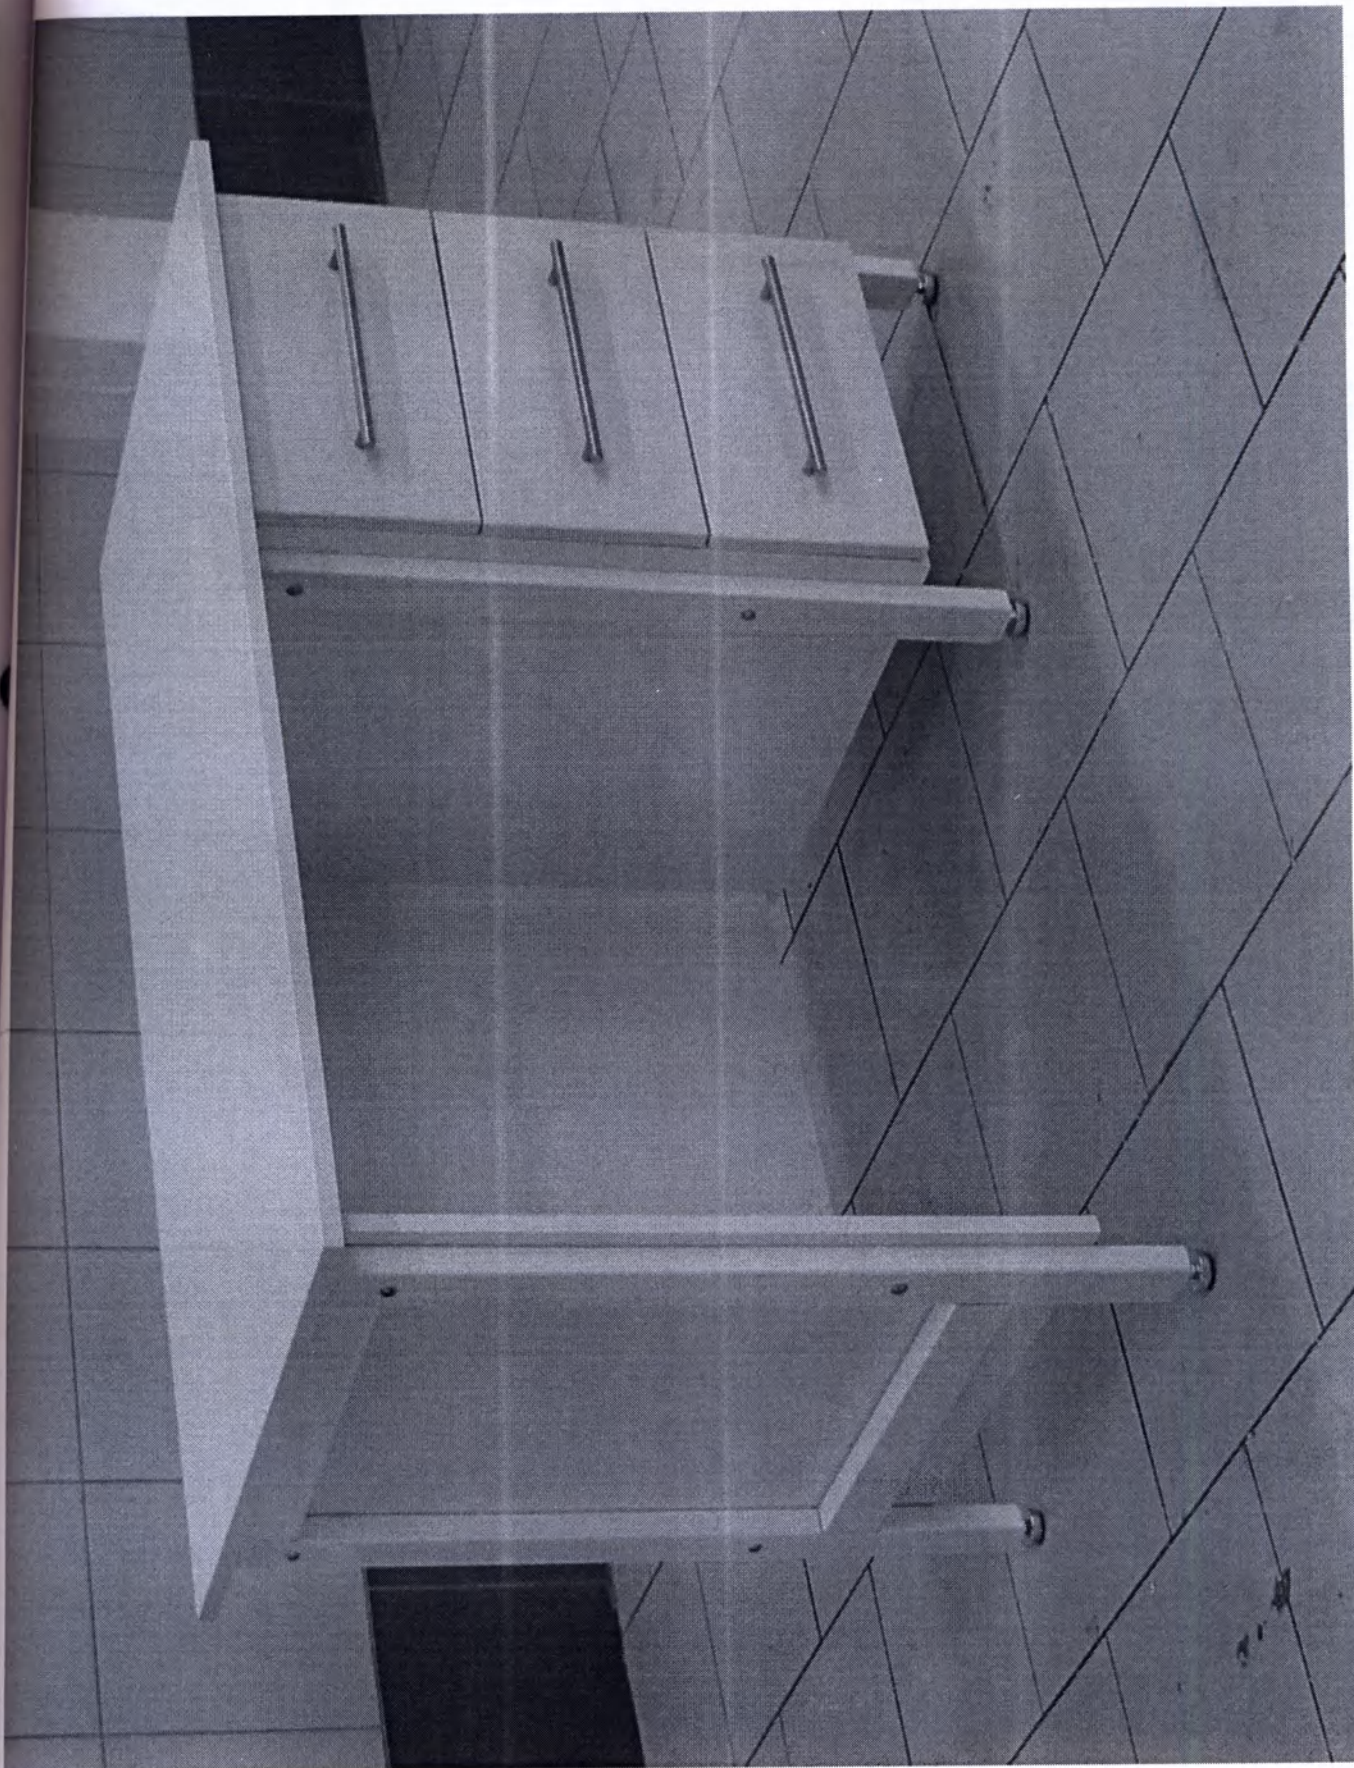


Фото 22 - Стол медицинский С-304

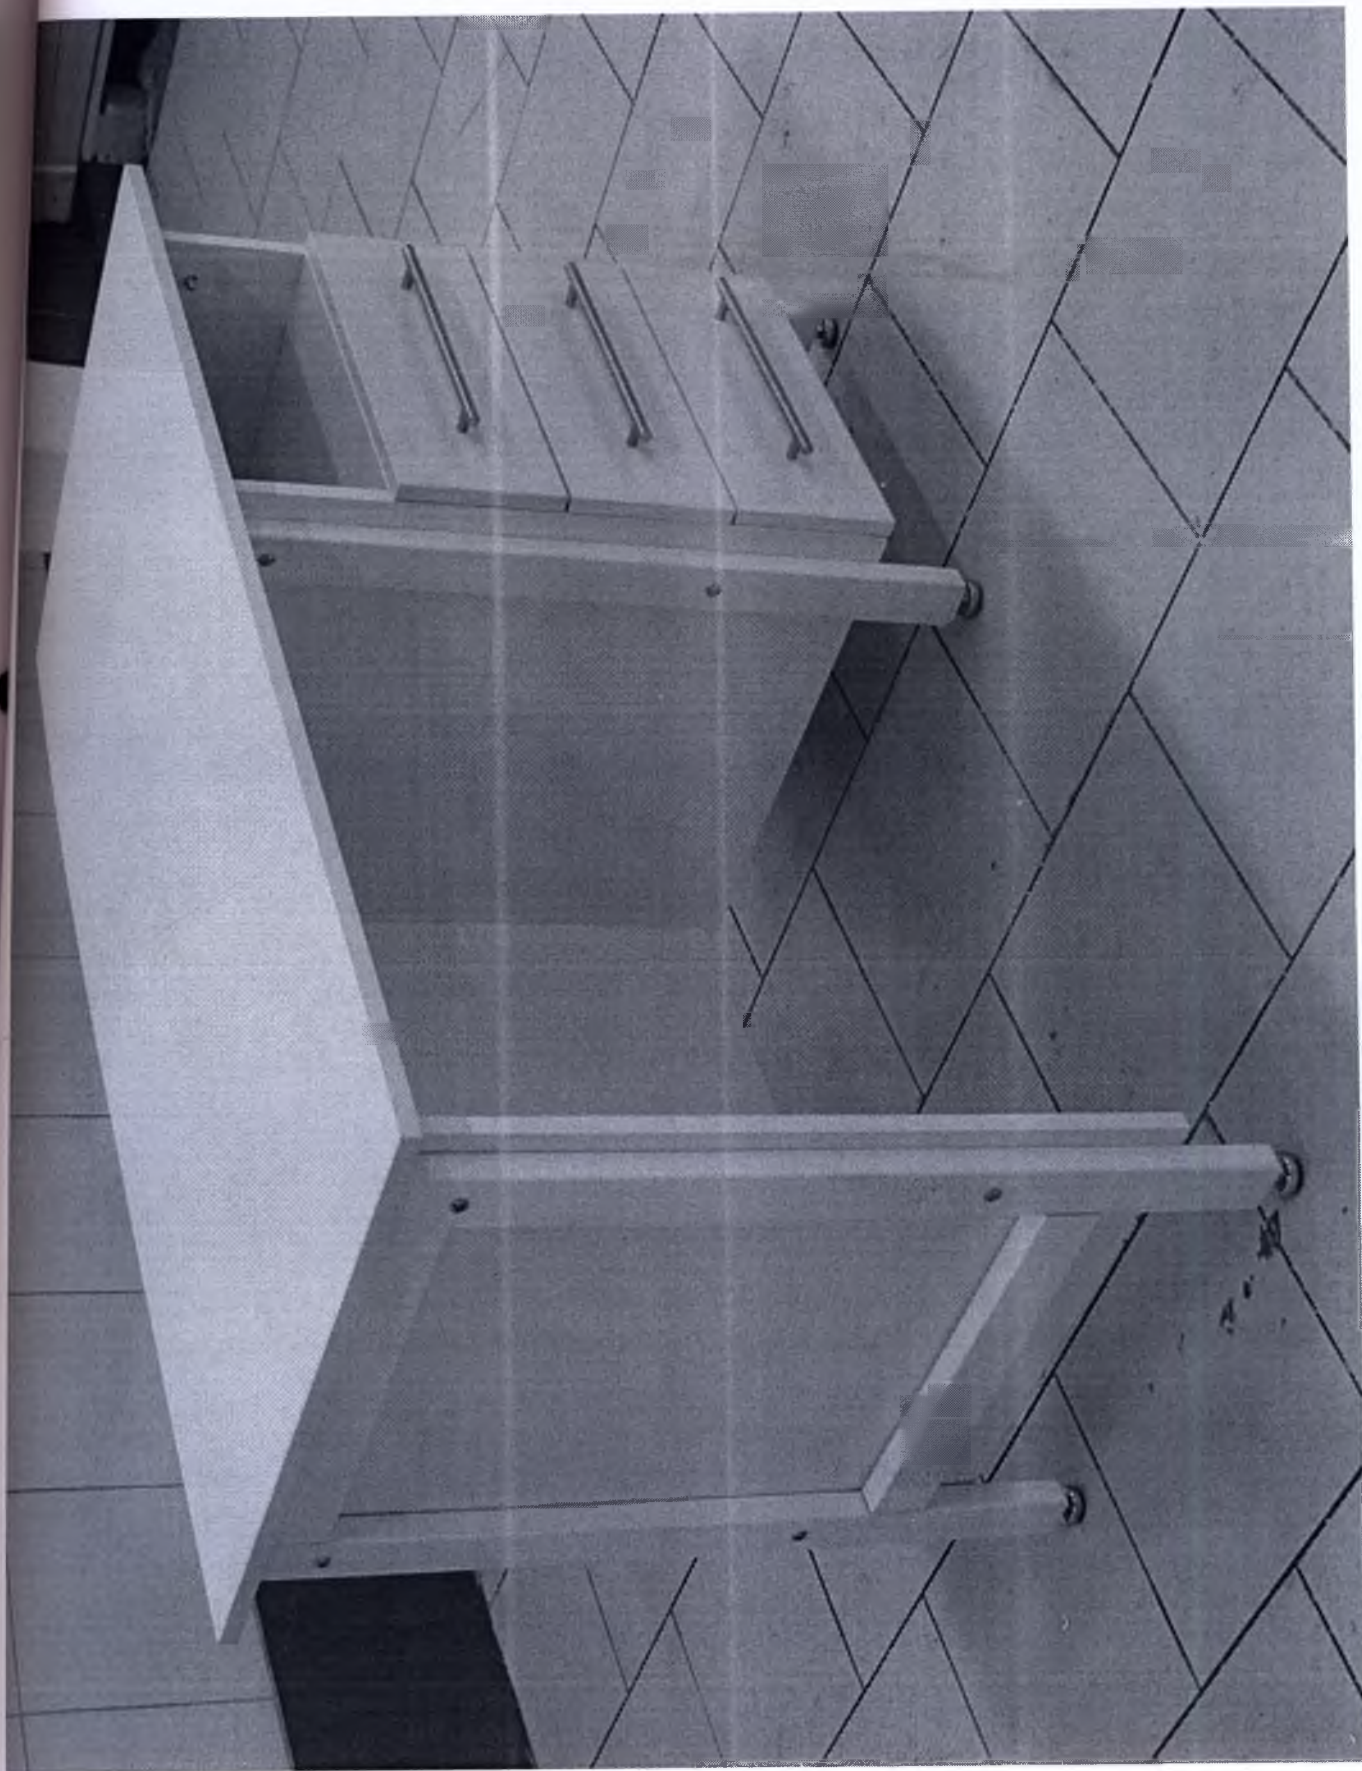


Фото 23 - Стол медицинский С-305

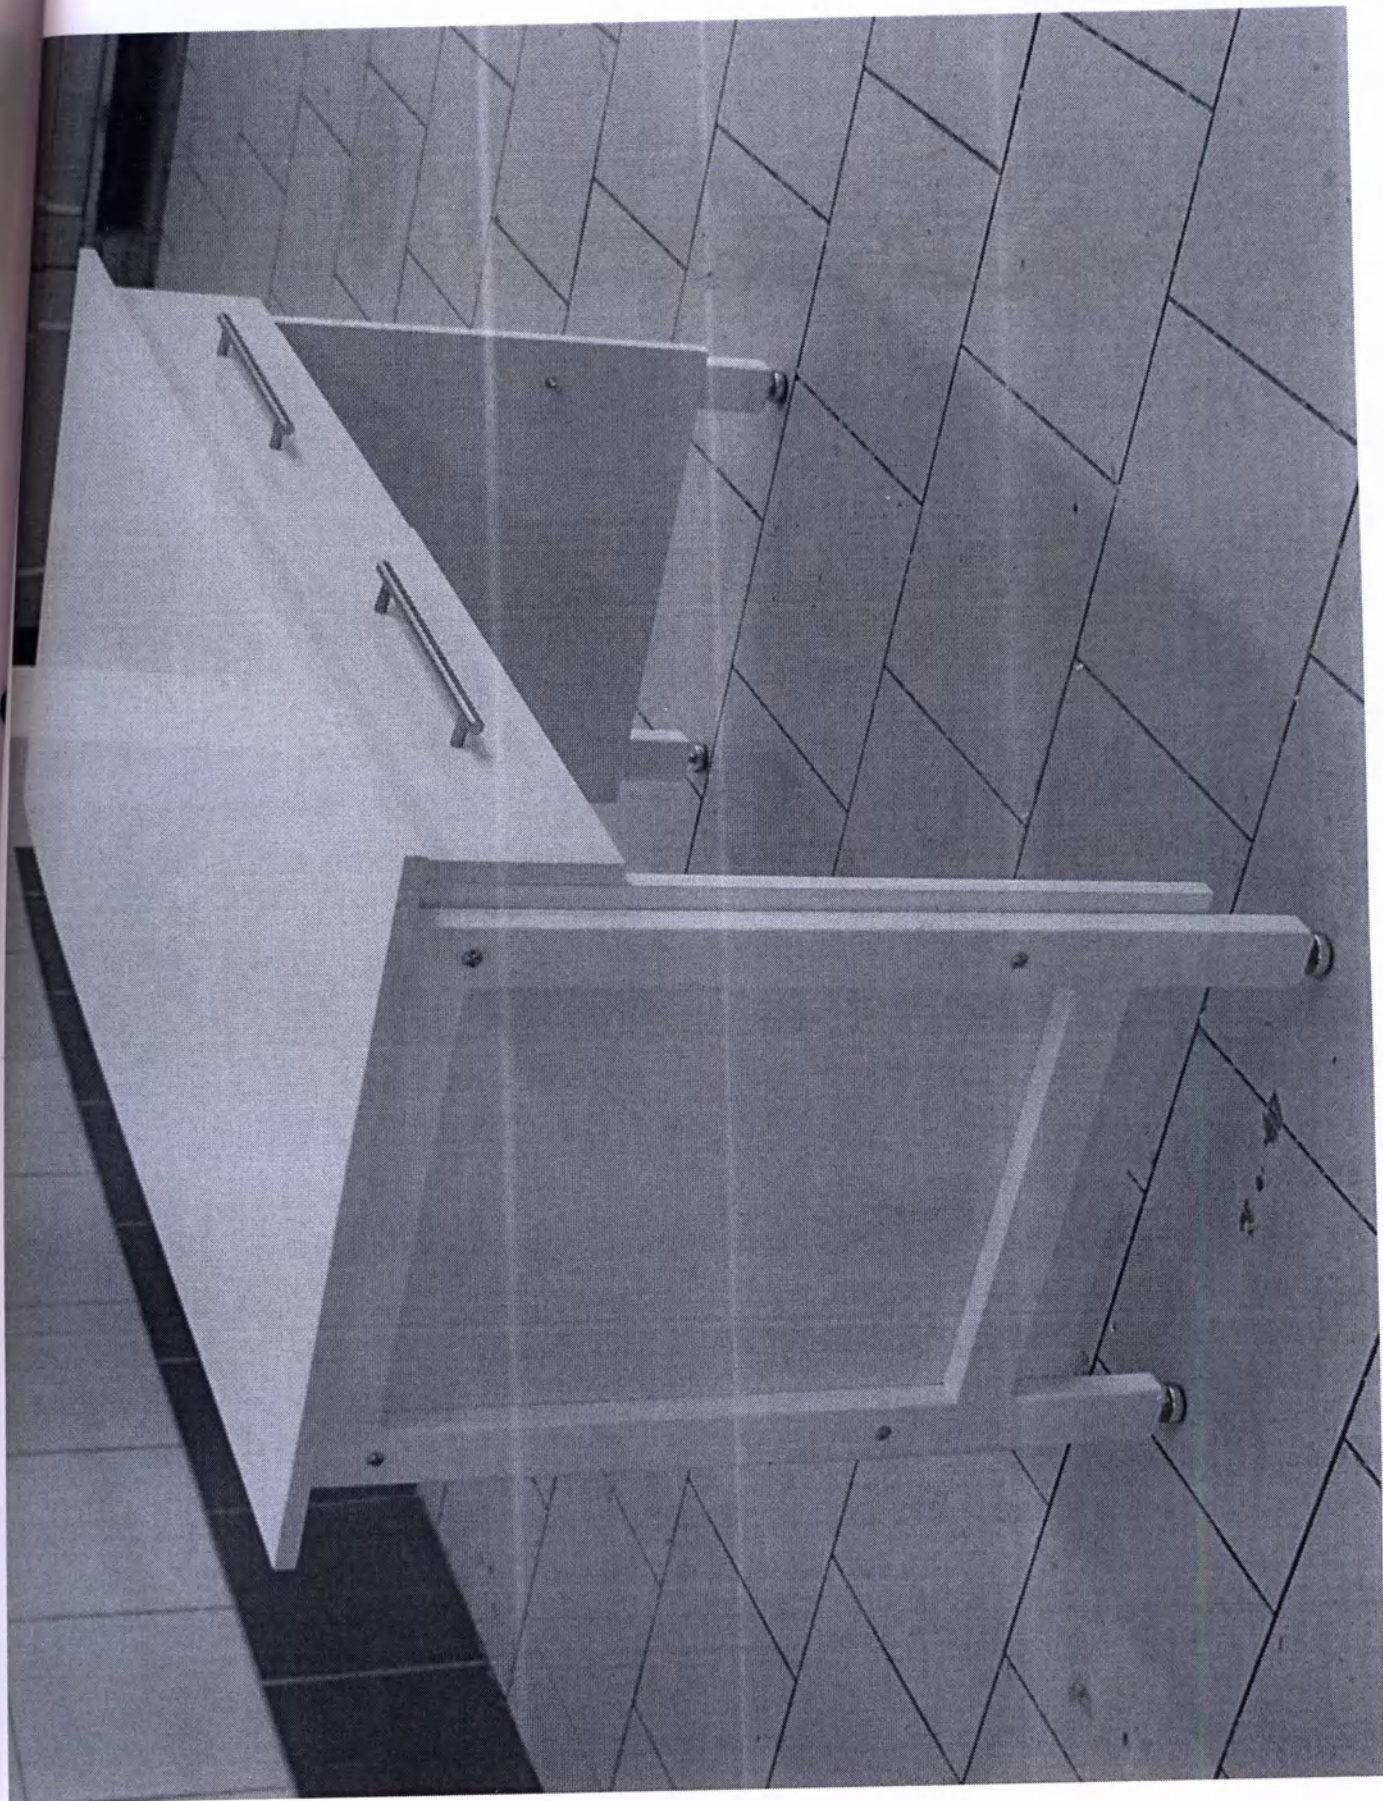


Фото 24 - Стол медицинский С-306

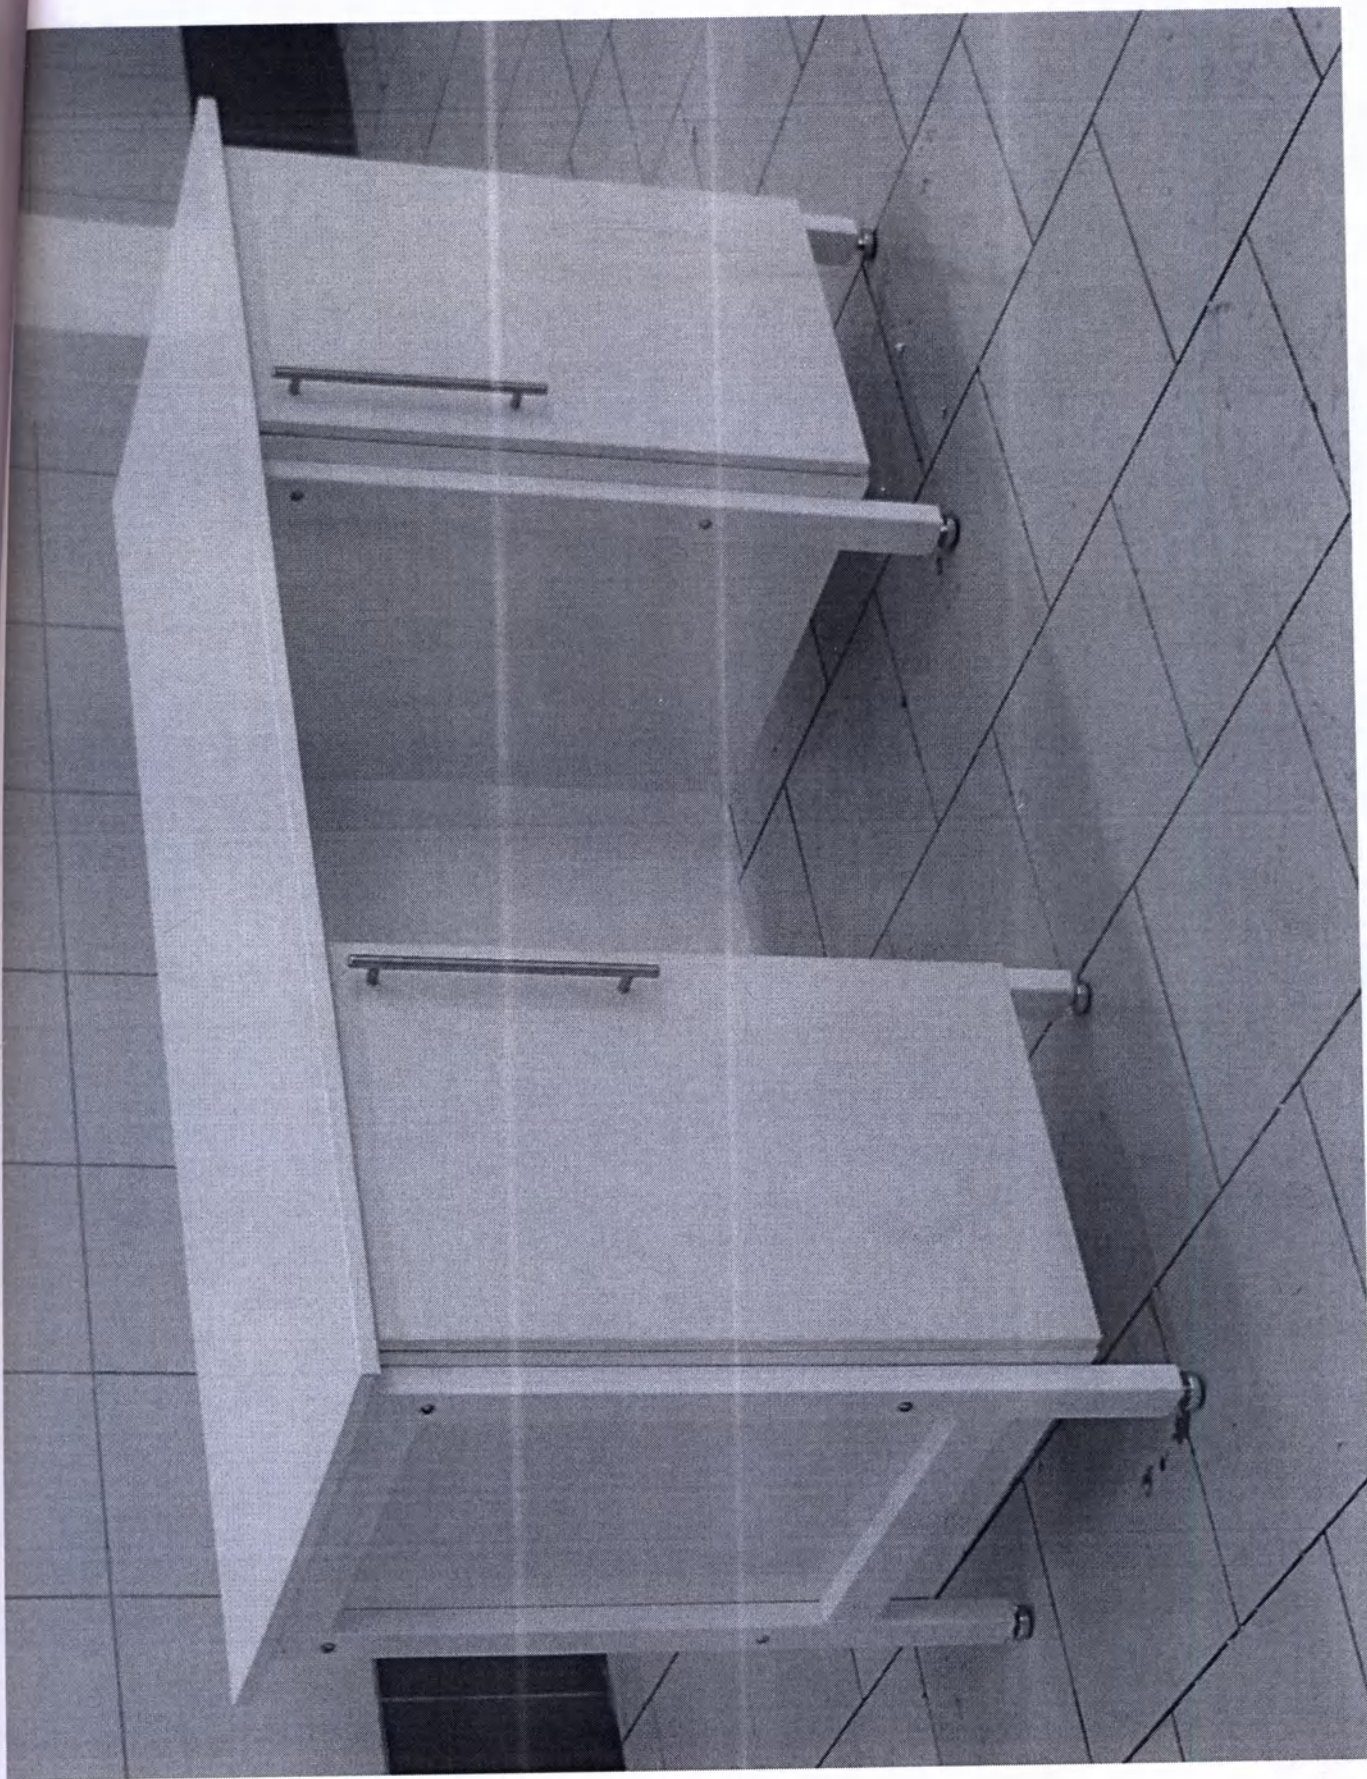


Фото 25 - Стол медицинский С-307

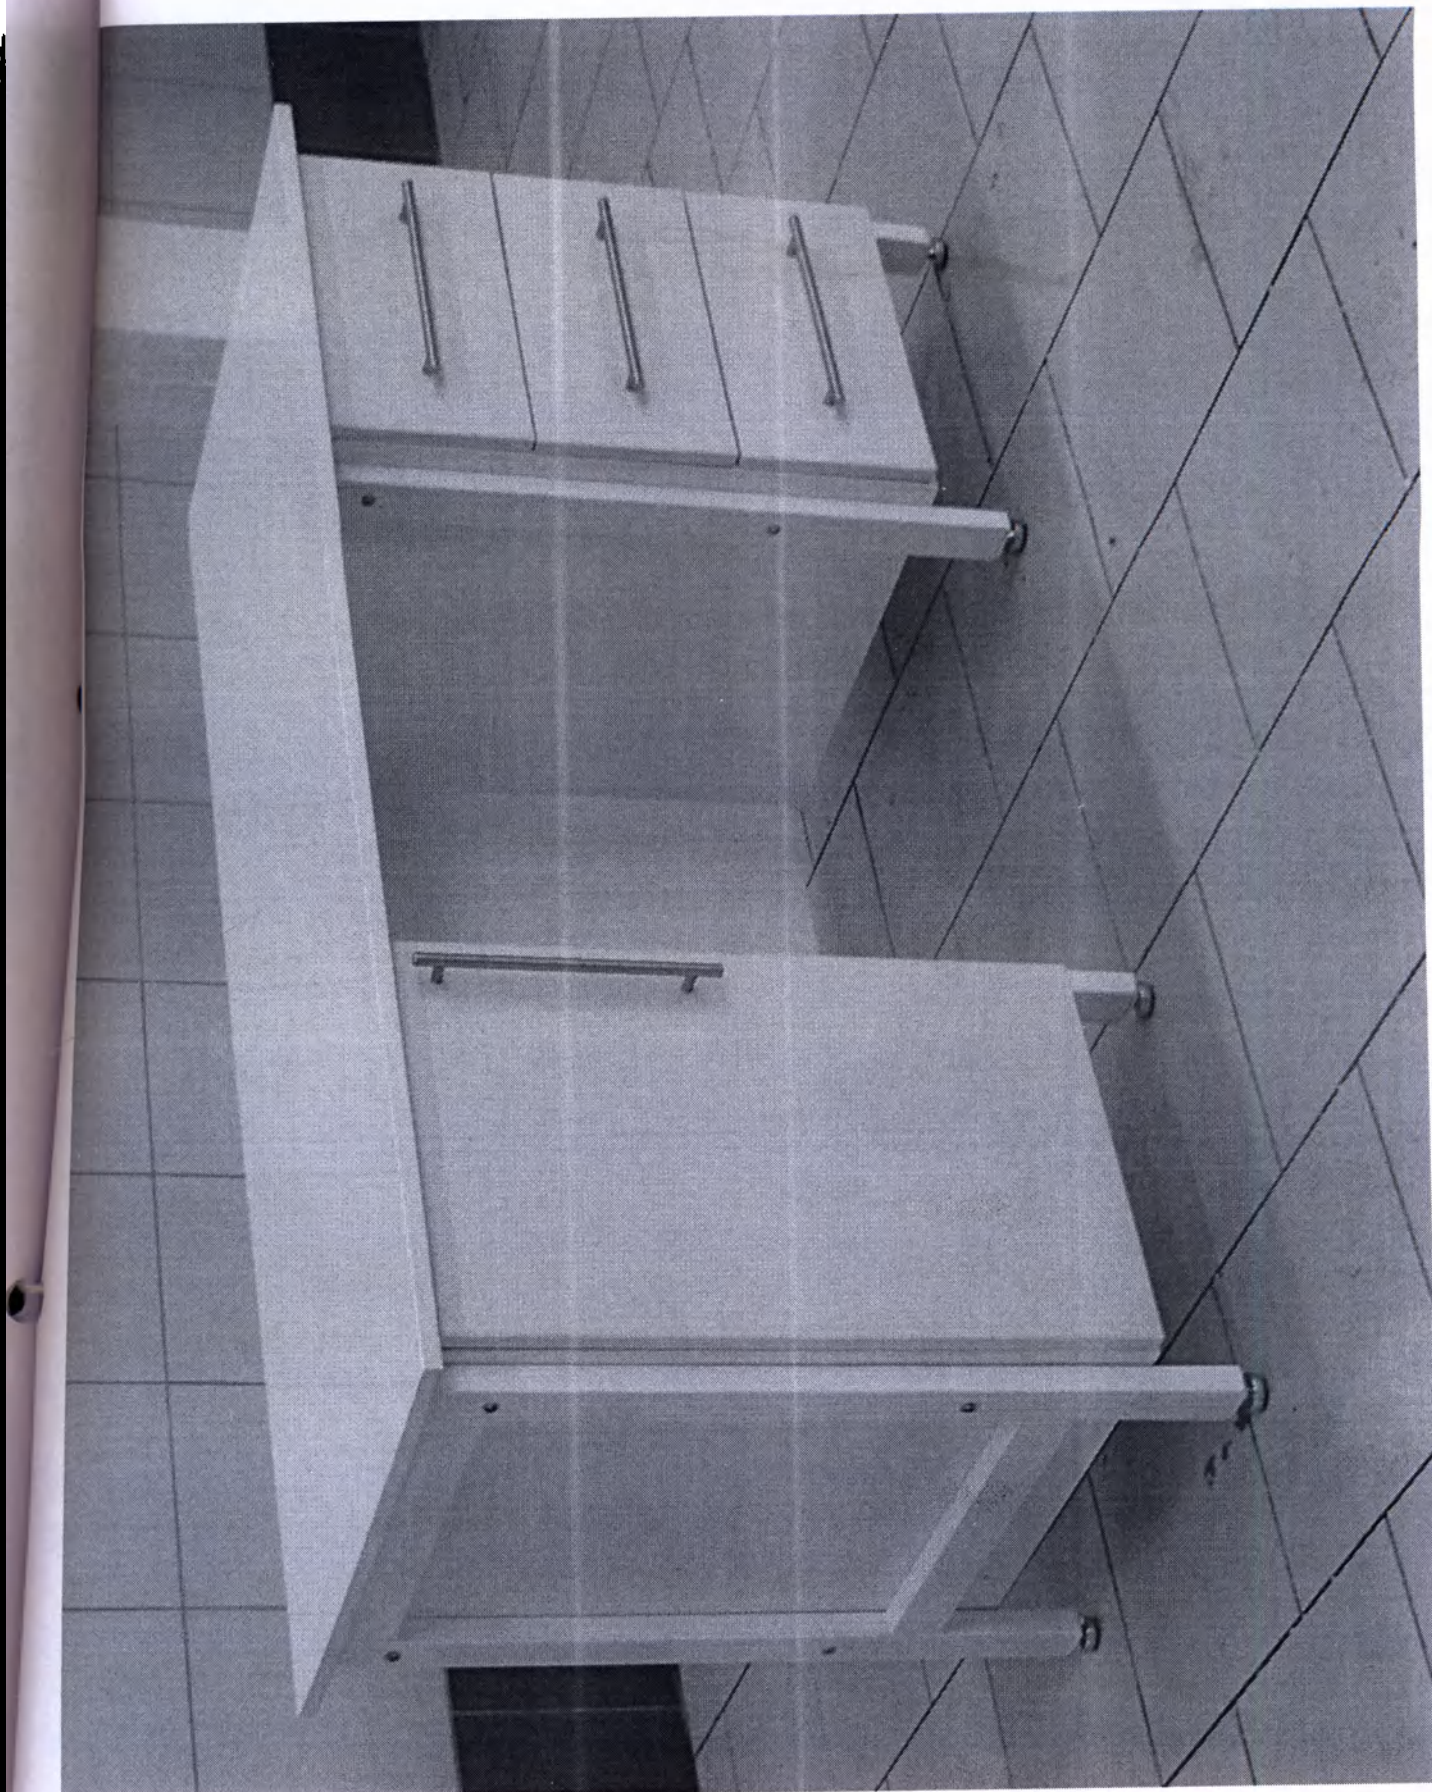


Фото 26 - Стол медицинский С-308

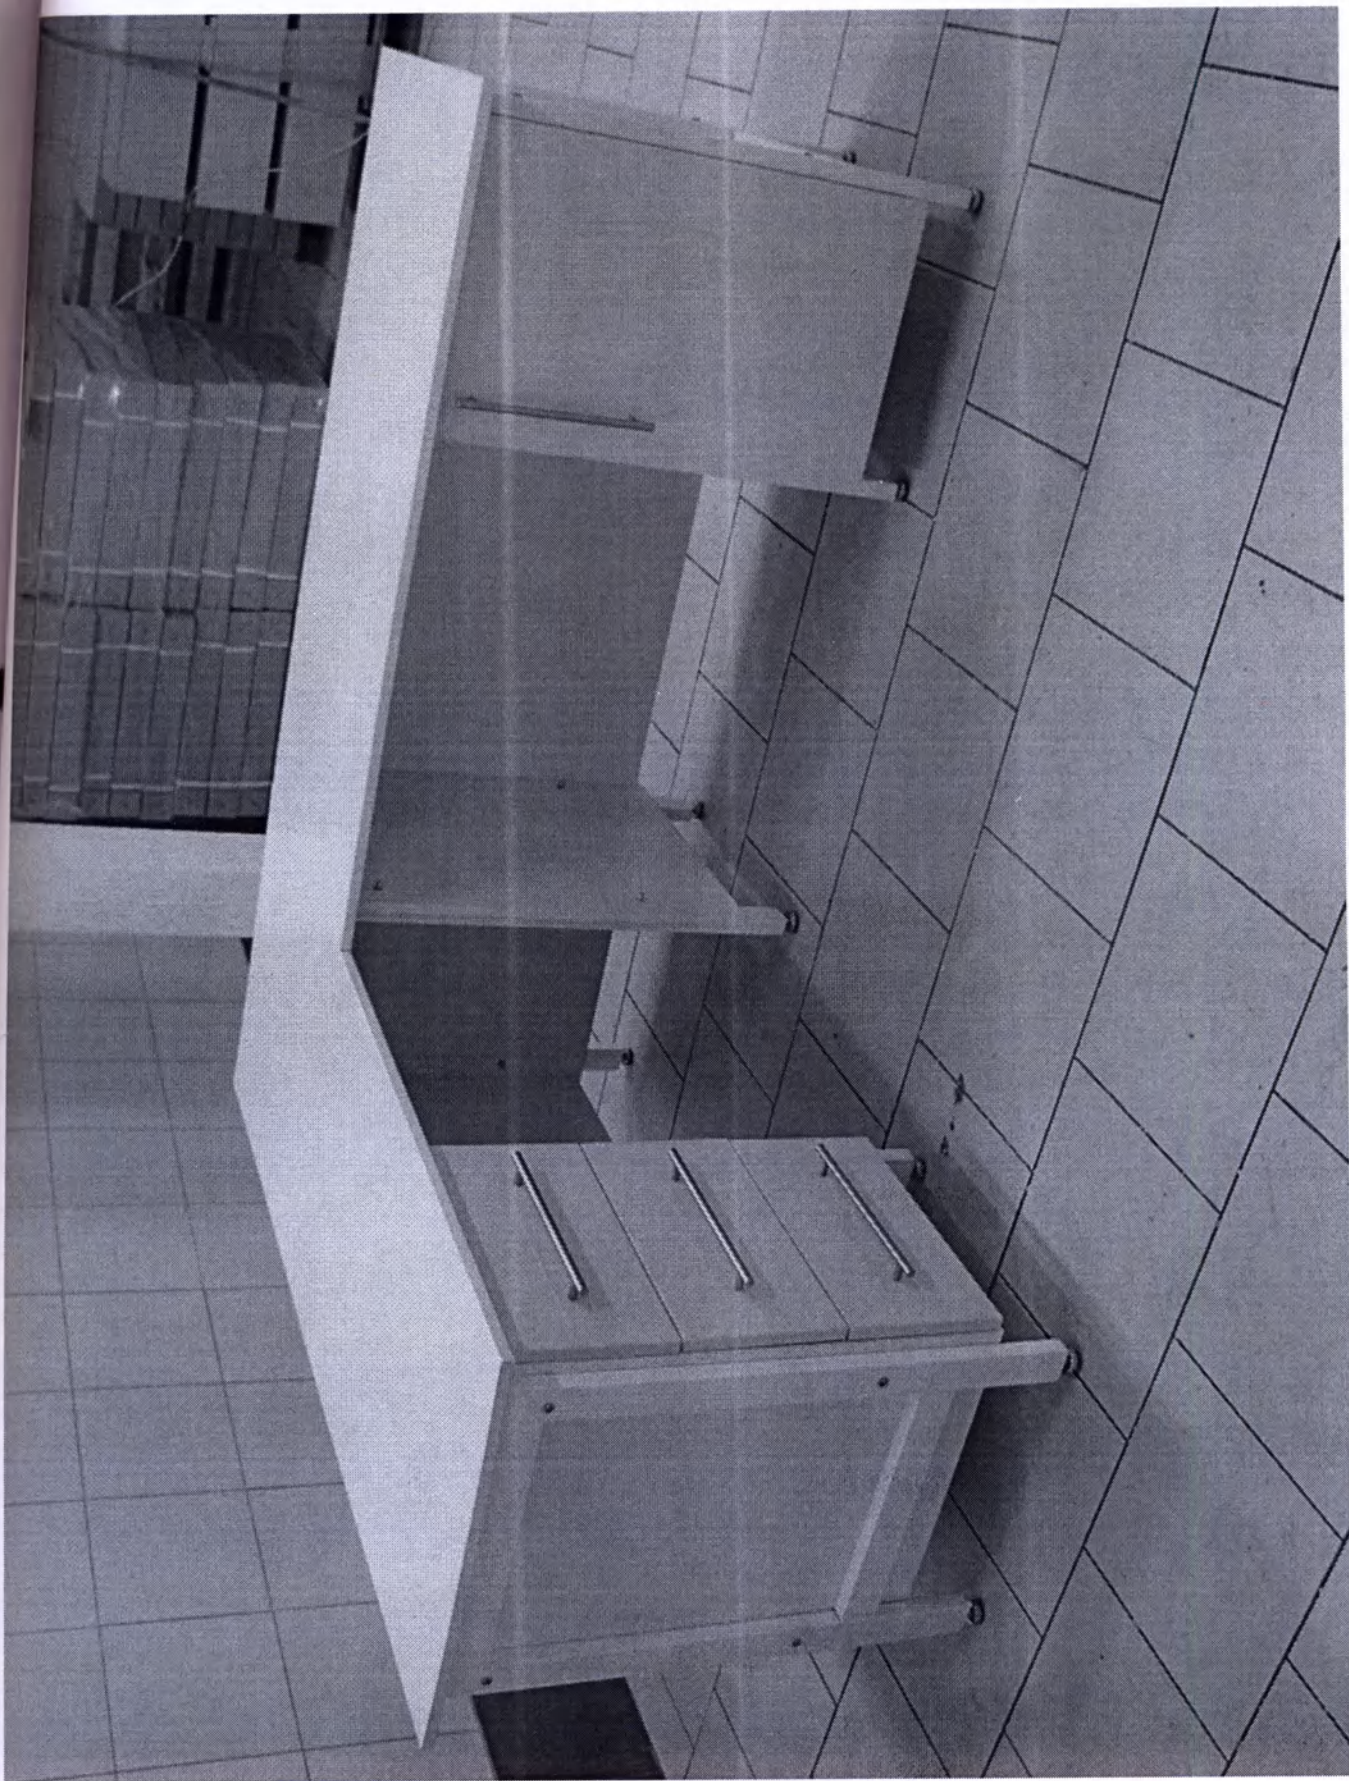


Фото 27 - Стол медицинский С-309

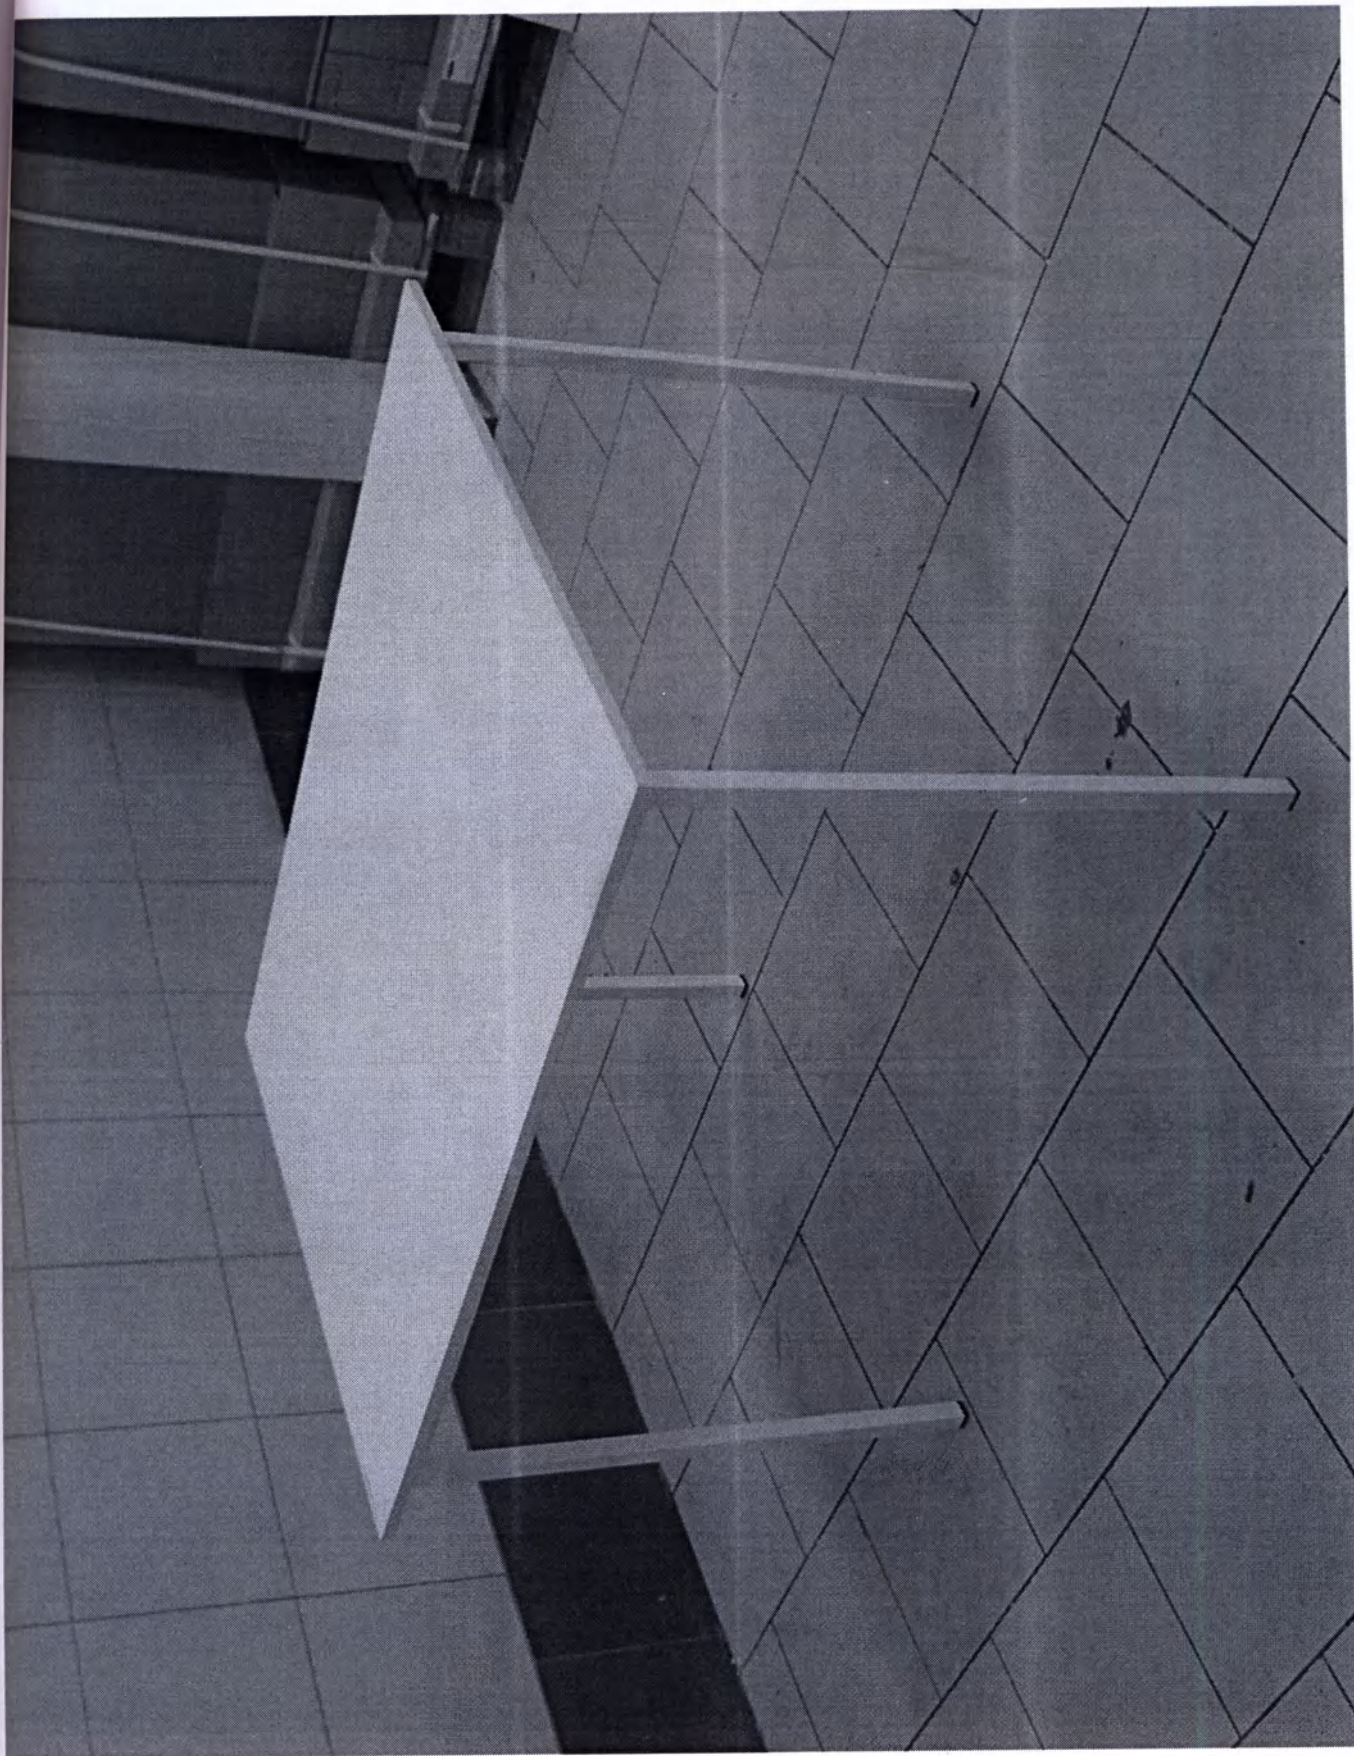


Фото 28 - Стол медицинский С-401

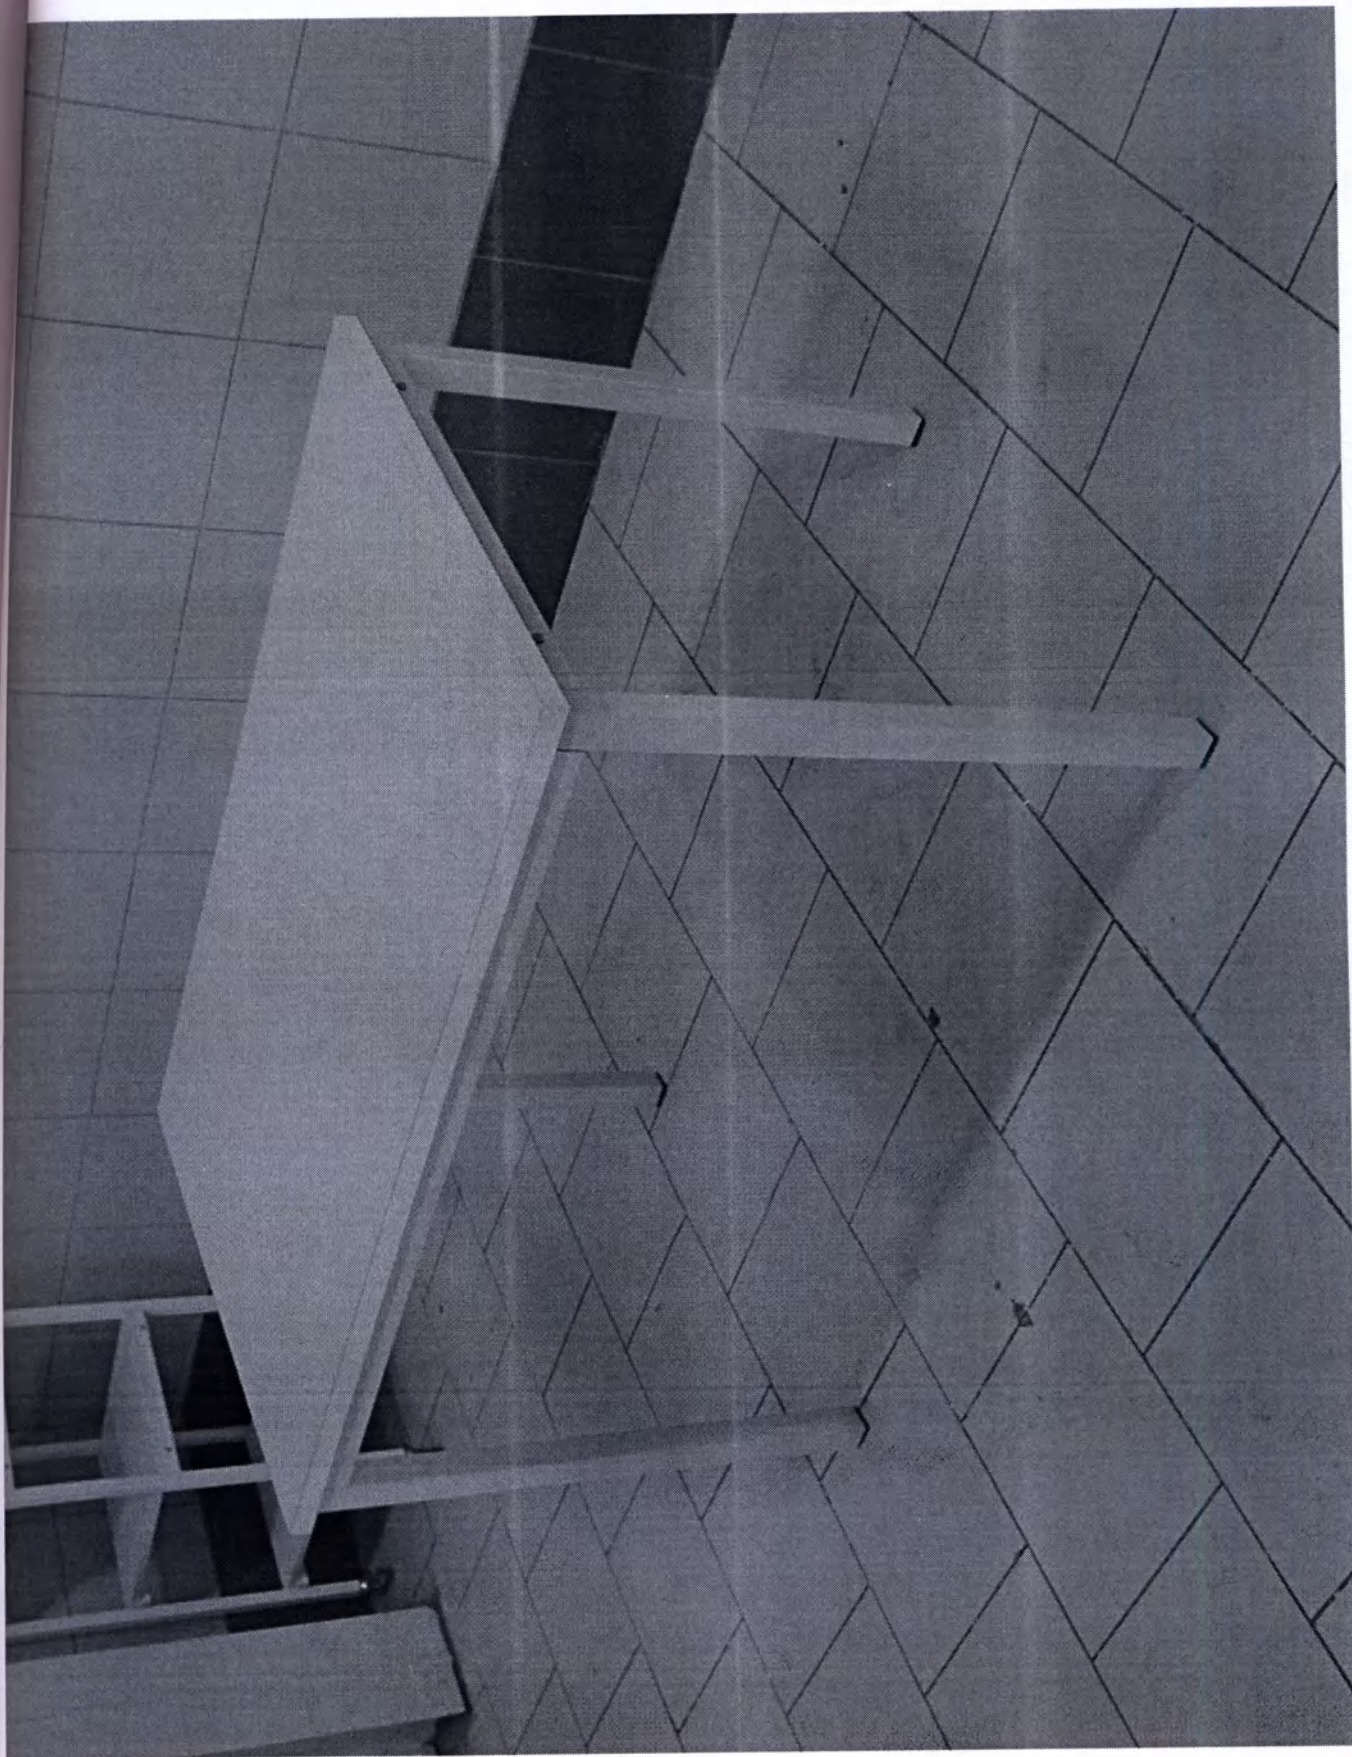


Фото 29 - Стол медицинский С-402

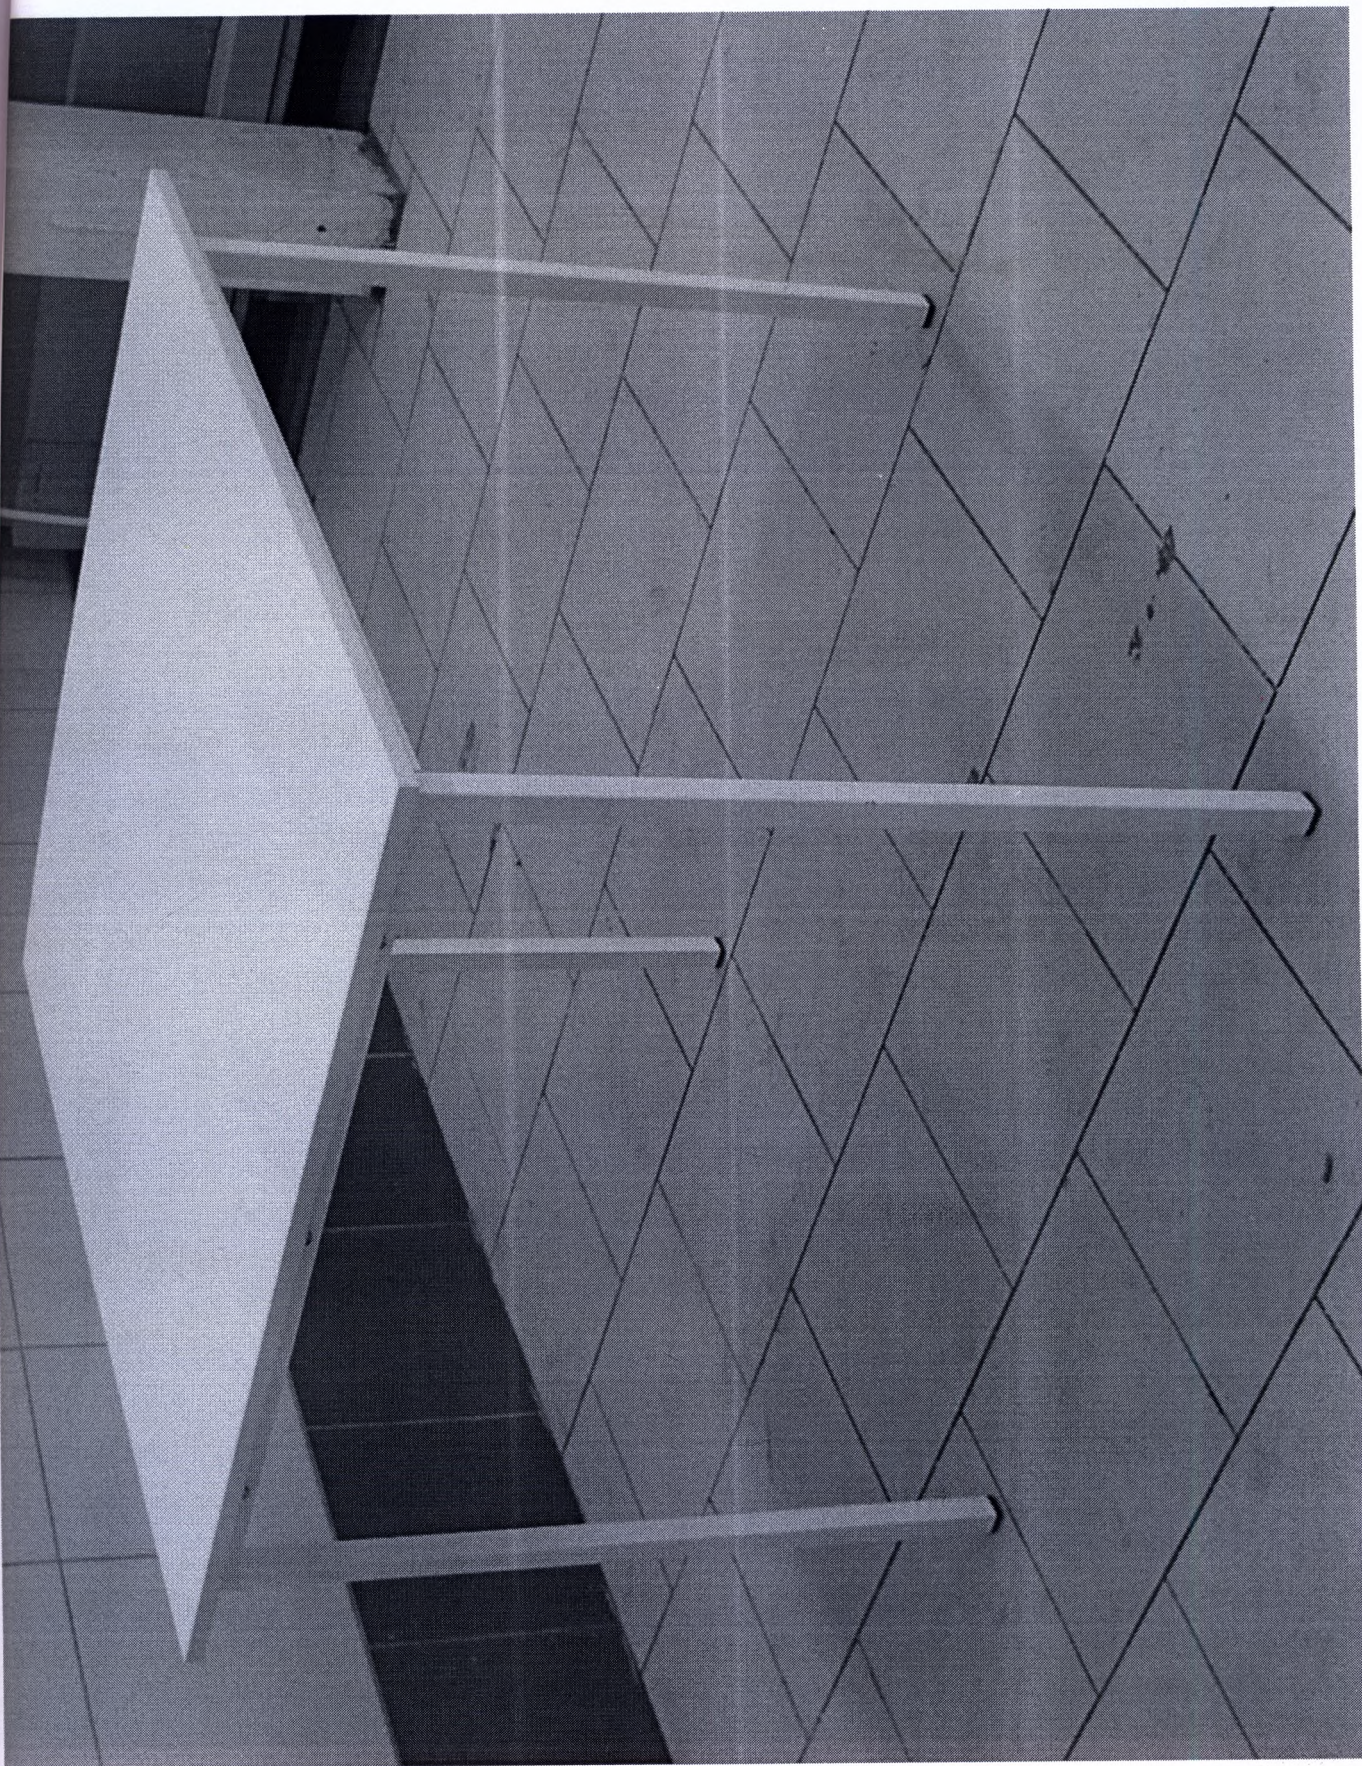


Фото 30 - Стол медицинский С-403



Фото 31 - Стол медицинский С-404

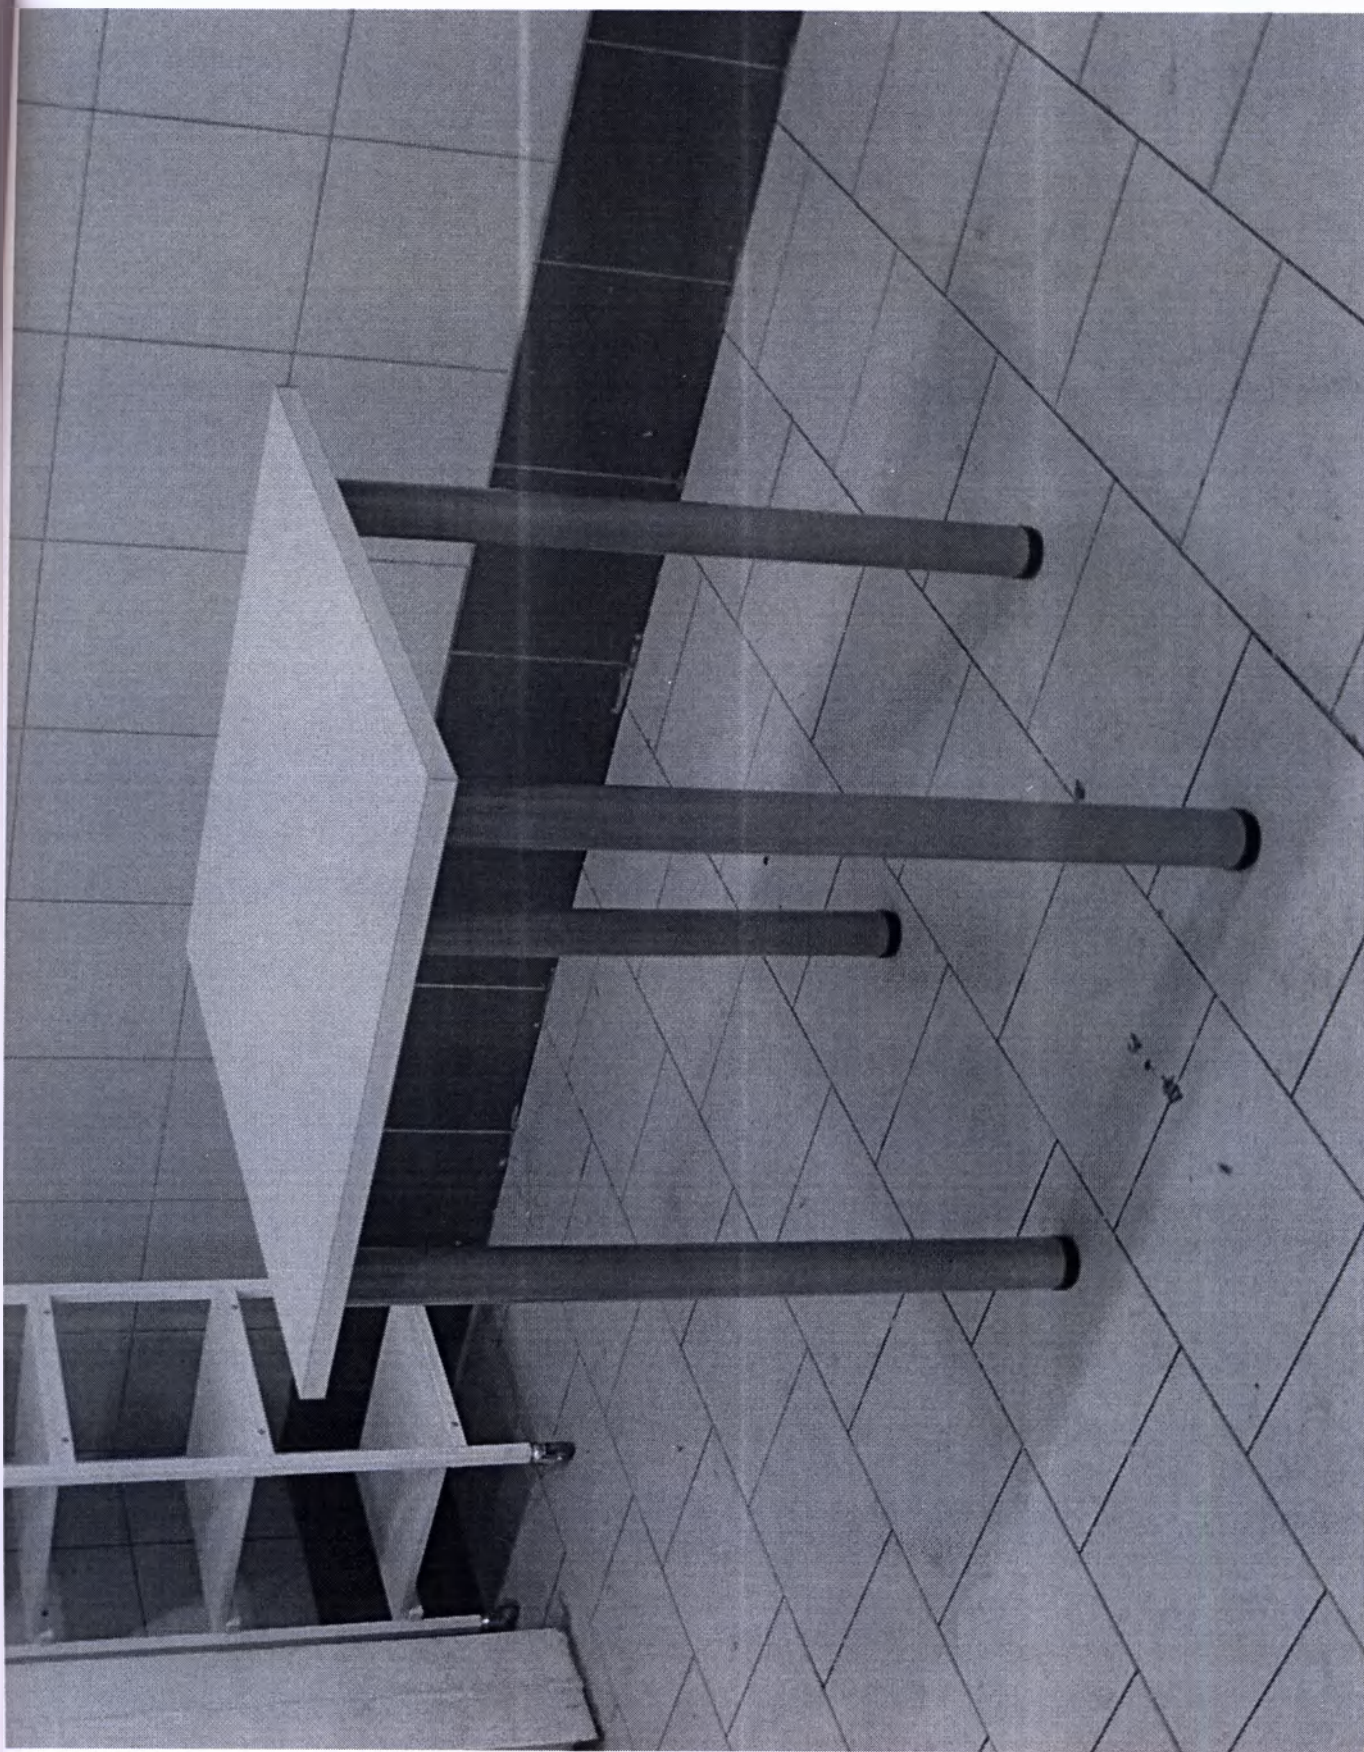


Фото 32 - Стол медицинский С-405

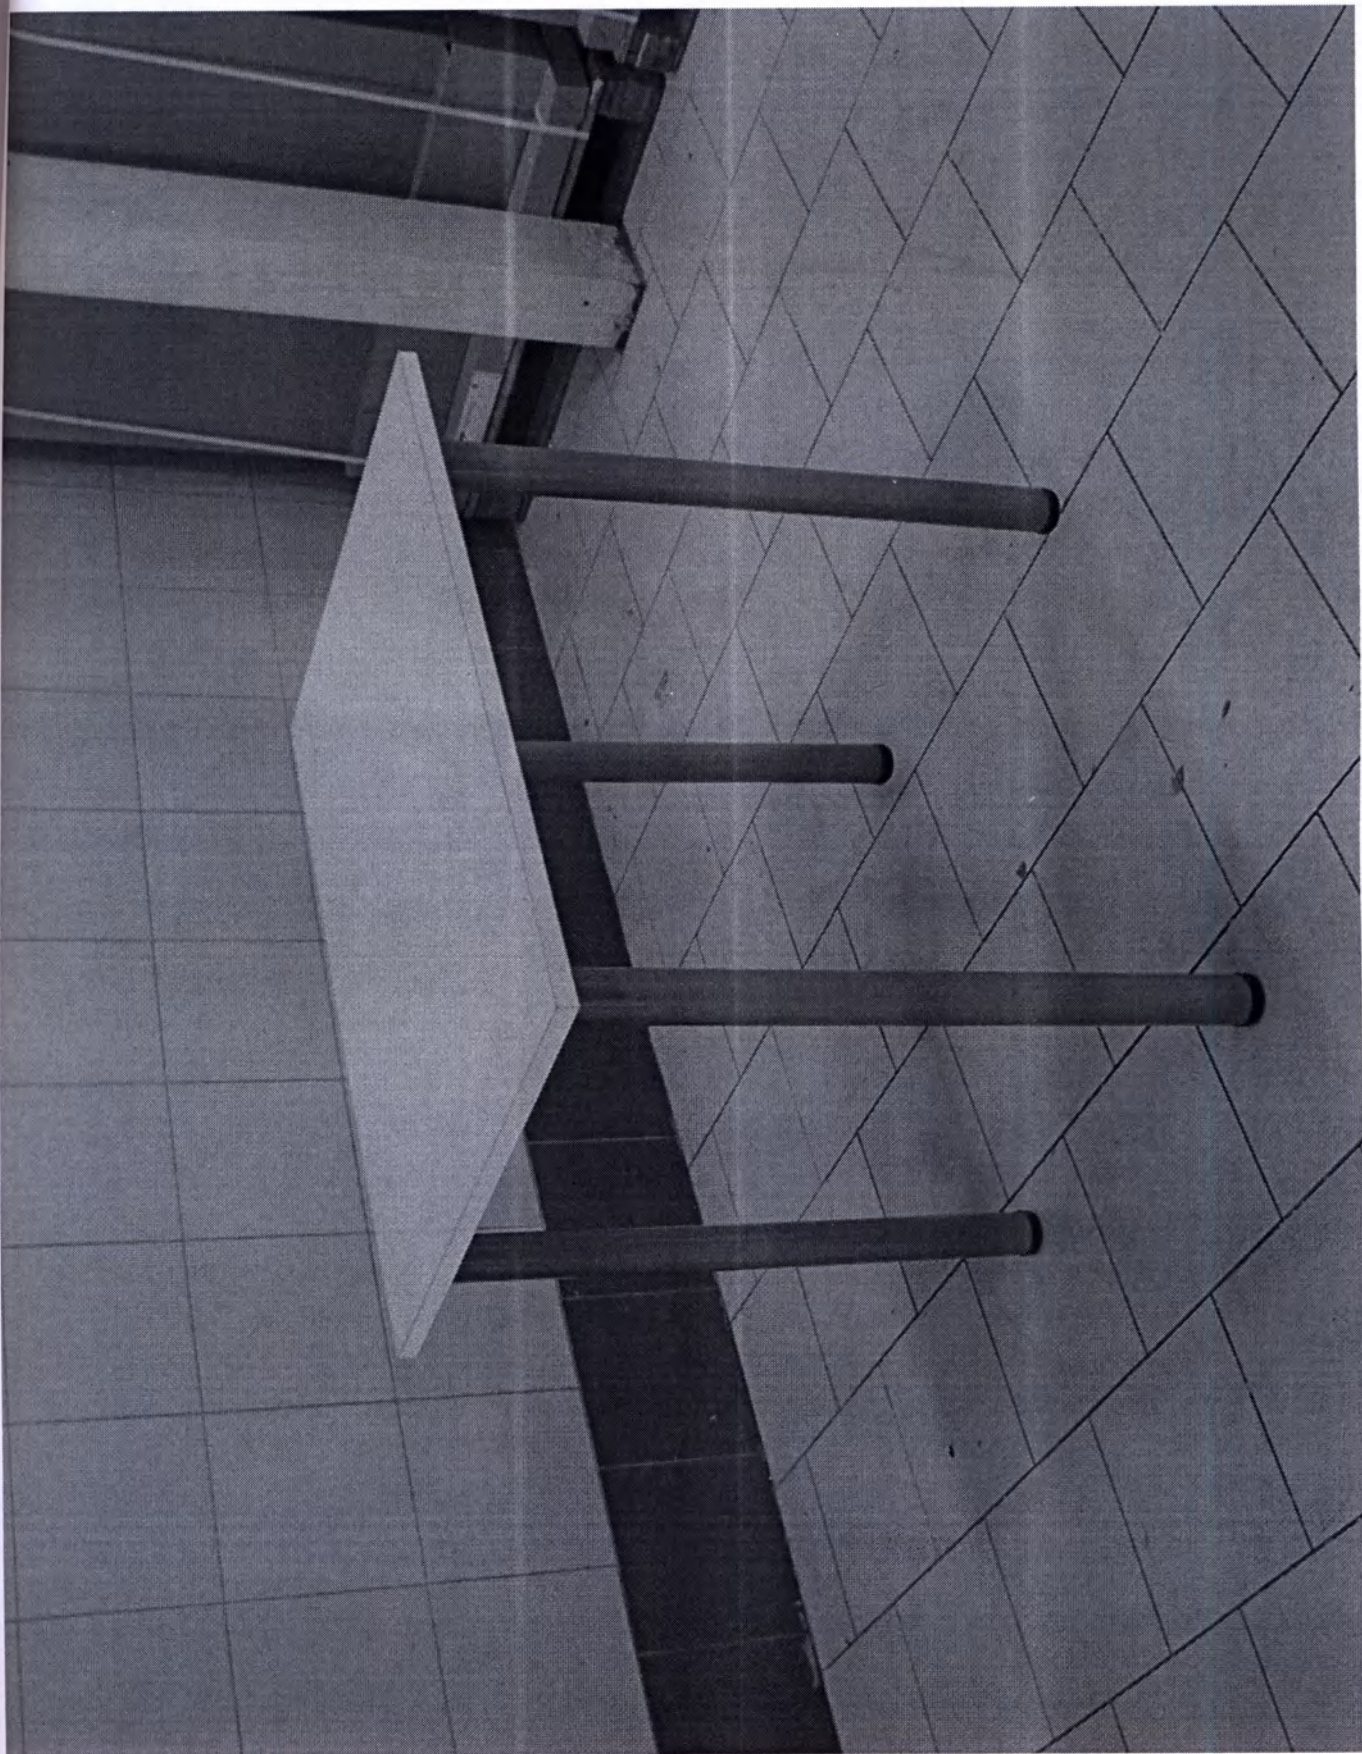


Фото 33 - Стол медицинский С-406



Фото 34 - Стол медицинский С-601



Фото 35 - Стол медицинский С-602



Фото 36 - Стол медицинский С-701



Фото 37 - Стол медицинский С-702



Фото 38 - Стол медицинский С-703



Фото 39 - Стол медицинский С-704

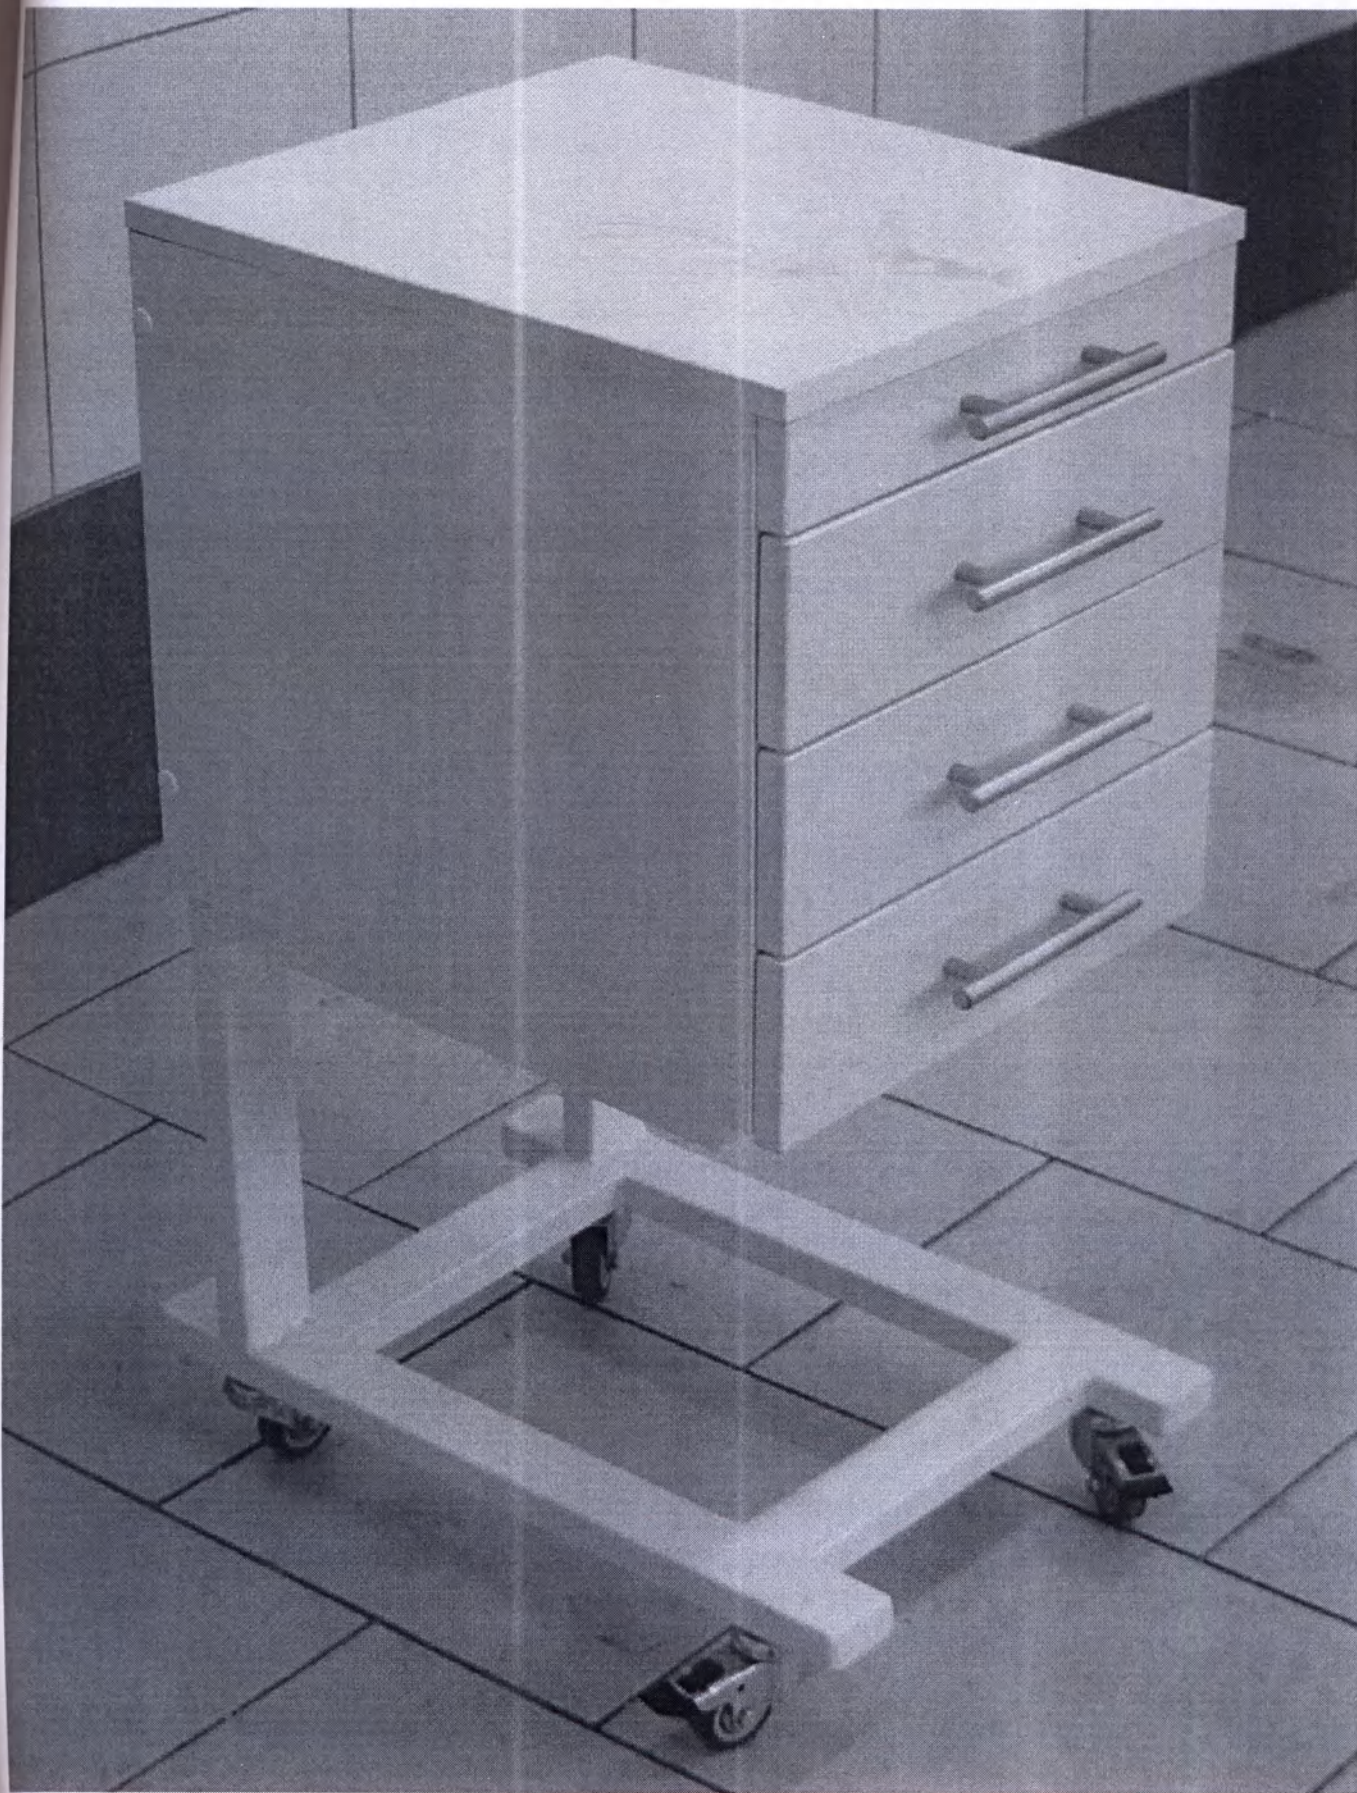


Фото 40 - Стол медицинский С-705

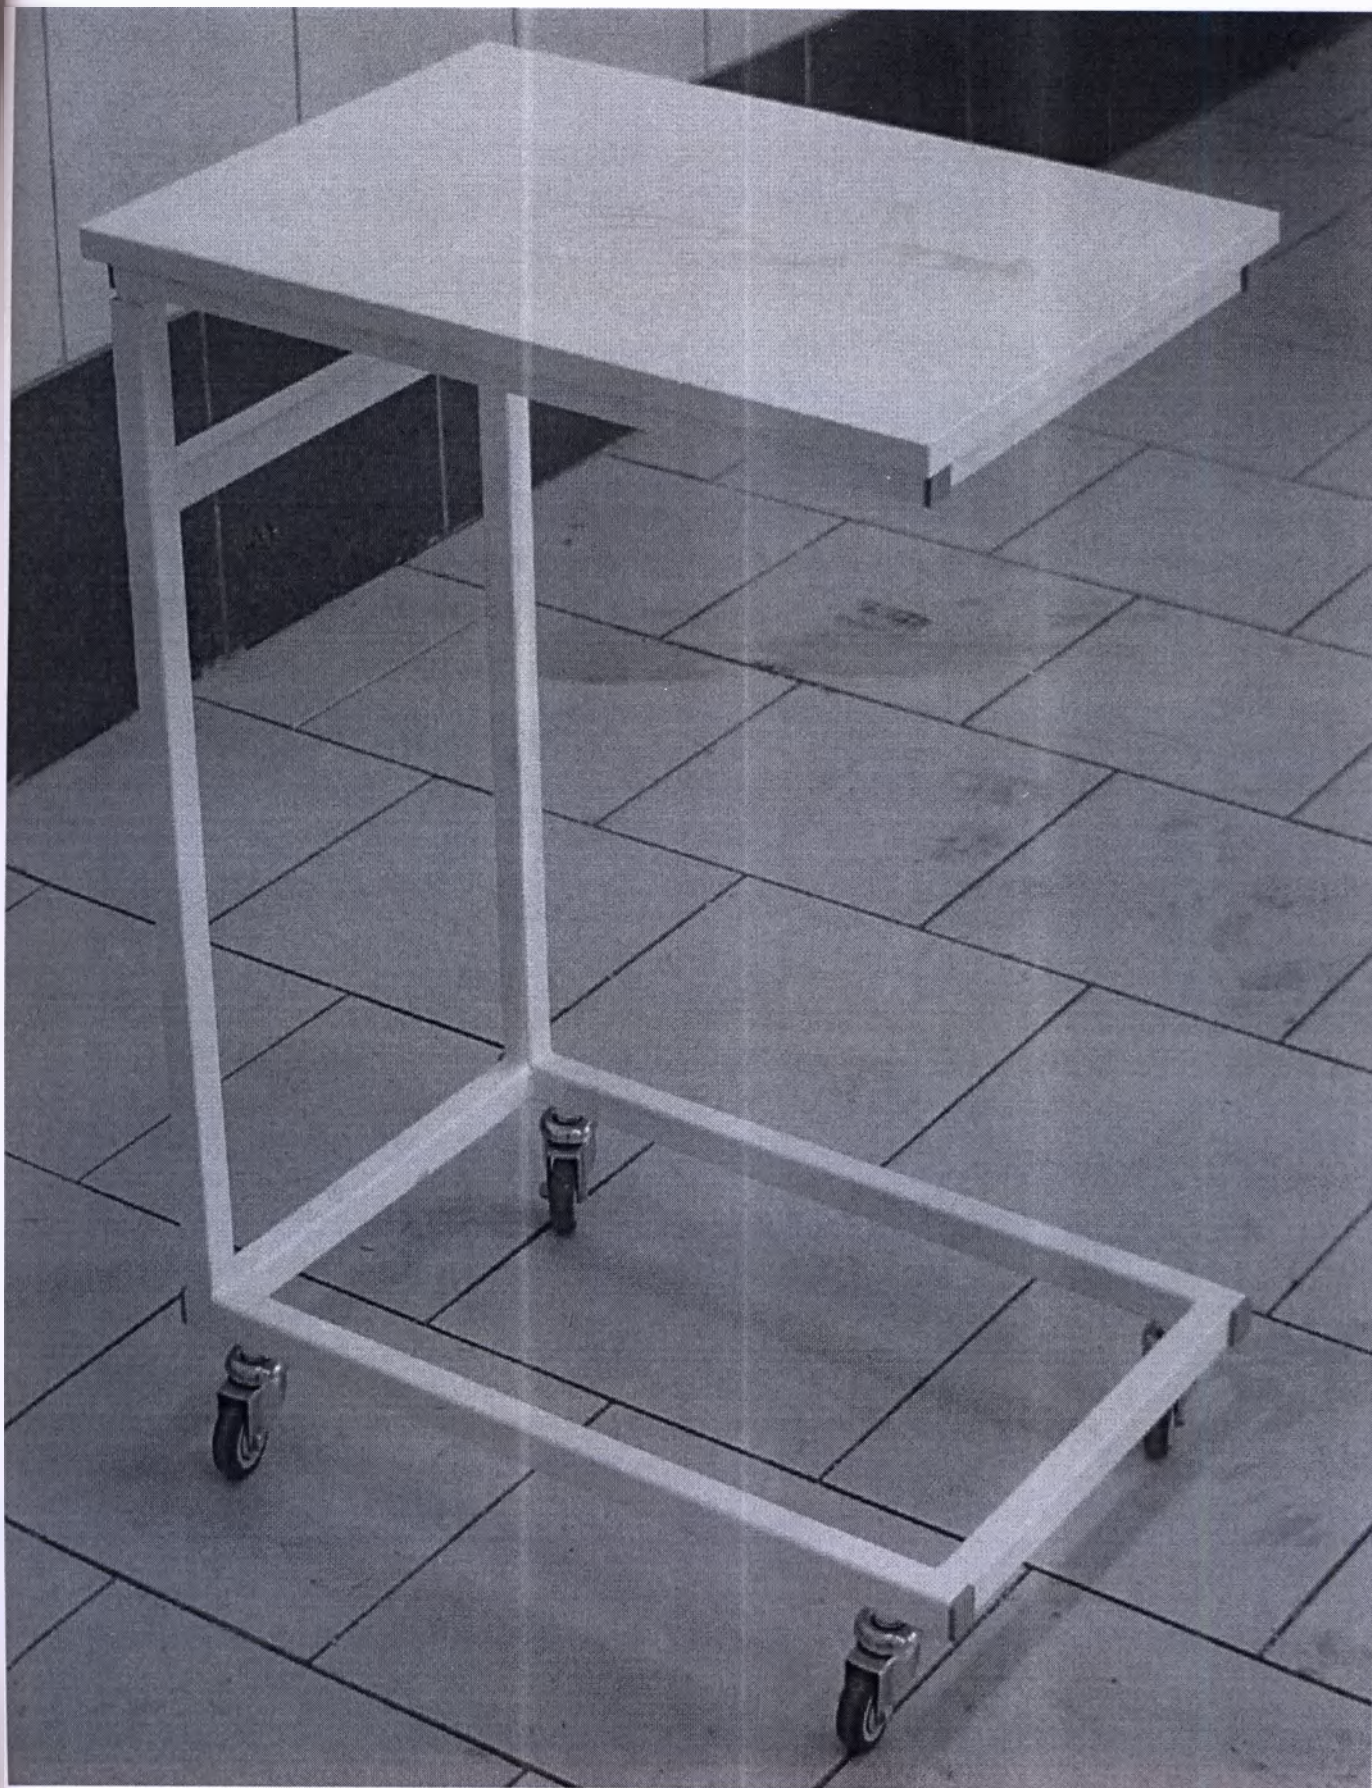


Фото 41 - Стол медицинский С-801

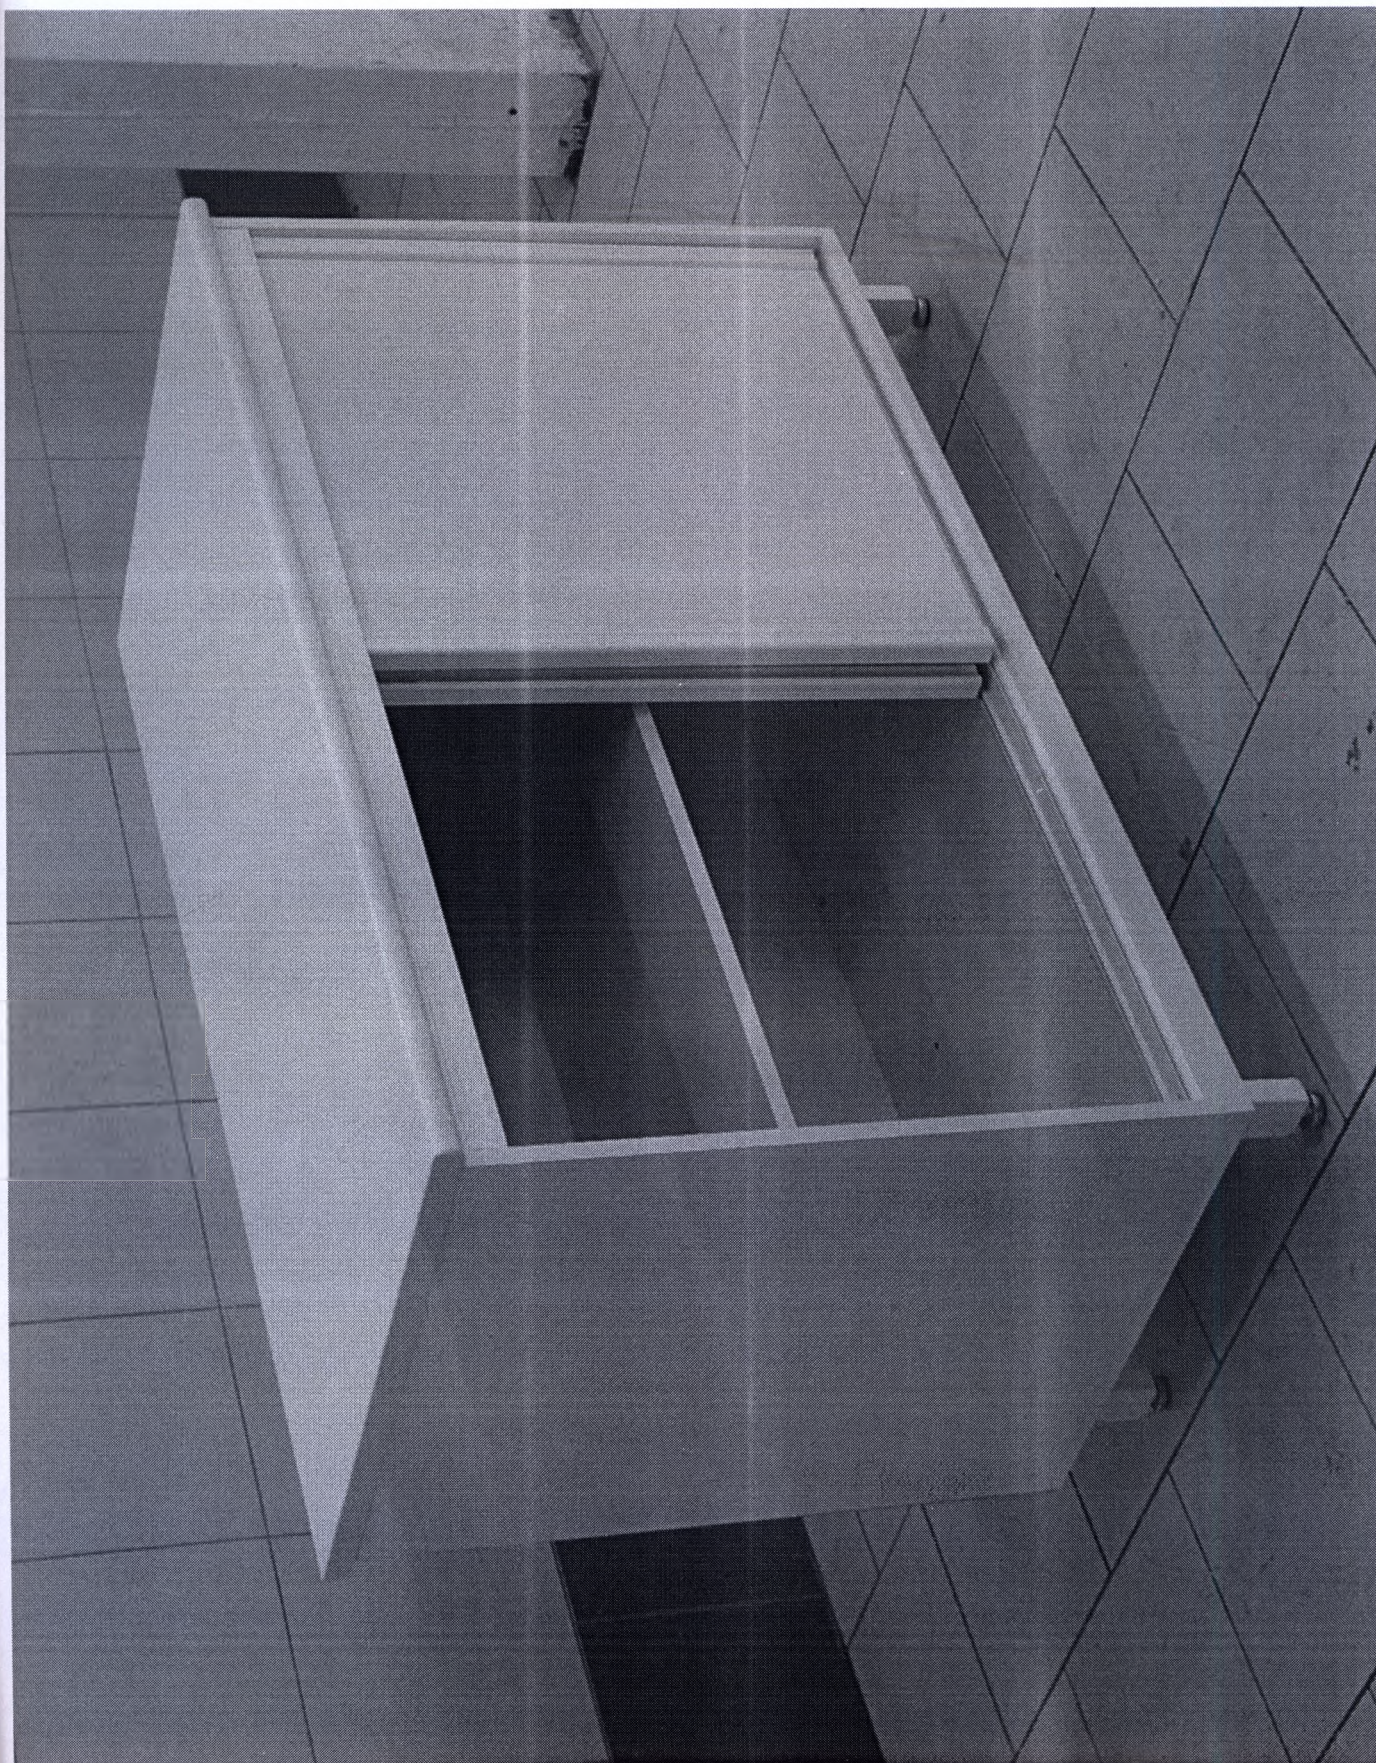


Фото 42 - Стол медицинский С-901

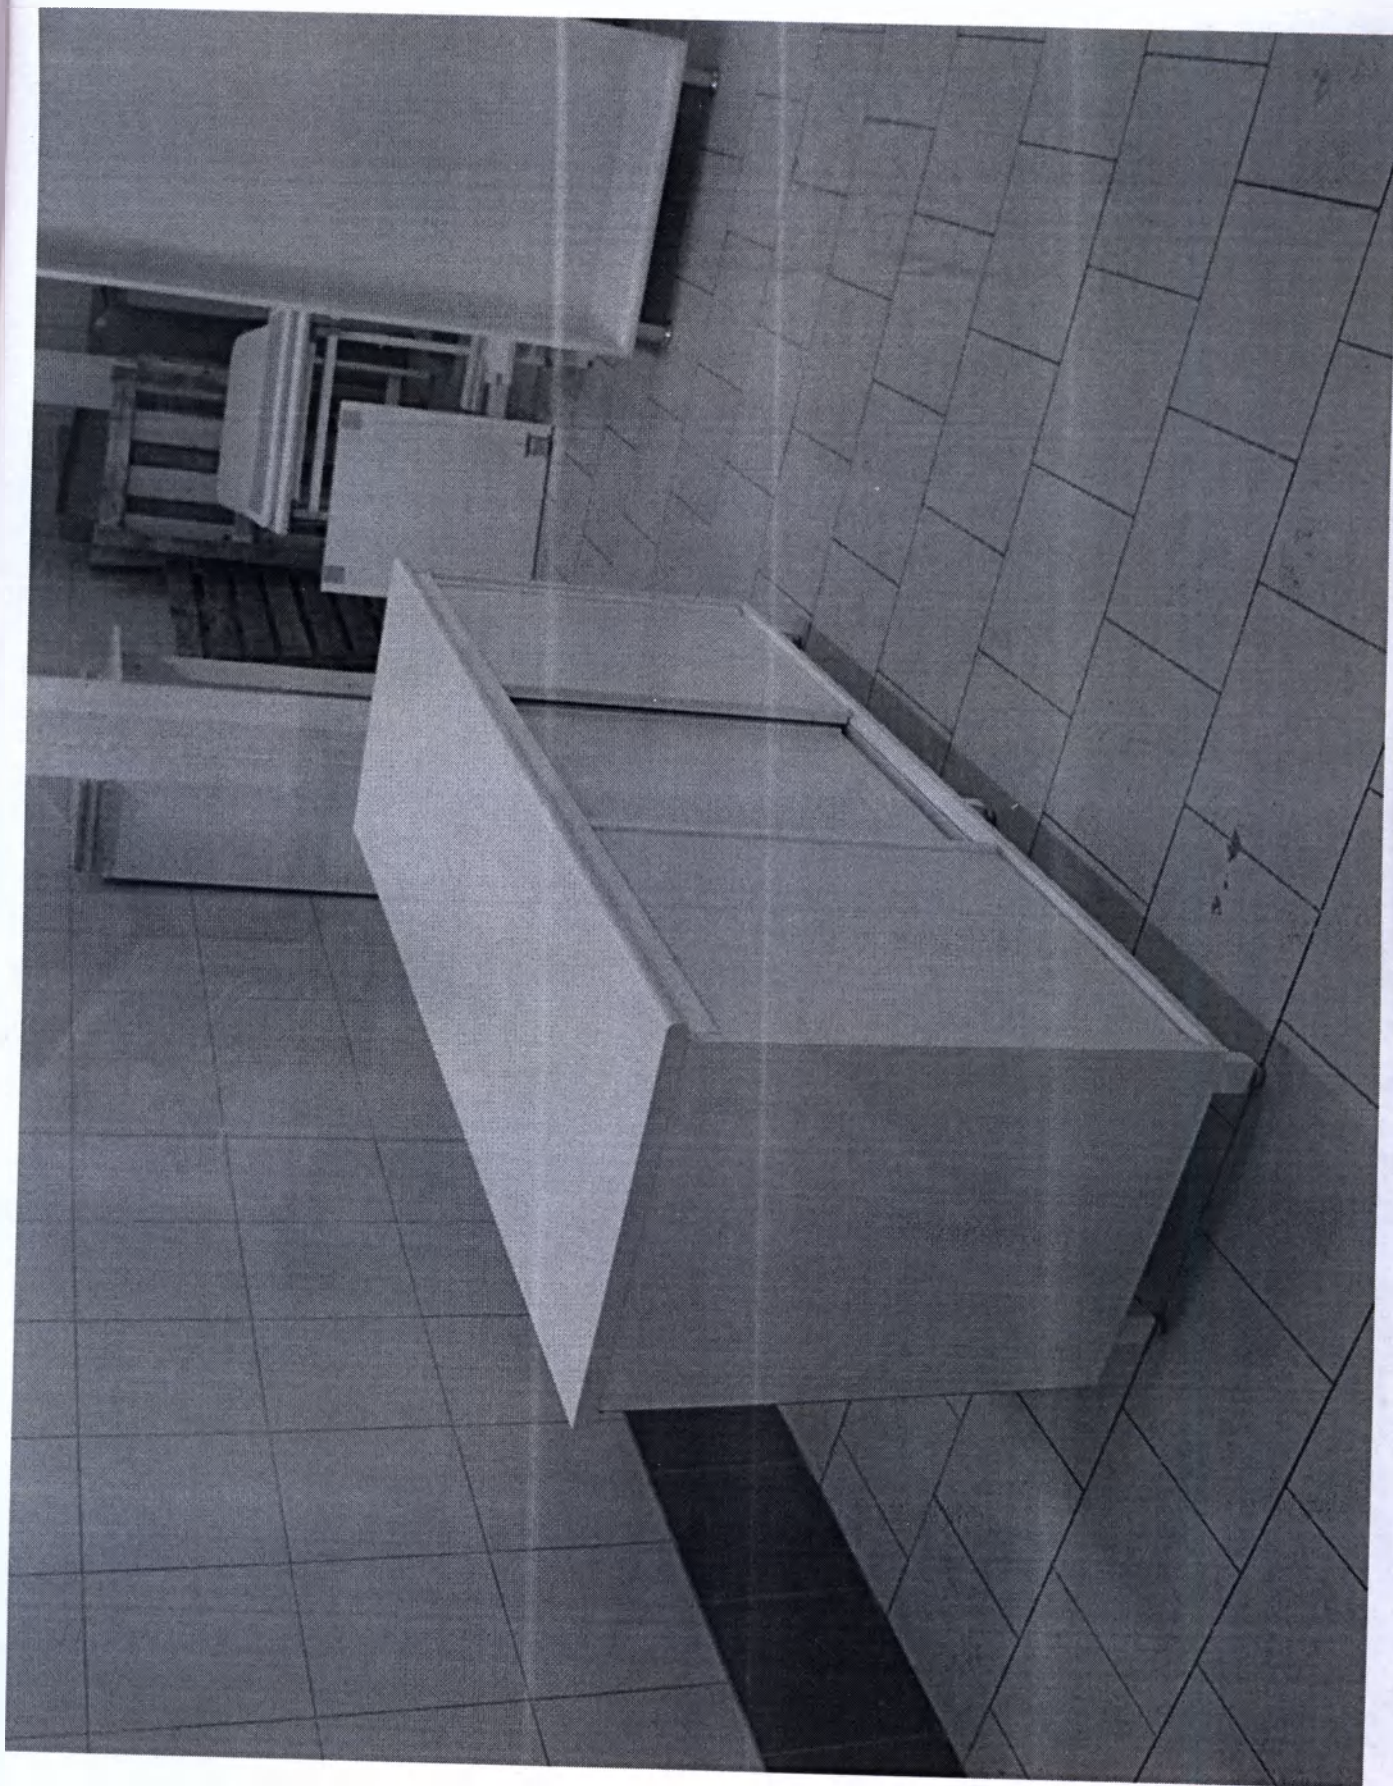


Фото 43 - Стол медицинский С-902

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

(сорок четыре) листов
цифрами прописью

Должность Директор


Подпись И.И. Иванов /

20 ____ г. М. П.

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ООО «ИНТЕРОН»

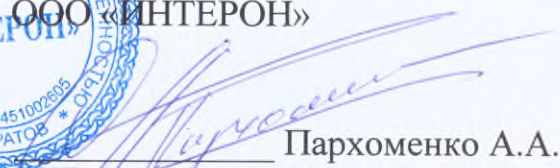
Пархоменко А.А.
«11» апреля 2019 г.

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия

«Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 в вариантах исполнения»

производства ООО «ИНТЕРОН», Россия

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	Вариант исполнения С-101 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 25.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	Вариант исполнения С-102 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 25.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	Вариант исполнения С-103 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 25.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	Вариант исполнения С-104 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 000000001		
Дата выпуска 25.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-105	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-106	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-107	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-108	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 05.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

10015, г.Саратов п. Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-109 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 10015, г.Саратов п. Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-201 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 10015, г.Саратов п. Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-202 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 10015, г.Саратов п. Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-203 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
дата выпуска 05.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

10015, г.Саратов Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-204 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 0000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом состоянии, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 10015, г.Саратов Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-205 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 0000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом состоянии, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 10015, г.Саратов Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-206 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 0000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом состоянии, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 10015, г.Саратов Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-207 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 05.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом состоянии, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-208	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
	Серийный номер 00000001 Дата выпуска 05.01.2018 г.	Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-209	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
	Серийный номер 00000001 Дата выпуска 05.01.2018 г.	Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-301	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
	Серийный номер 00000001 Дата выпуска 05.01.2018 г.	Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-302	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
	Серийный номер 00000001 Дата выпуска 05.01.2018 г.	Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

400015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-303	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 400015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-304	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 0000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 400015, г.Саратов Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-305	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001	Дата выпуска 01.2018 г.	ШТАМП ОТК
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		

Юридический адрес: 400015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-306 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 000000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 05.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-307	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 05.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-308	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 05.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-309	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 00000001		
Дата выпуска 05.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул.Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-401	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Серийный номер 000000001		
Дата выпуска 05.01.2018 г.		
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 440015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-402 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 440015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-403 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 440015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-404 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 05.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 440015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-405 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 000000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 25.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-406 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 25.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-601 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 25.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-602 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 25.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-701 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 25.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-702 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 15.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-703 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 15.01.2018 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-704 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.03.2017 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения С-705 ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001		Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.03.2017 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения C-801	ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 00000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.03.2017 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения C-901	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 000000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.03.2017 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Юридический адрес: 410015, г.Саратов ул. Орджоникидзе 6 А Тел./Факс 8 (8452)90-80-80	Столы медицинские по ТУ 32.50.30-001-24933245-2018 Вариант исполнения C-902	Изготовитель : ООО "ИНТЕРОН" Изготовлено в Российской Федерации
Серийный номер 000000001	ТУ 32.50.30-001-24933245-2018	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____
Дата выпуска 01.03.2017 г.		Порядок применения, гарантия изготовителя : см. инструкцию по эксплуатации.
Хранить и транспортировать изделие в разобранном виде в чистом, сухом месте, в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С и относительной влажности 100% при 25 С. Допускается перевозка изделия любым крытым видом транспорта, при соблюдении правил транспортировки.		ШТАМП ОТК

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листа (ов).



Подпись

Сергейченко А.А.

ФИО