

УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ВольтМетрика»


Е. Ю. Артемьева

11 2019 г.




**Фотографии
медицинского изделия**

**Система обеззараживания медицинских отходов
микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018**

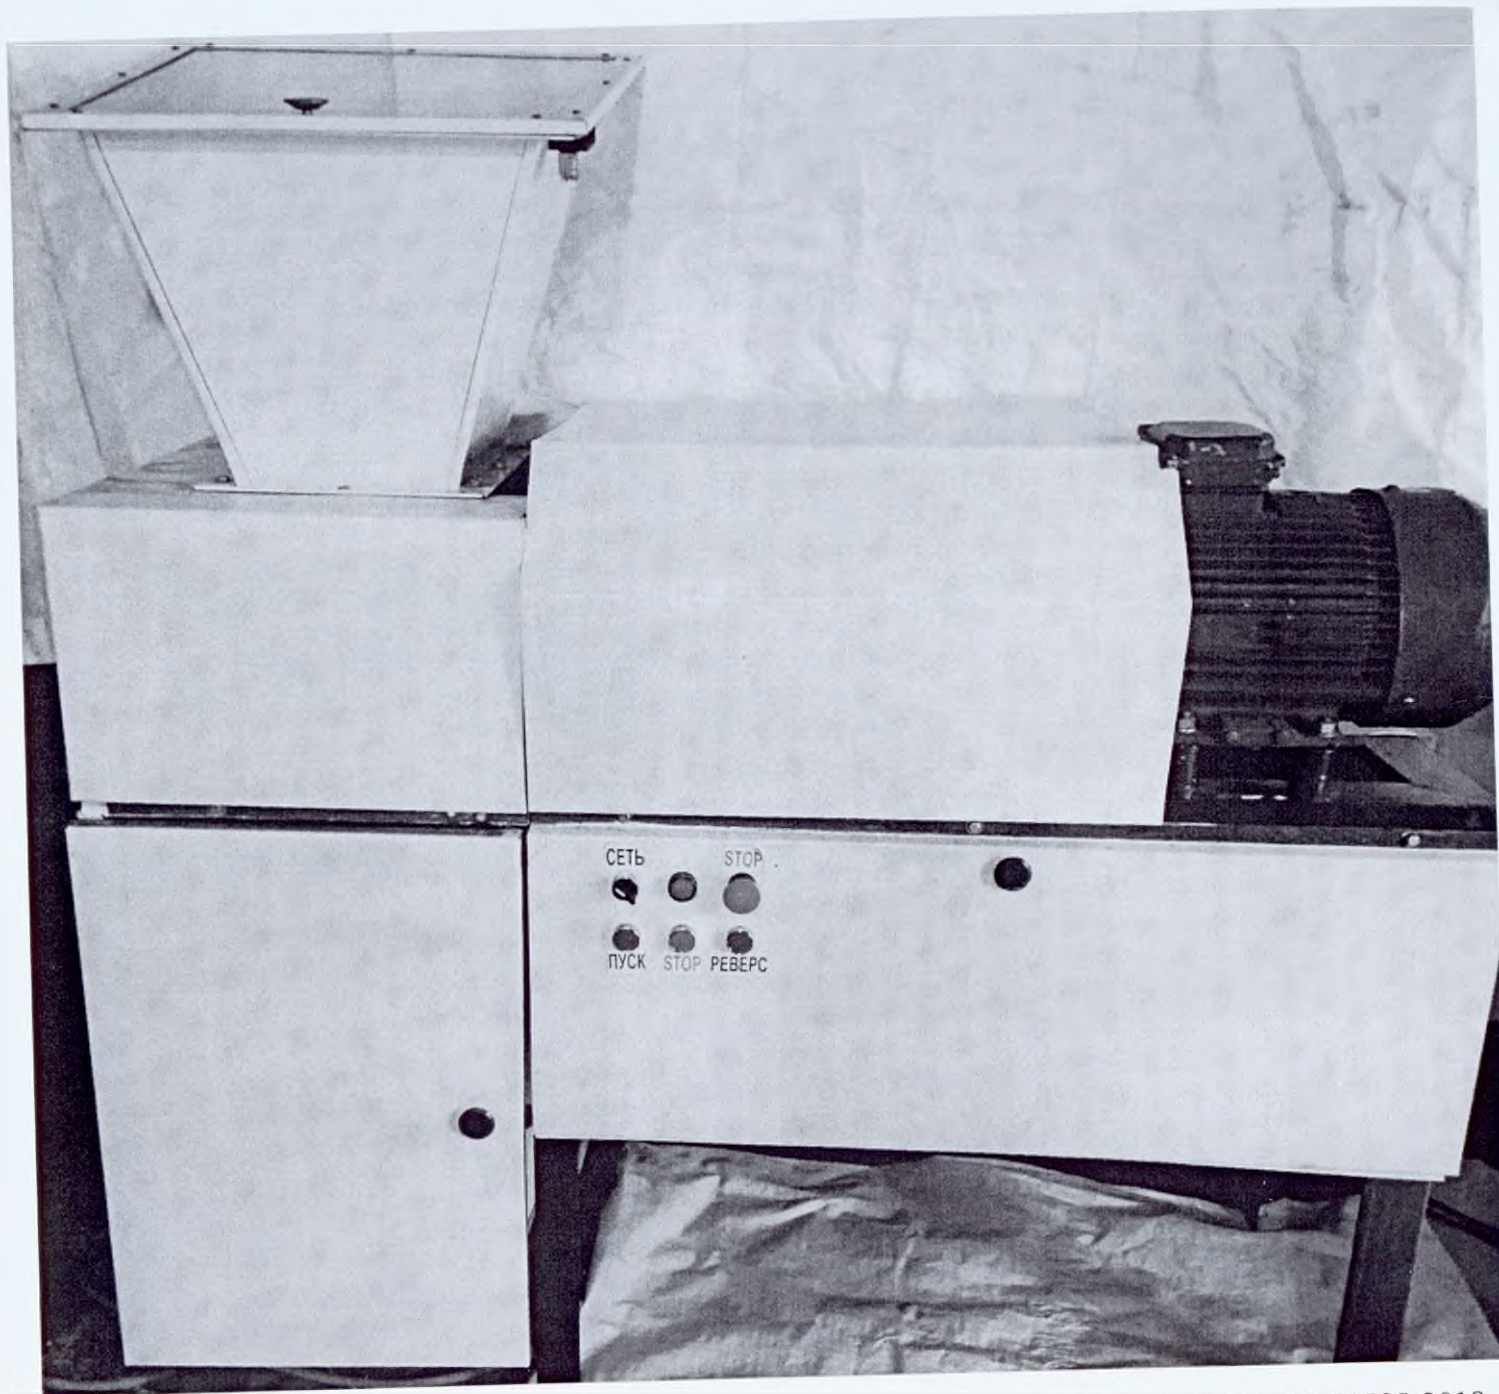


ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru заражения медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Общий вид устройства измельчения отходов

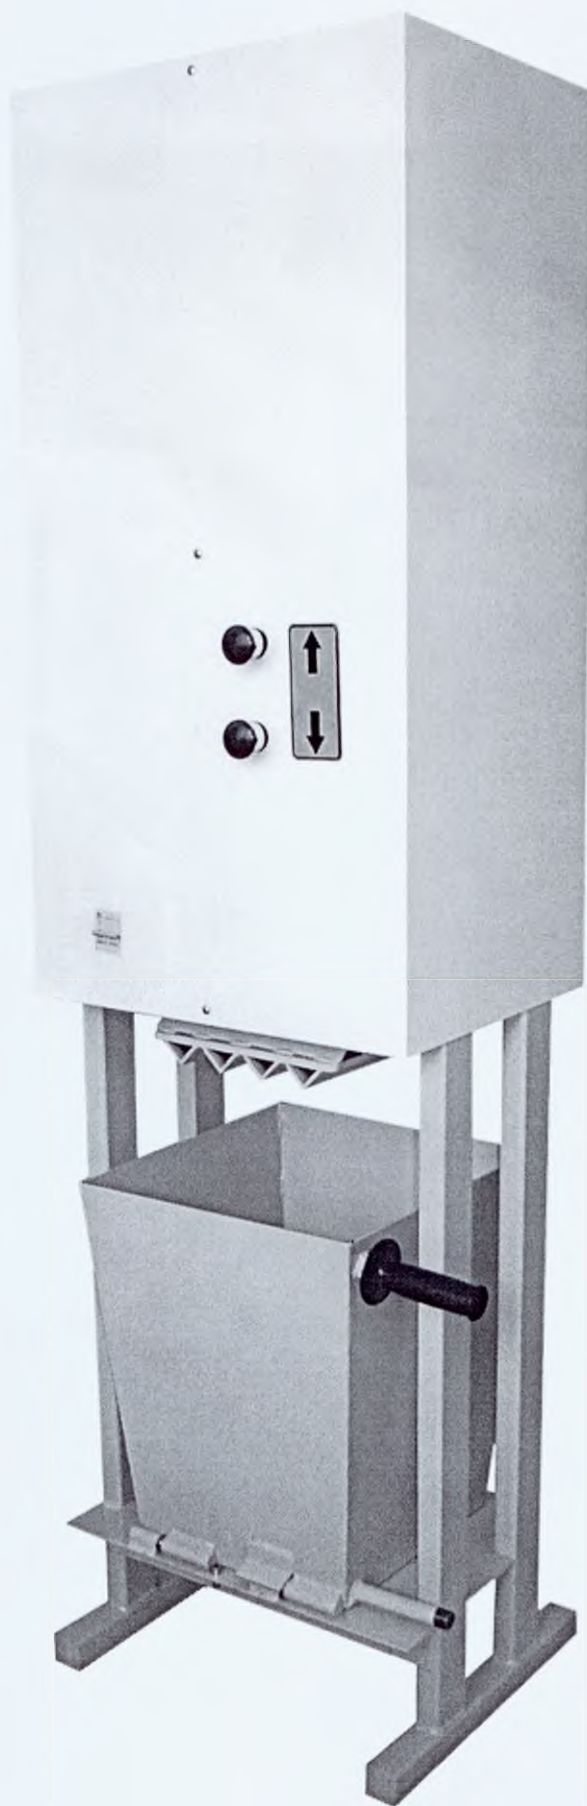

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Общий вид устройства прессования отходов




Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:

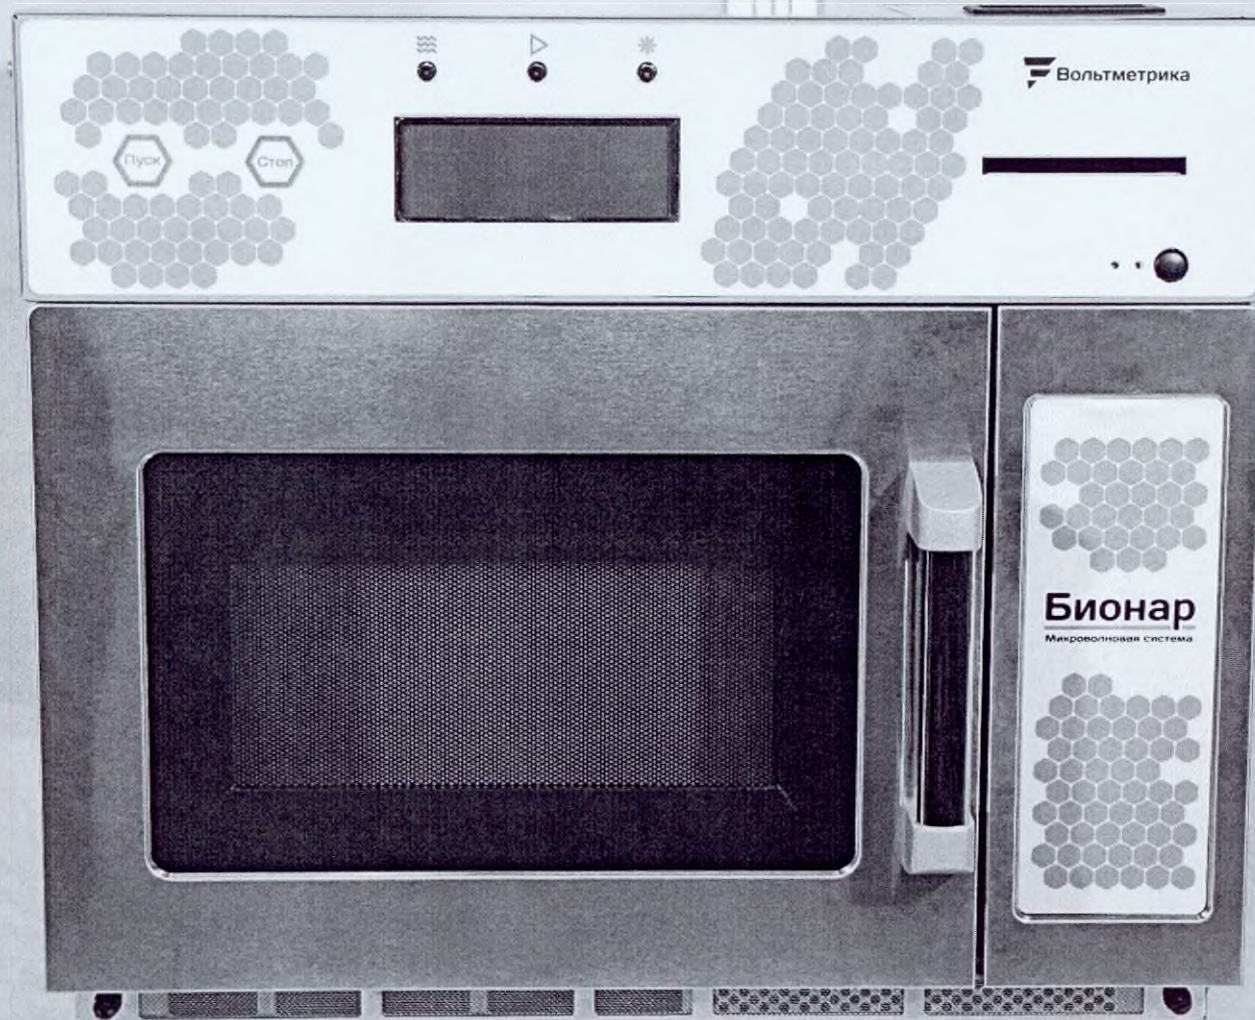


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:

Общий вид микроволновой камеры с блоком управления - Модификация 2

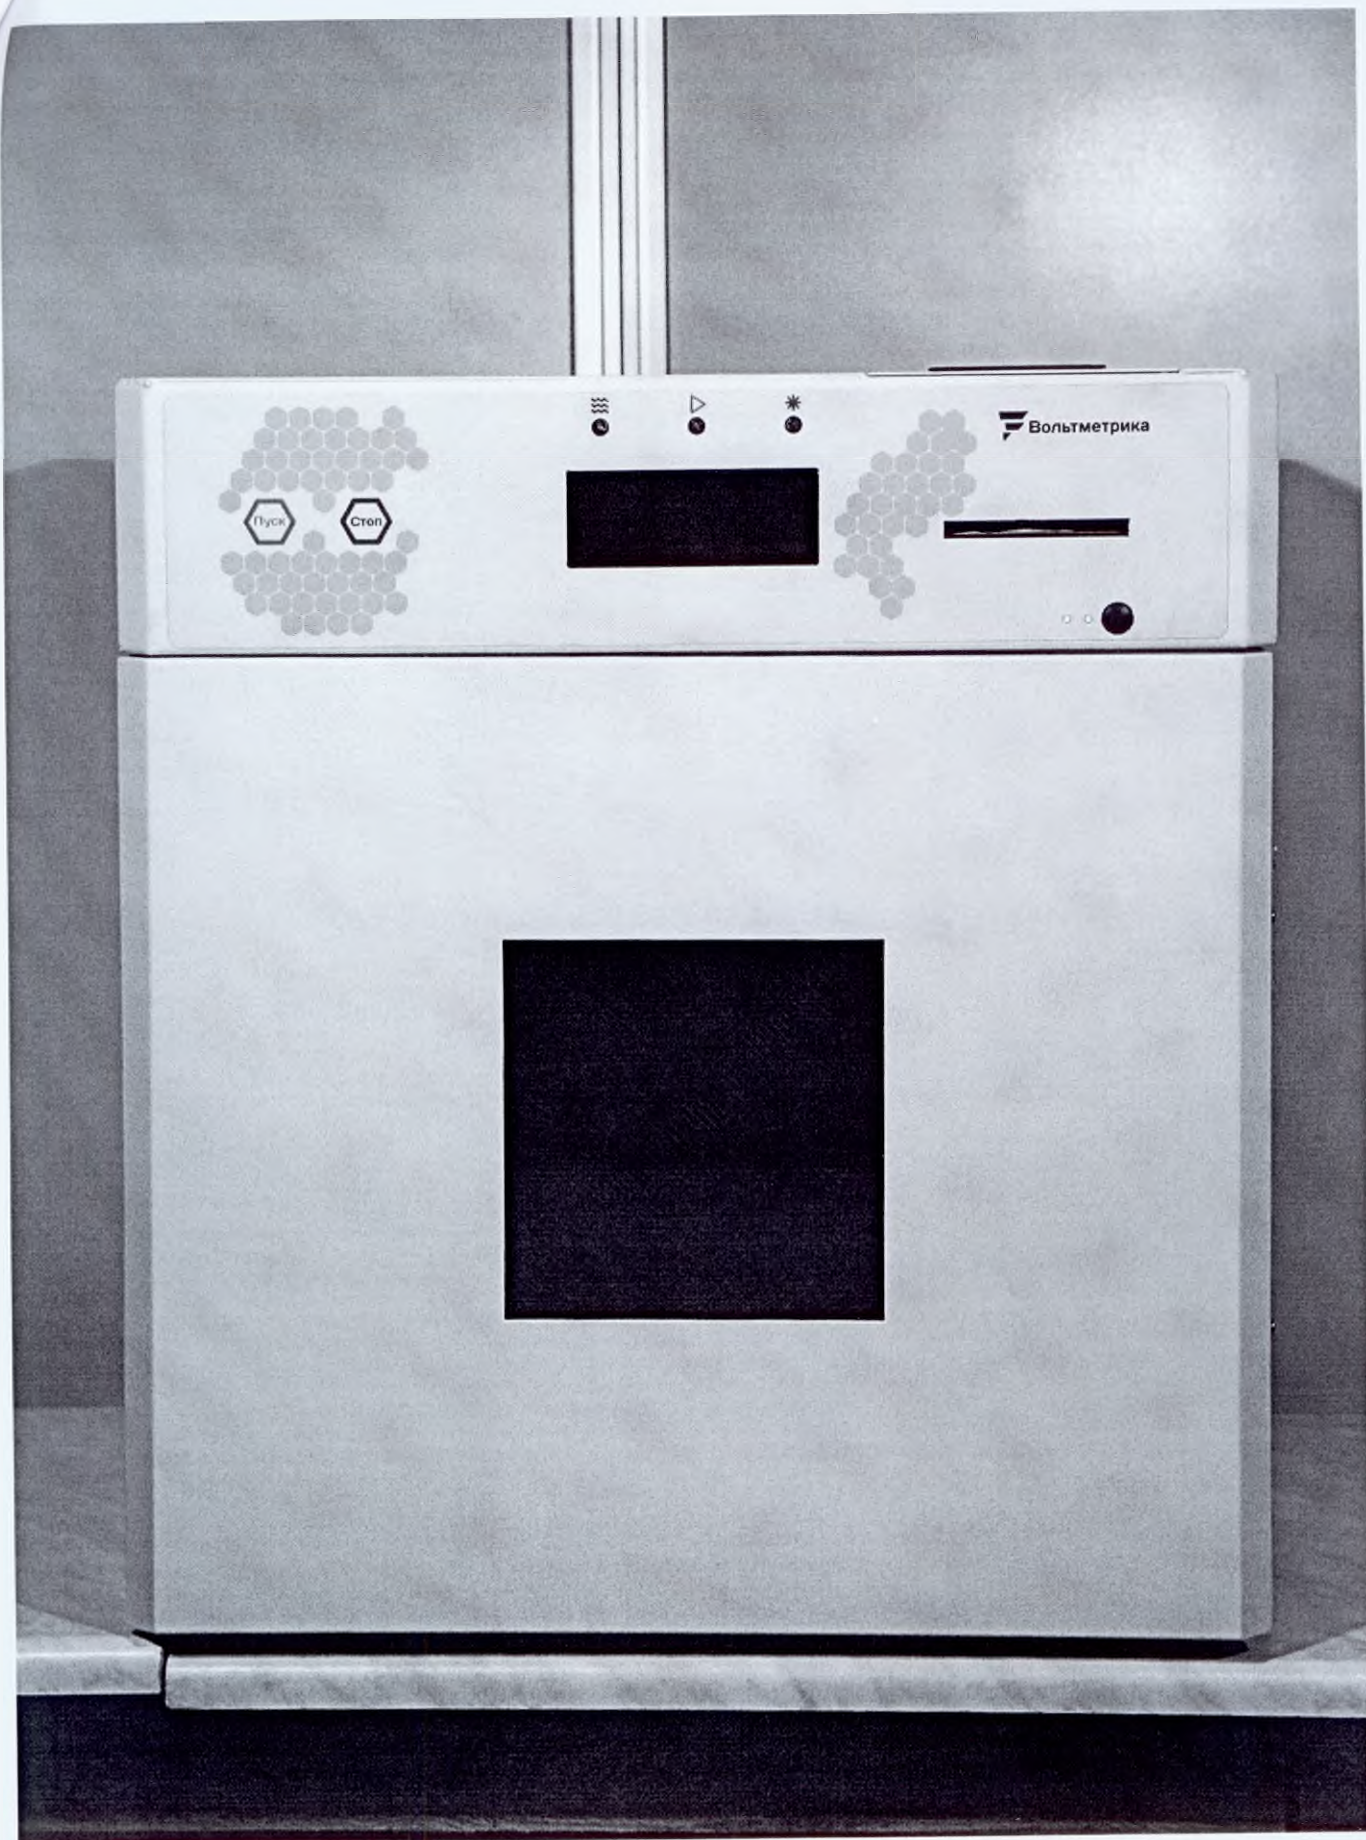

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Общий вид микроволновой камеры с блоком управления - Модификация 3

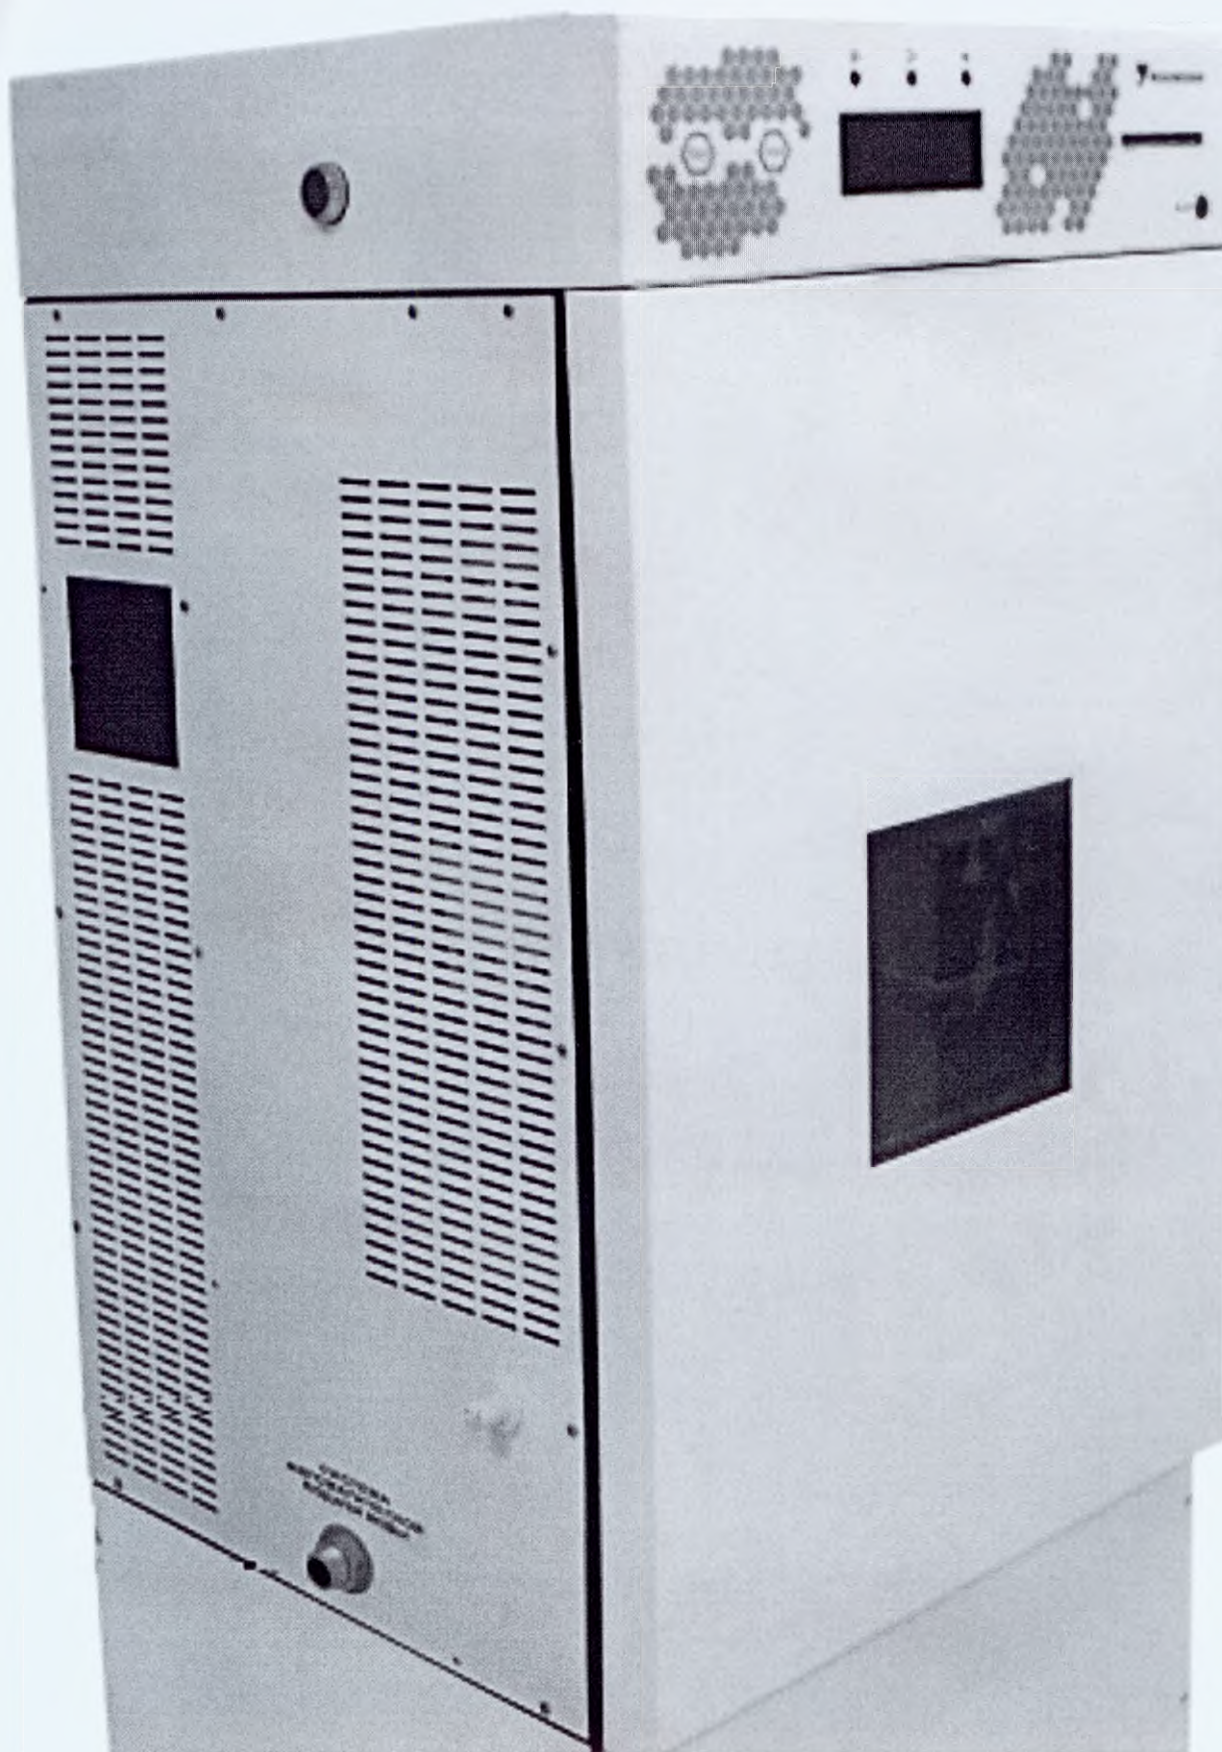

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Общий вид микроволновой камеры с блоком управления - Модификация 4

"Бионар"

Версия 1.0.

000 "Вольтметрика"

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018: Панель управления

ООО «ВольтМетрика»

**Система обеззараживания медицинских
отходов микроволновая «Бионар»**

Камера микроволновая мод. 1

Заводской номер 001

$U_{\text{пит}}$ 220 В, 50 Гц $P_{\text{потреб}}$ 1900 Вт

Дата изготовления 22.01.2018

ТУ 32.50.50-001-20851585-2018

РУ №

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Маркировка микроволновой камеры с блоком управления

ООО «ВольтМетрика»

**Система обеззараживания медицинских
отходов микроволновая «Бионар»**

Устройство прессования

Заводской номер 001

$U_{\text{пит}}$ 220 В, 50 Гц $P_{\text{потреб}}$ 3000 Вт

Дата изготовления 22.01.2018

ТУ 32.50.50-001-20851585-2018

РУ №

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018: Маркировка устройства прессования отходов

ООО «ВольтМетрика»

Система обеззараживания медицинских
отходов микроволновая «Бионар»

Устройство измельчения

Заводской номер 001


$U_{\text{пит}}$ 380 В, 50 Гц $P_{\text{потреб}}$ 5000 Вт

Дата изготовления 22.01.2018


ТУ 32.50.50-001-20851585-2018

РУ №

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018: Маркировка устройства измельчения отходов

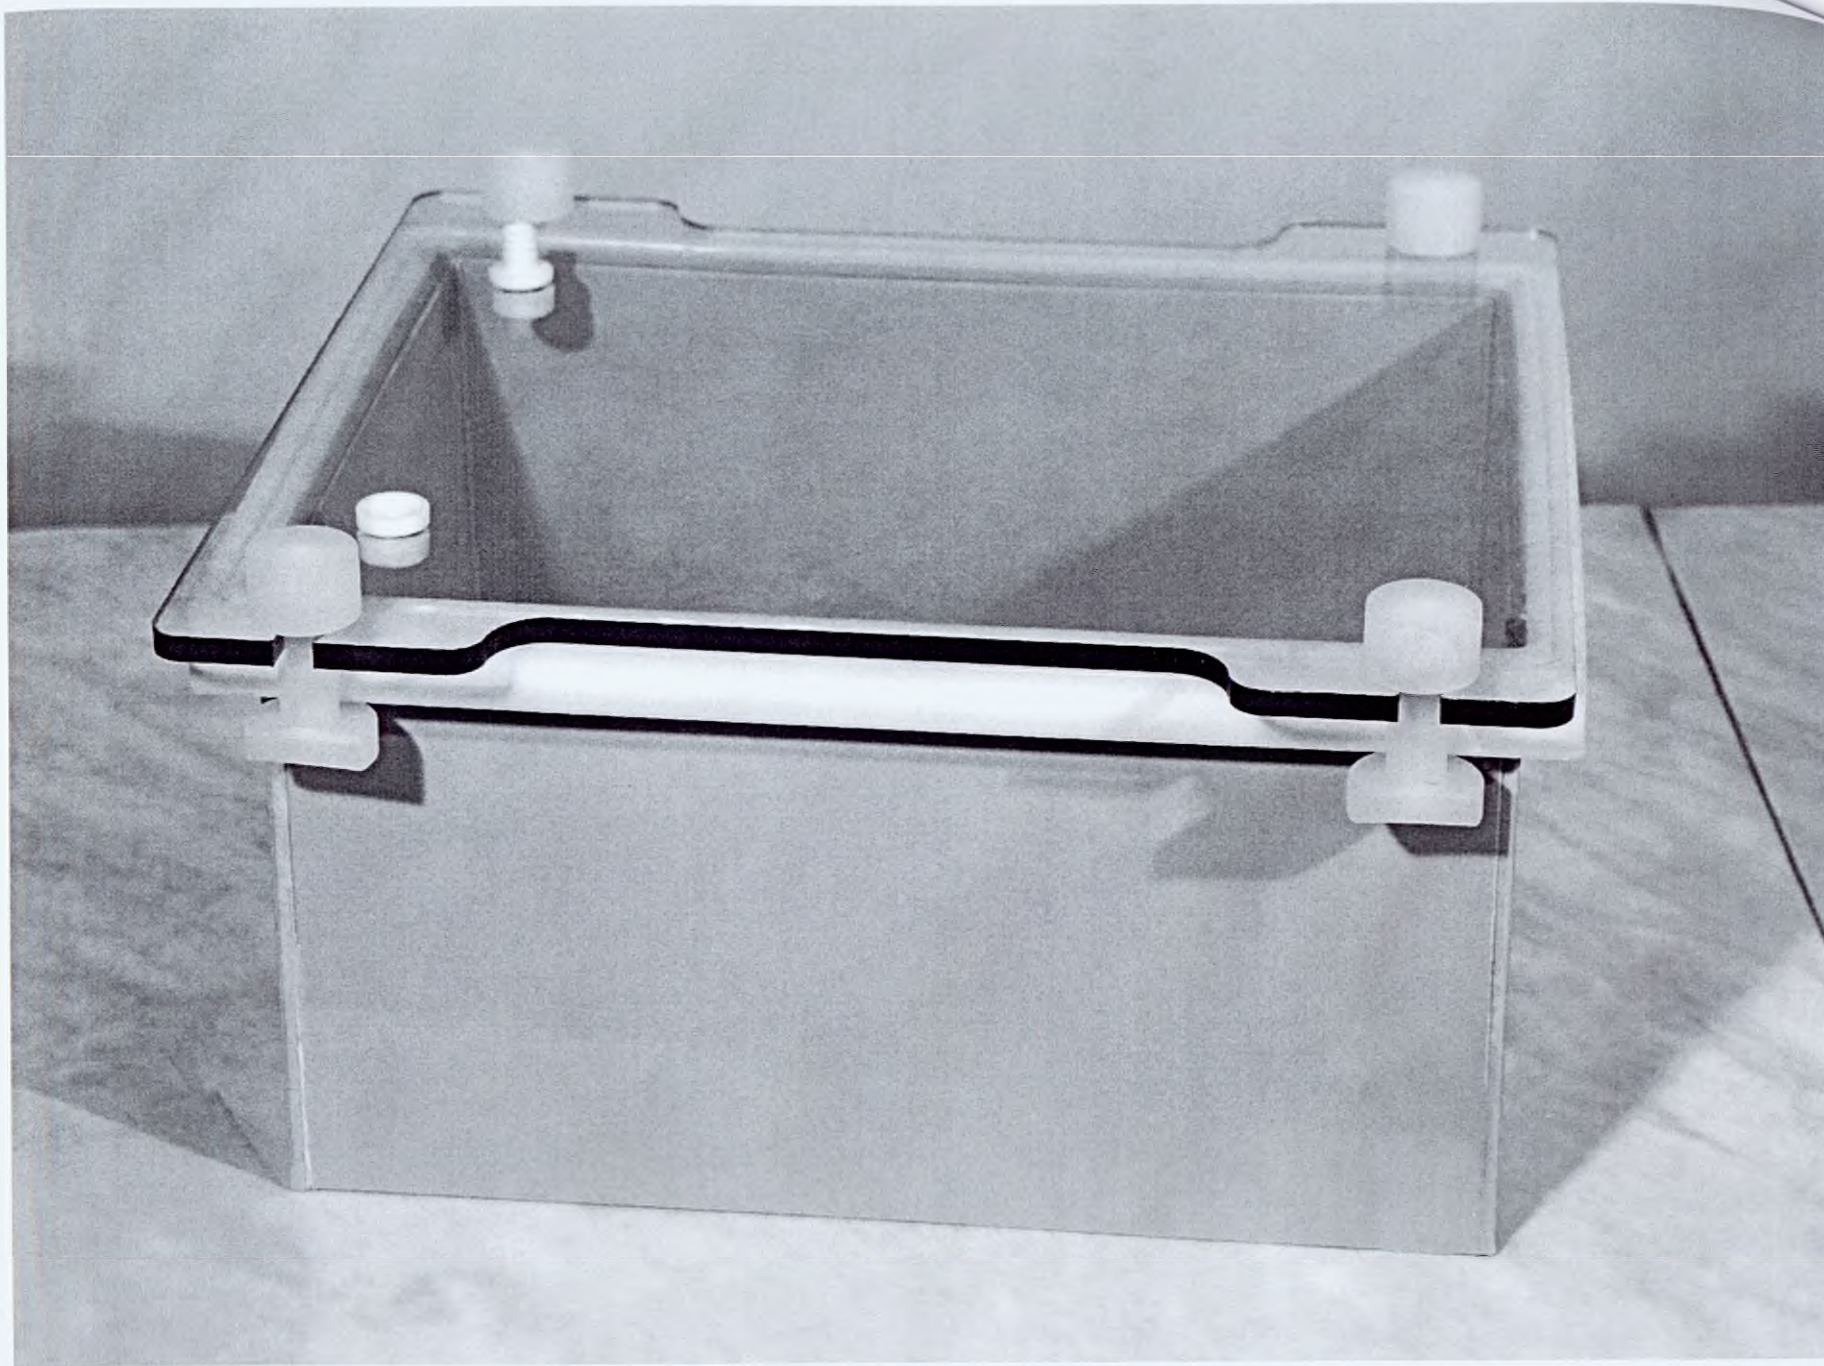


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Контейнер для обеззараживания - объем 4 литра

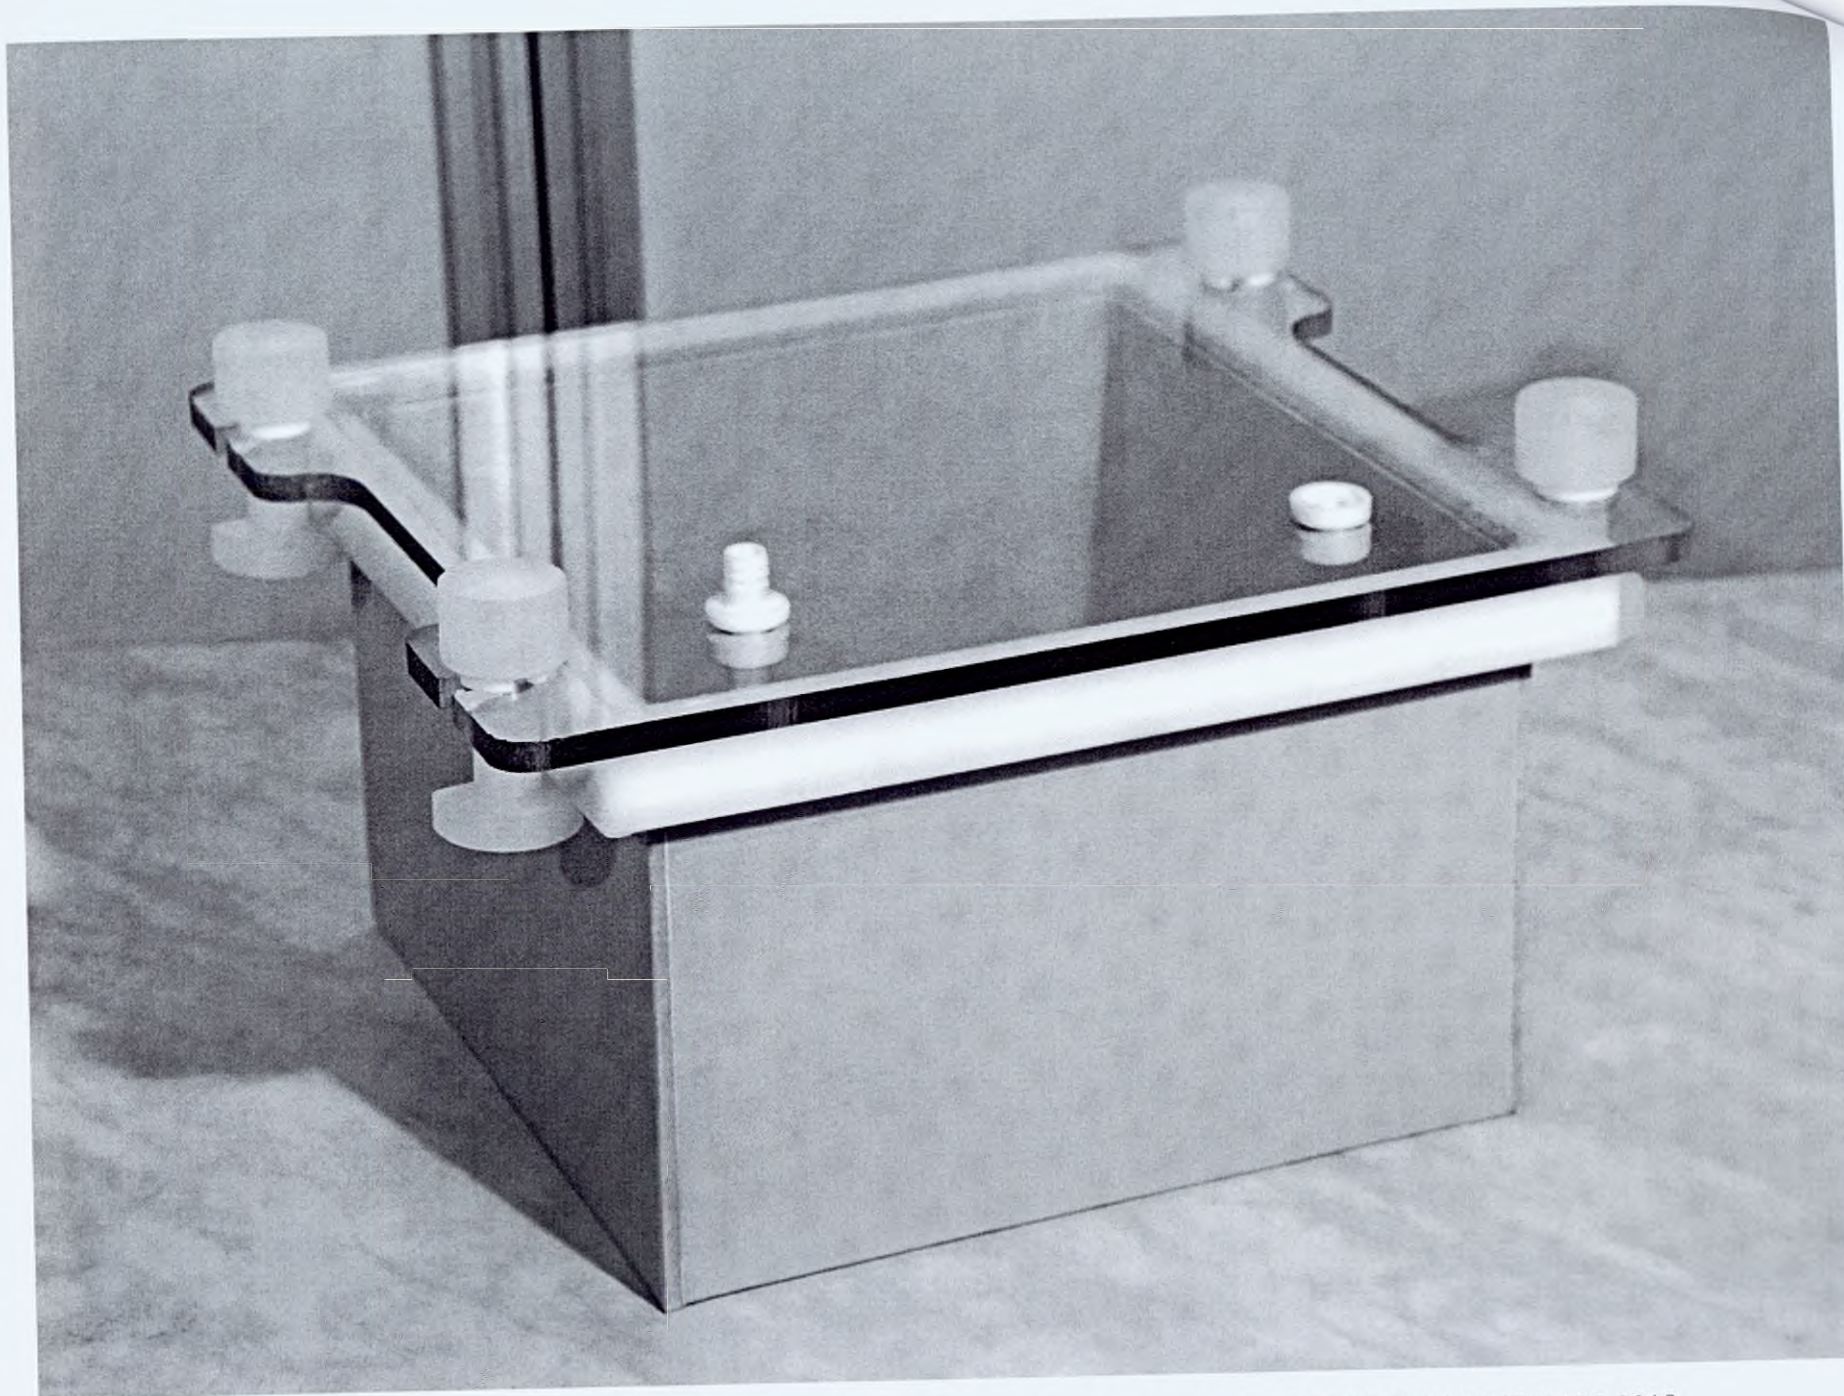


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:


Контейнер для обеззараживания - объем 6 литров

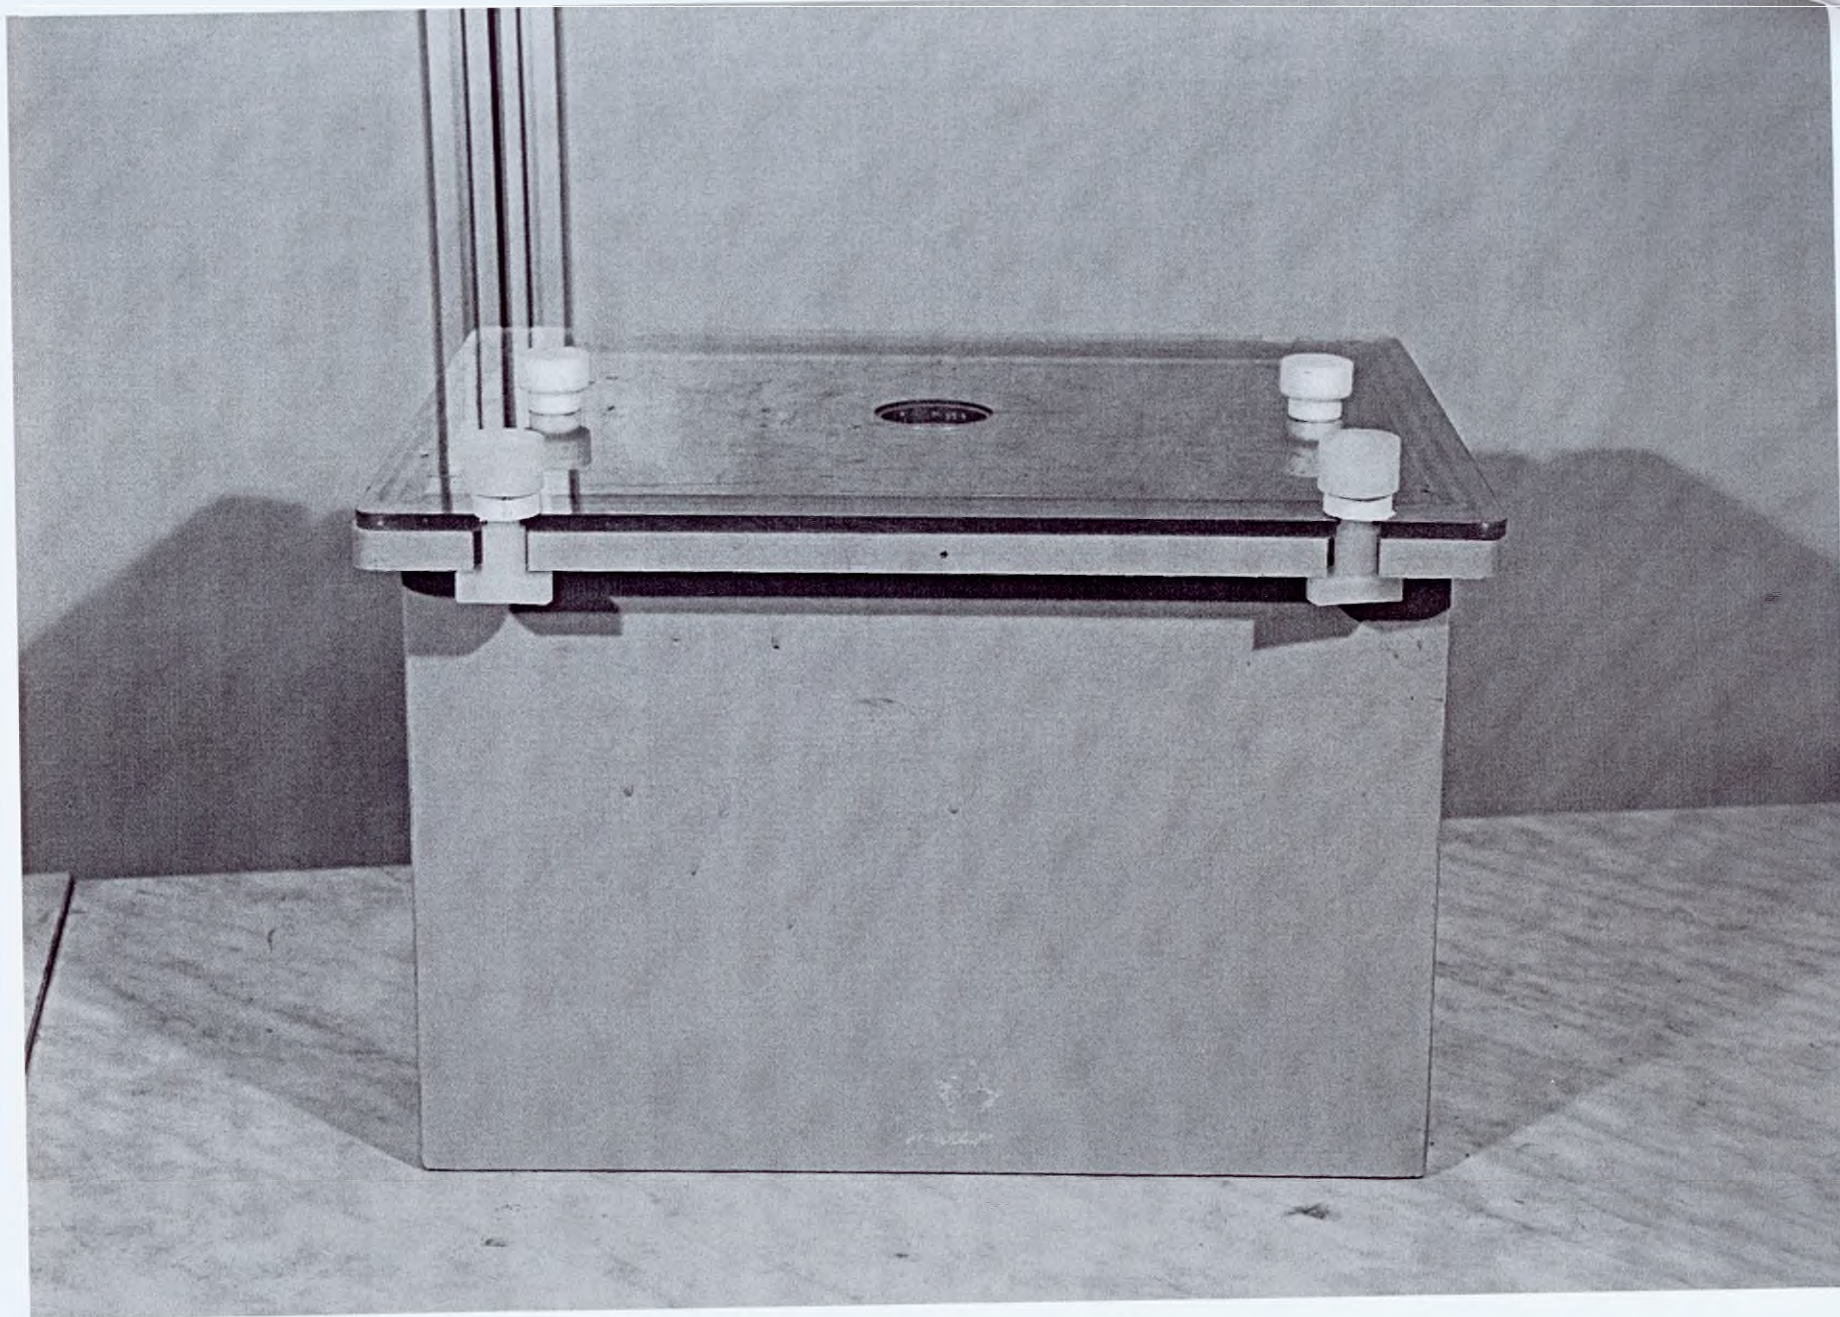

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:


Контейнер для обеззараживания - объем 8 литров

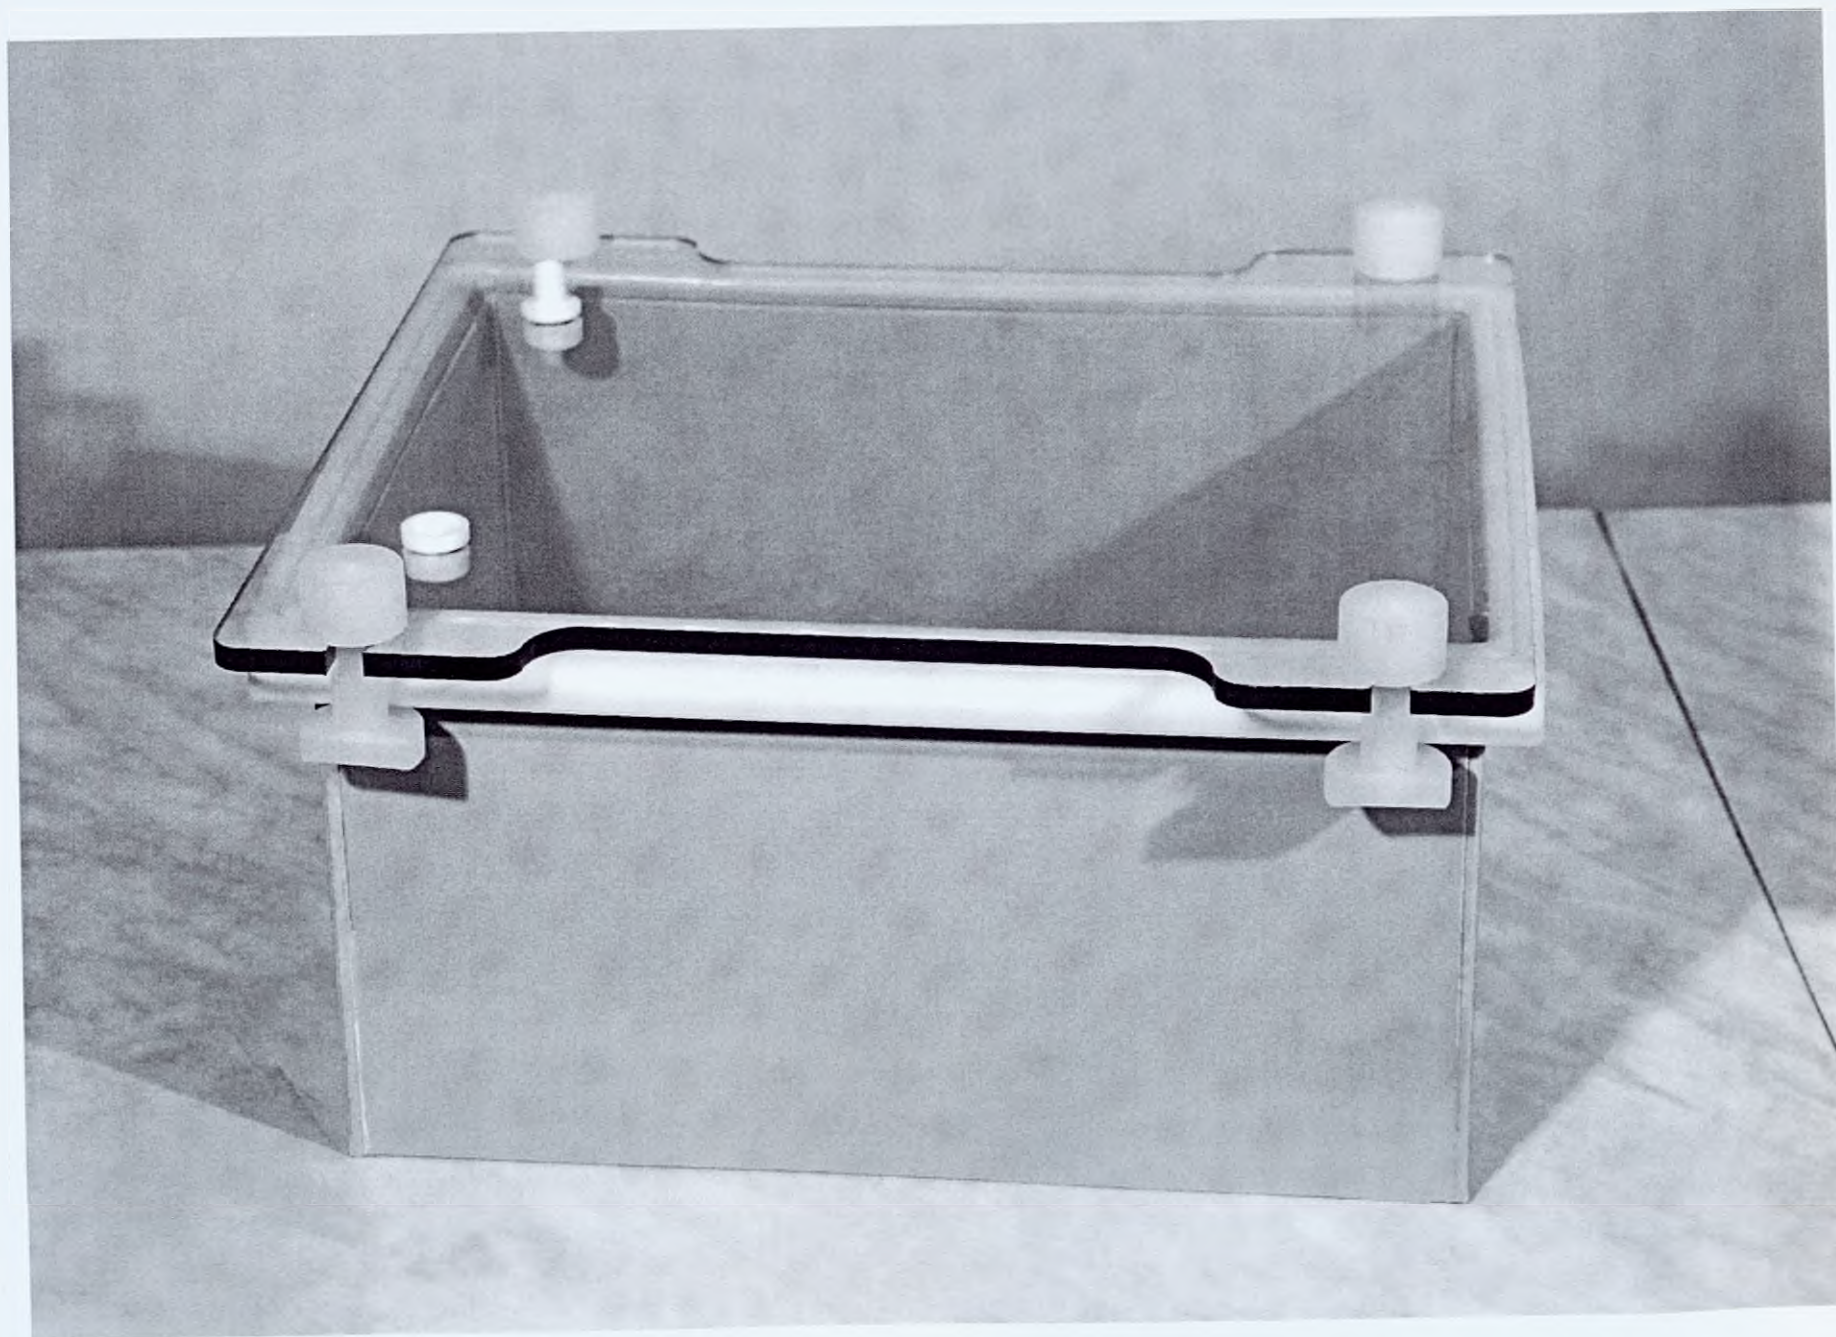

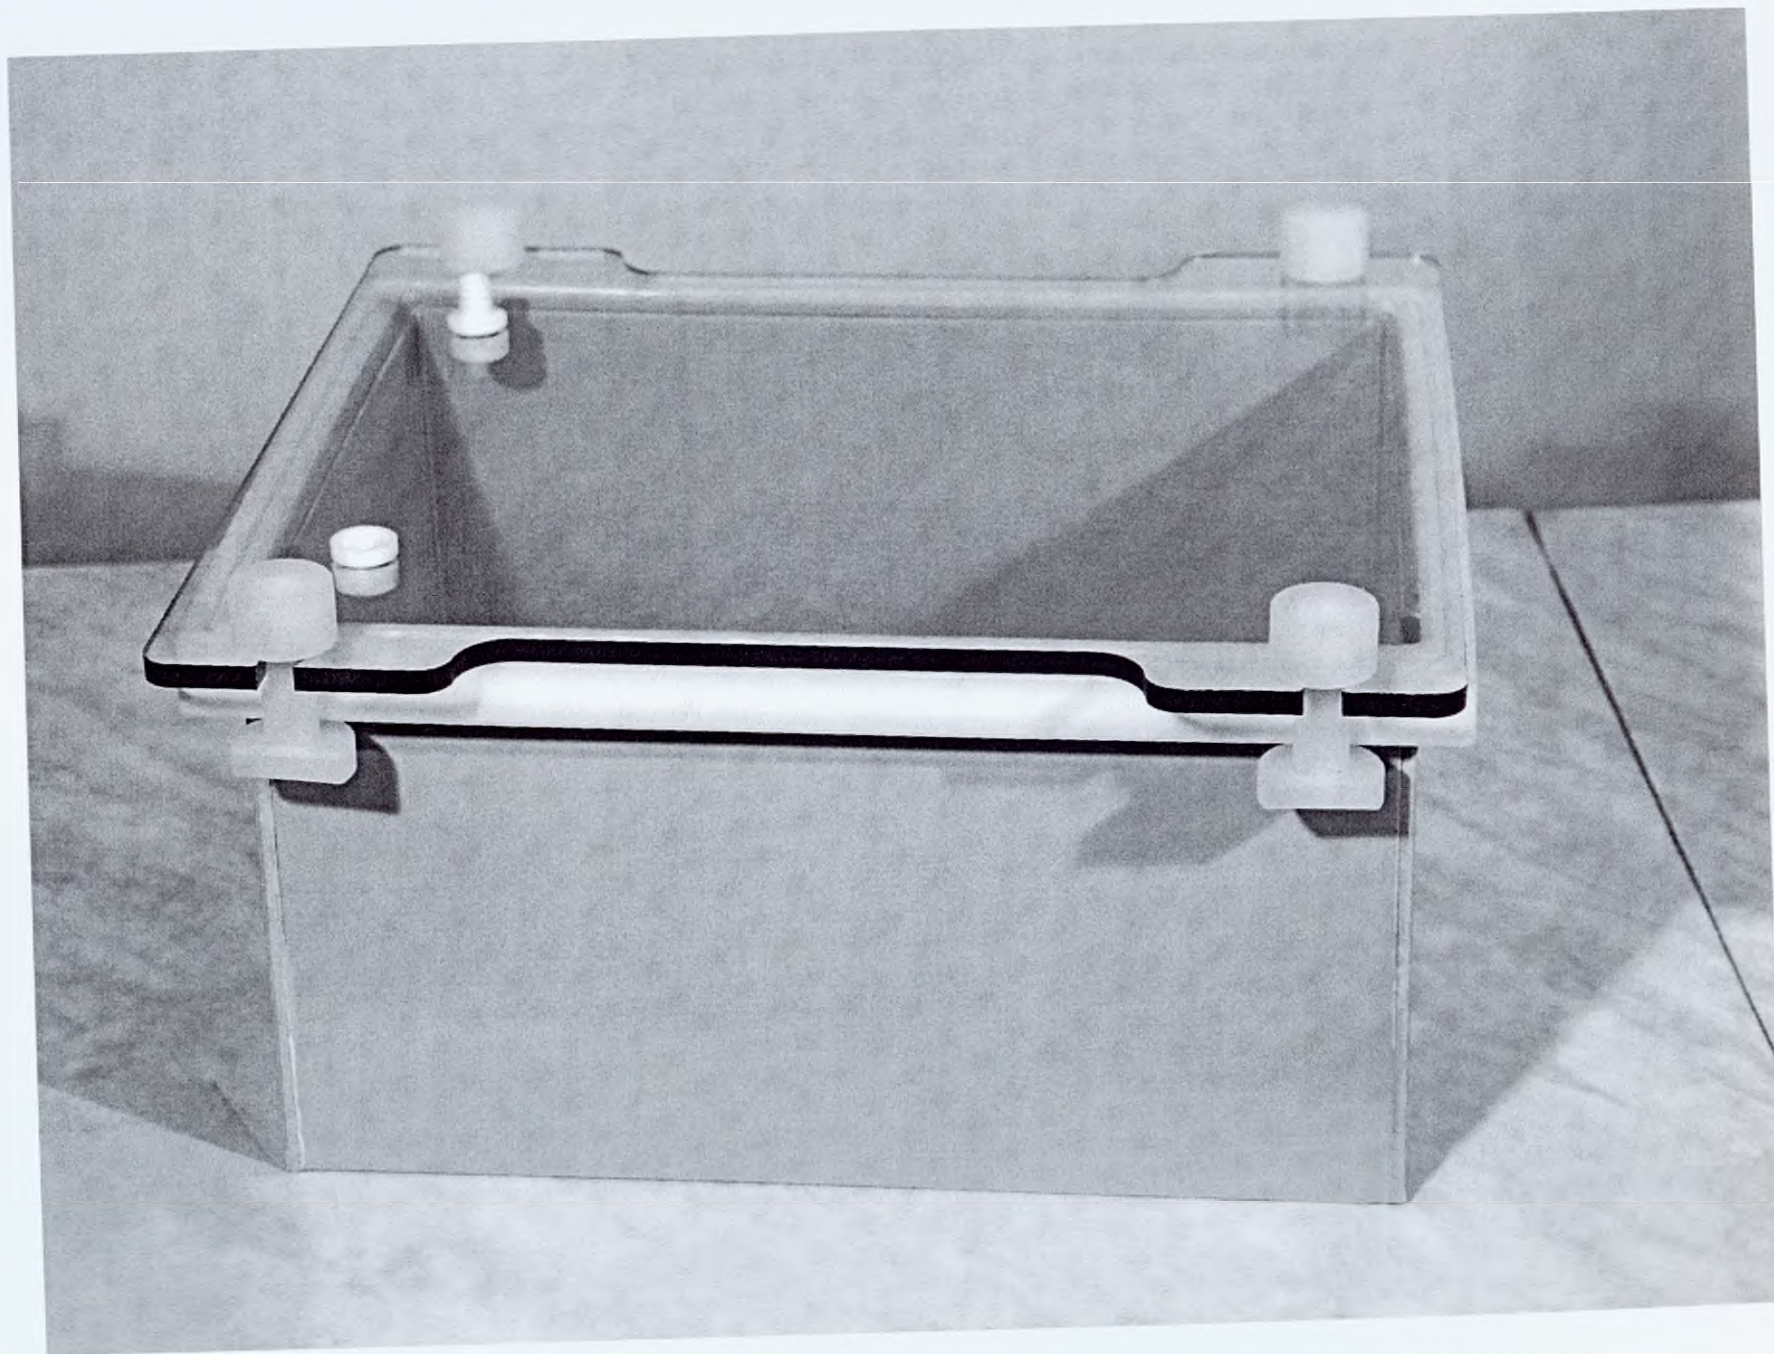


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:


Контейнер для обеззараживания - объем 16 литров

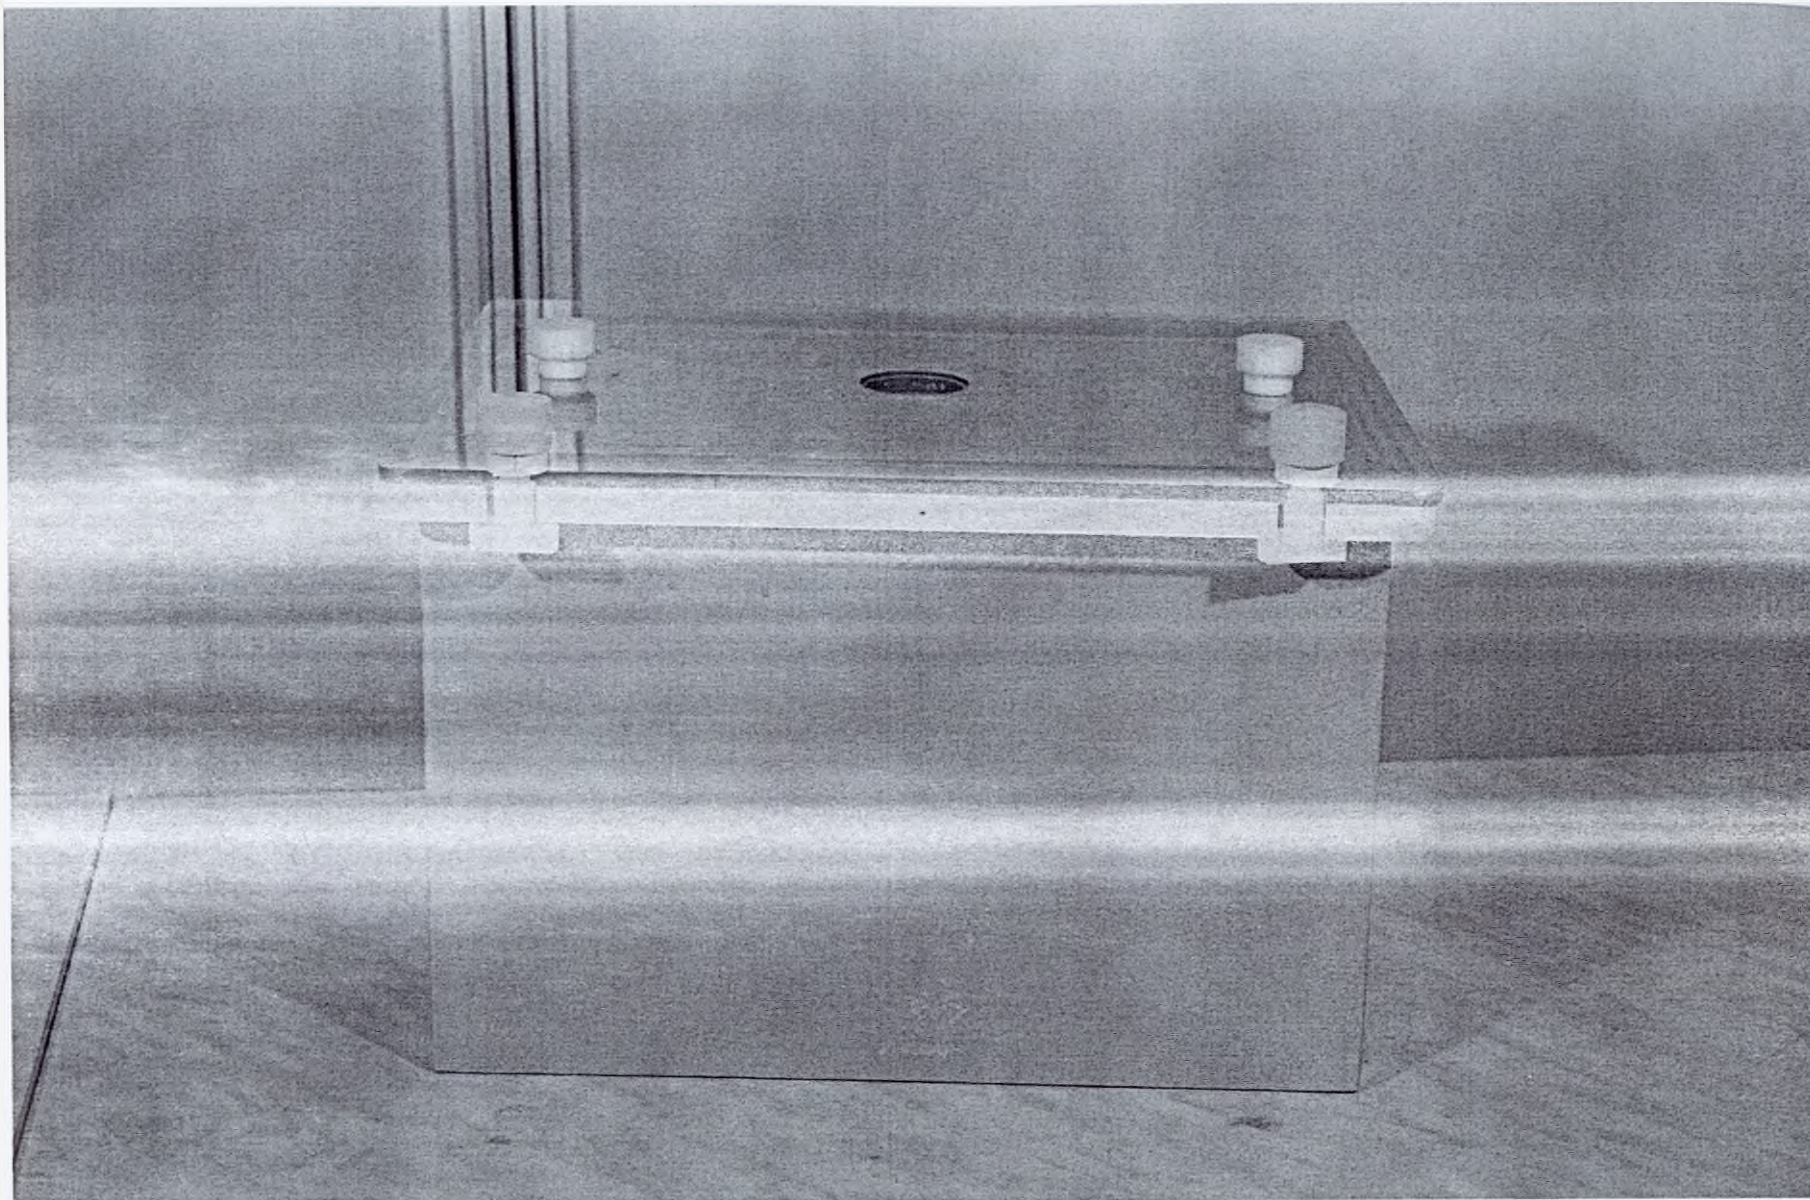


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Контейнер для обеззараживания - объем 30 литров

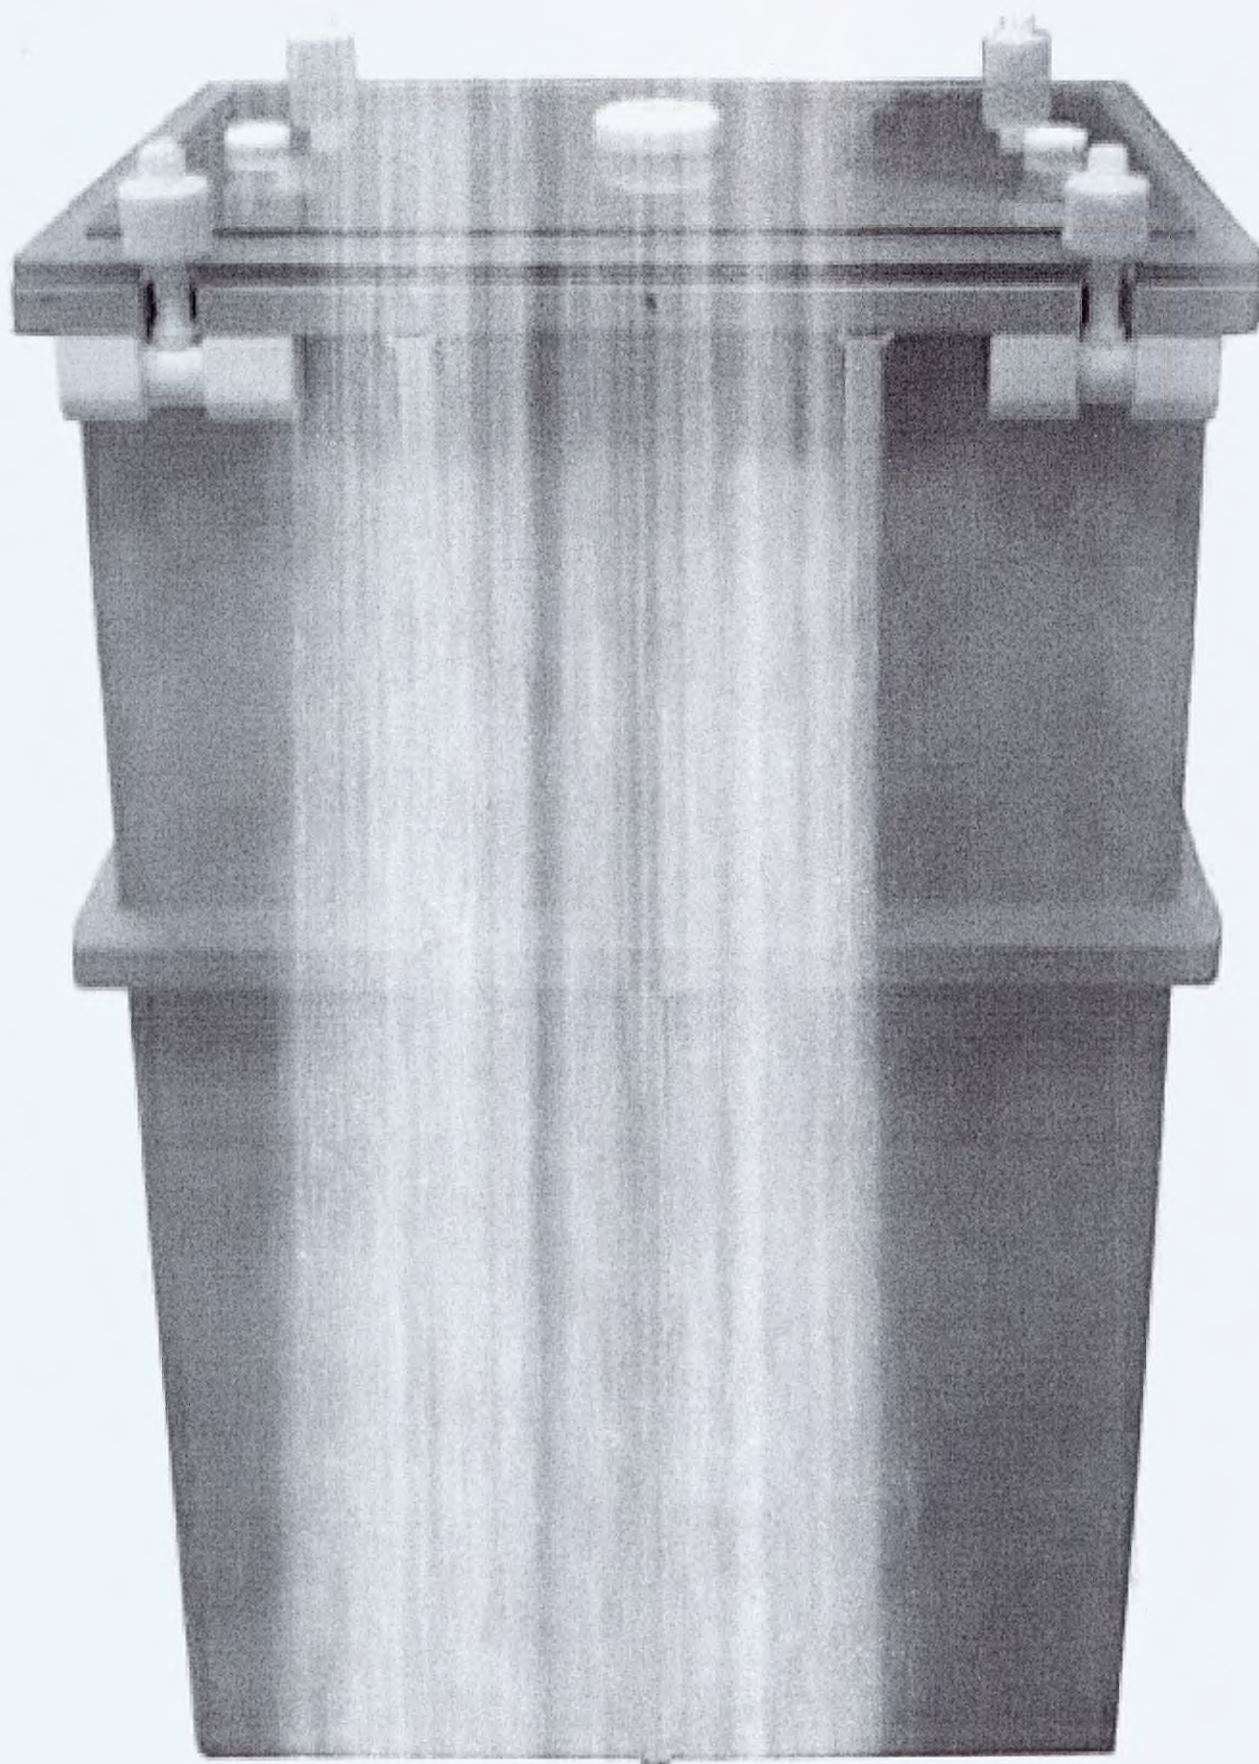


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Контейнер для обеззараживания - объем 60 литров

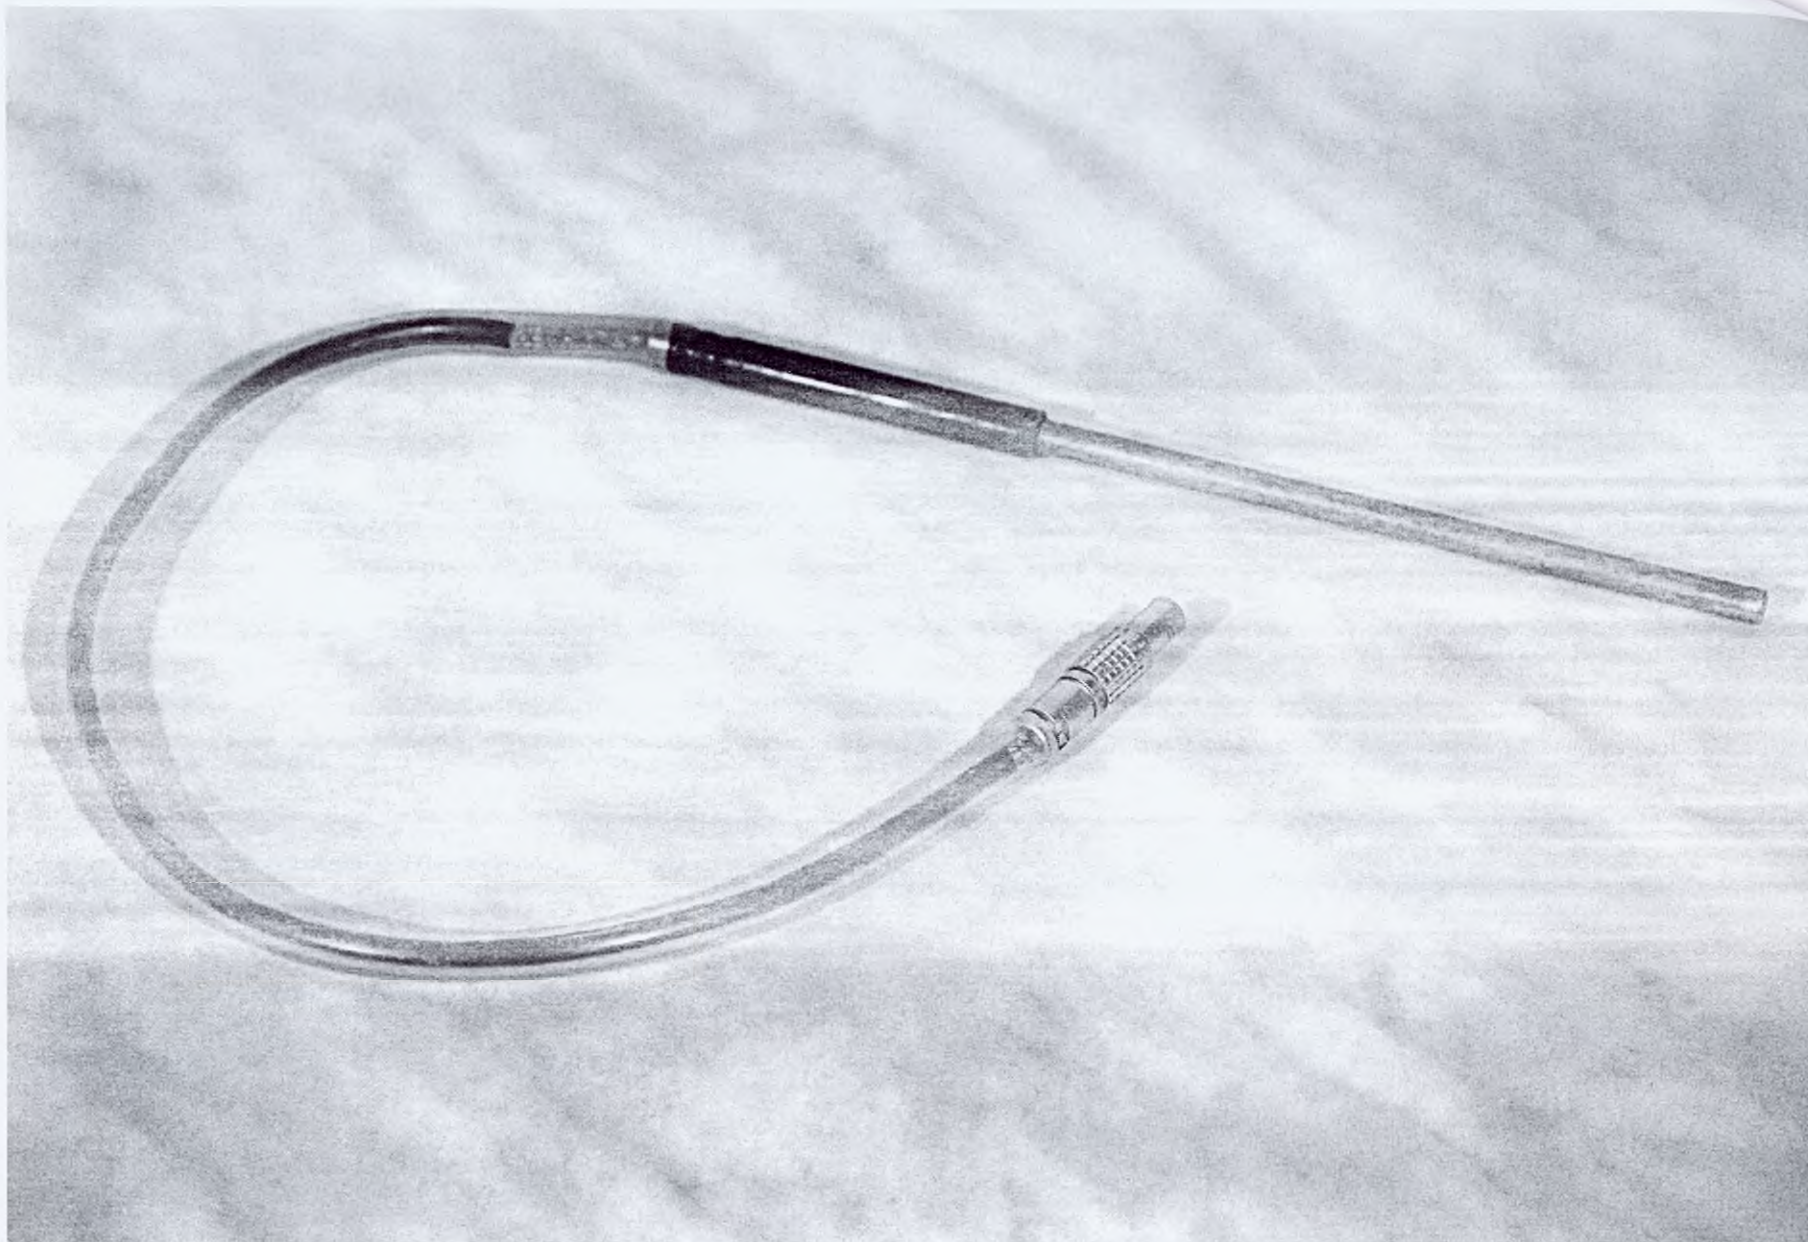


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Датчик температуры - погружной

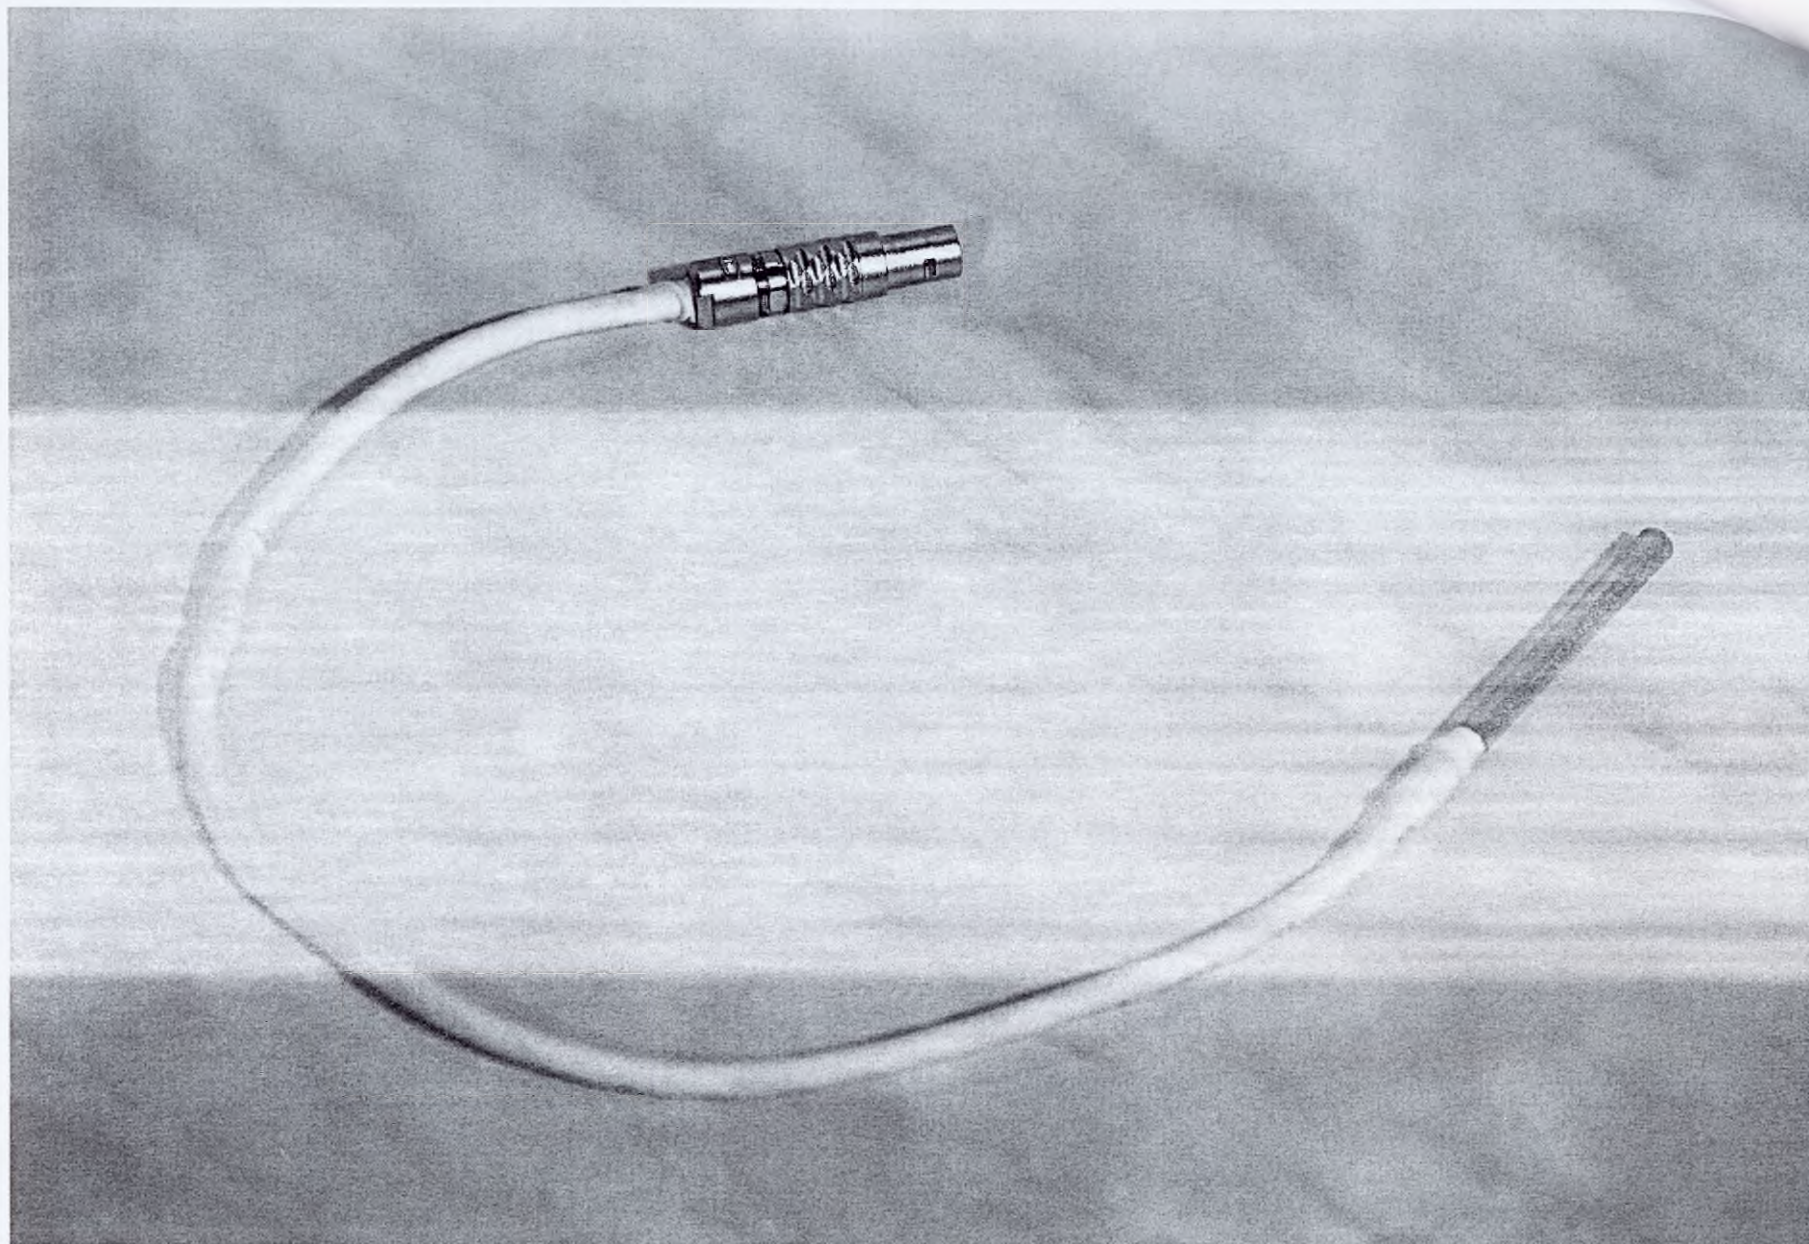


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Датчик температуры - бесконтактный

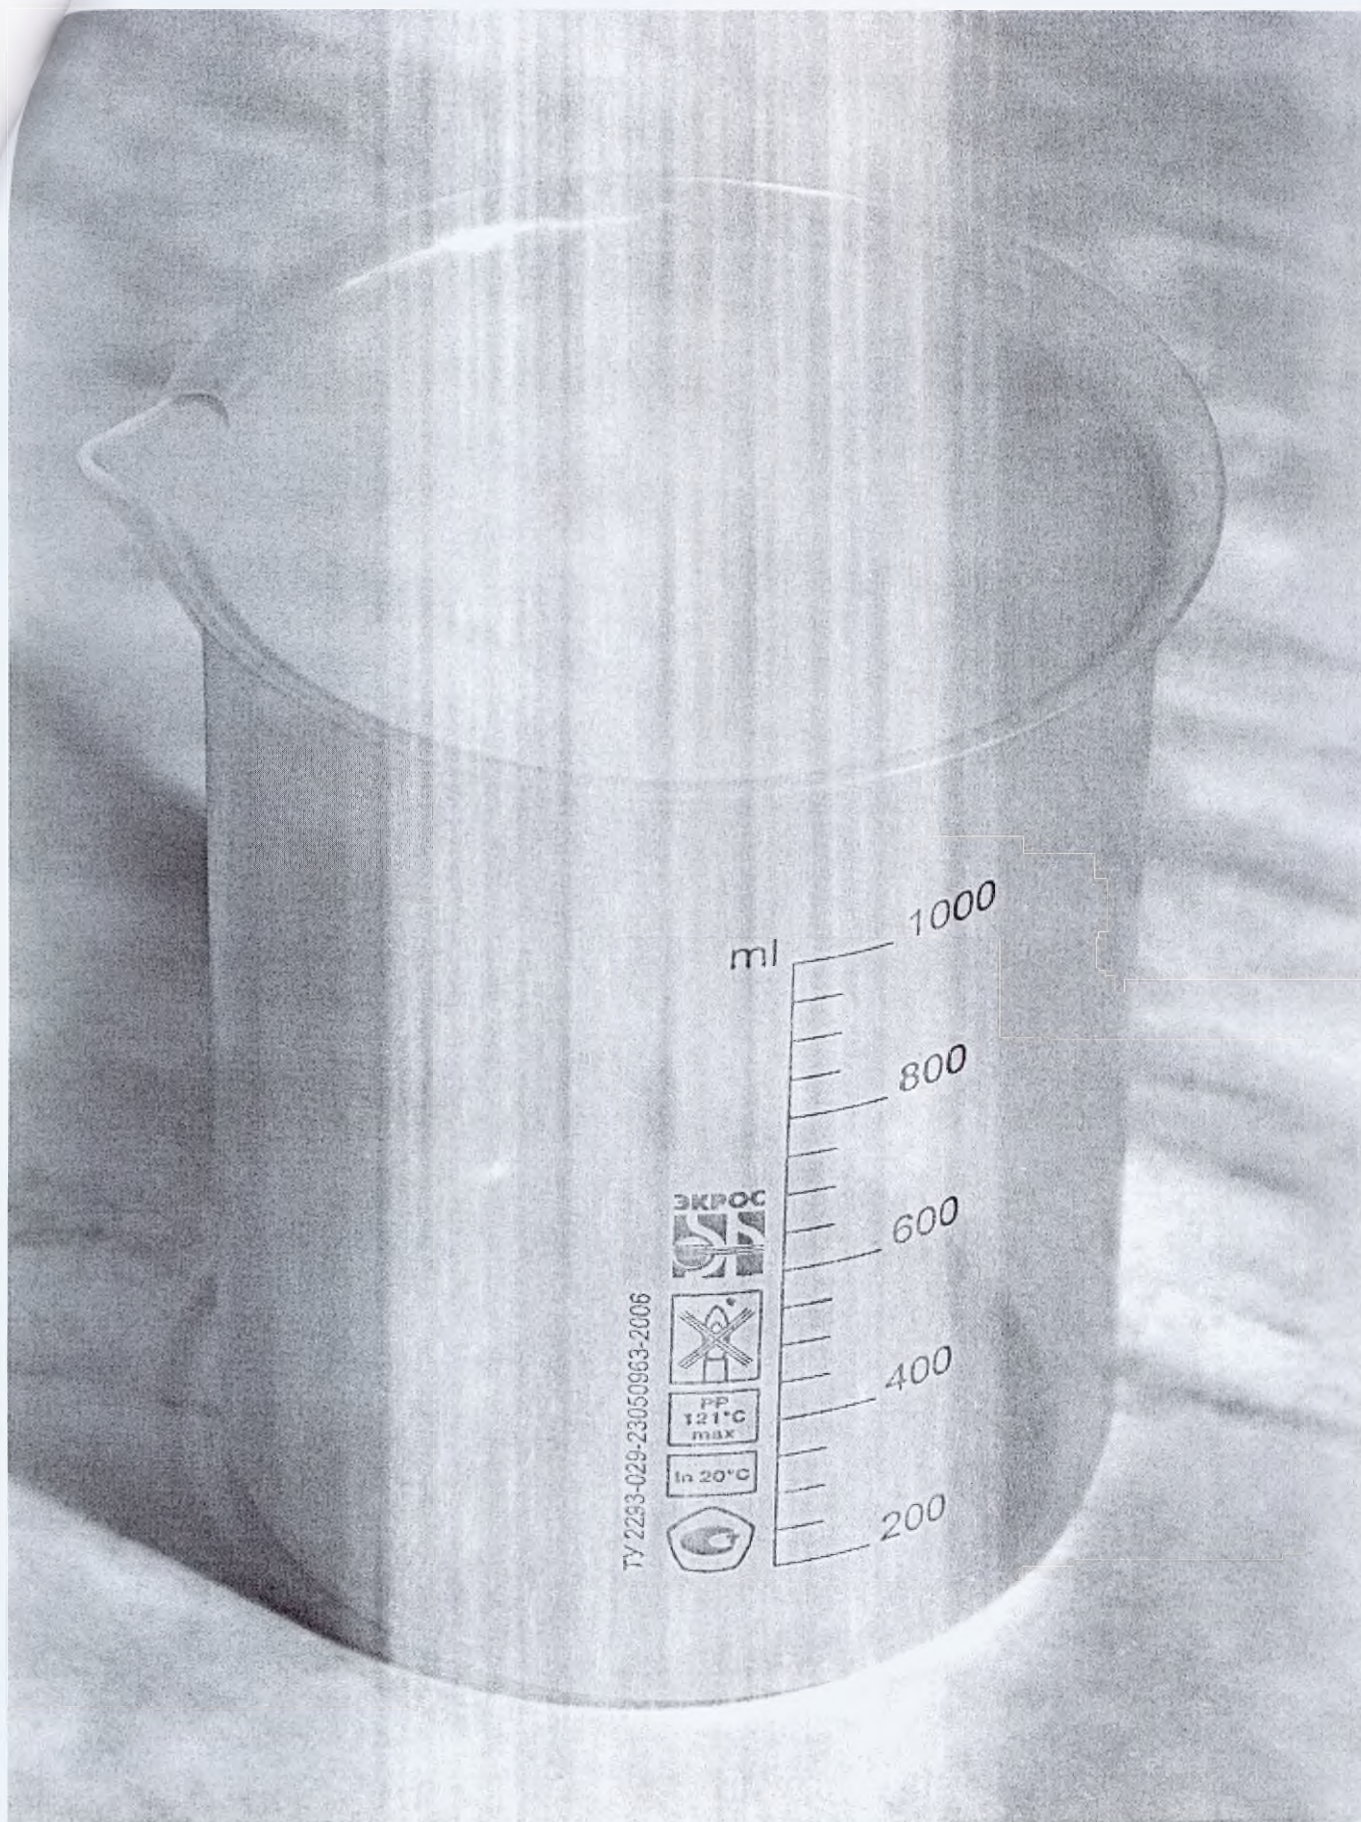


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
стакан мерный 1000 мл

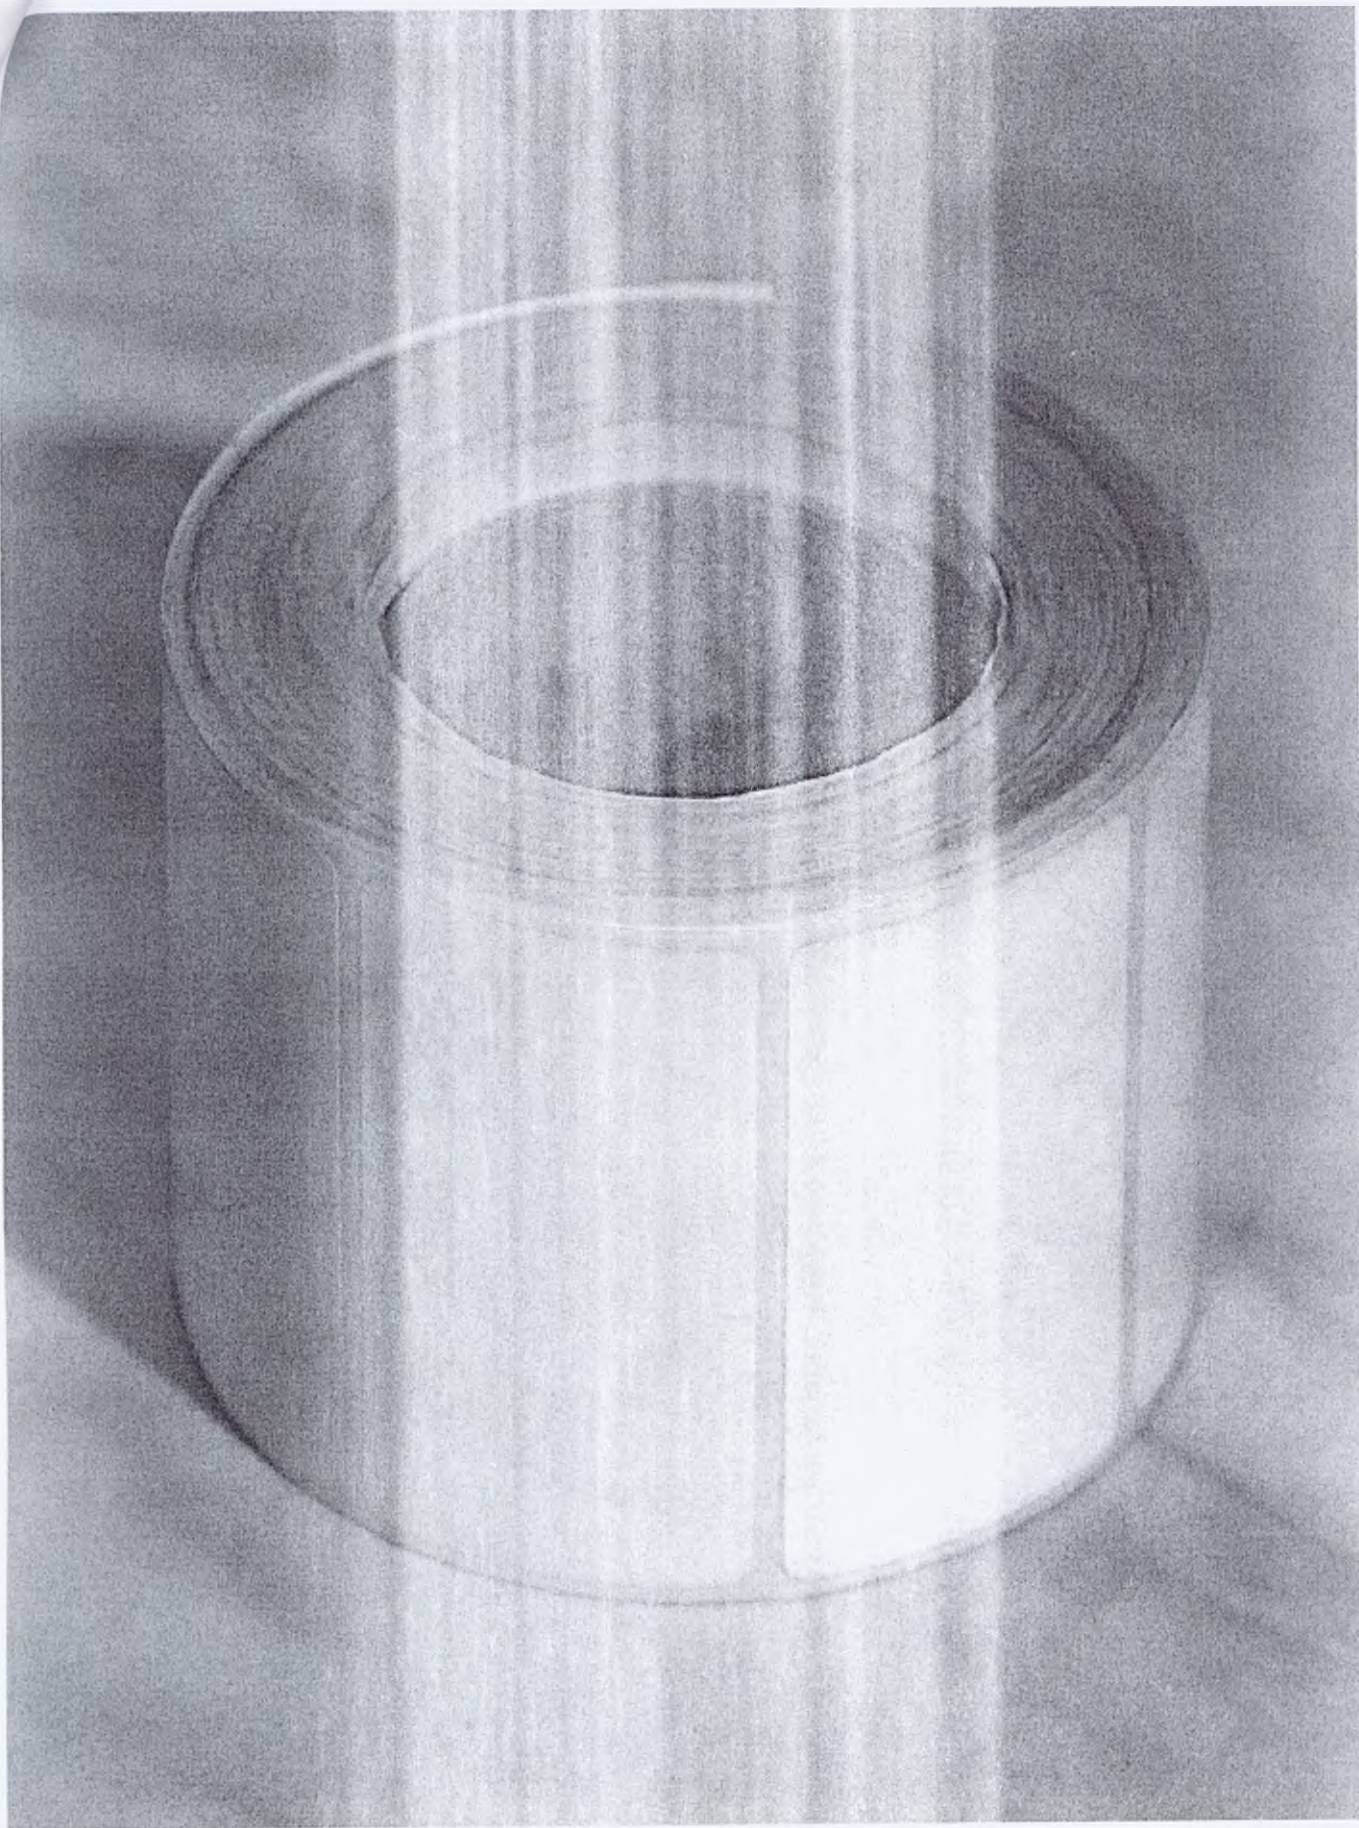


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
термотрансферные этикетки, рулон

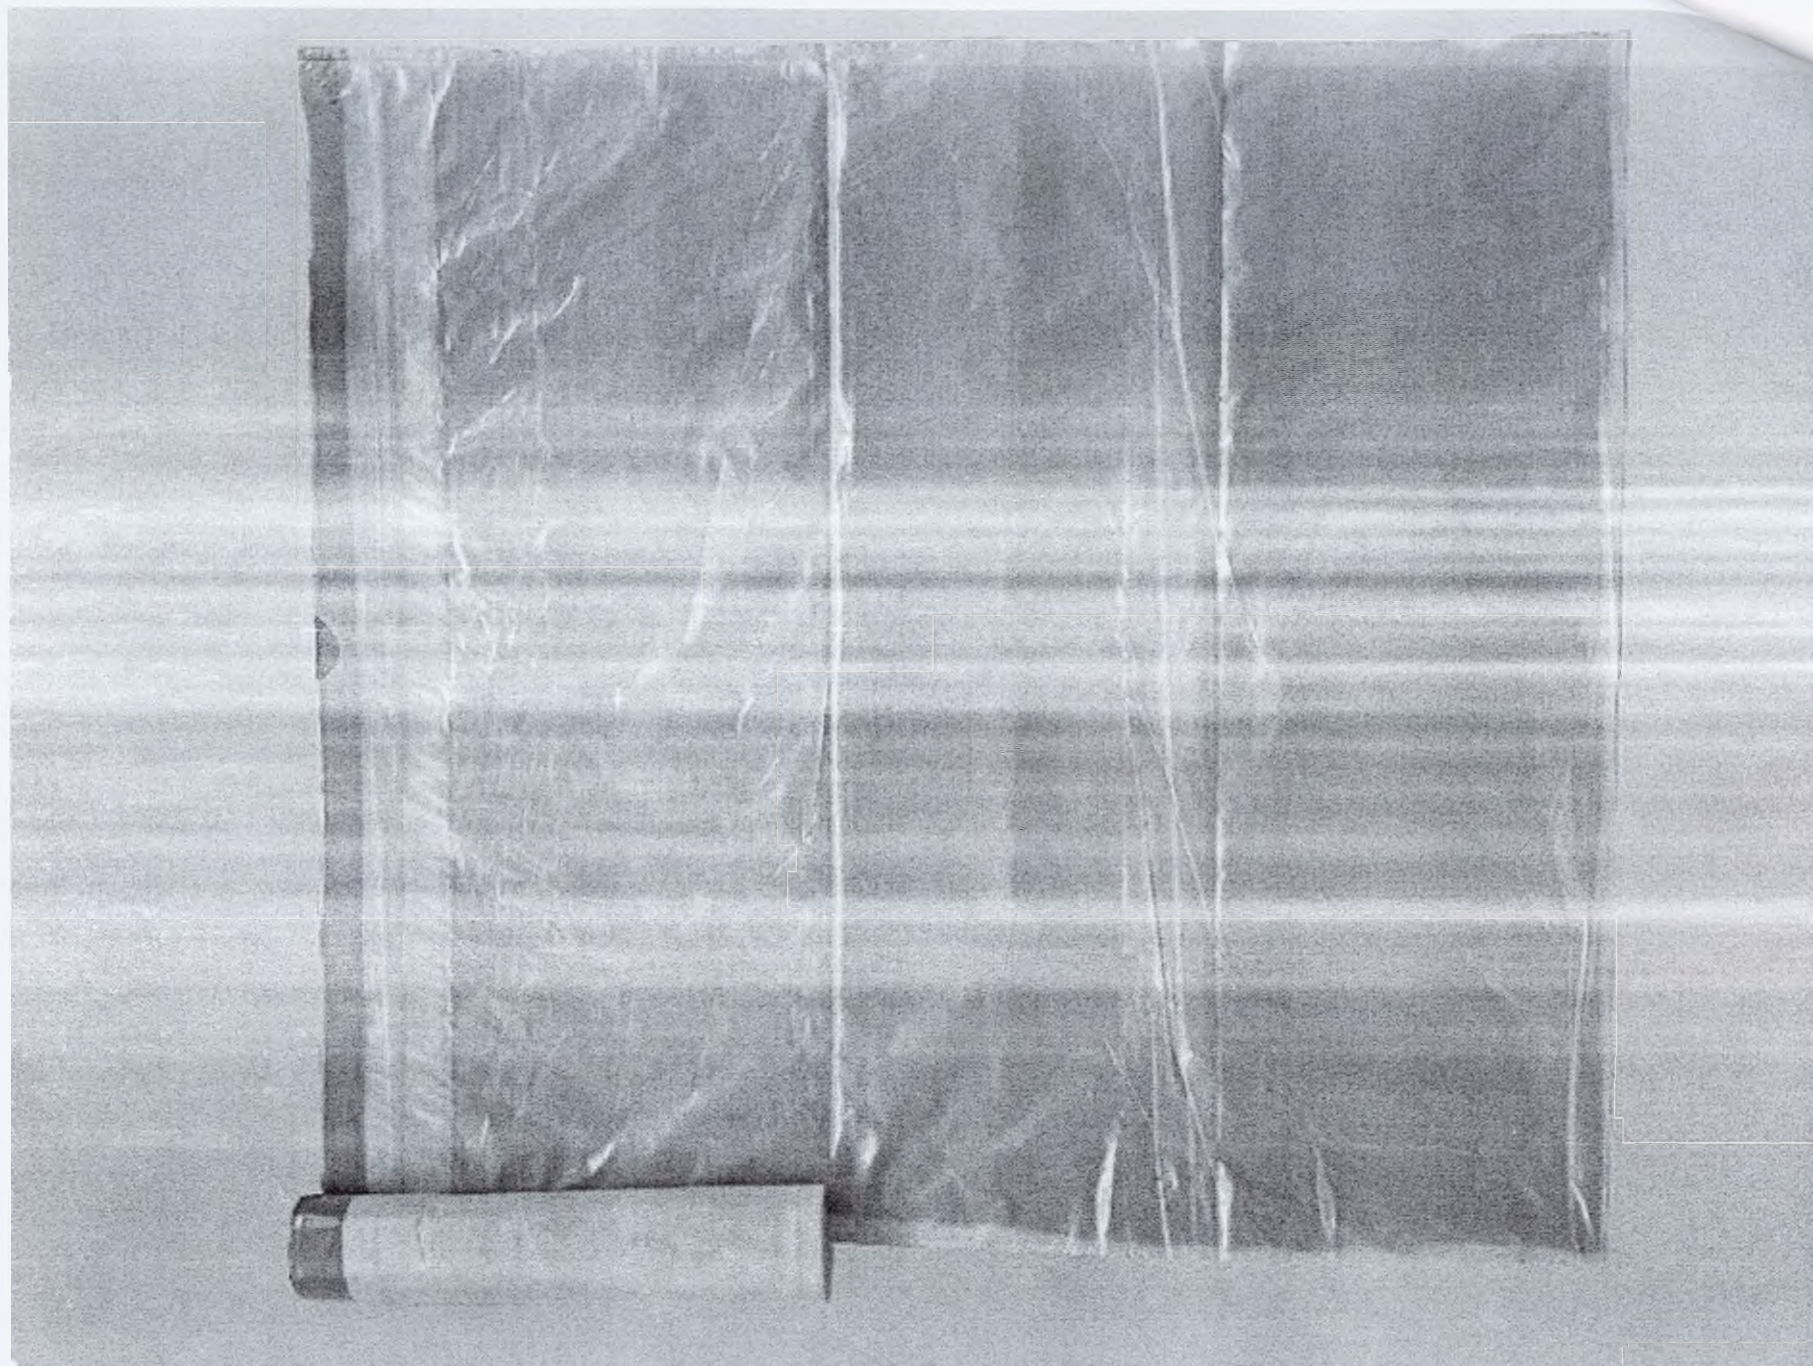


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
пакет для отходов № 1 специальный

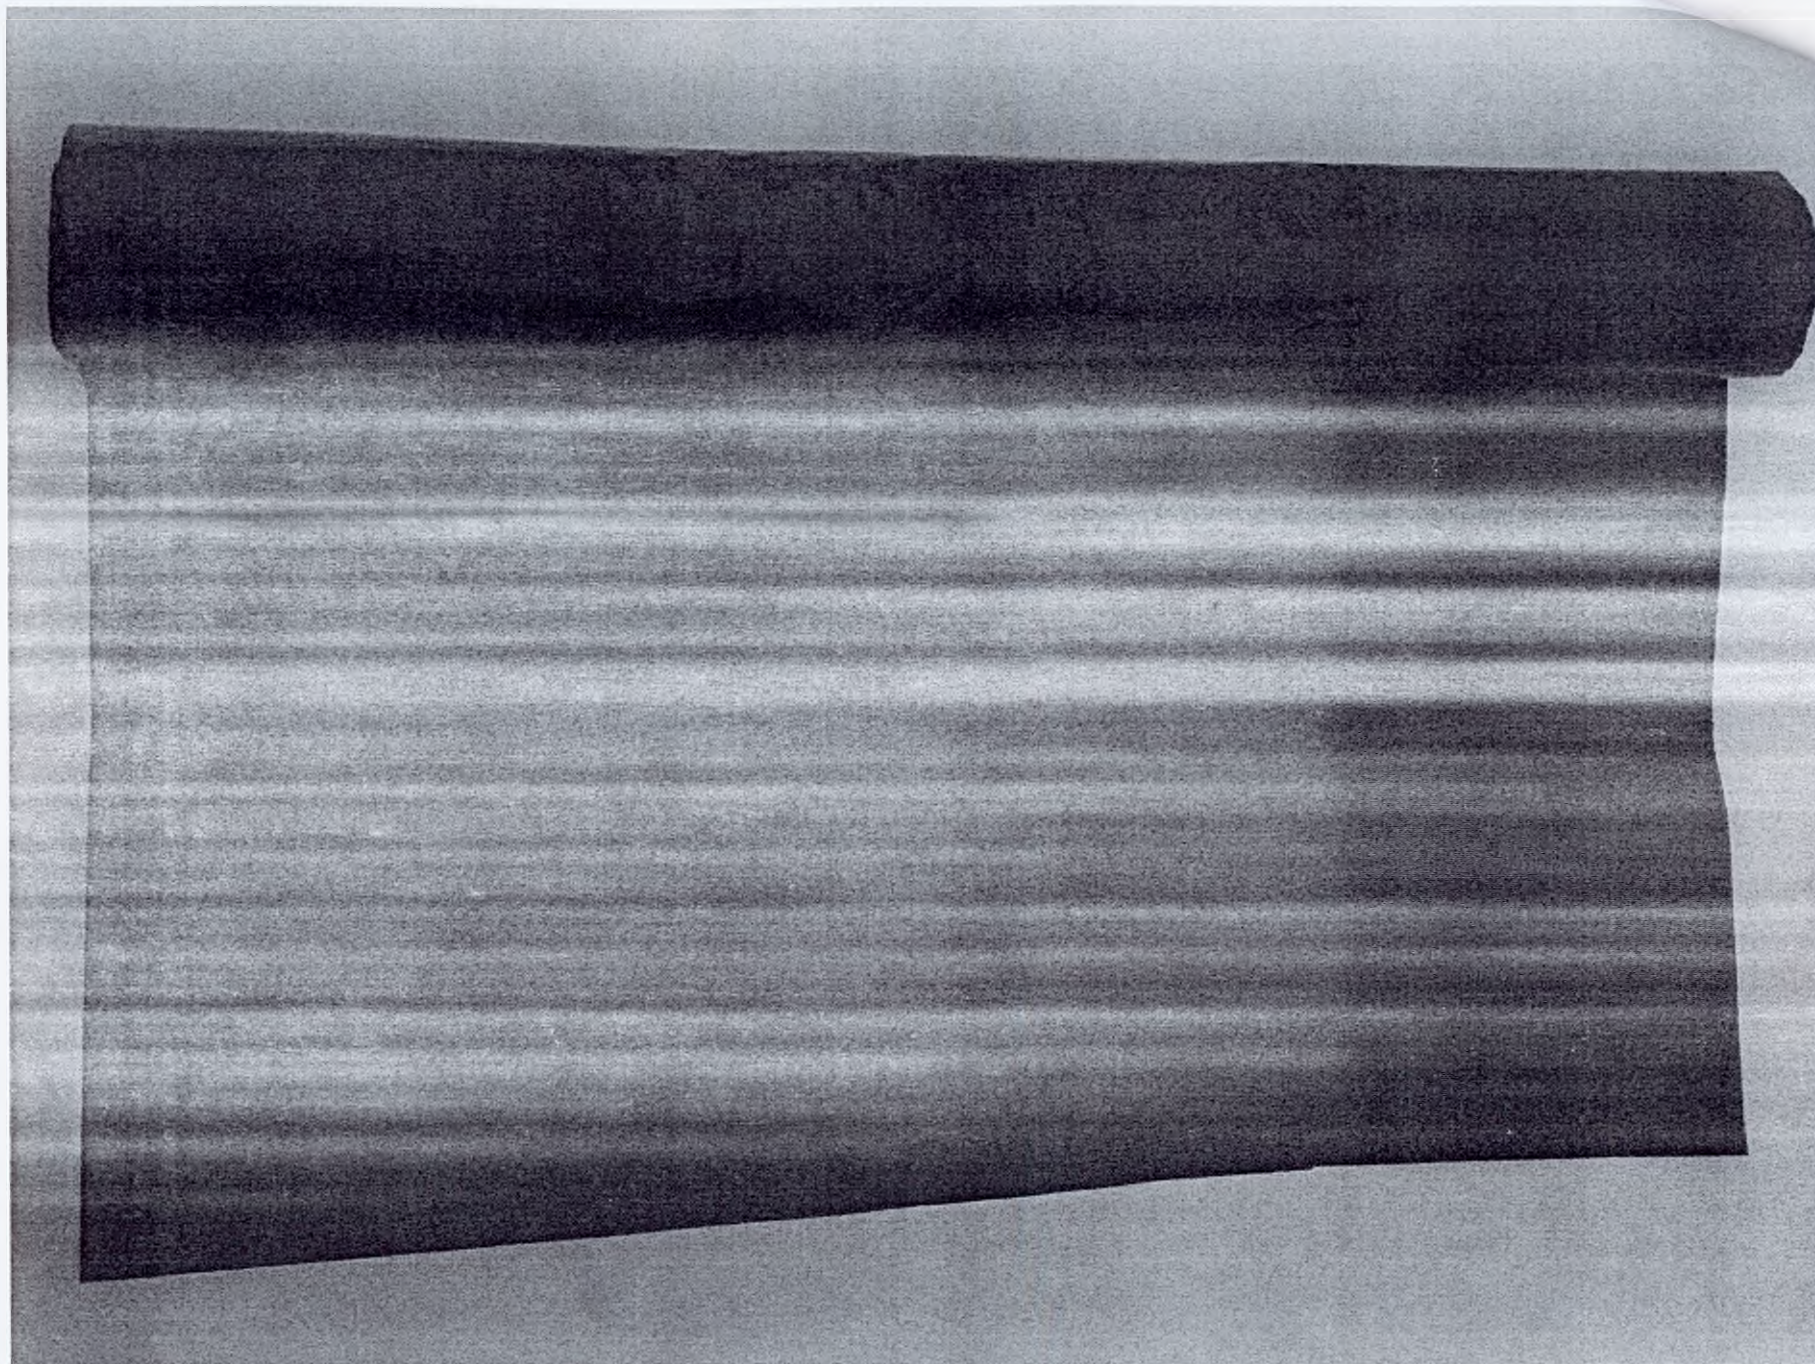


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
пакет для отходов № 2 специальный

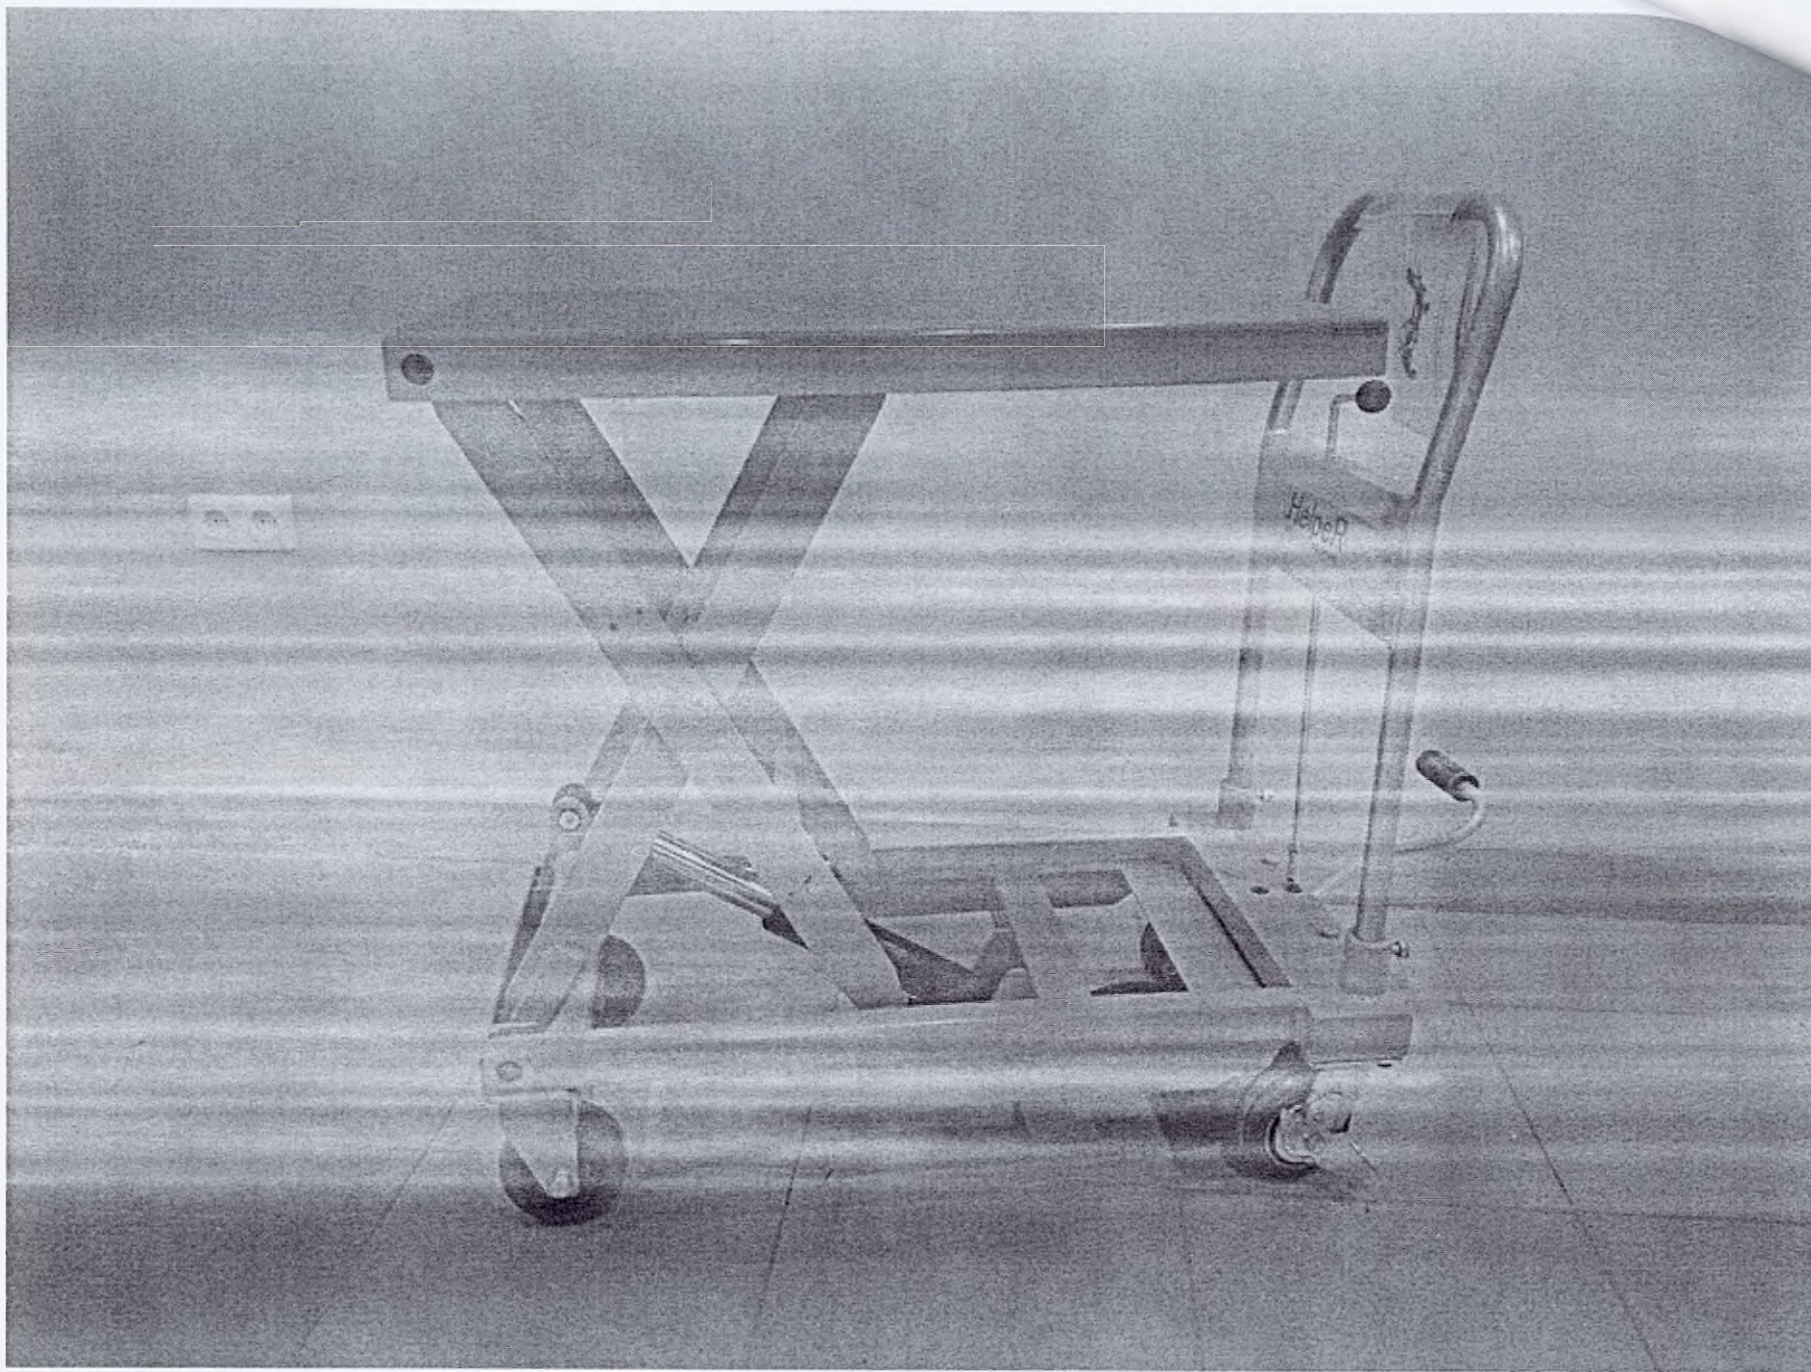


Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018: тележка колесная для контейнера

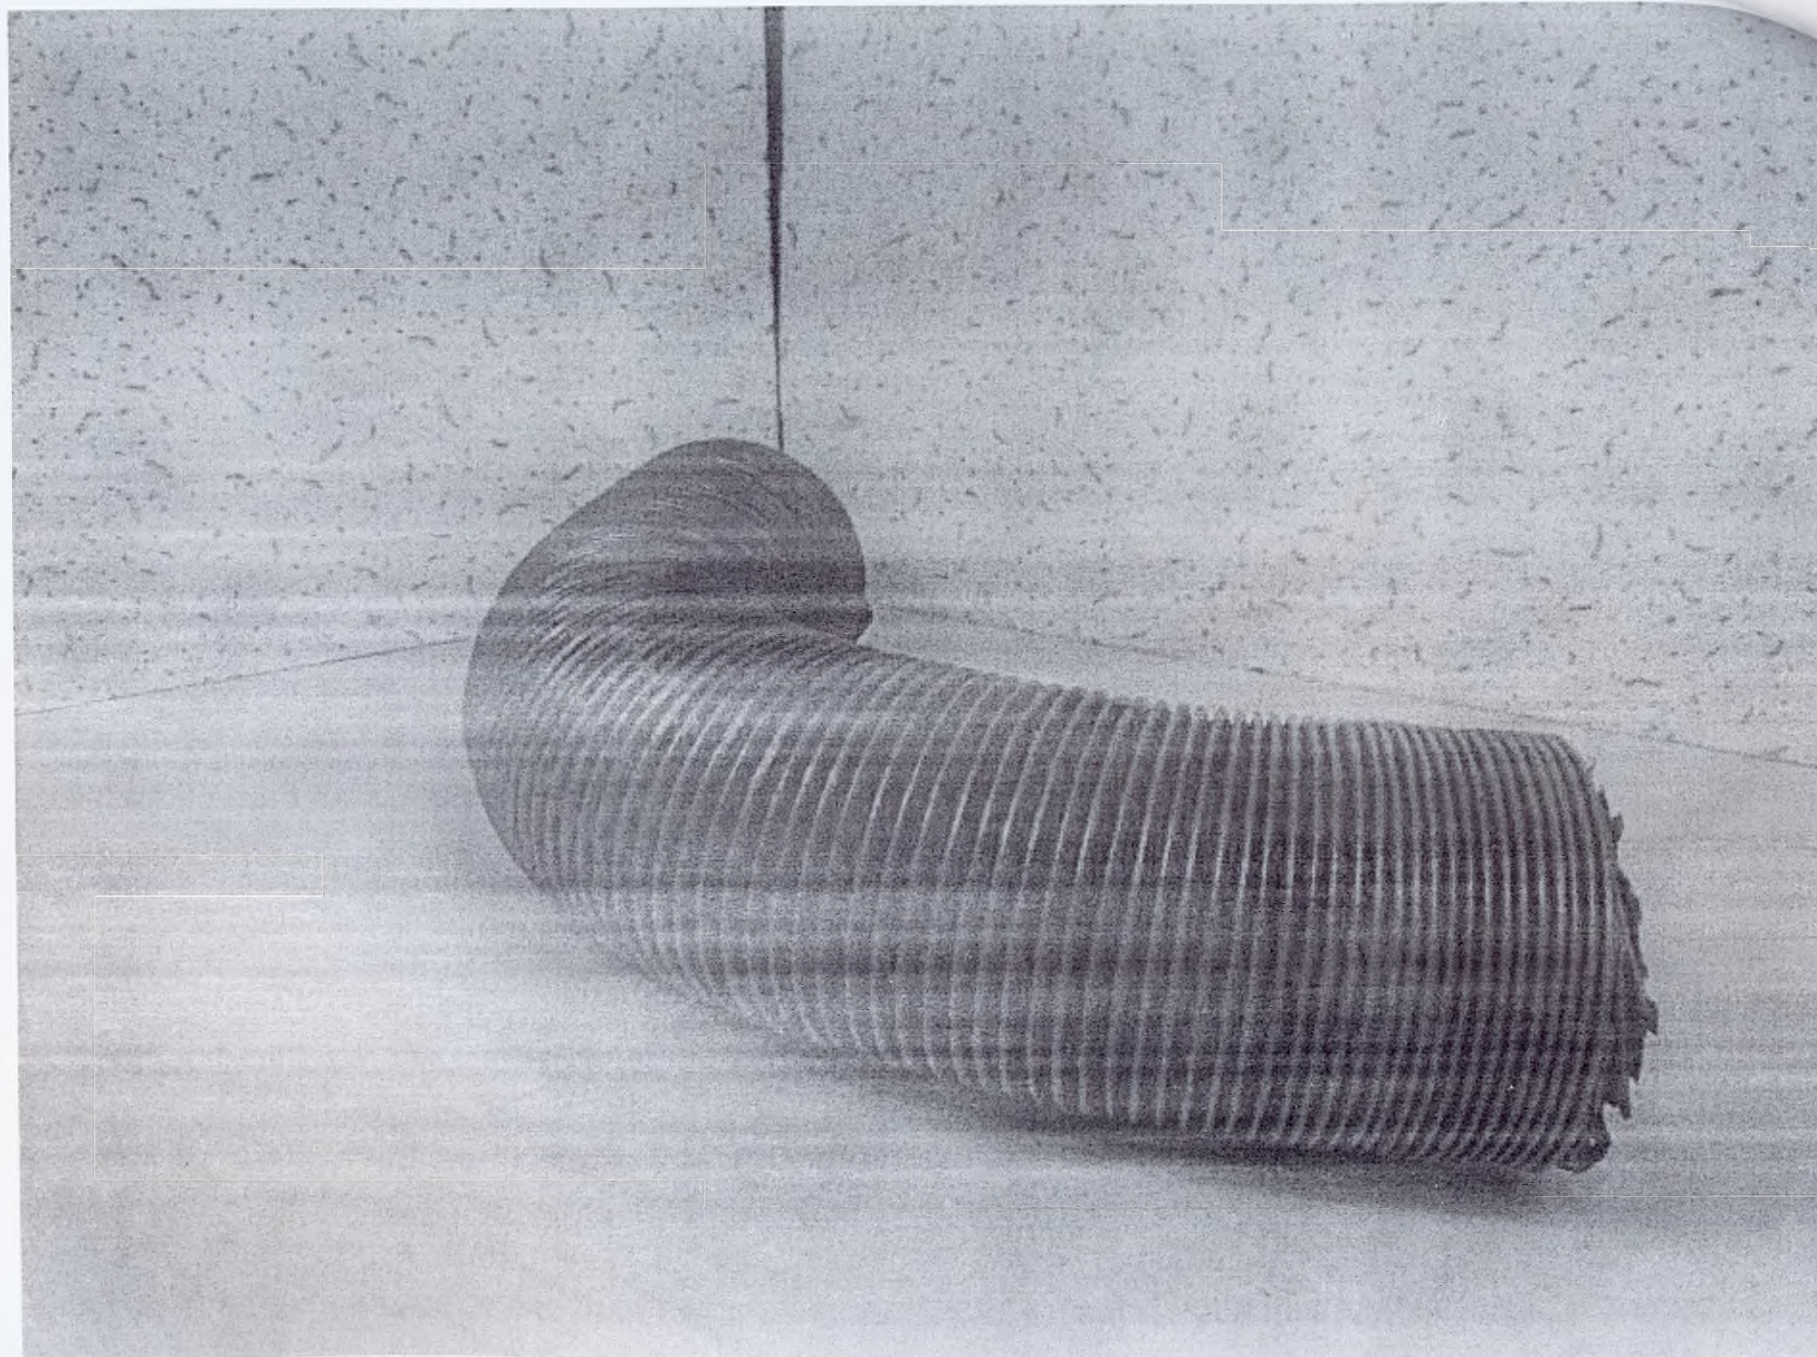

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
рукав вентиляционный

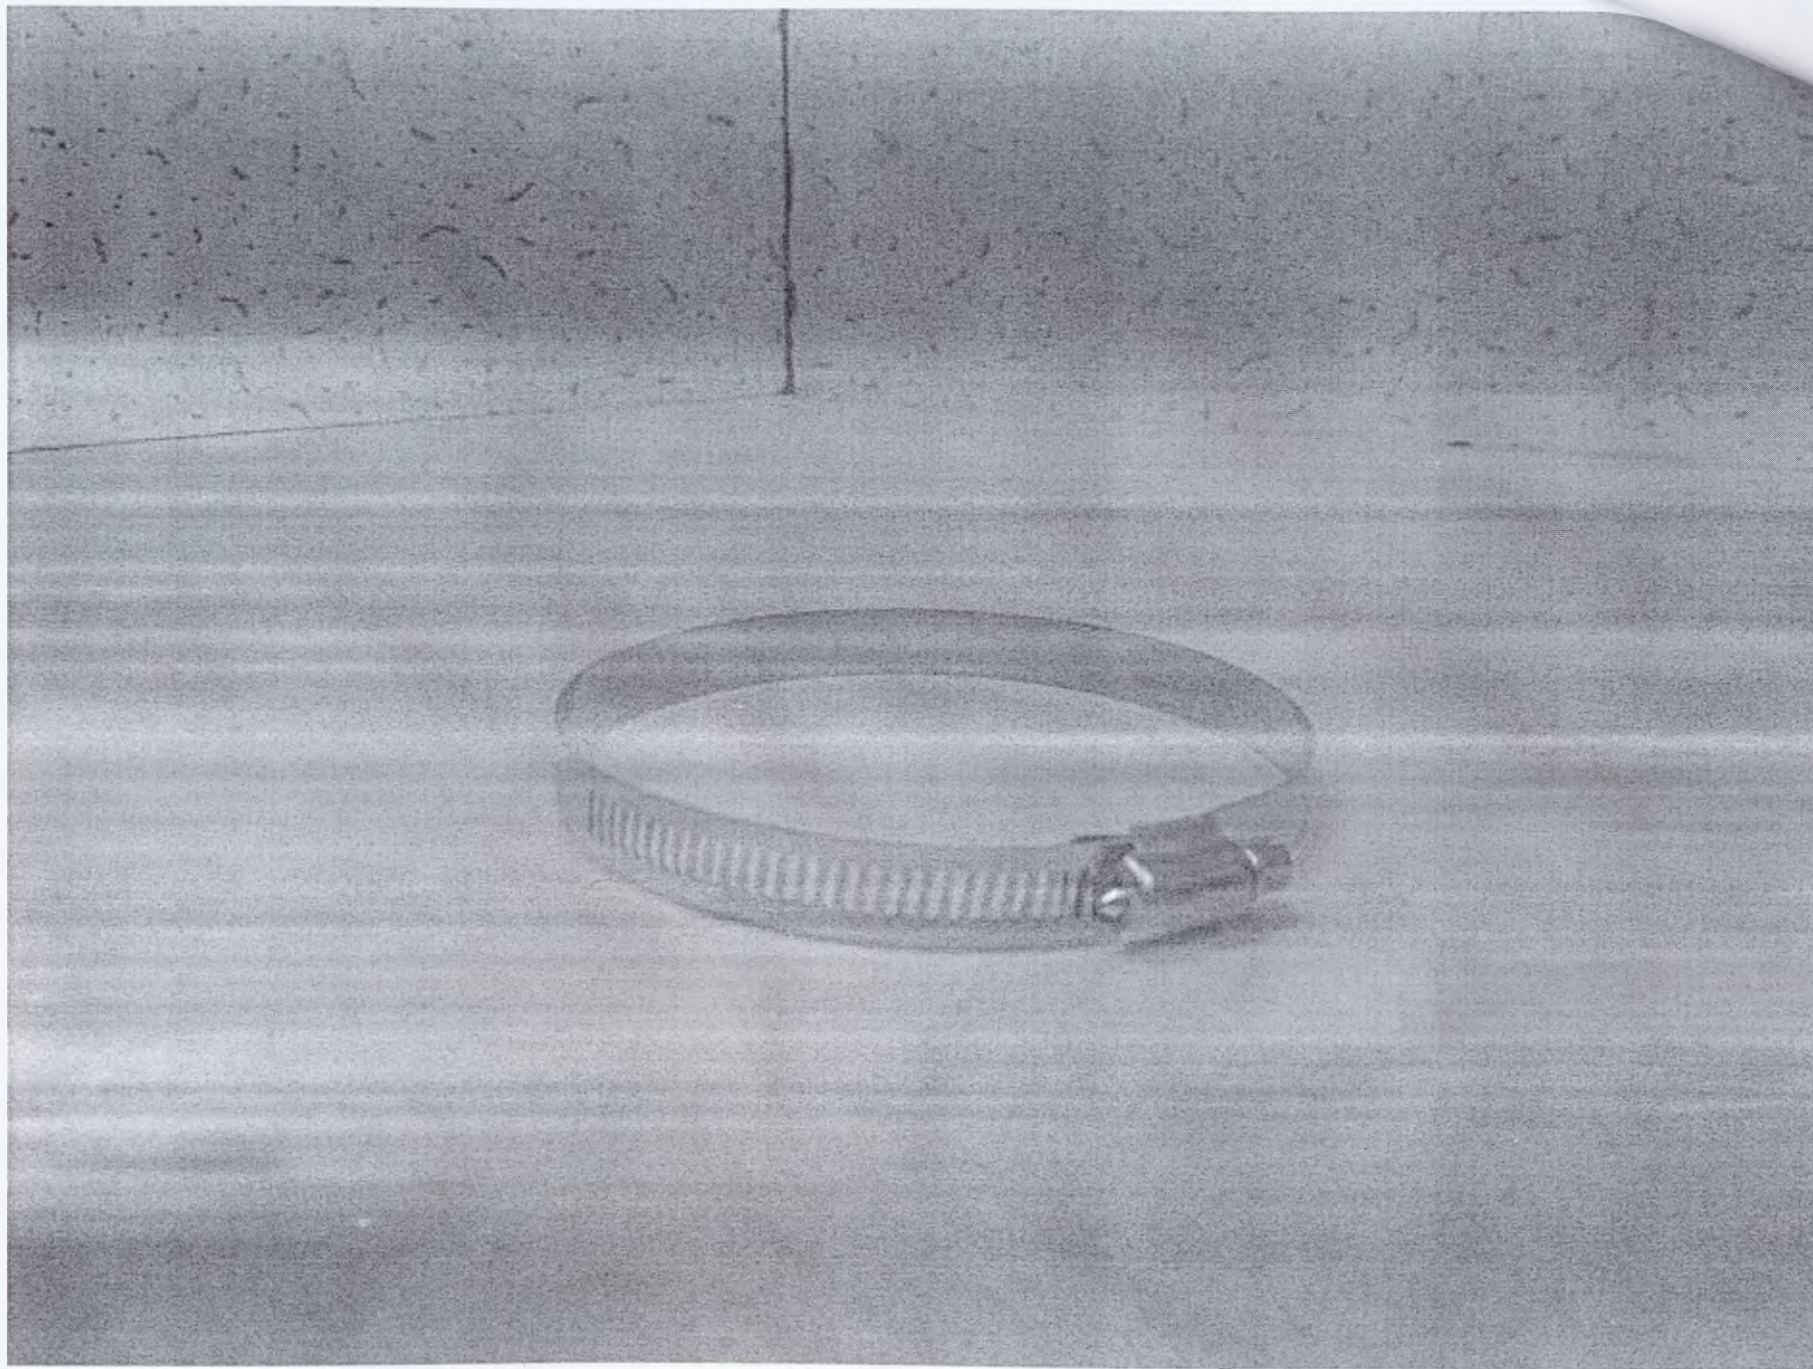

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Хомут винтовой

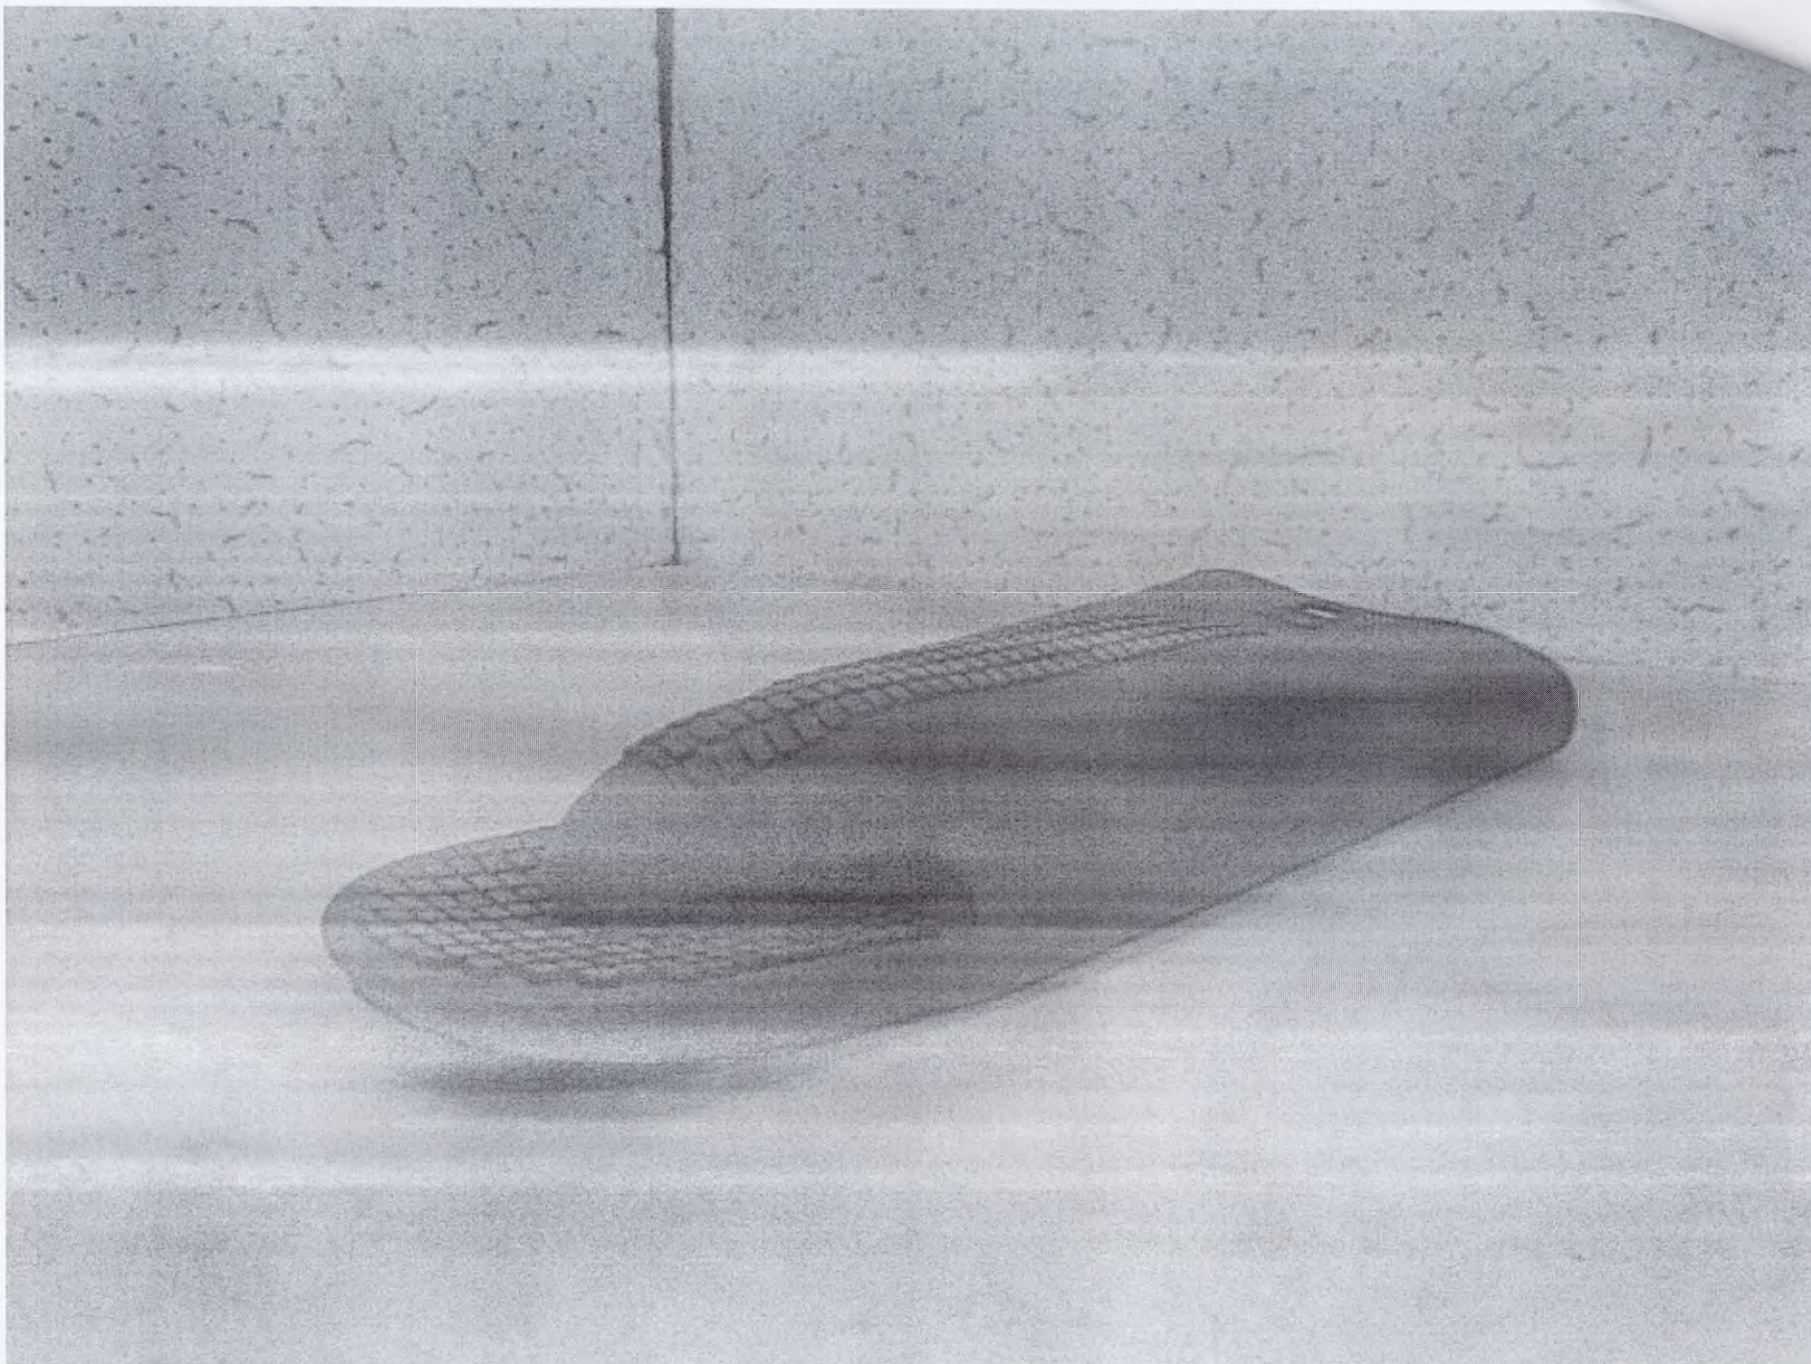

Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар» по ТУ 32.50.50-001-20851585-2018:
Рукавица термостойкая

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
Директо _____ ФИО
Личная подпись _____

28 листов

