



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
общего Т3 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Т3 Общий Калибраторы
(Alinity i Total T3 Calibrators)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**

Alinity i Total T₃ Calibrators



CONTAINS: AZIDE




		CONC	CONC
		ng/mL	nmol/L
CAL A	1 x 3.0 mL	0.20	0.31
CAL B	1 x 3.0 mL	0.50	0.77
CAL C	1 x 3.0 mL	0.75	1.15
CAL D	1 x 3.0 mL	1.50	2.30
CAL E	1 x 3.0 mL	3.50	5.38
CAL F	1 x 3.0 mL	6.00	9.22



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

07P9401



Exp.

2018-04-10


LOT

78239UI00


R01



G52648R02



(01) 00380740130541 (17) 180410
(10) 78239UI00 (240) 07P9401 (91) Total T3

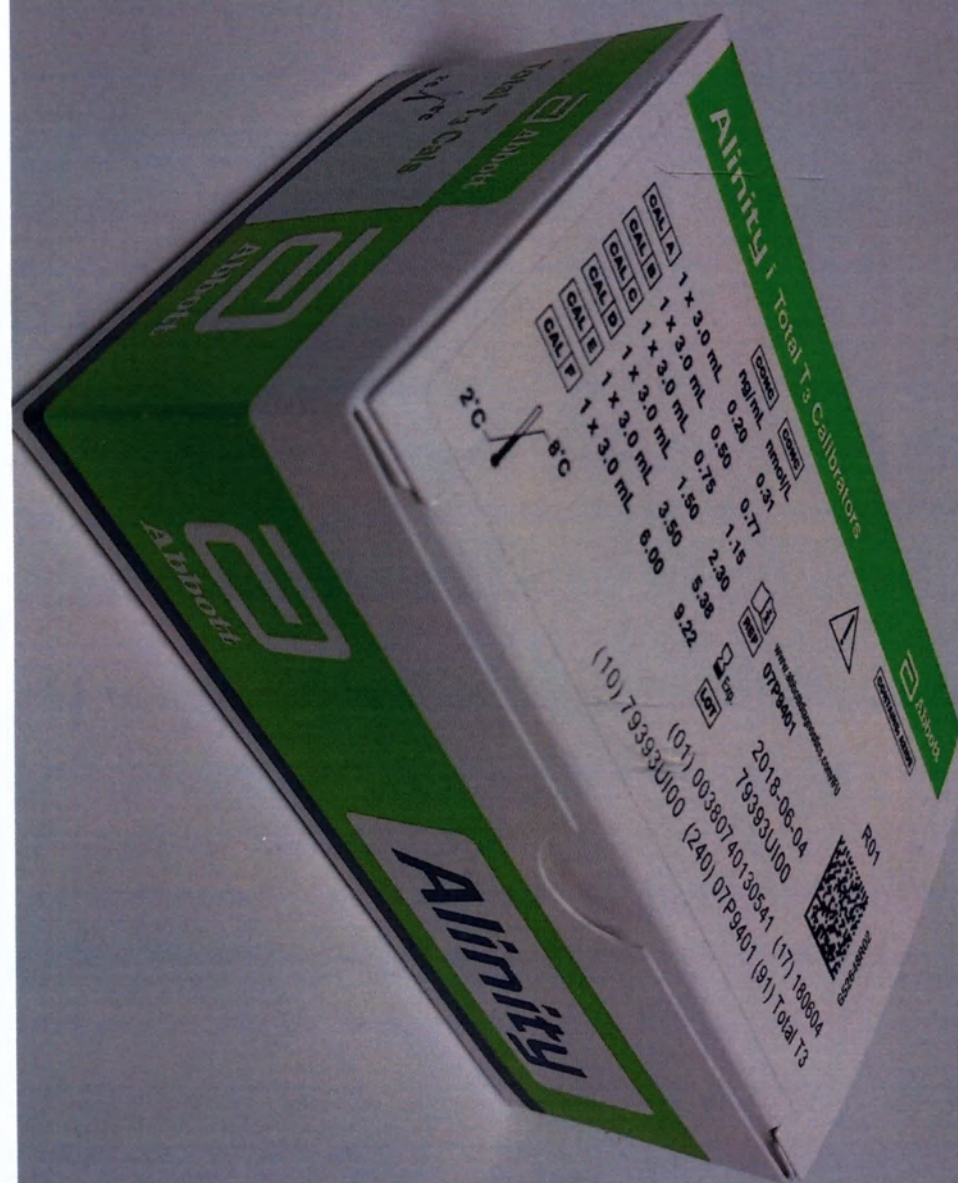





Alinity i Total T₃ Calibrators



CONTAINS: AZIDE

		CONC	CONC
		ng/mL	nmol/L
CAL A	1 x 3.0 mL	0.20	0.31
CAL B	1 x 3.0 mL	0.50	0.77
CAL C	1 x 3.0 mL	0.75	1.15
CAL D	1 x 3.0 mL	1.50	2.30
CAL E	1 x 3.0 mL	3.50	5.38
CAL F	1 x 3.0 mL	6.00	9.22



www.abbottdiagnostics.com/VFU



REF 07P9401



Exp. 2018-04-10




LOT 78239UI00

R01



G52648R02



(01) 00380740130541 (17) 180410
 (10) 78239UI00 (240) 07P9401 (91) Total T₃

en
 Total T₃
 REF 07P9401
 G71276R01
 S7P940

Apply to: CAL A to CAL F





Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на _____

7 (силь)



Макет маркировки на медицинское изделие
Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
общего Т3 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Т3 Общий
Калибраторы (Alinity i Total T3 Calibrators)»



REF

07P94-01

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения общего Т3 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Т3 Общий Калибраторы (Alinity i Total T3 Calibrators)»

в составе:

- Калибратор А (Alinity i Total T3 CAL A) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор В (Alinity i Total T3 CAL B) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор С (Alinity i Total T3 CAL C) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор D (Alinity i Total T3 CAL D) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор Е (Alinity i Total T3 CAL E) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор F (Alinity i Total T3 CAL F) -1 флакон х 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г.

Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Total T₃ Cals



PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353 (0) 23 23 1400

Abbott

Alinity i Total T₃ CalibratorsAlinity i Total T₃ Calibrators

Abbott

		CONC	CONC
		ng/mL	nmol/L
CAL A	1 x 3.0 mL	0.20	0.31
CAL B	1 x 3.0 mL	0.50	0.77
CAL C	1 x 3.0 mL	0.75	1.15
CAL D	1 x 3.0 mL	1.50	2.30
CAL E	1 x 3.0 mL	3.50	5.38
CAL F	1 x 3.0 mL	6.00	9.22



CONTAINS: AZIDE

www.abbottdiagnostics.com/ARJ

07P9401



Exp.




LOT

2°C

2016090235

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



CONTAINS: AZIDE

Alinity i
Total T₃

CAL A


SN

CN

ABBOTT



07P94A
3.0 mL
0.20 ng/mL
G71804R01



CONTAINS: AZIDE

Alinity i
Total T₃

CAL B

SN

CN

ABBOTT



07P94B
3.0 mL
0.50 ng/mL
G71805R01



CONTAINS: AZIDE

Alinity i
Total T₃

CAL C


SN

CN

ABBOTT



07P94C
3.0 mL
0.75 ng/mL
G71806R01



CONTAINS: AZIDE

Alinity i
Total T₃
CAL D


SN

CN

ABBOTT



07P94D
3.0 mL
1.50 ng/mL
G71807R01



CONTAINS: AZIDE

Alinity i
Total T₃
CAL E


SN

CN

ABBOTT



07P94E
3.0 mL
3.50 ng/mL
G71808R01




CONTAINS: AZIDE

Alinity i
Total T₃
CAL F

SN

CN

ABBOTT



07P94F
3.0 mL
6.00 ng/mL
G71809R01

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Пронумеровано, прош
скреплено печатью на

