

**Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие**

**Разбавитель для ручного разведения образцов для исследования общего Т3 с использованием набора Т3 Общий Реагенты на иммунохимических анализаторах Alinity i «Т3 Общий Разбавитель для ручного разведения (Alinity i Total T3 Manual Diluent)»**

**(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**

**Alinity i**

Total T<sub>3</sub>  
Manual Diluent


REF 07P9440

**MANUAL DILUENT**

1 x 5 mL



**CONTAINS: AZIDE**



Abbott Ireland  
Diagnostics Division  
Lisnamuck, Longford  
Co. Longford  
Ireland  
+353-43-3331000

IVD




**PRODUCT OF IRELAND**

**Total T<sub>3</sub>**  
**Manual Diluent**



[www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)

R01



Exp.

2018-02-13




76221UI00






G70638R01

(01) 00380740130572 (17) 180213  
(10) 76221UI00 (240) 07P9440


 Abbott

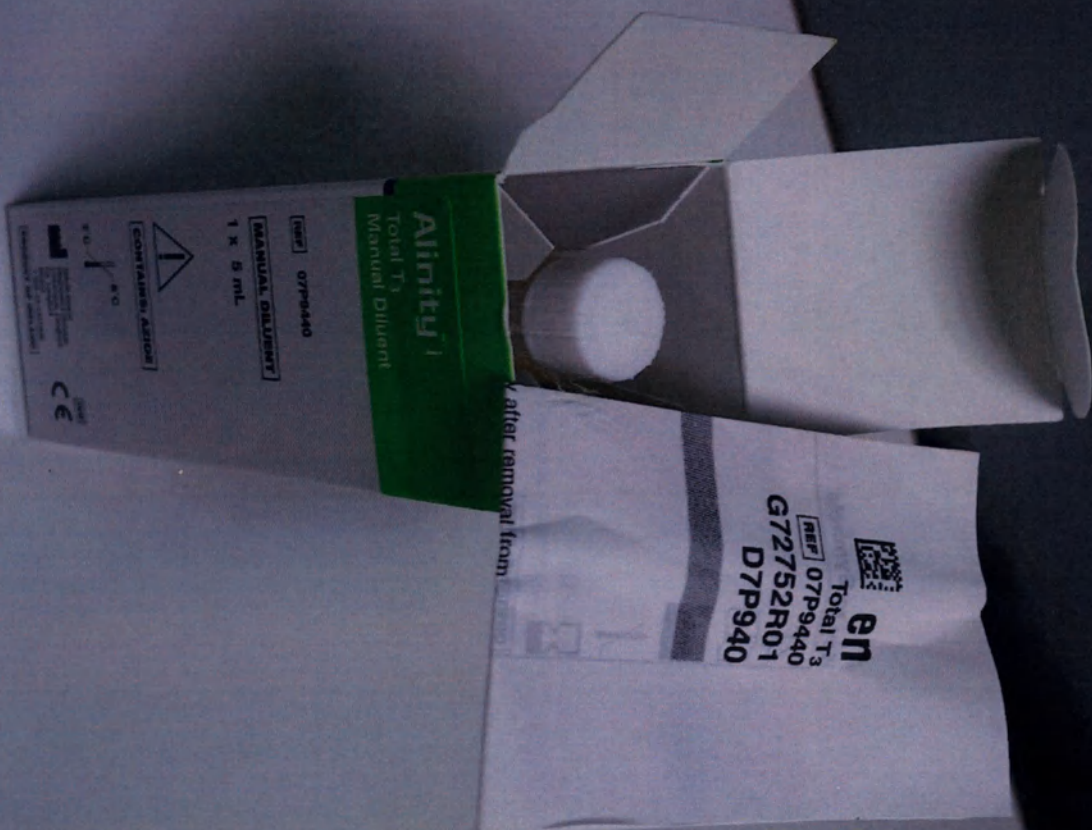

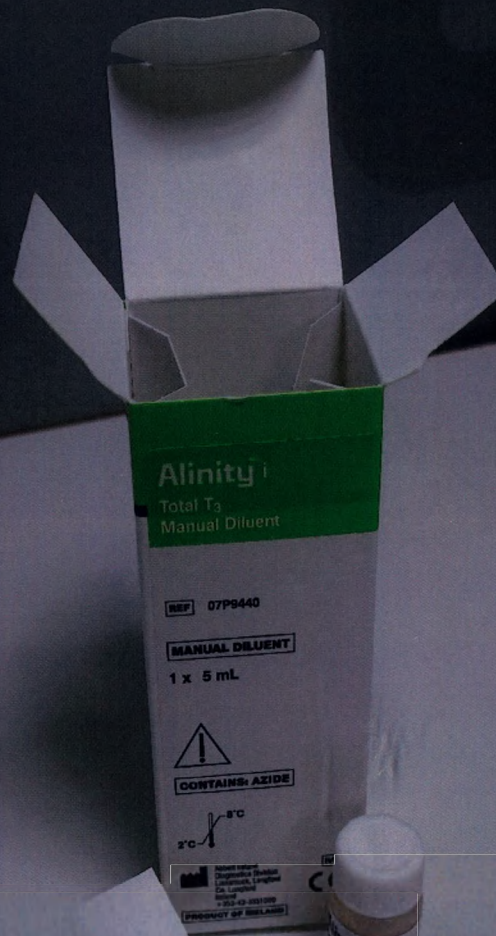

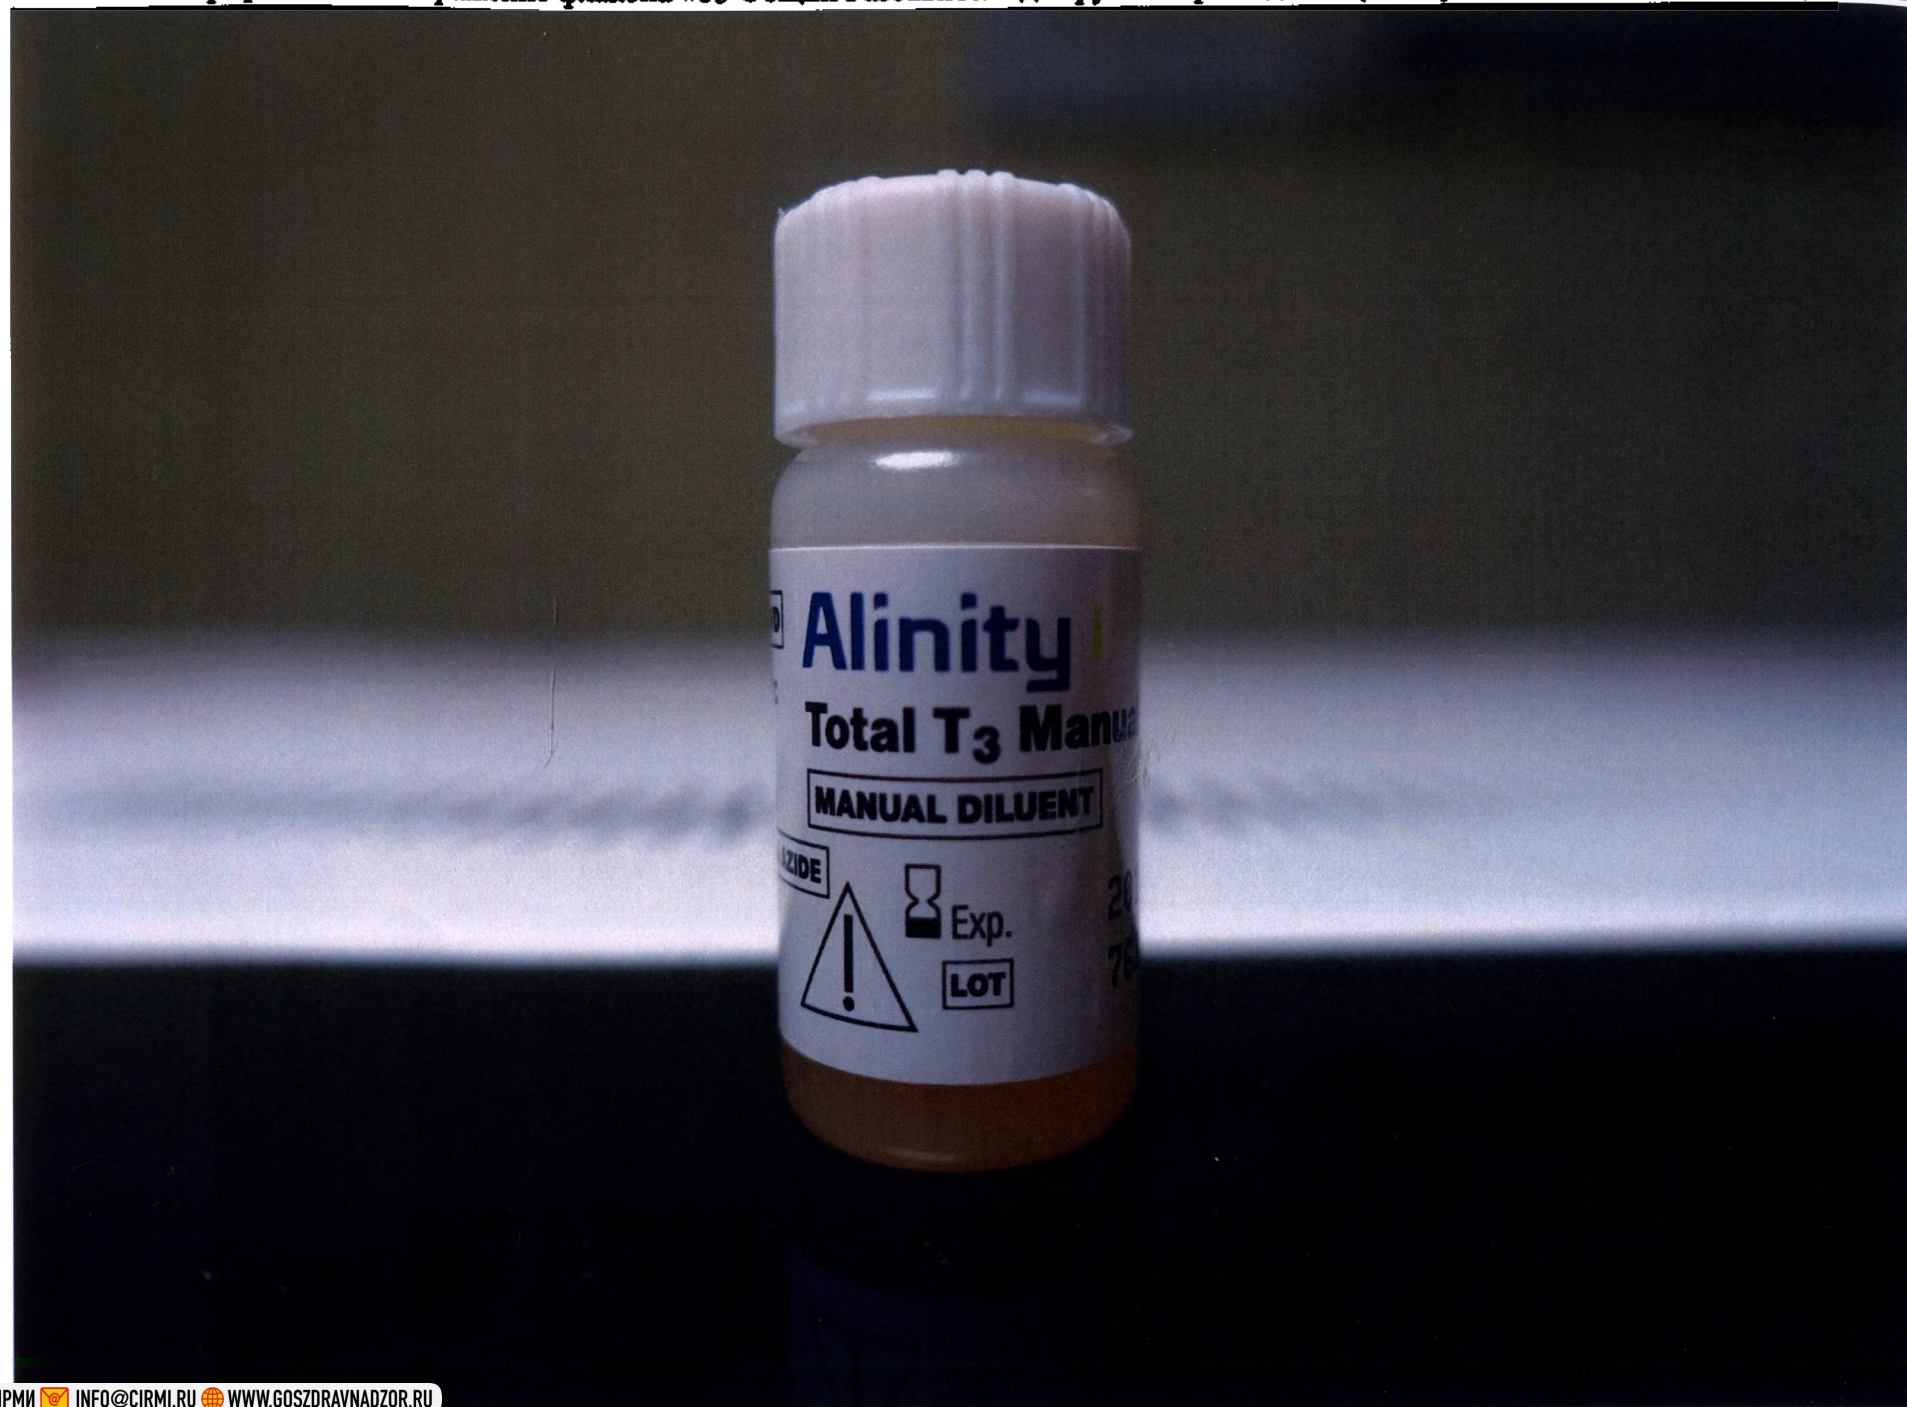

Пронумеровано, проши  
скреплено печатью на

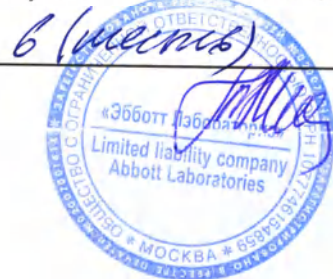

**Макет маркировки на медицинское изделие**  
**Разбавитель для ручного разведения образцов для исследования общего Т3 с**  
**использованием набора Т3 Общий Реагенты на иммунохимических**  
**анализаторах Alinity i «Т3 Общий Разбавитель для ручного разведения (Alinity**  
**i Total T3 Manual Diluent)»**



REF 07P94-40

IVD



Разбавитель для ручного разведения образцов для исследования общего Т3 с использованием набора Т3 Общий Реагенты на иммунохимических анализаторах Alinity i «Т3 Общий Разбавитель для ручного разведения (Alinity i Total T3 Manual Diluent)»

в составе:

- Разбавитель для ручного разведения (Alinity i Total T3 Manual Diluent) – 1 флакон х 5,0 мл
- Инструкция по применению

**Производитель:** Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № \_\_\_\_/\_\_\_\_ от \_\_\_\_./\_\_\_\_./\_\_\_\_ / Инструкцию по применению на русском языке: [www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

**Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,  
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Abbott

Alinity i  
Total T3  
Manual Diluent

G70638R01


REF 07P9440

MANUAL DILUENT

1 x 5 mL



CONTAINS: AZIDE

[www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)Total T3  
Manual DiluentAbbott Ireland  
Diagnostics Division  
Lisnamuck, Longford  
Co. Longford  
Ireland  
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND



Alinity i

Total T<sub>3</sub> Manual Diluent

MANUAL DILUENT

07P94P

5 mL

G52649R02

CONTAINS: AZIDE

Exp.

LOT

ABBOTT



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

| Стандарт                  | Наименование стандарта                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015 | Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.                                     |
| ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015 | Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения. |
| ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014   | Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.                                      |

асшифровка символов представлена в инструкции.

Пронумеровано, прошито  
скреплено печатью на \_\_\_\_\_

