

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ВестМед»

Столярова Е.К.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Установка стоматологическая имплантологическая портативная
хирургическая Implantmed SI-923, производства «W&H Dentalwerk Bürmoos
GmbH, Austria


Содержание

Установка стоматологическая имплантологическая портативная хирургическая Implantmed SI-923	3
1. Блок управления SI-923.....	4
2. Кассета для стерилизации.....	7
3. Транспортировочный чемодан	8
4. Тележка, белая или Тележка, белая, с электрическими розетками	9
5. Держатель мотора	11
6. Штатив	12
7. Предохранитель 250 V – T1, 25 АН	13
8. Устройство, предотвращающее скручивание Locking pin.....	14
9. Мотор ЕМ-19 с кабелем длиной 1,8 м.	15
10. Педаль управления S-N1	17
10. педаль управления SN-2 проводная	18
11 Бюгель для перемещения педали управления S-N1	19
11. Бюгель для перемещения педали управления S-N2	20
12. Комплект стерильных одноразовых трубок для промывания, длина 2,2 м).....	21
13. Стерилизуемый комплект трубок для промывания, длина 2,2 м.....	22
14. Фиксаторы (5 шт.).....	23
15. Образец русскоязычного стикера.....	24
16. Потребительская упаковка.....	25
Эксплуатационная документация. 1. Инструкция по эксплуатации	26



1. Блок управления SI-923

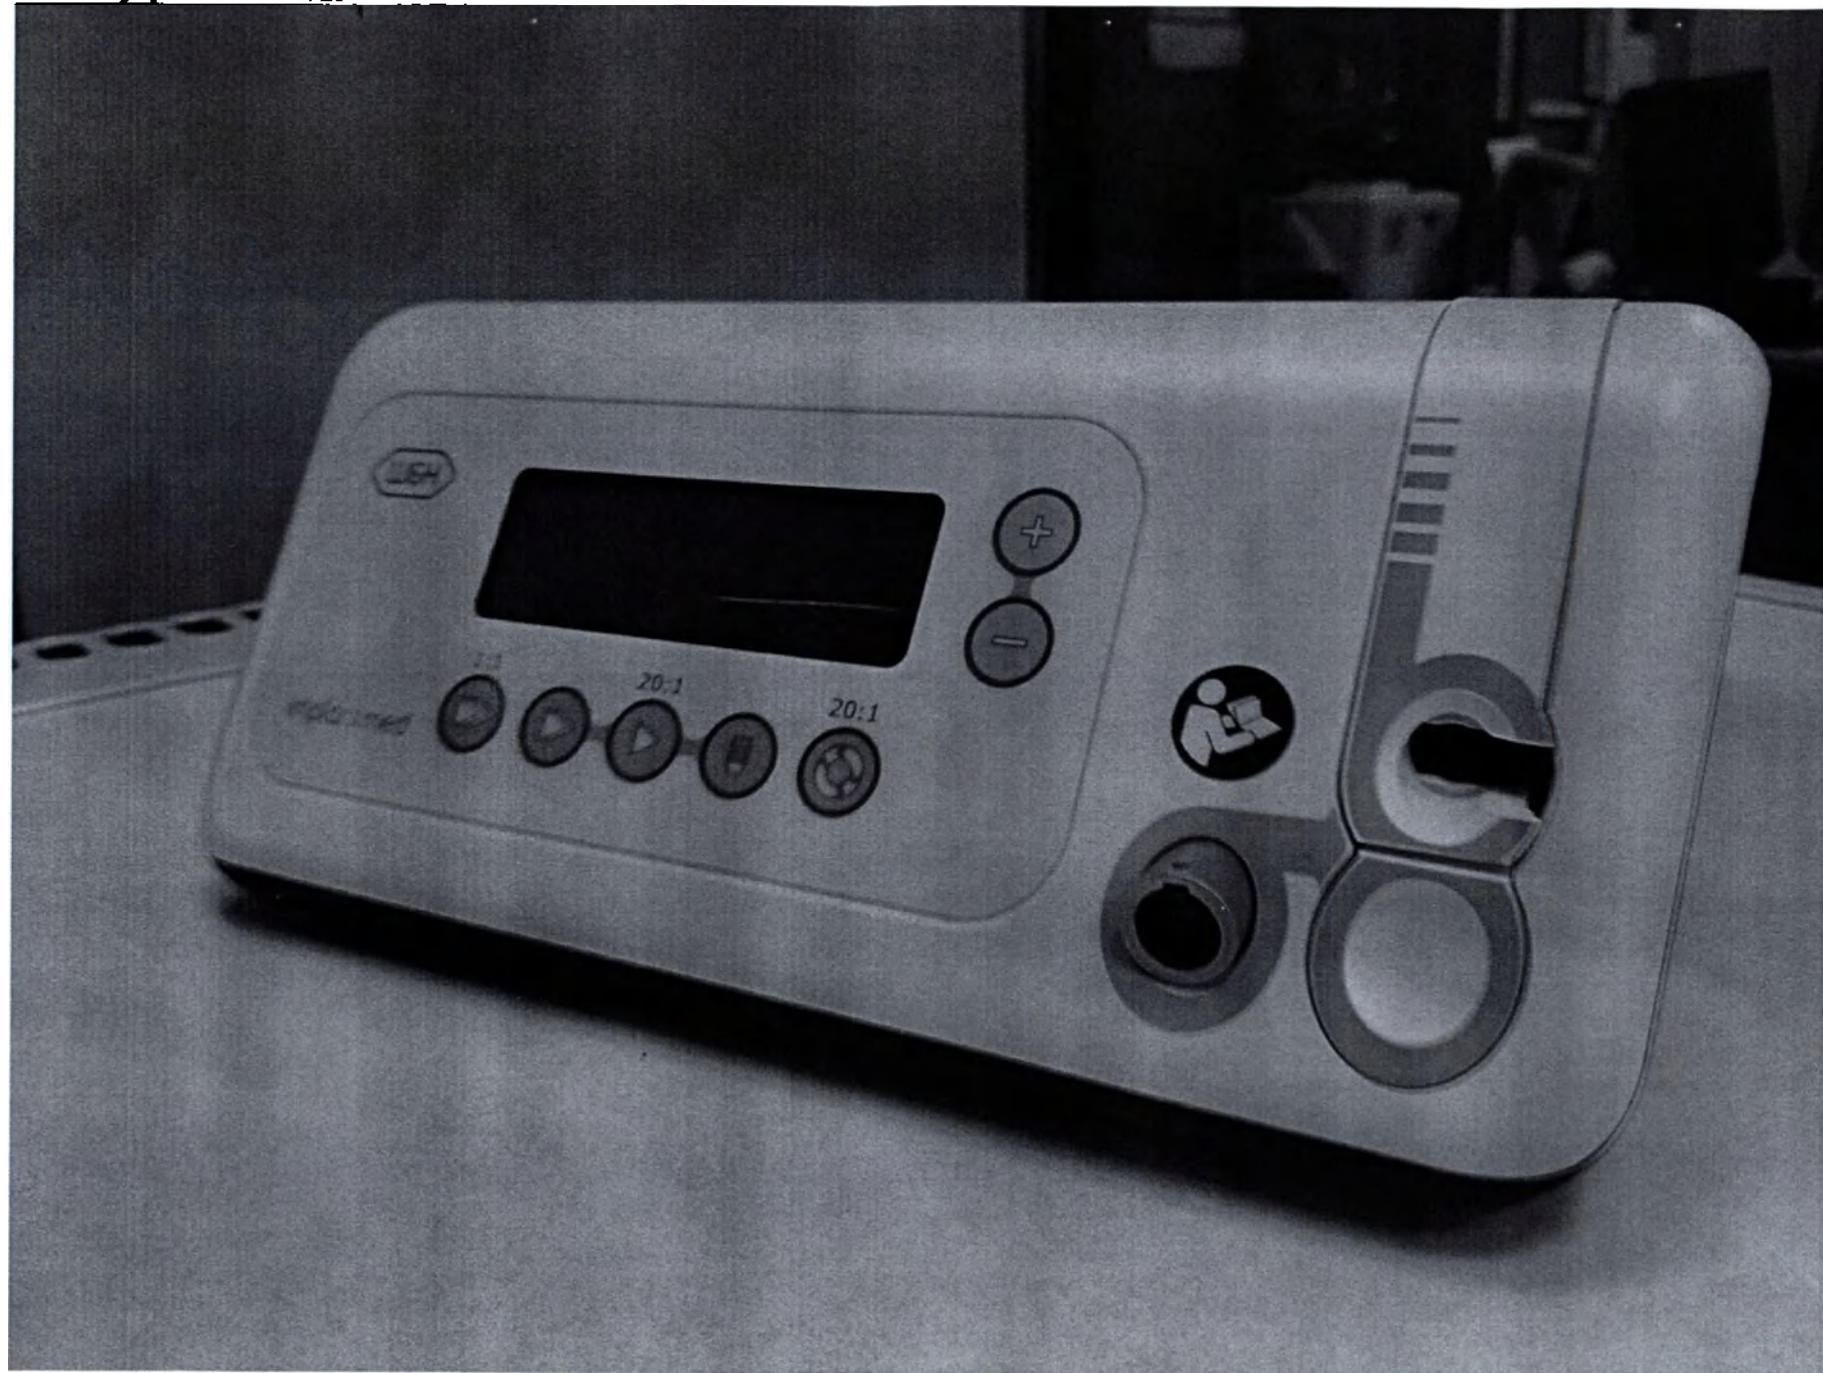

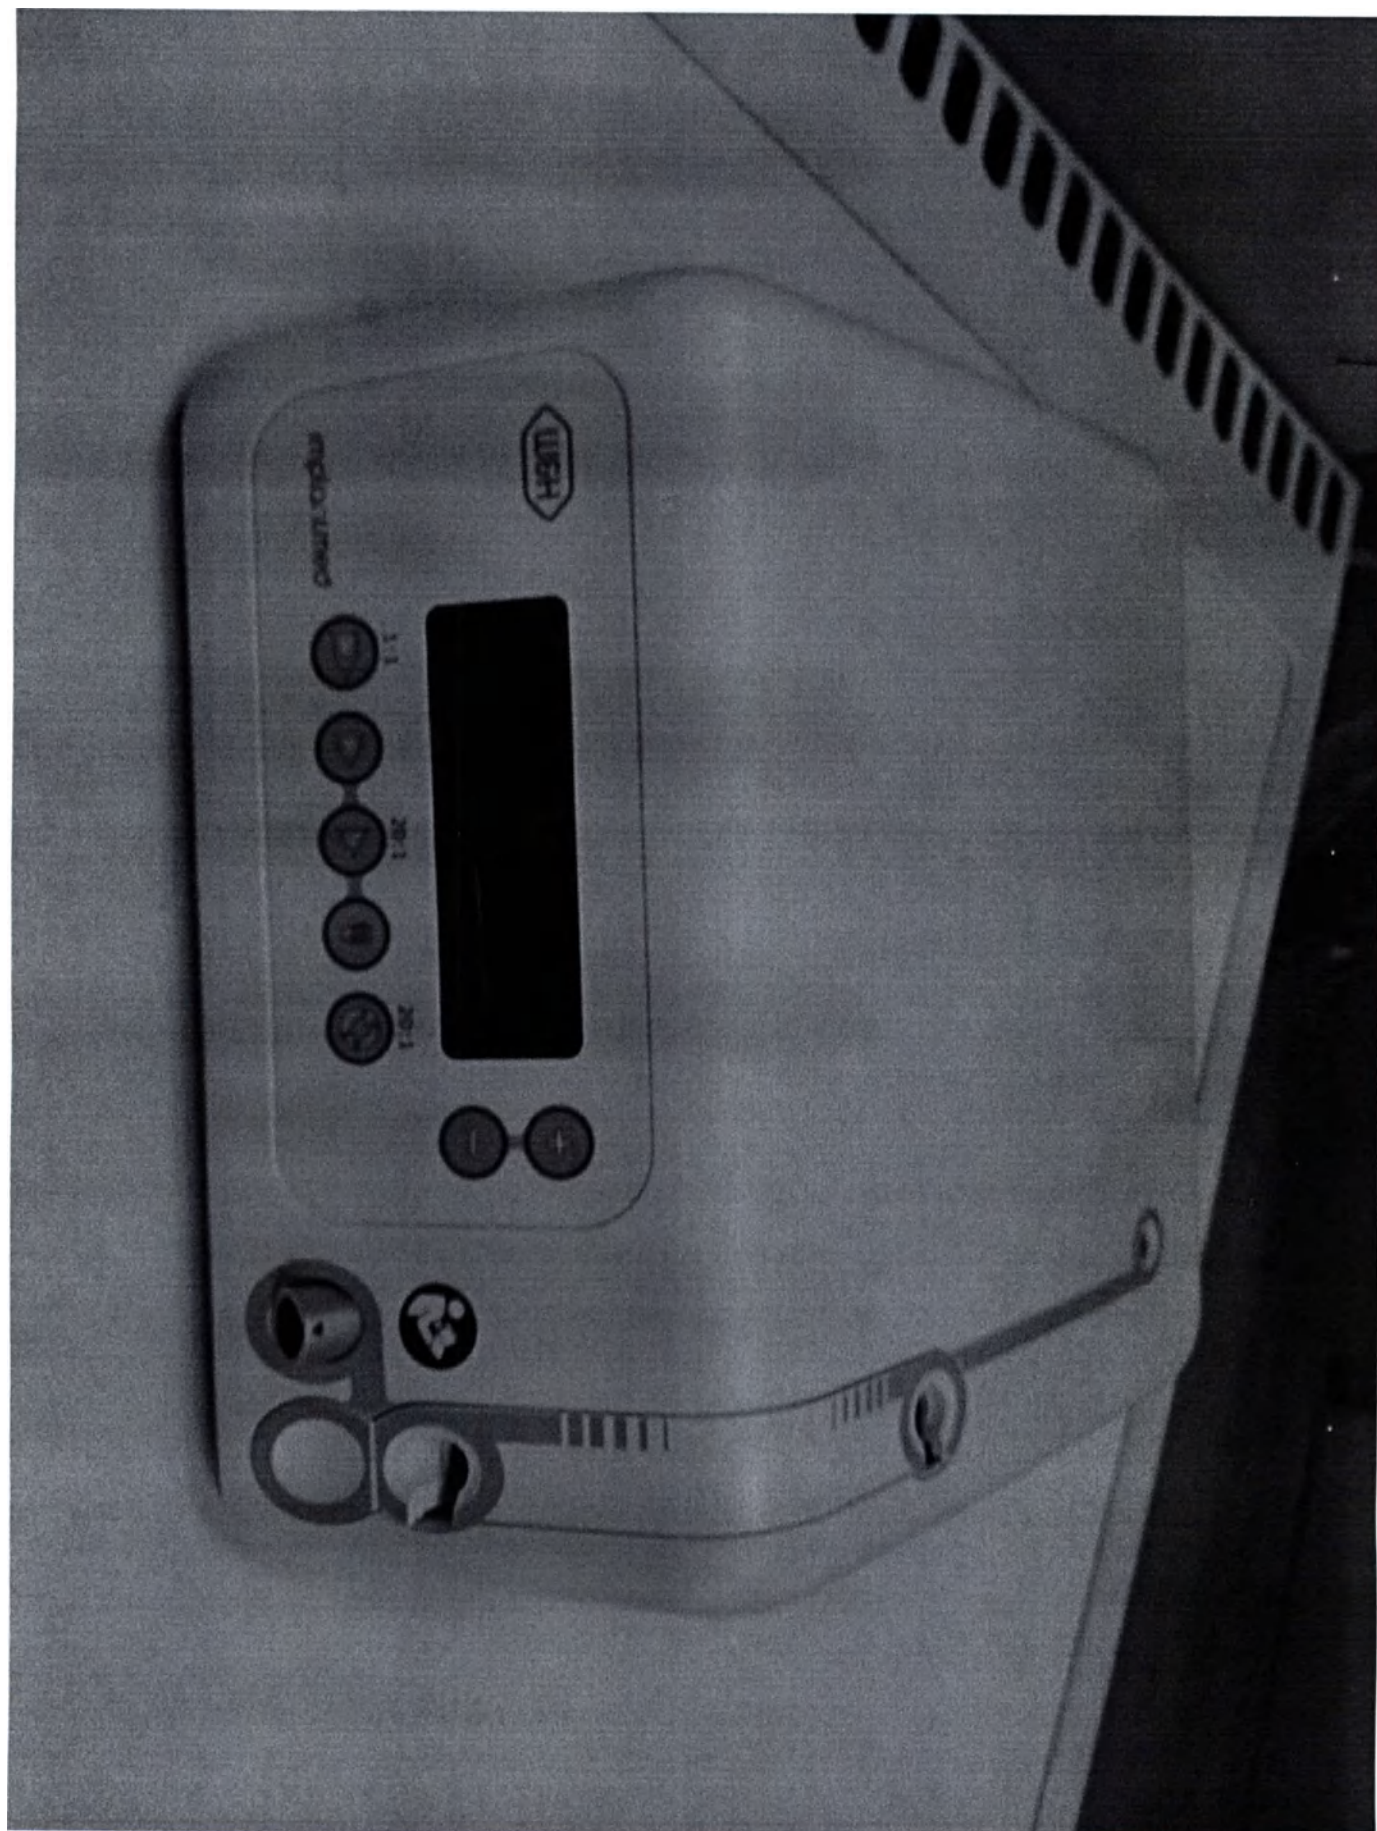



ИИХ-441-36118-01

Type		SH-923	SN	12071
rpm		20.000 max.	Cal 2015	170 VA
V		230-240 AC	A 0,1-0,8	50-60 Hz

2. Кассета для стерилизации




3. Транспортировочный чемодан




4. Тележка, белая или Тележка, белая, с электрическими розетками



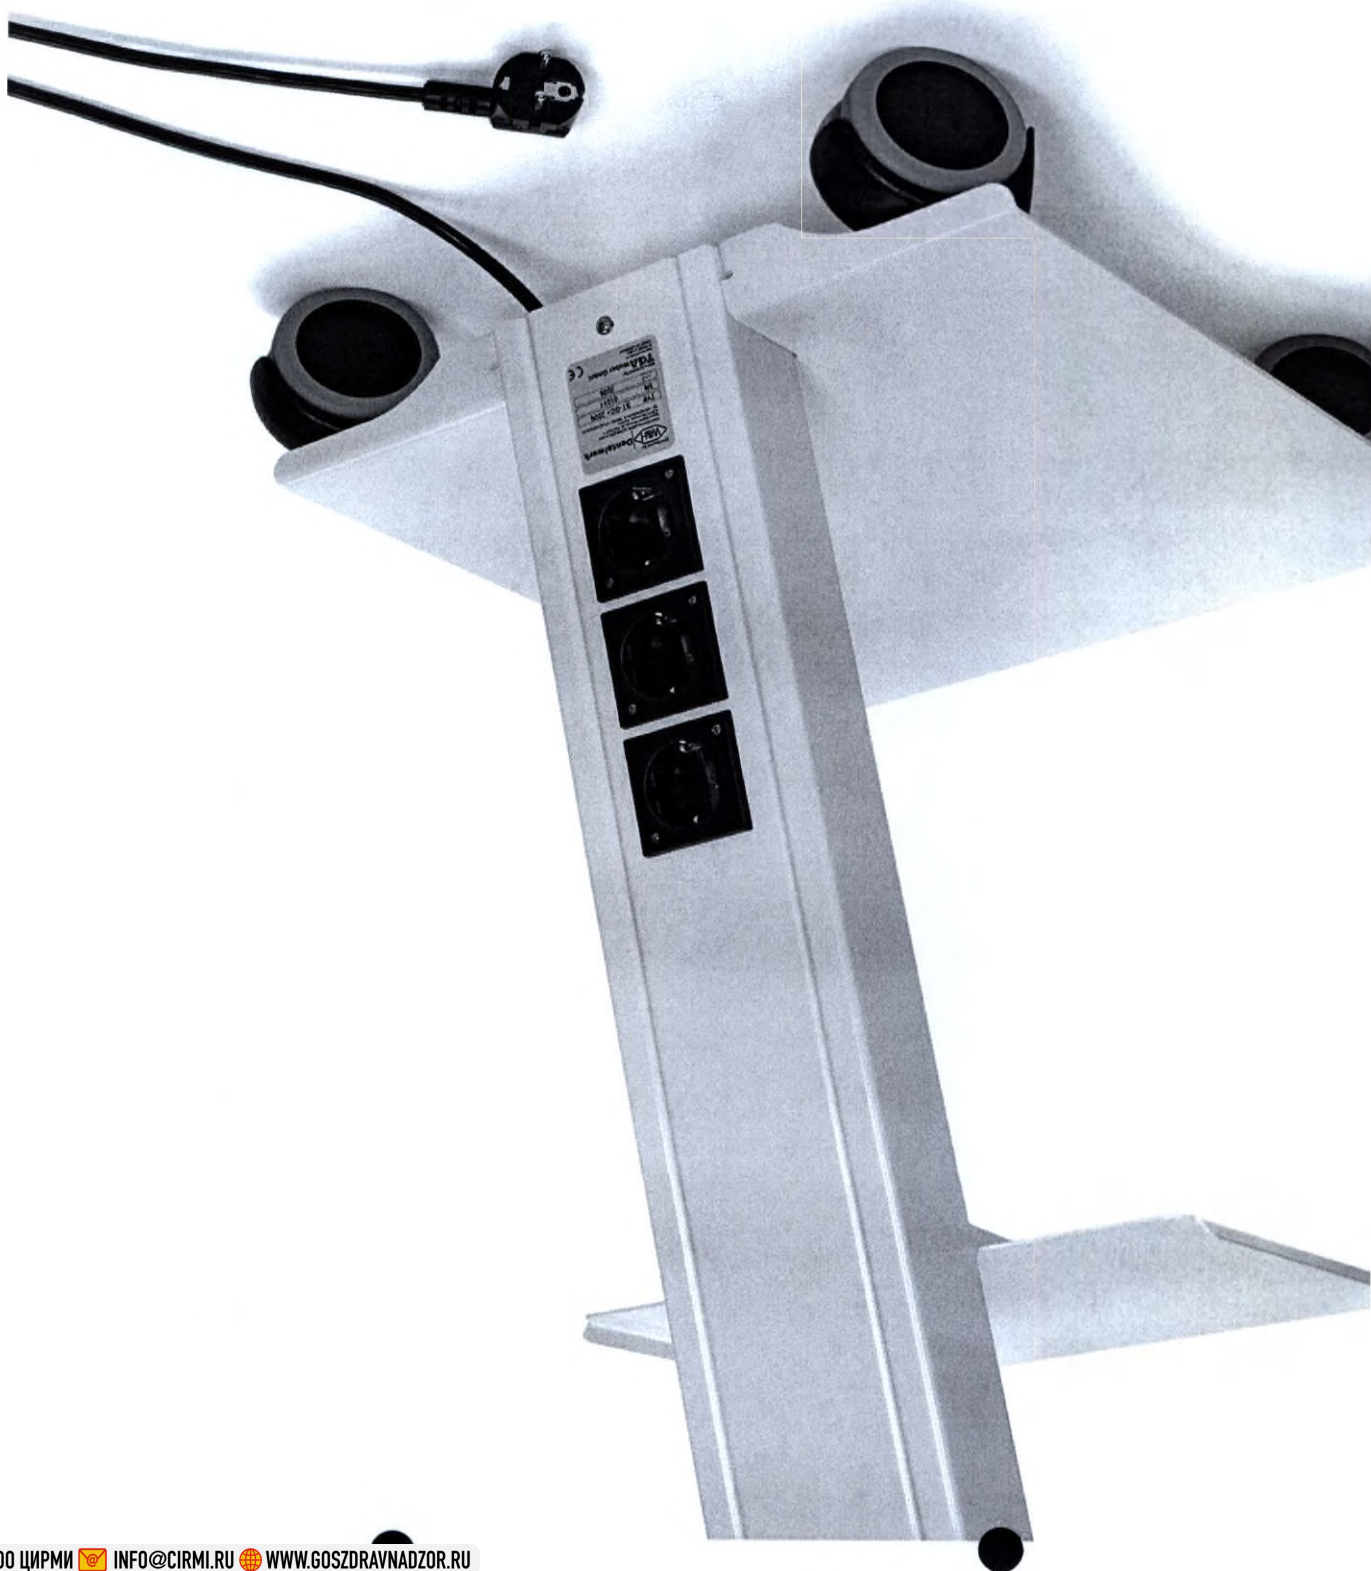


5. Держатель мотора




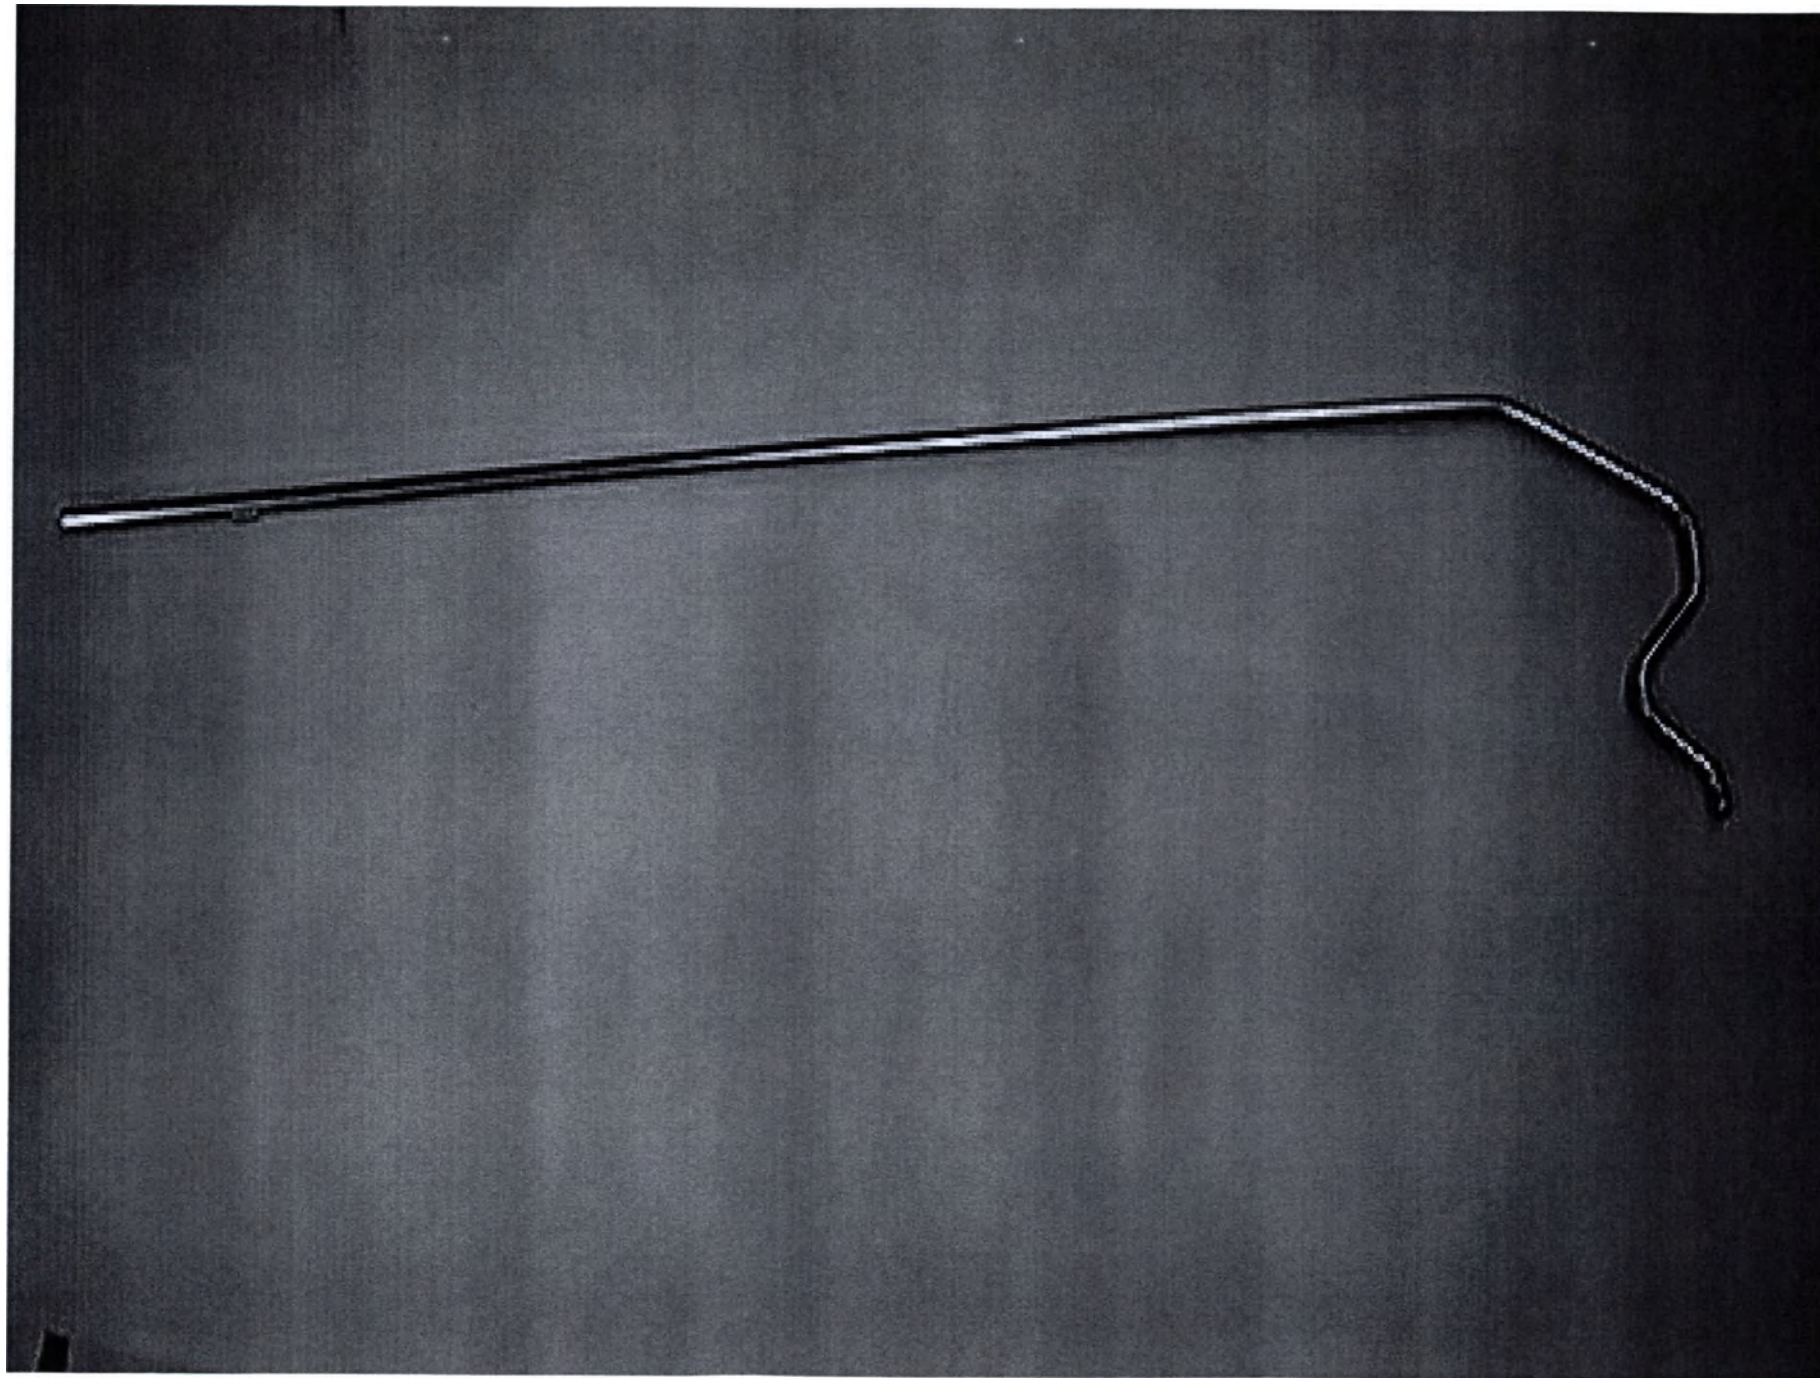

7. Предохранитель 250 V – T1, 25 АН

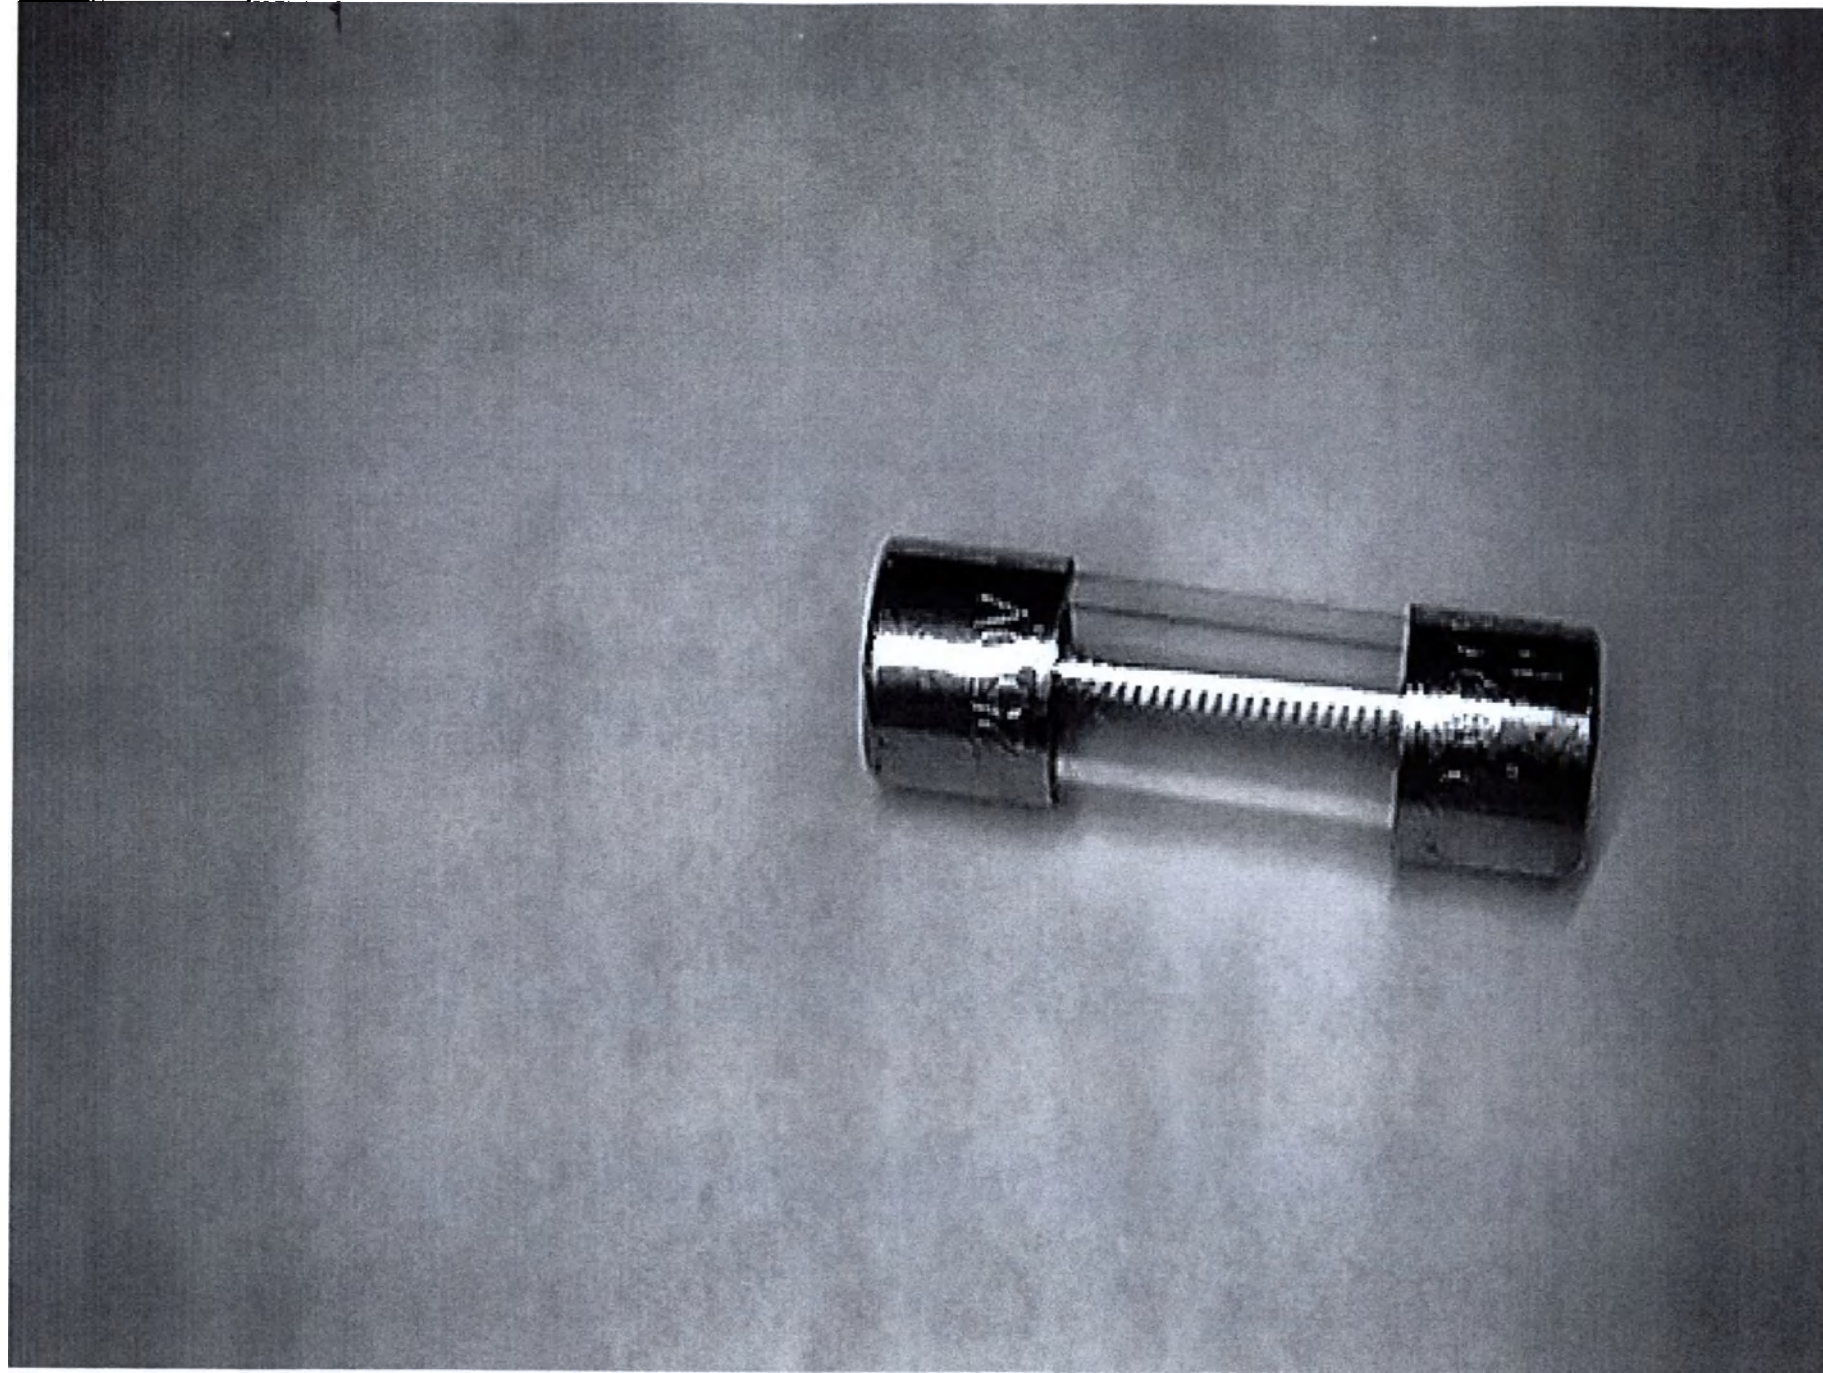

8. Устройство, предотвращающее скручивание Locking pin

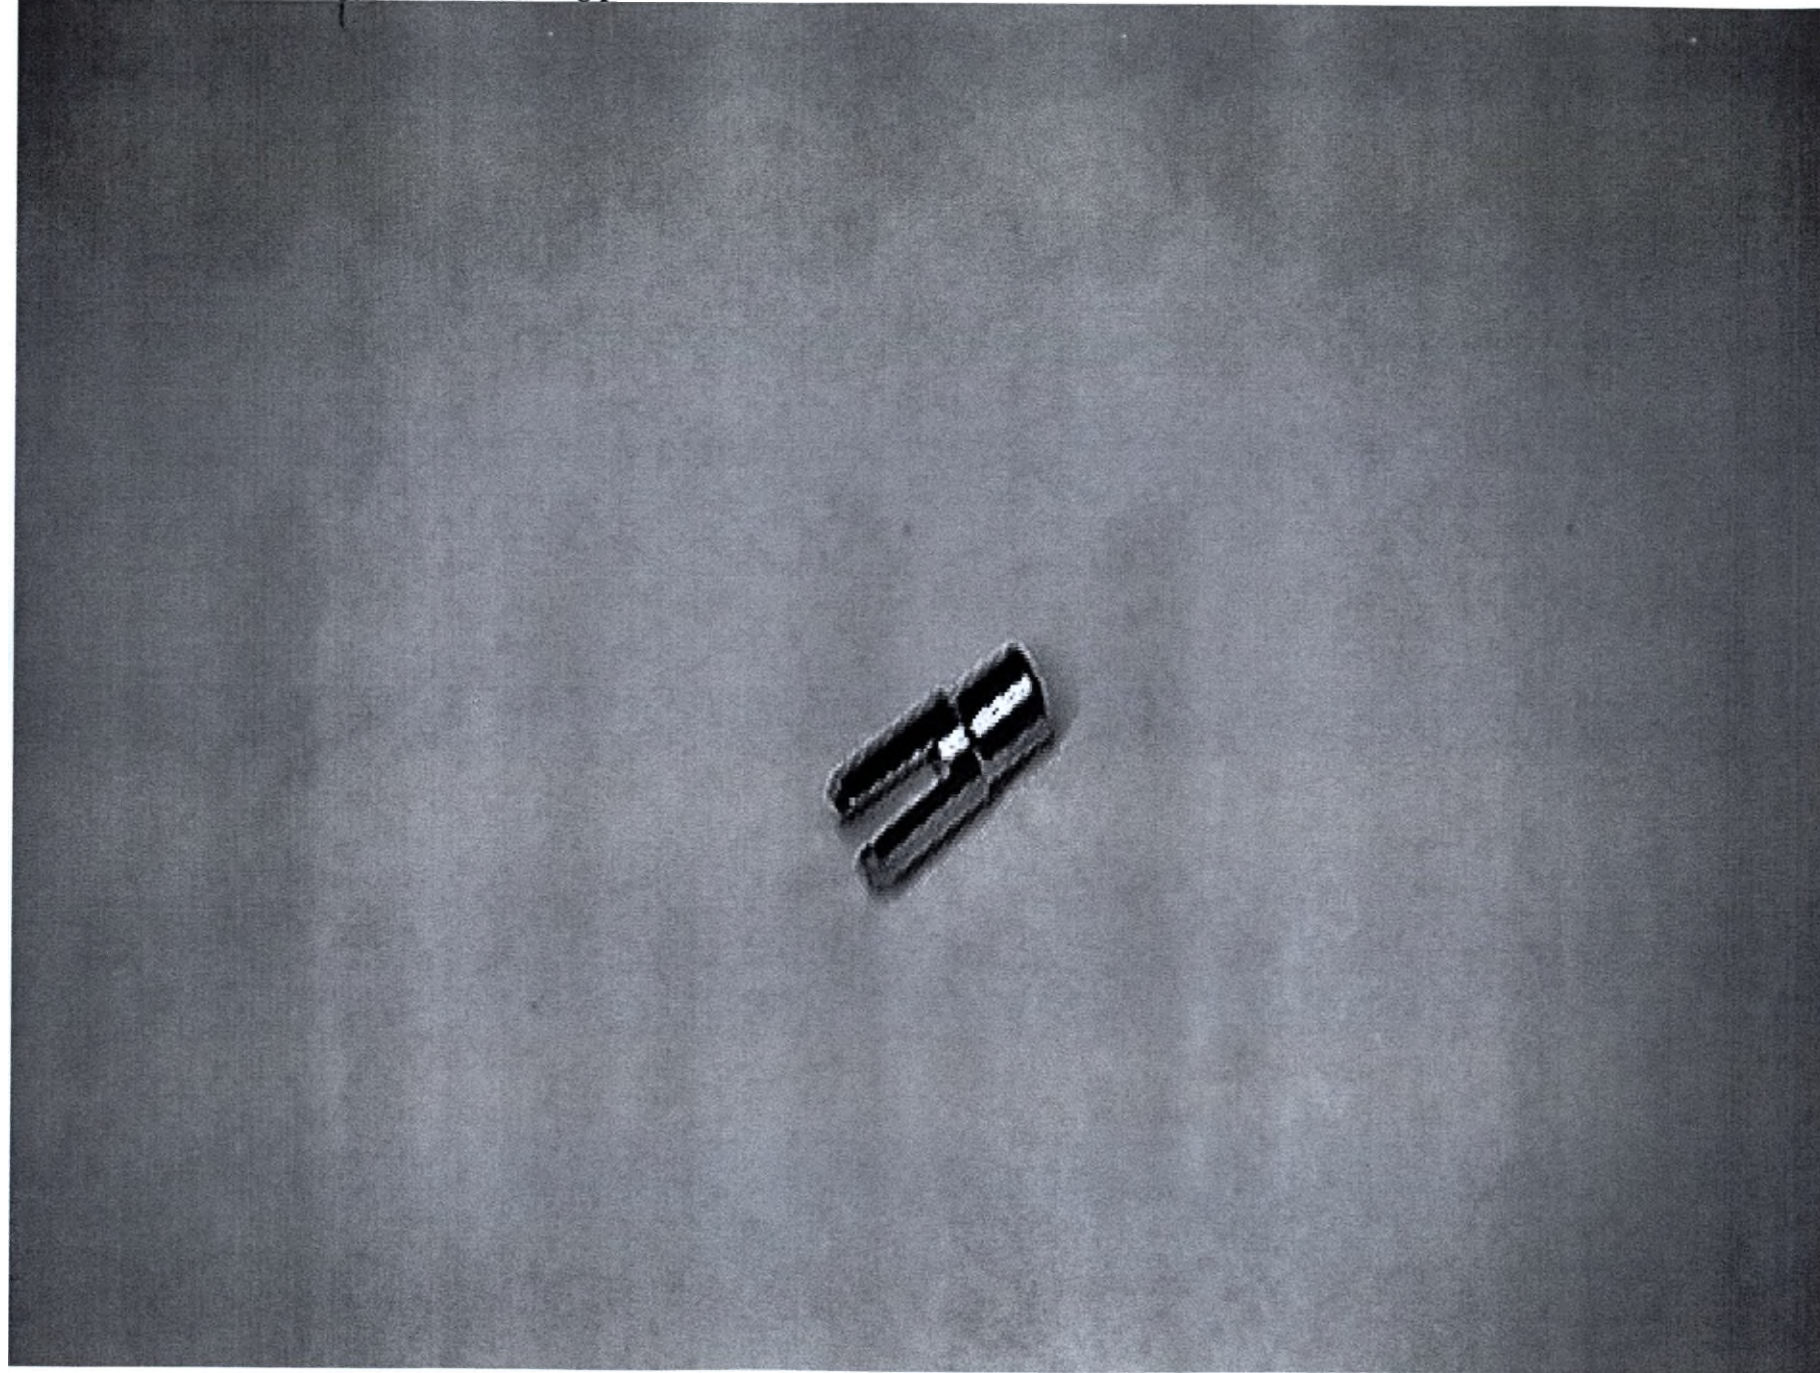

9. Мотор EM-19 с кабелем длиной 1,8 м.





10. Педаль управления S-N1




10. педаль управления SN-2 проводная






11. Бюгель для перемещения педали управления S-N2

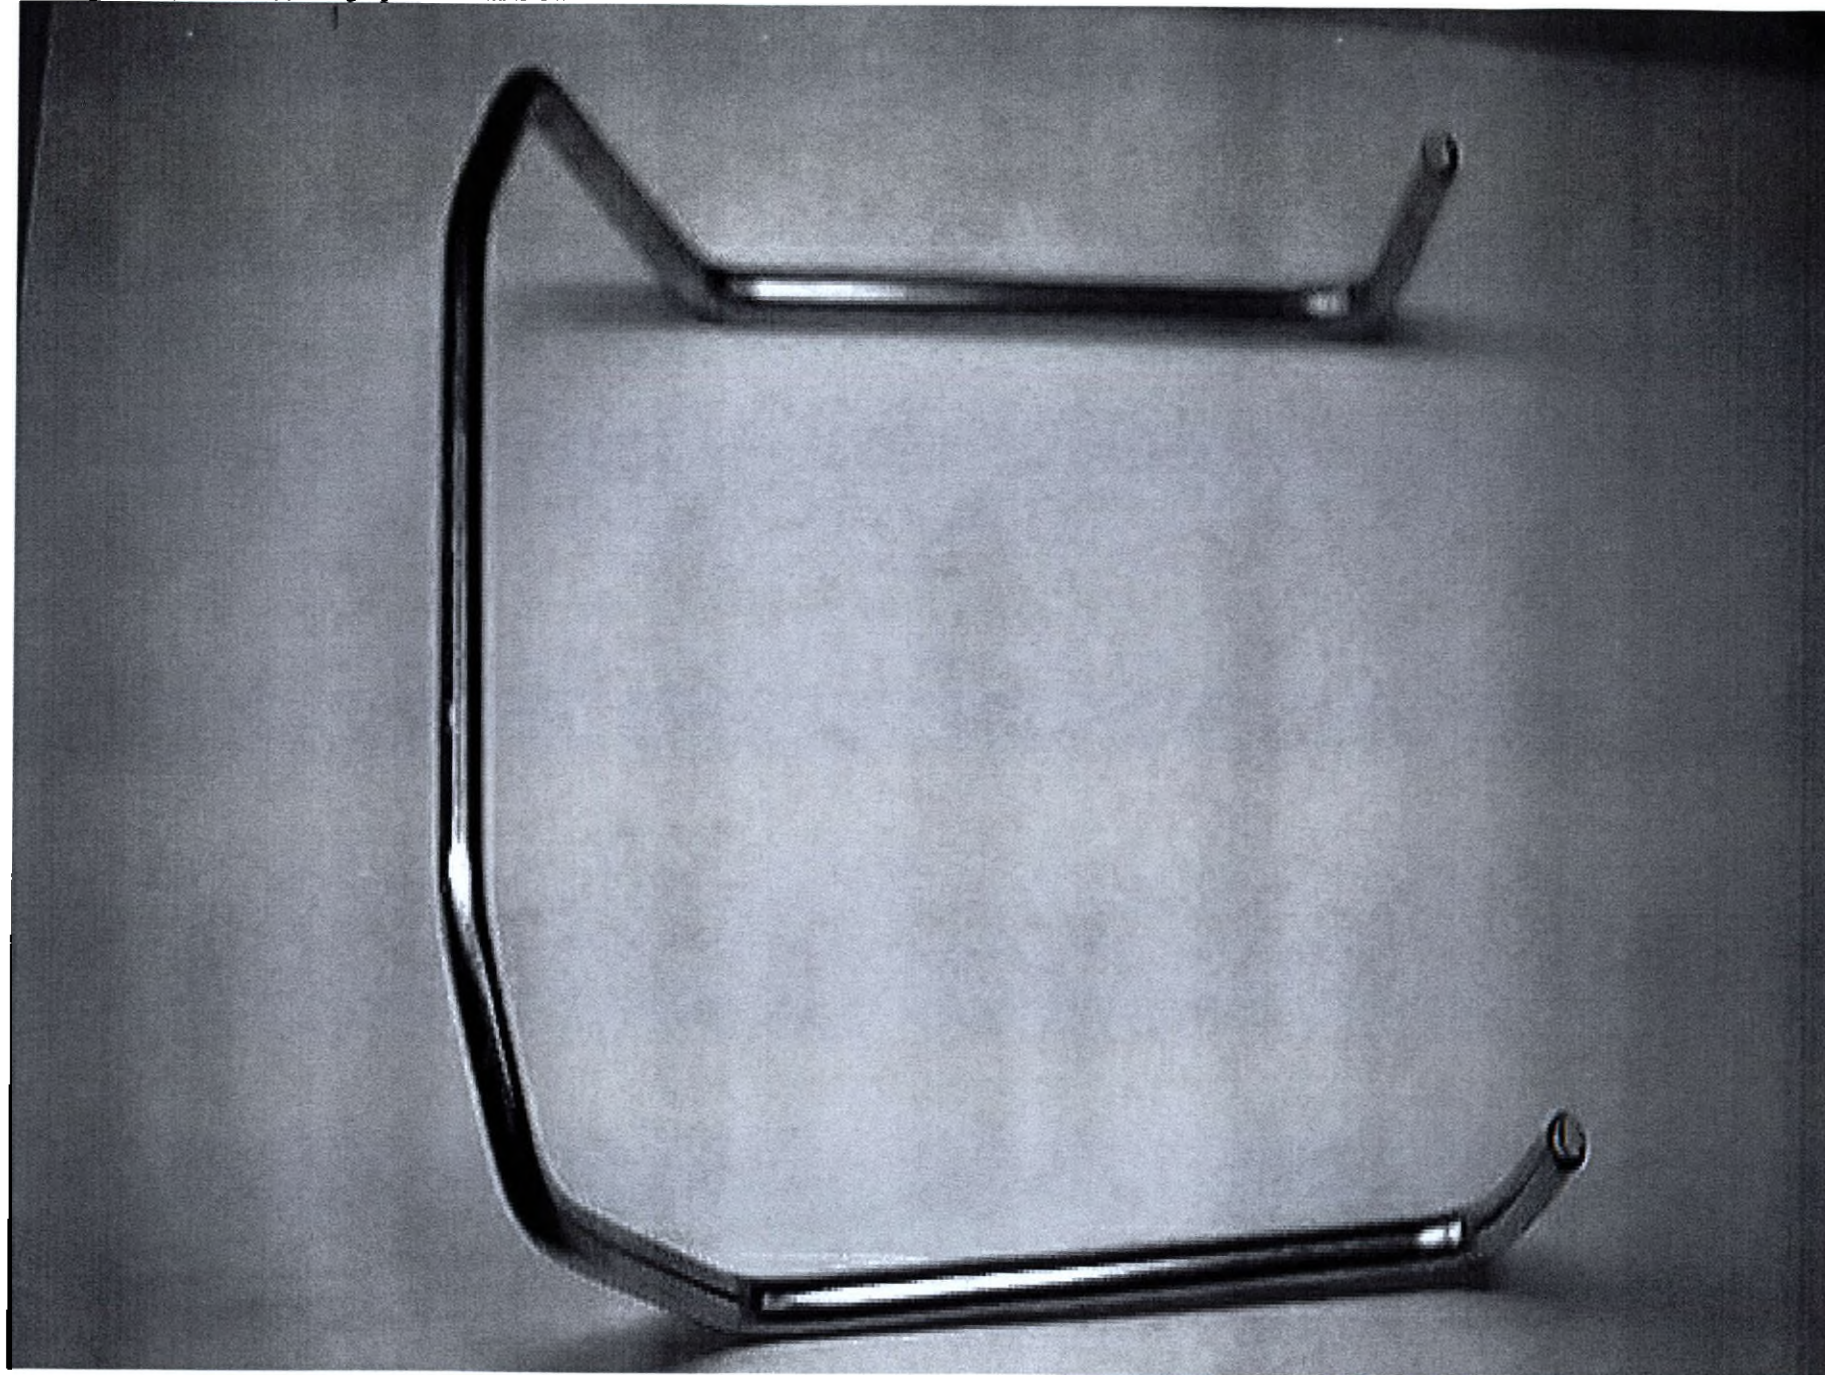


[illegible]


13. Стерилизуемый комплект трубок для промывания, длина 2,2 м.

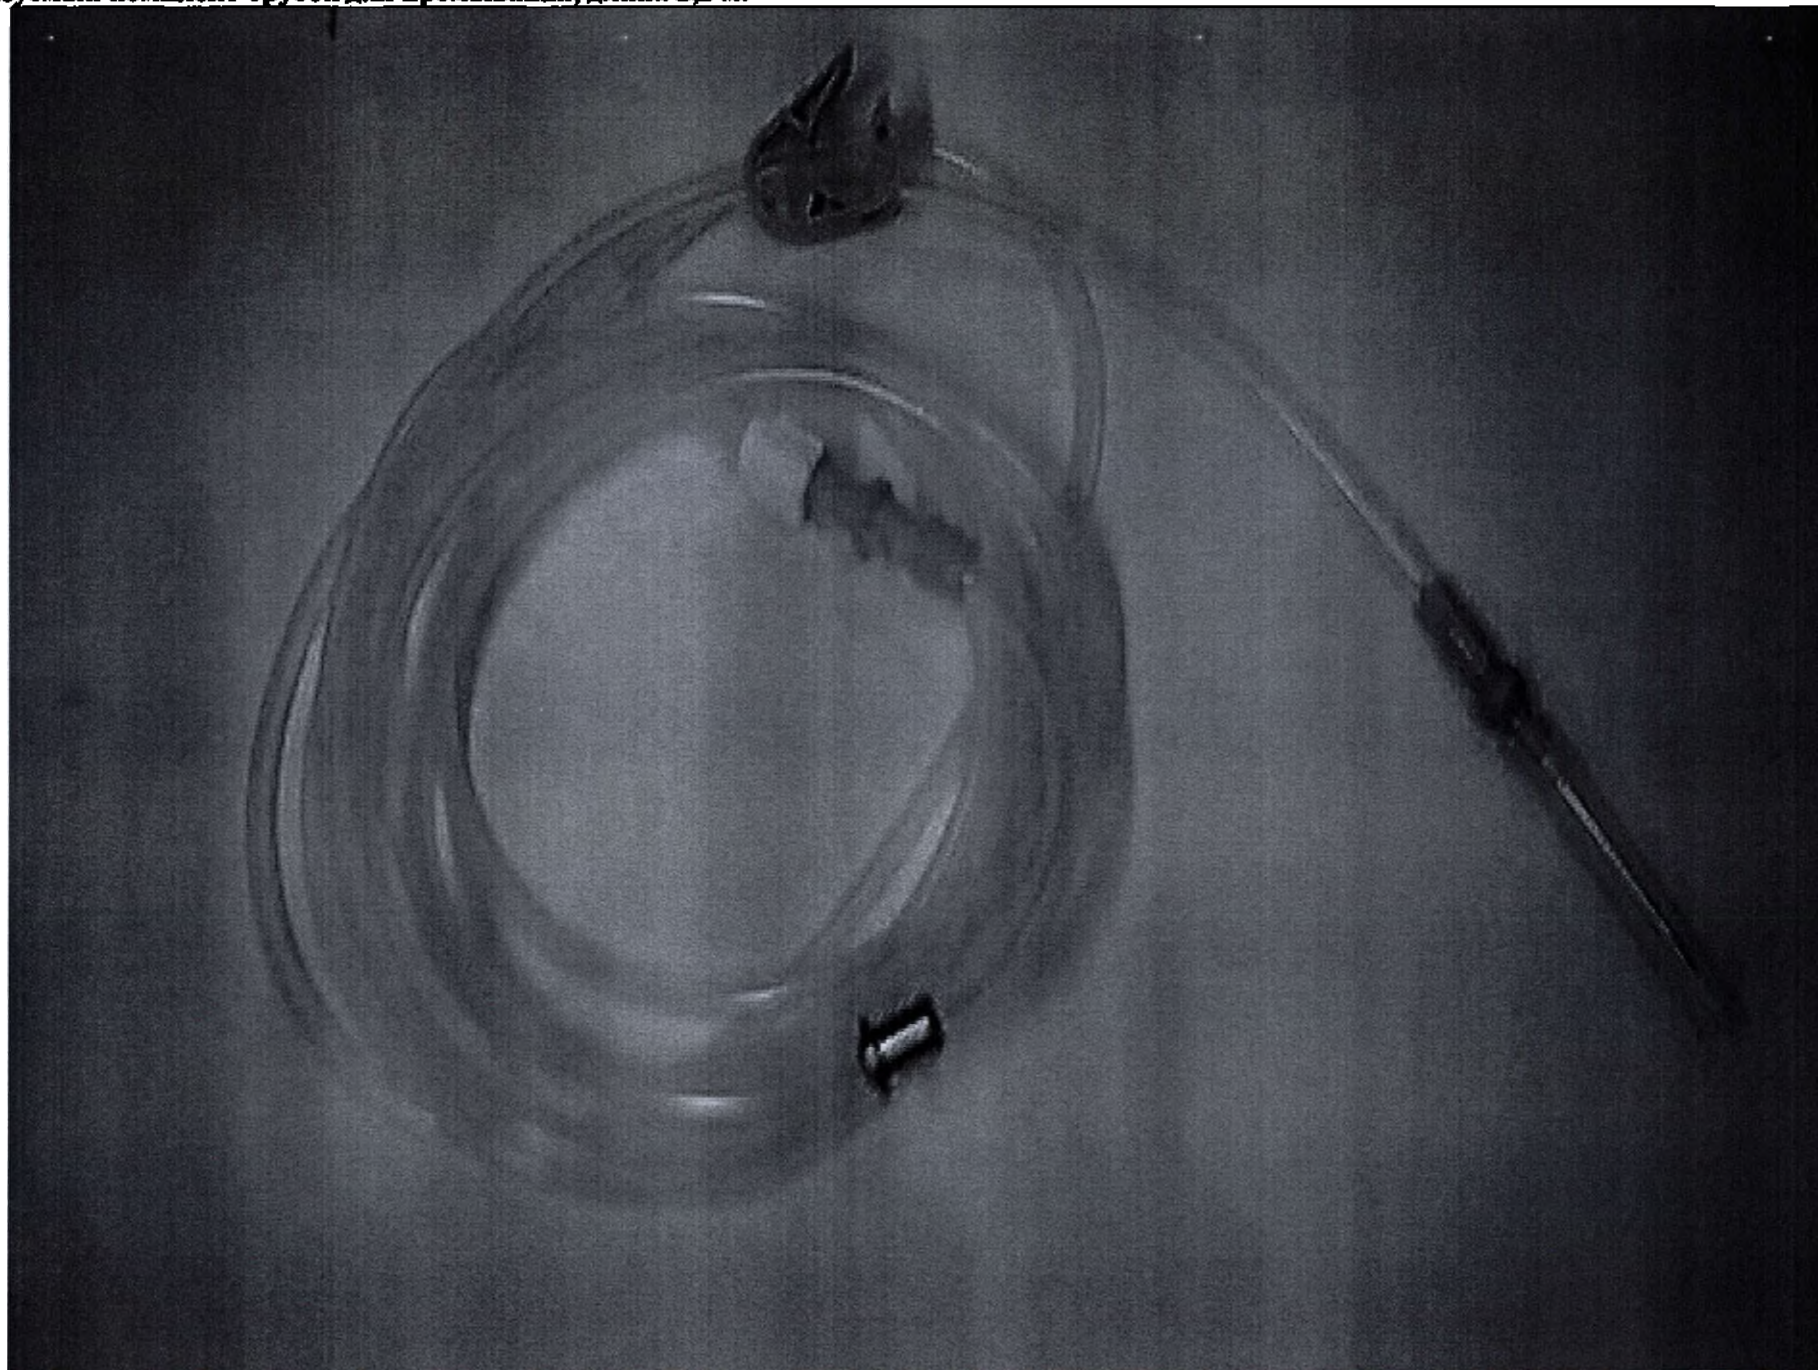

14. Фиксаторы (5 шт.)

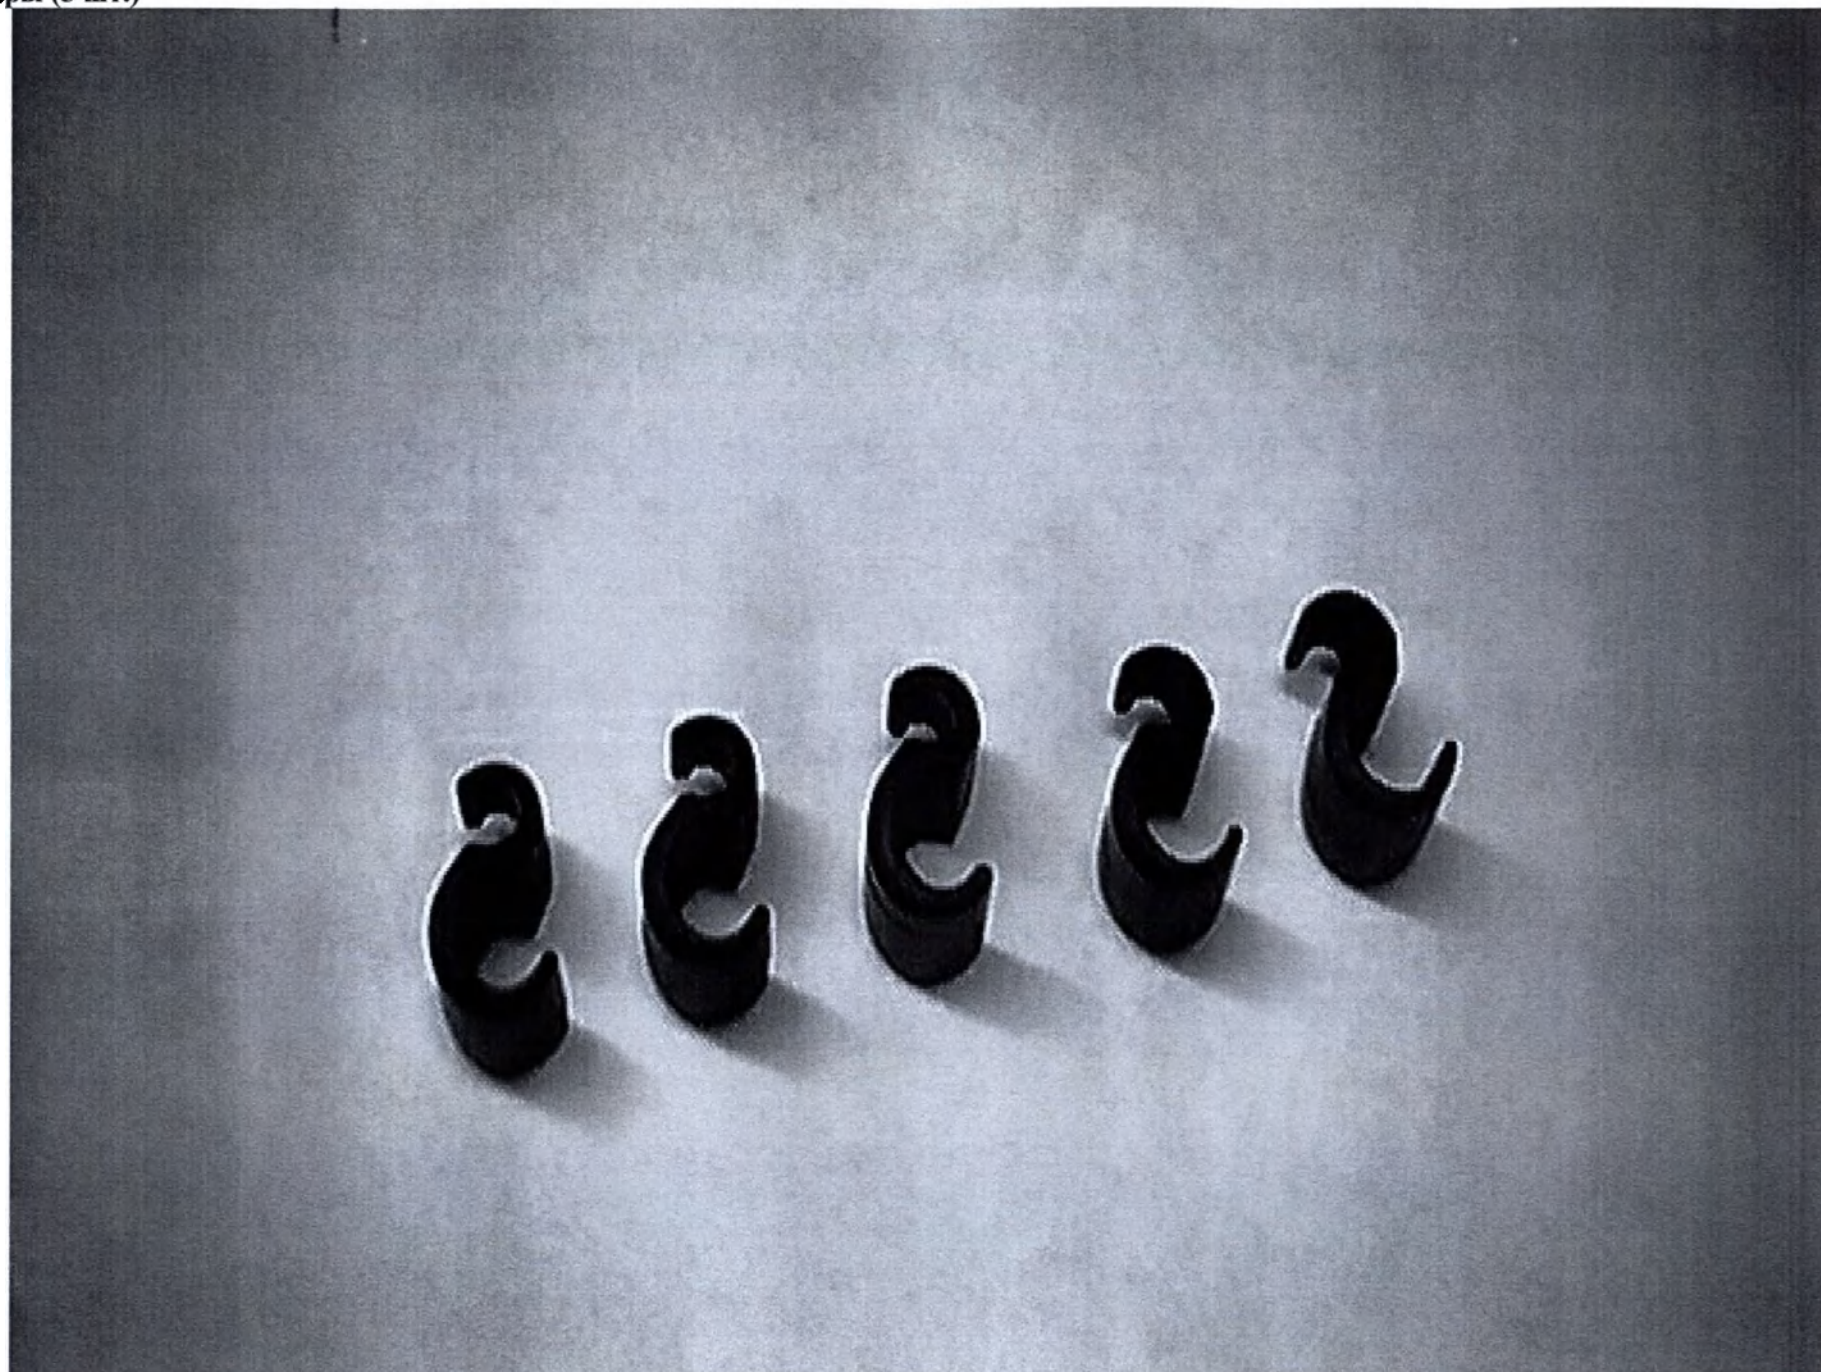

PEOPLE HAVE PRIORITY

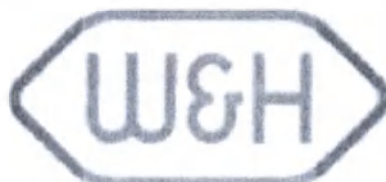

**Установка стоматологическая
имплантологическая портативная хирургическая
Implantmed SI-923 с принадлежностями**

РУ № XXX 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Информация о технике безопасности и использованию по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.


Производитель:
W&H Dentalwerk Buermoos
GmbH, Ignaz-Glaser-Straße
53, 5111 Bürmoos, Austria

Уполномоченный представитель:
ООО «ВестМед», Россия,
121087, г. Москва,
Промышленный проезд,
д. 5, стр. 1



Approved by
Account Manager

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH



Joachim Wickl



August 12, 2019

Инструкция по эксплуатации

Установка стоматологическая имплантологическая портативная

хирургическая Implantmed SI-923

производства W&H Dentalwerk Buermoos GmbH, Австрия

2019

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатно 16 лист (ов)

Столррова

