

Приложение № 1


Фотографии общего вида медицинского изделия:

«Прибор офтальмологический UD-800 ультразвуковой диагностический с принадлежностями», производства TOMEY CORPORATION (ТОМЕЙ КОРПОРЕЙШН), Япония.


Основной блок



Датчик В-режима

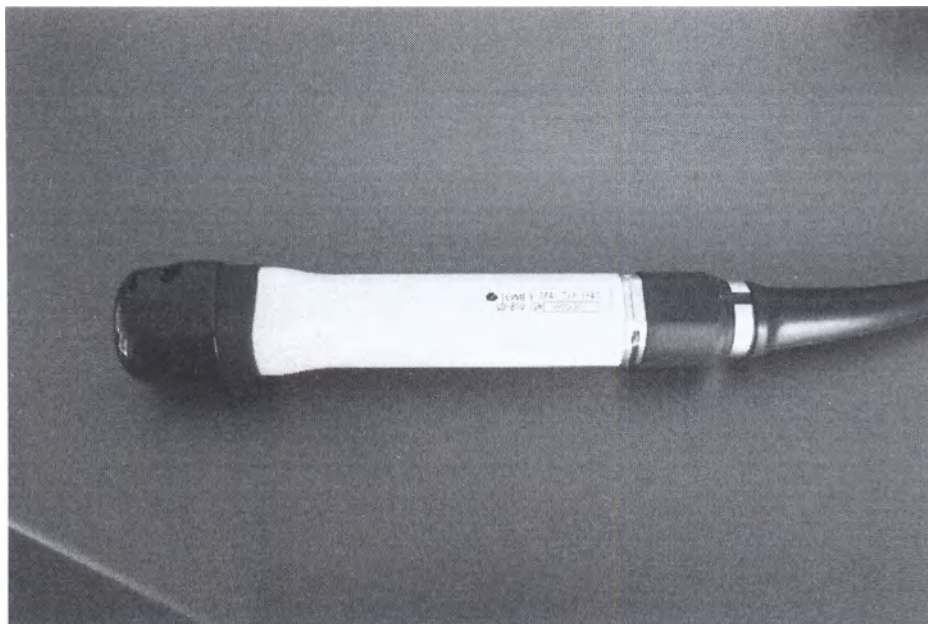


Кабель электропитания

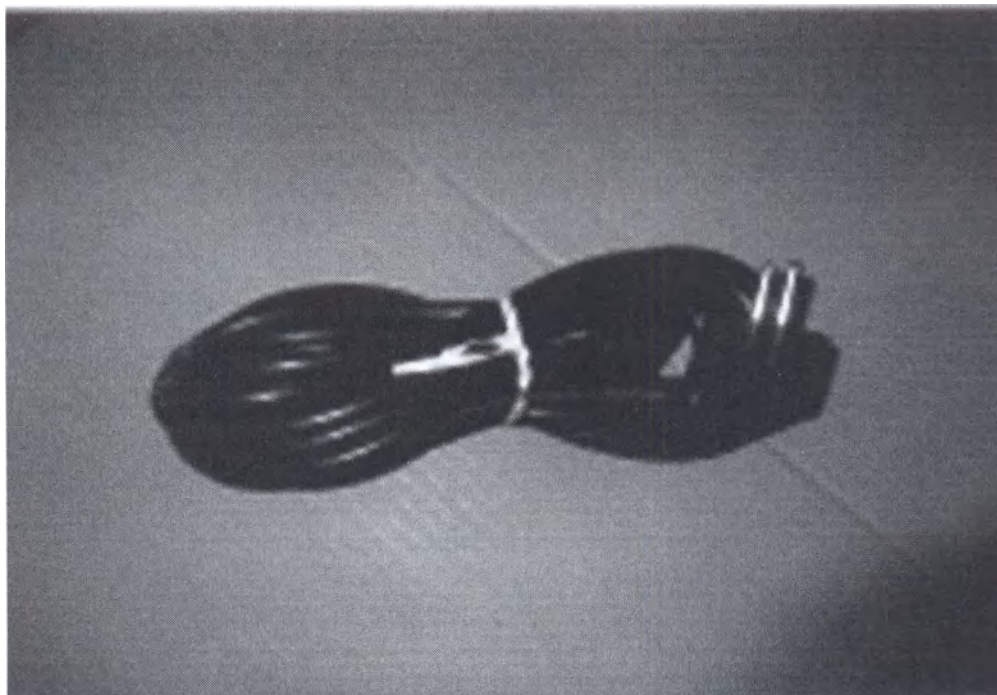


Педаль




Предохранители

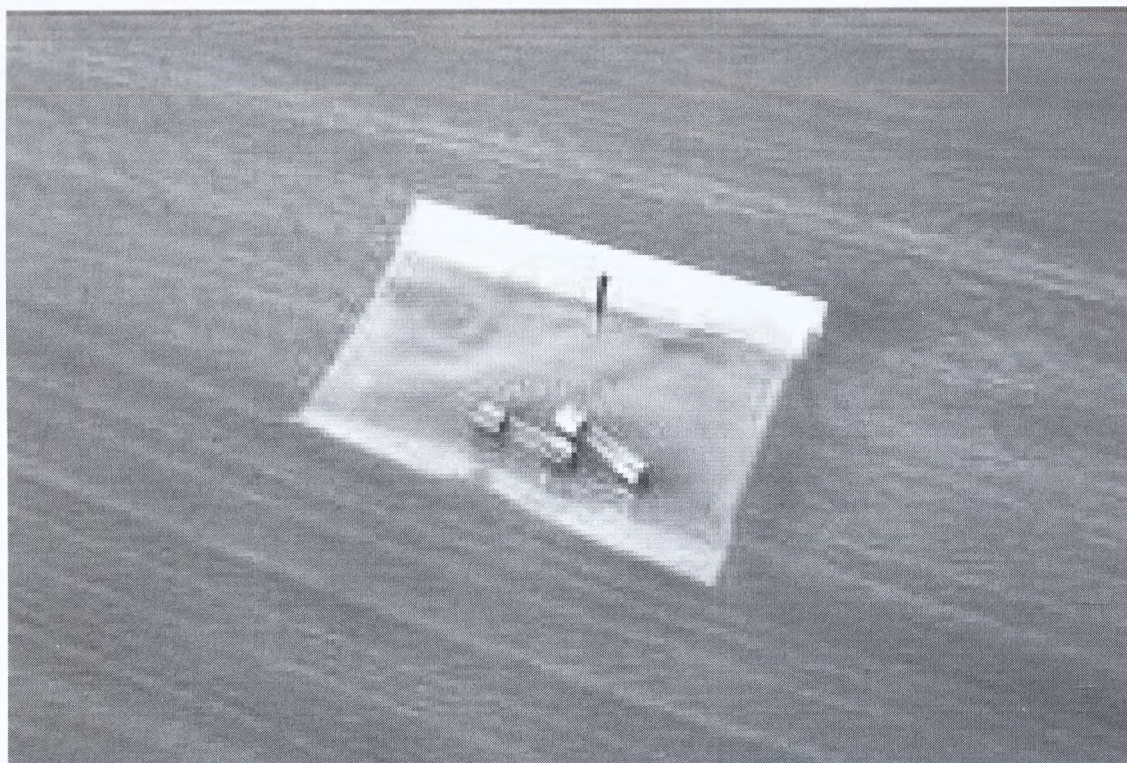


Чехол пылезащитный

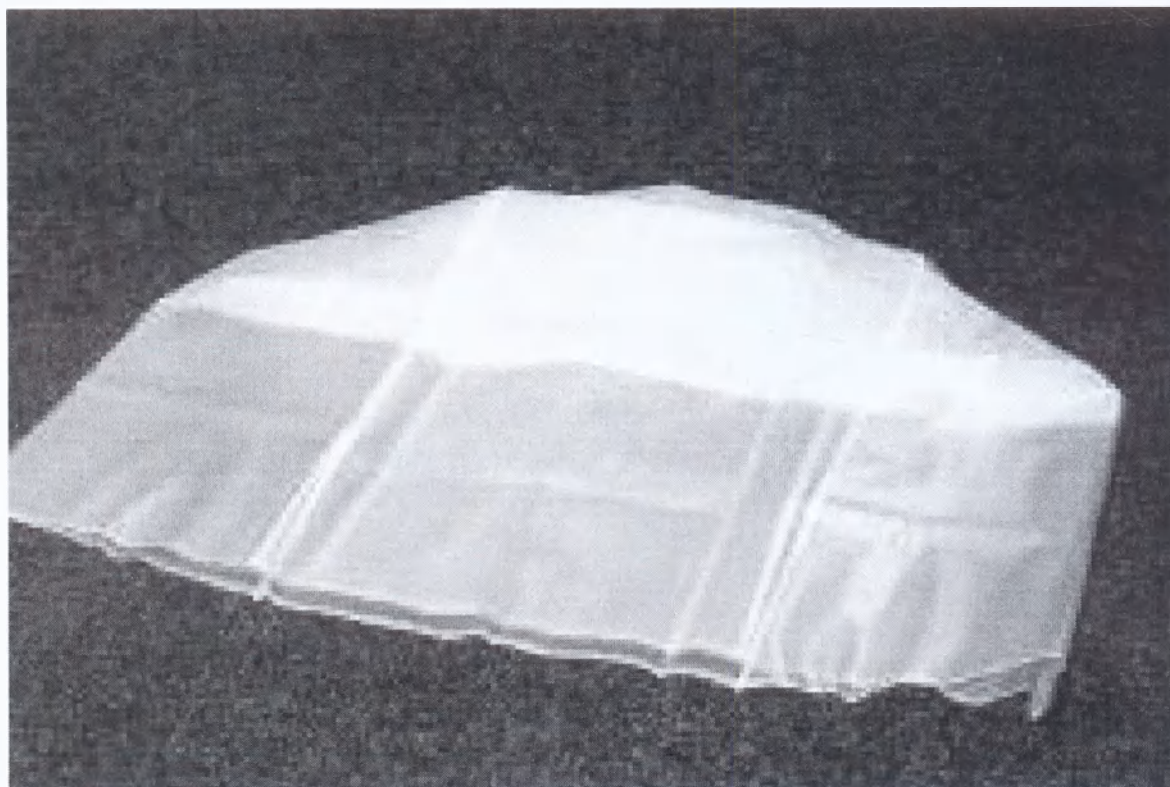


Бумага для печати

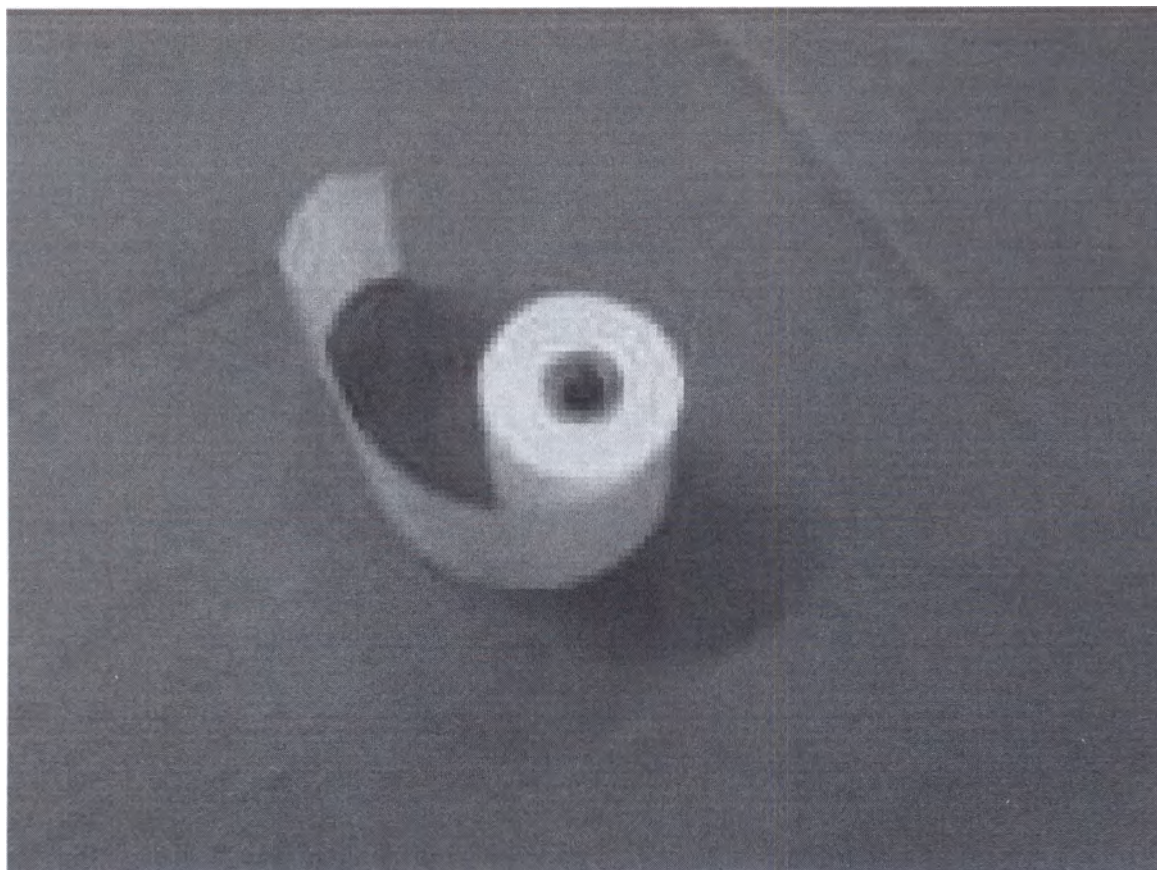


Гель ультразвуковой

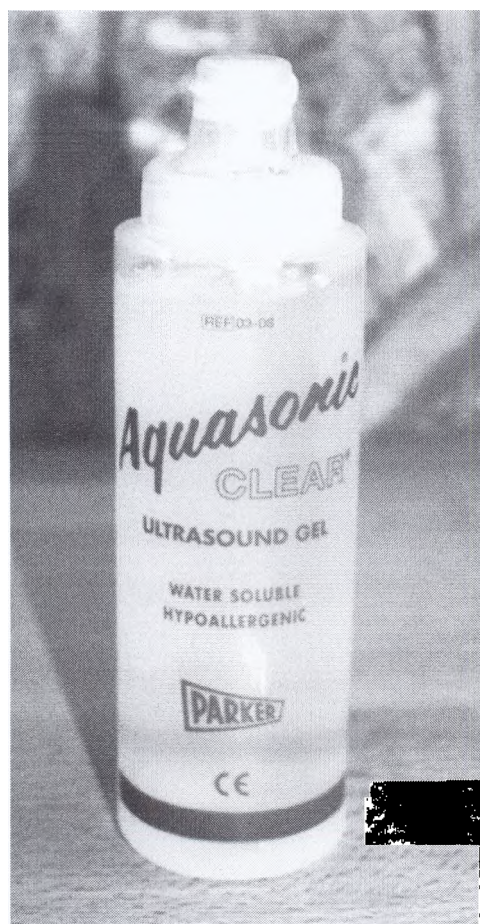


Датчик UBM

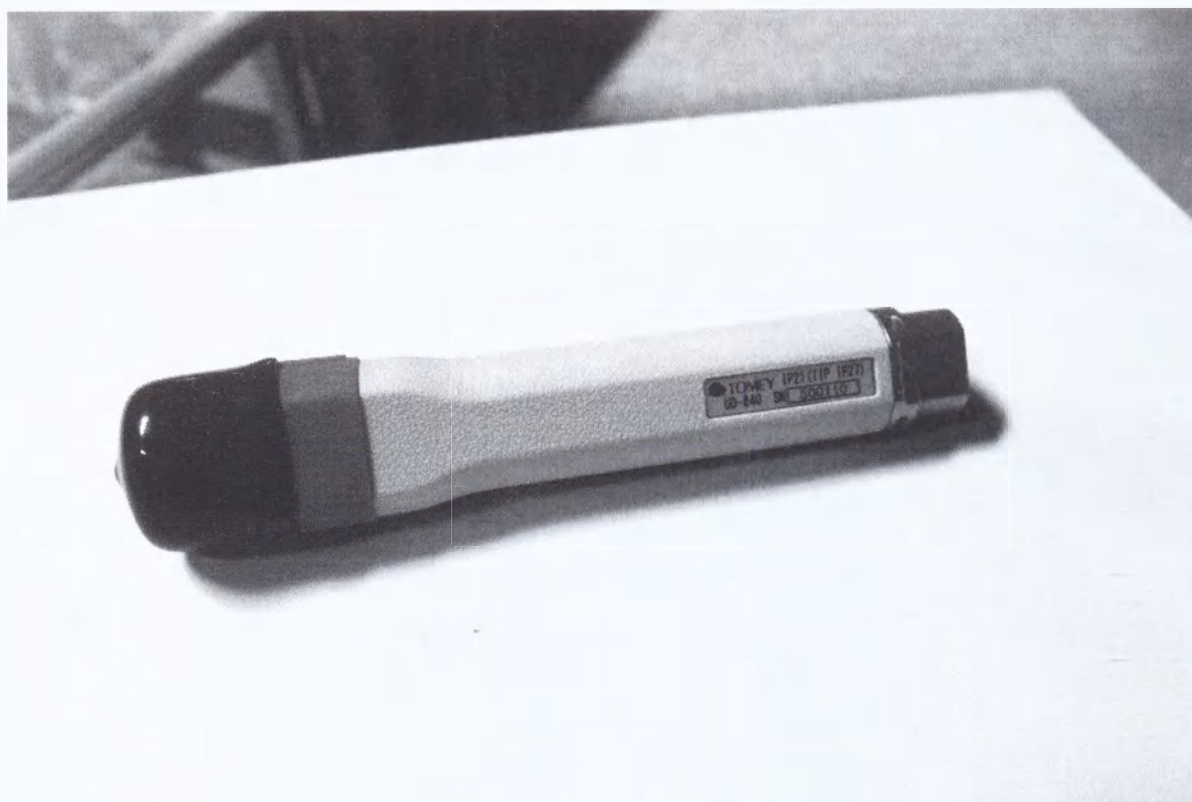


Колпачки мембранные

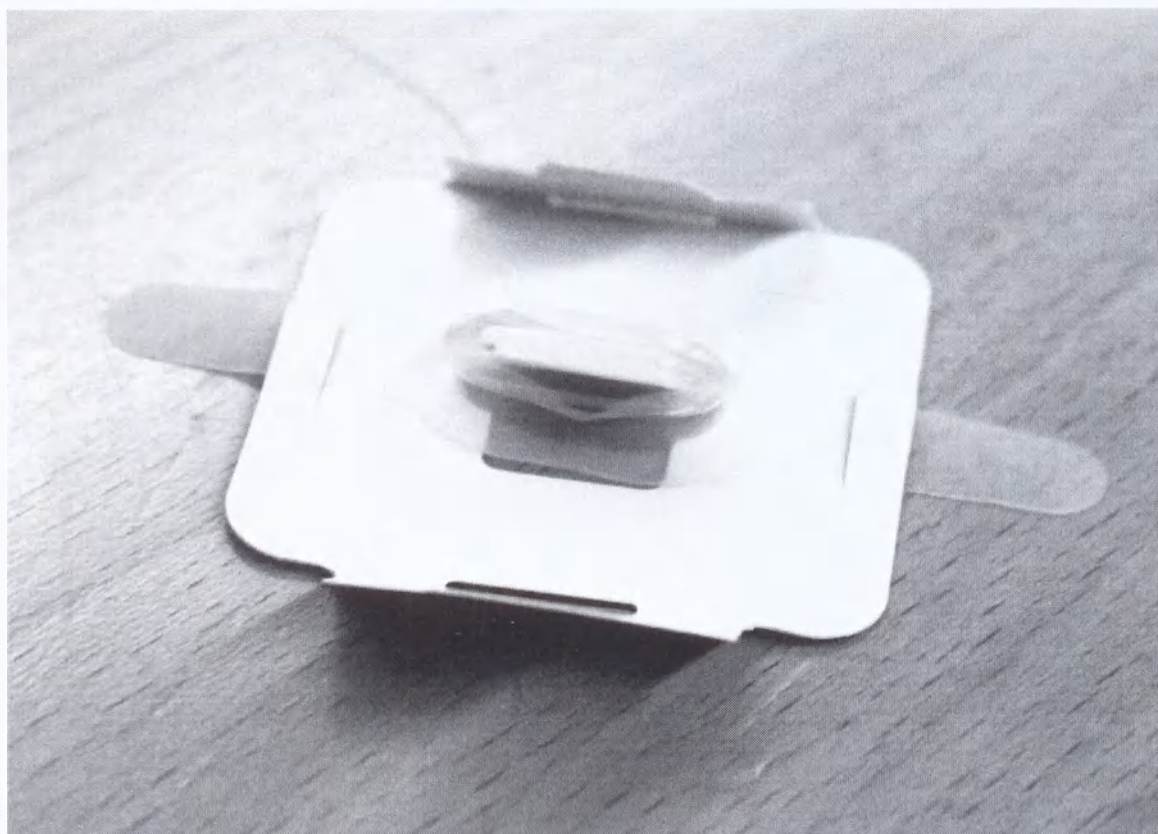


Рука-держатель датчика

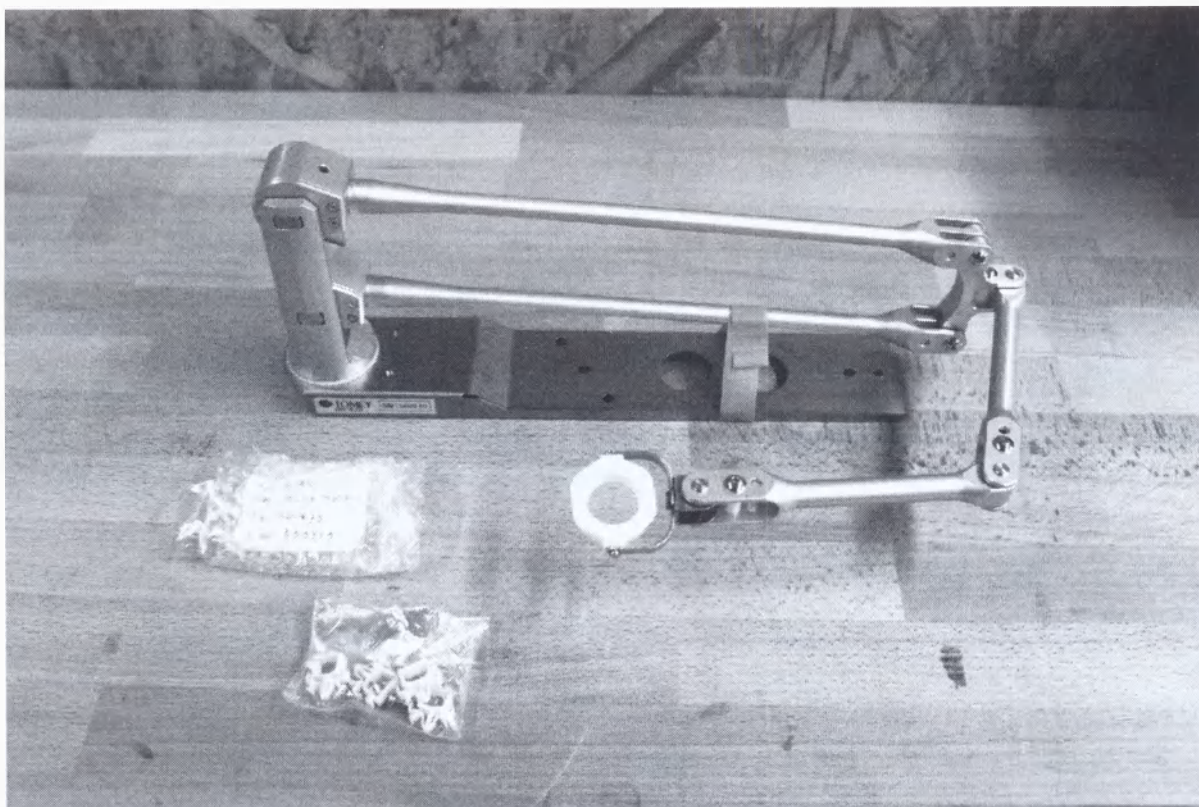

Датчик биометрии

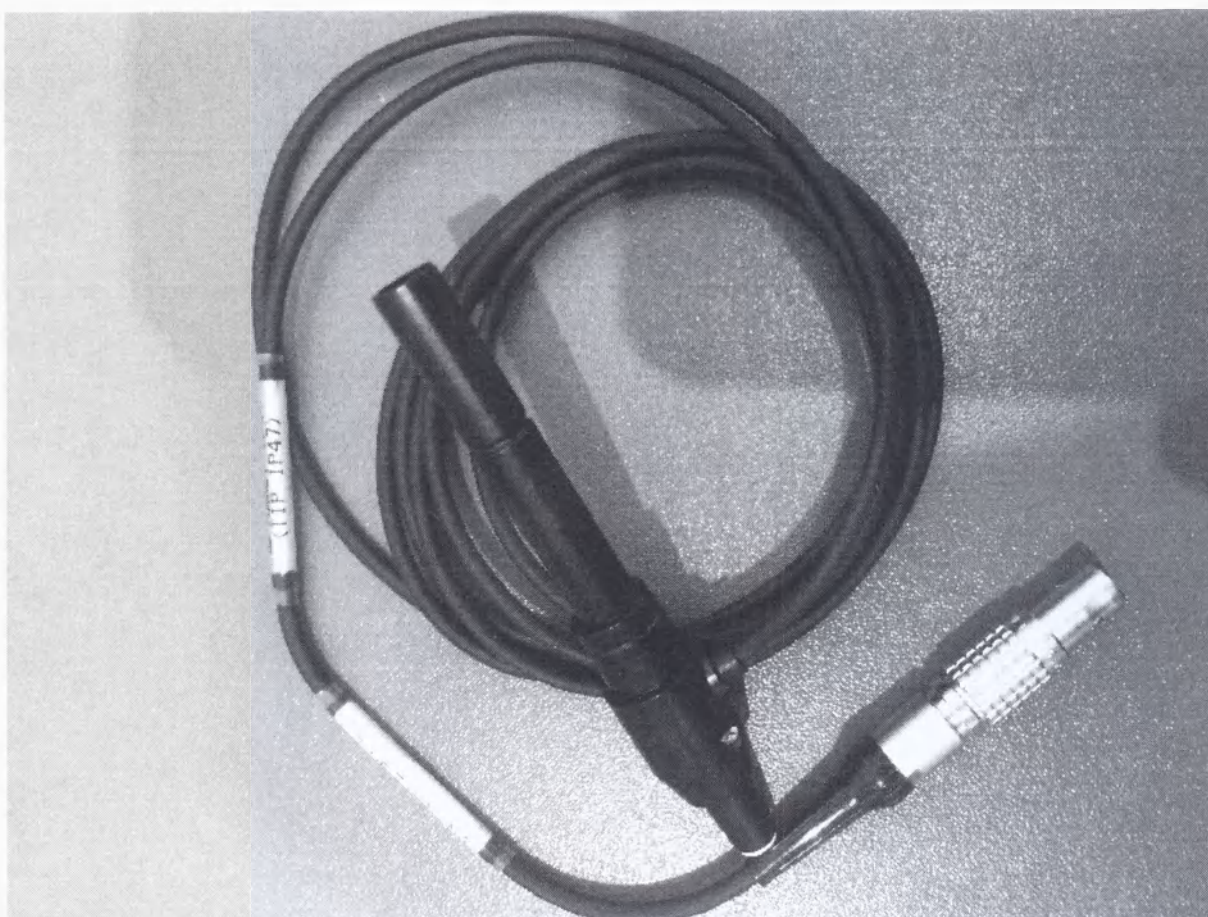


Иммерсионная насадка

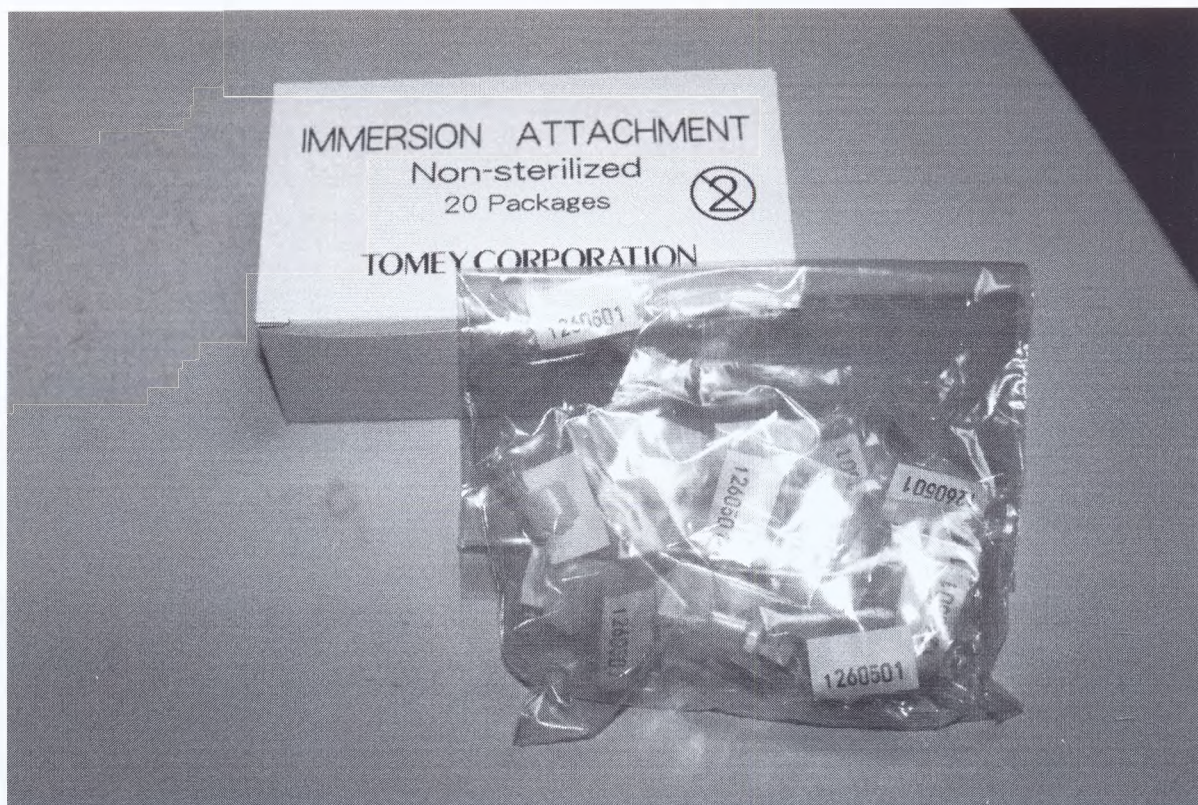


Тестовый объект для биометрии



Датчик пахиметрии

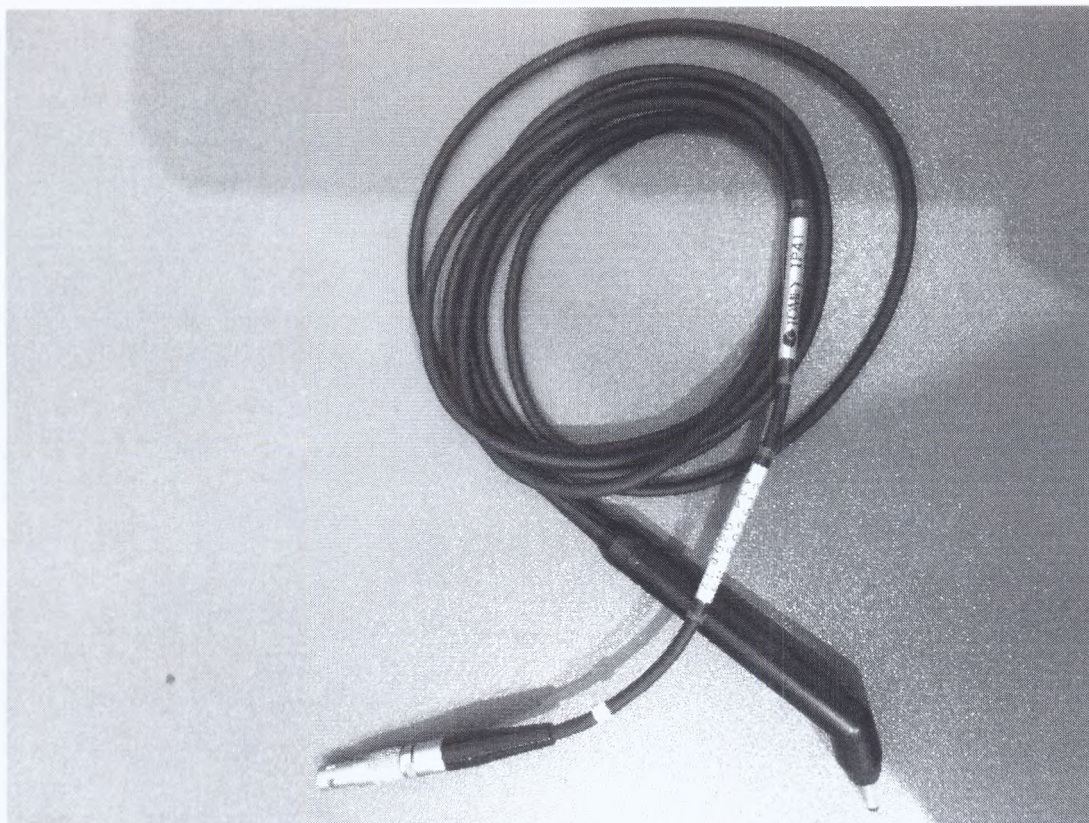

Тестовый объект для пахиметрии

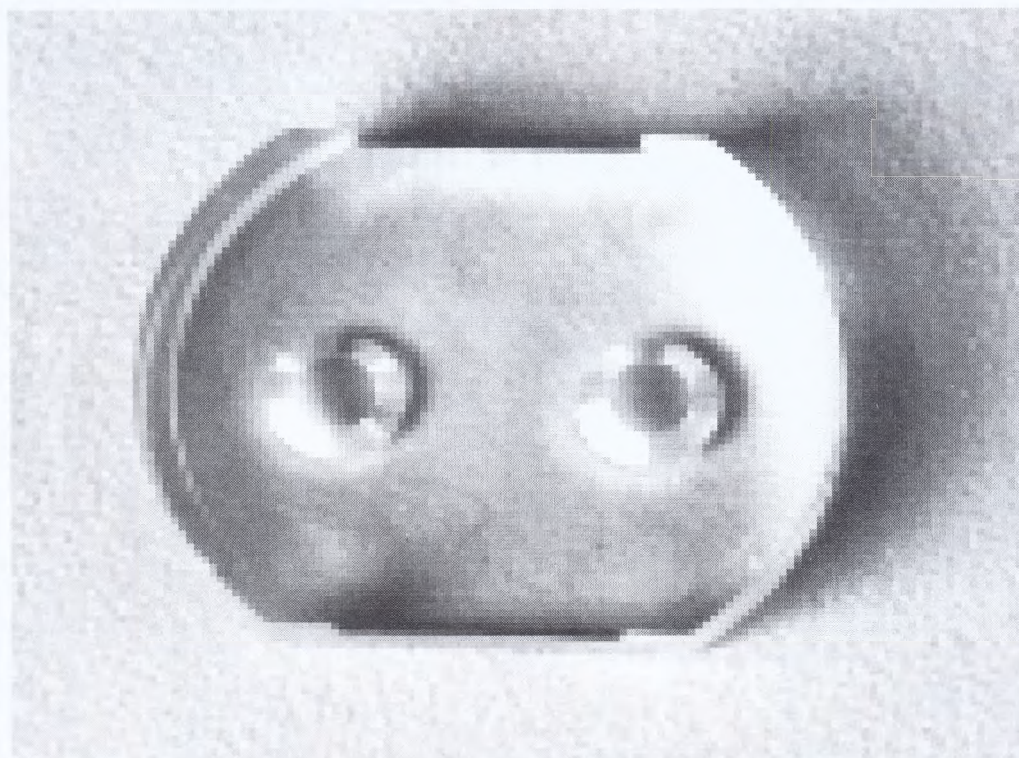

Датчик диагностики А-режима

