

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»
А.В. Шаламов



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наборы для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™

Производитель Мерит Медикал Системс, Инк., США.
Merit Medical Systems, Inc.
Юридический адрес: 1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA


Наборы для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™:

1. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:
 - игла биопсийная, диаметром 14 G (2,1 мм), 16 G (1,6 мм), 18 G (1,25 мм), 20 G (0,9 мм), длиной 10 см, 15 см, 20 см, 25 см;
 - интродьюсер коаксиальный, диаметром 13 G (2,45 мм), 15 G (1,8 мм), 17 G (1,45 мм), 19 G (1,1 мм); длиной: 4,4 см; 4,5 см; 4,6 см; 9,4 см; 9,5 см; 9,6 см; 14,5 см; 14,6 см; 19,5 см – не более 2 шт. (при необходимости),
 - стилет – не более 2 шт. (при необходимости),
 - инструкция по применению

2. Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:
 - интродьюсер коаксиальный, диаметром 13 G (2,45 мм), 15 G (1,8 мм), 17 G (1,45 мм), 19 G (1,1 мм); длиной: 4,4 см; 4,5 см; 4,6 см; 9,4 см; 9,5 см; 9,6 см; 14,5 см; 14,6 см; 19,5 см
 - стилет – не более 2 шт. (при необходимости),
 - инструкция по применению


Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:


- игла биопсийная,
- интродьюсер коаксиальный
- стилет

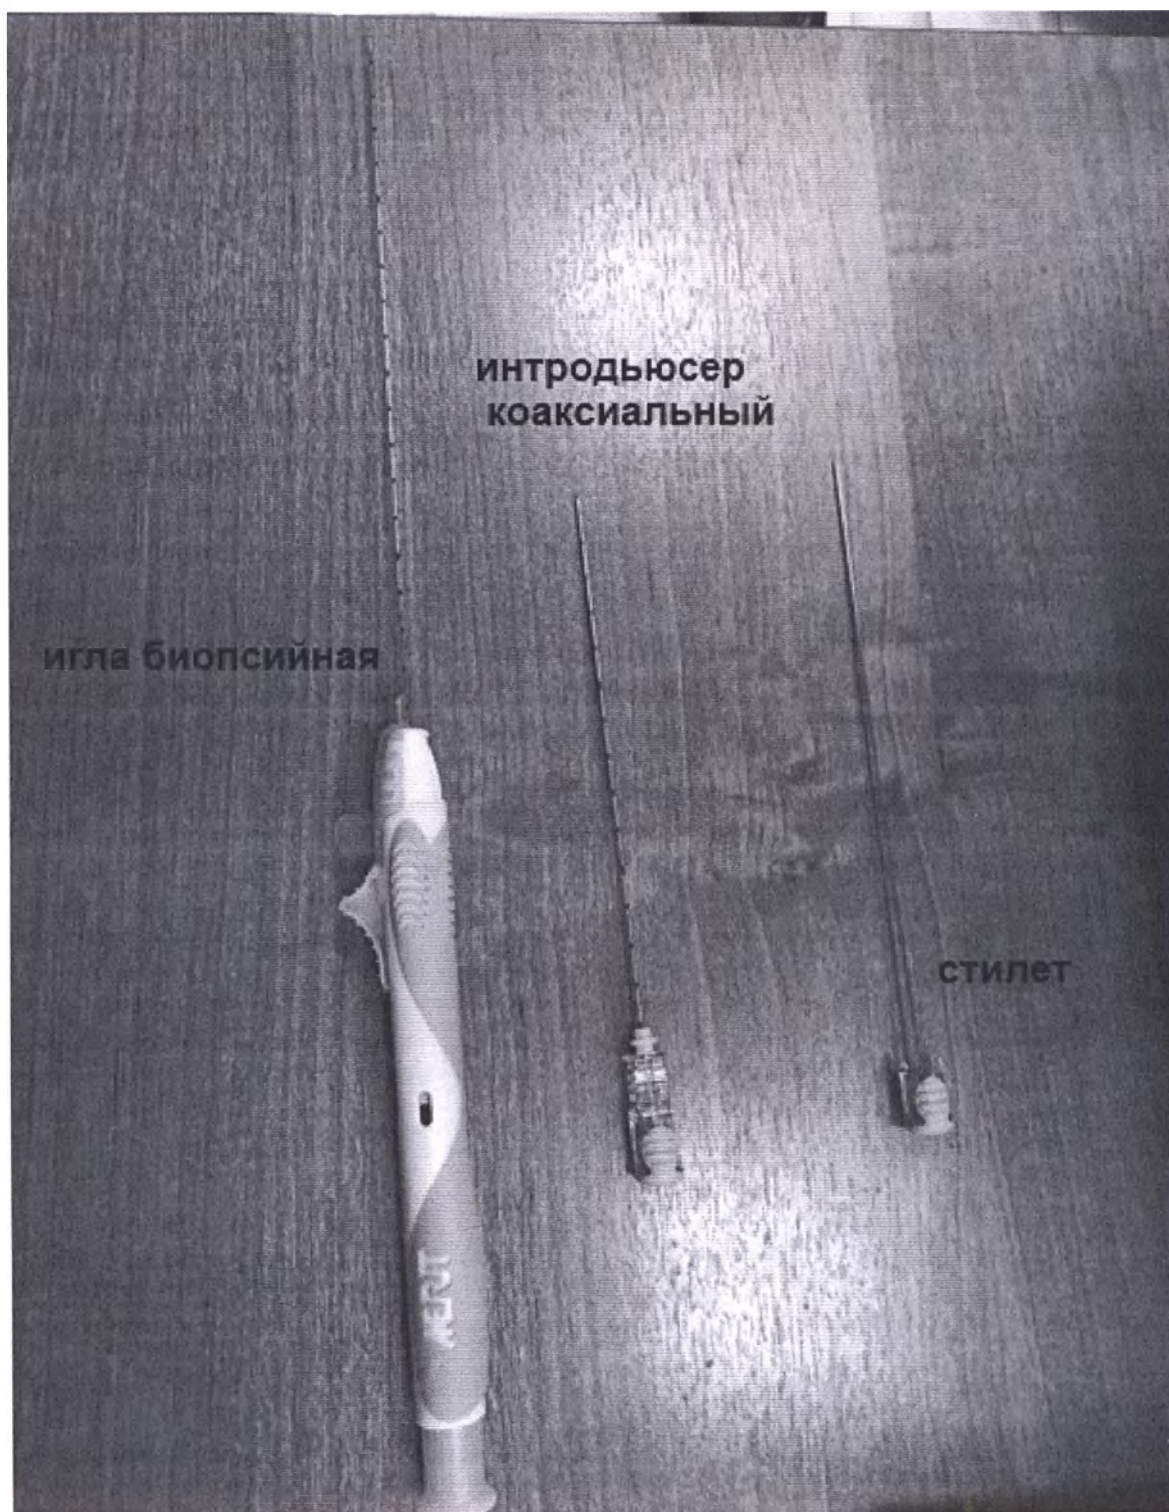

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:

- игла биопсийная,
- интродьюсер коаксиальный
- стилет

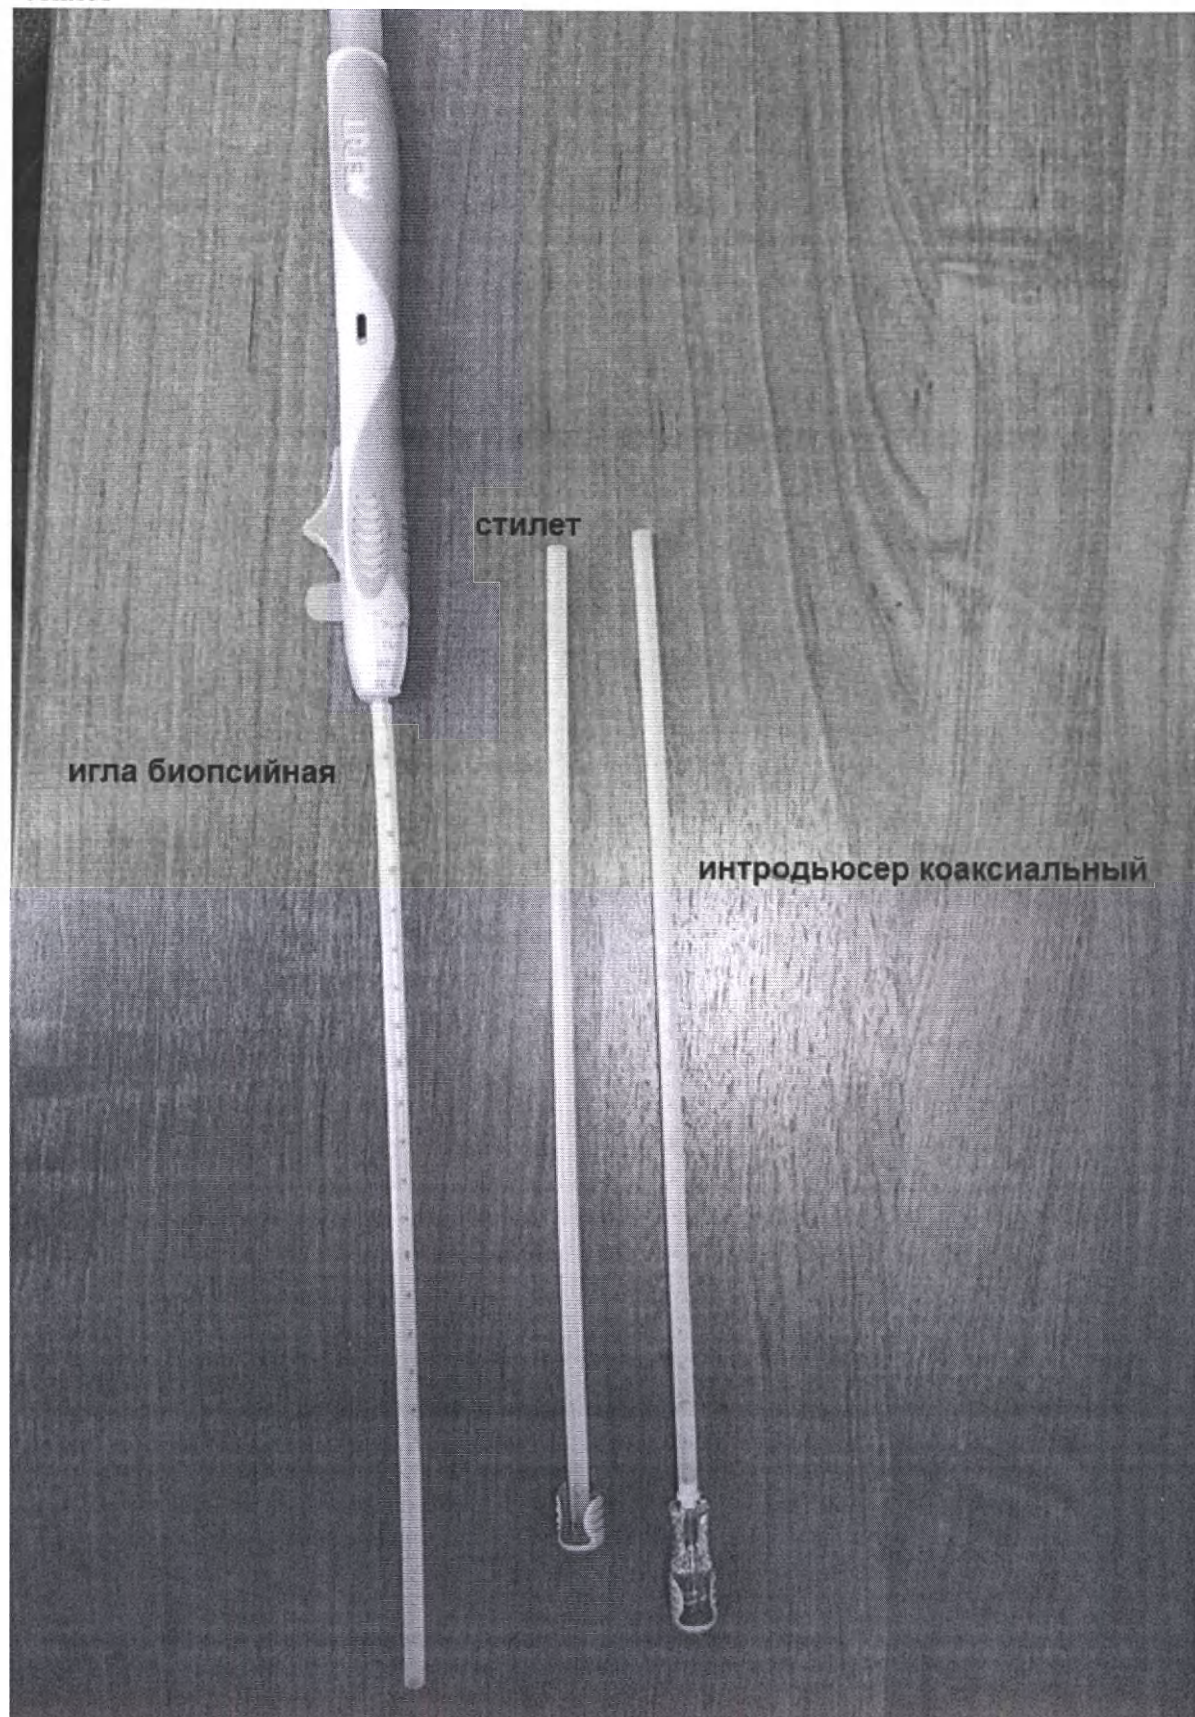

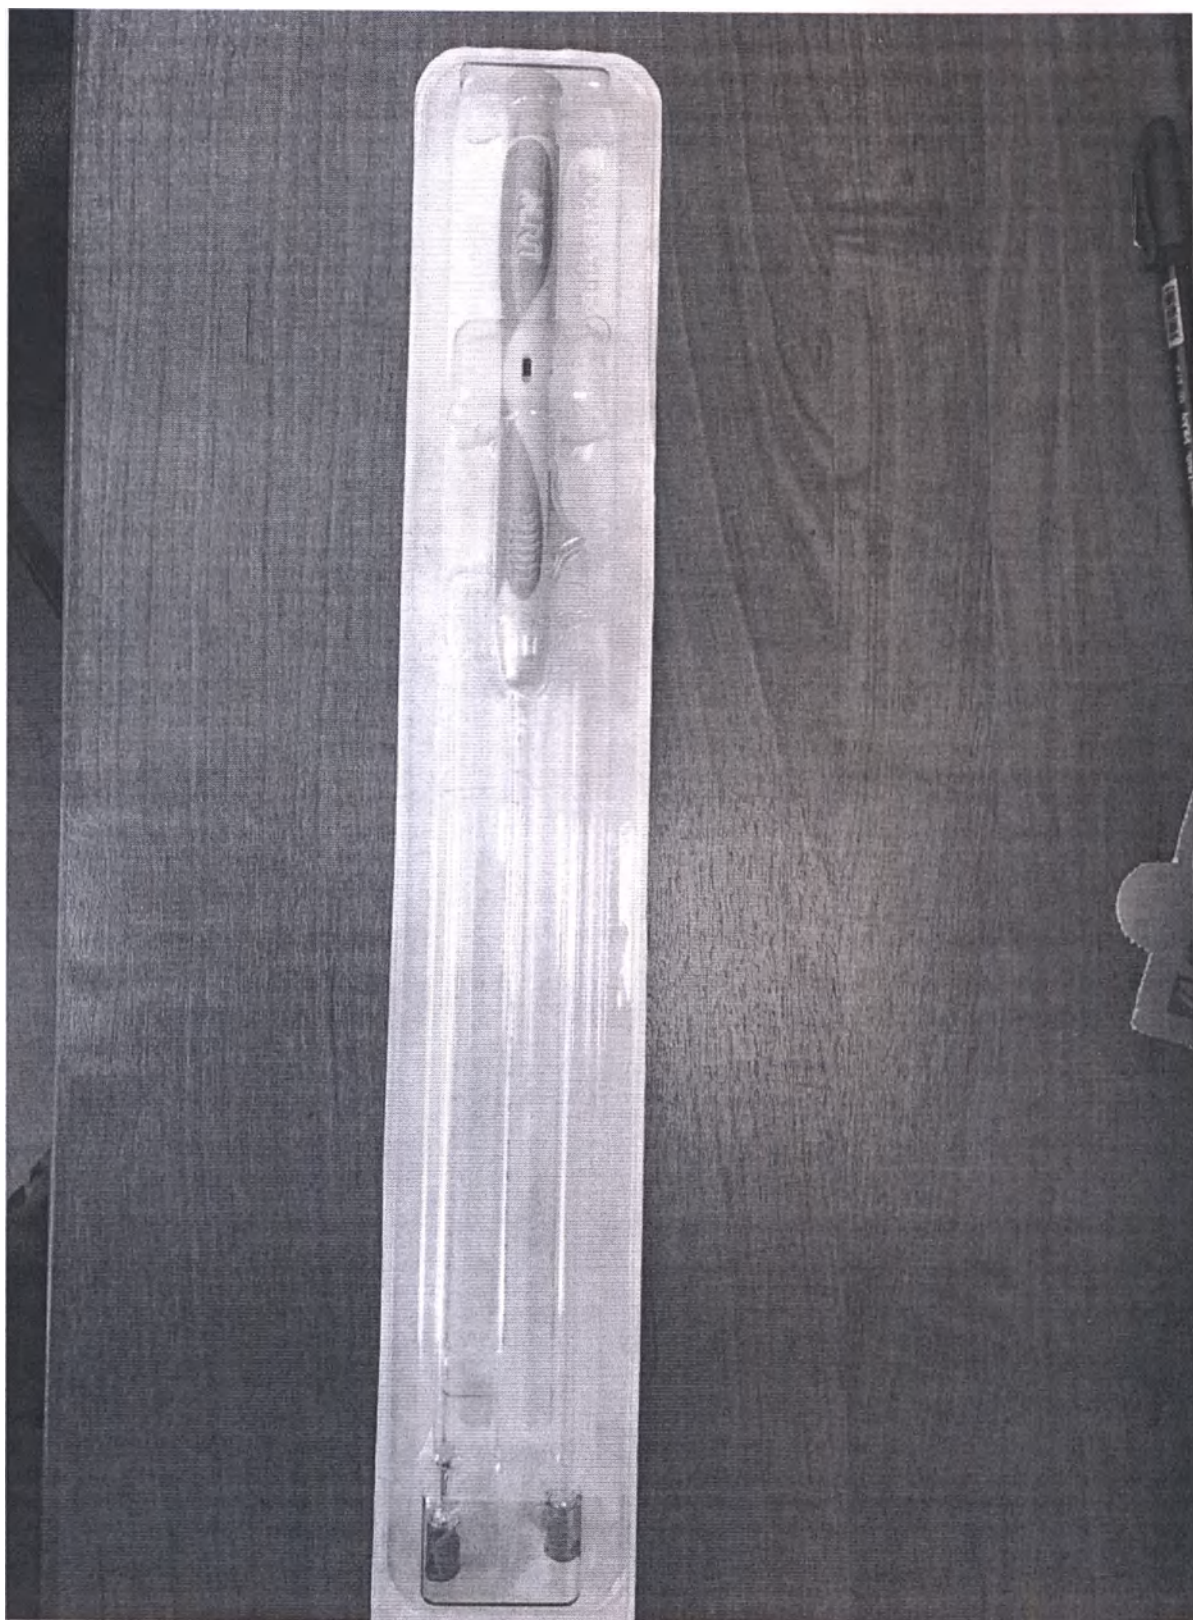

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:

- игла биопсийная,
- интродьюсер коаксиальный
- стилет

et
SYSTEM



20G
X 20.0 cm



REF **CORCA2020B**

LOT H1362018



Use By: 2021-05-31

1 Unit
Made in U.S.A.

Merit Medical Systems, Inc., 1680 W. Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-532-1800, U.S.A. Customer Service 1-800-358-1748

Merit Medical Ireland Ltd., Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 92 22

For instructions, scan QR code, or go to www.merit.com/ri and enter IFU 42125085
For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service

LOT: H1362018
EXP: 05/2021 11/2021

Caution: Consult accompanying documents

Do not use if package is damaged

STERILE EO

Single Use

Rx ONLY


CE 0086



BIOPSY SYSTEM
SYSTÈME DE BIOPSIE
SISTEMA PER BIOPSIA
BIOPSIESYSTEM
SISTEMA DE BIOPSIAS
SISTEMA DE BIÓPSIA
SISTEMA DE BIÓPSIA
BIOPSIESYSTEM
BIOPSISYSTEM

KO
SY
BI
CIC
SY
SY
CIC
BIO


Образец маркировки набора

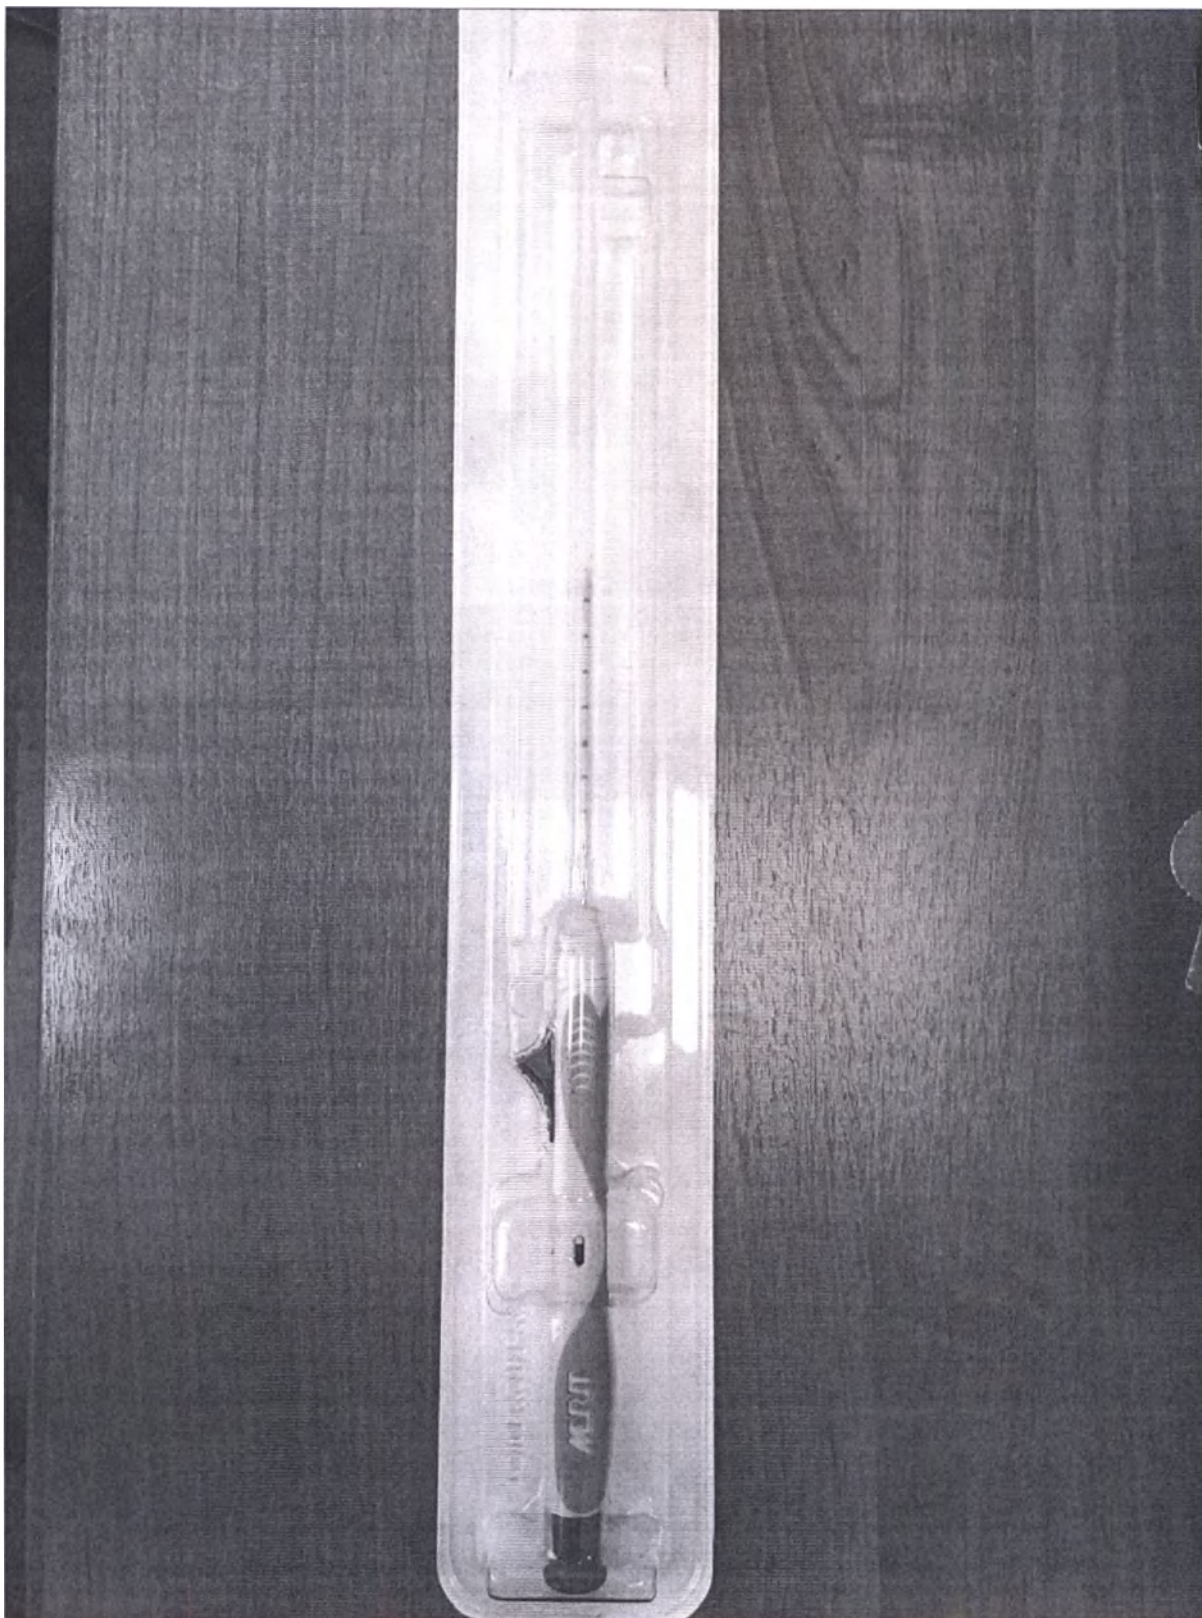


Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:
- игла биопсийная

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:
- игла биопсийная



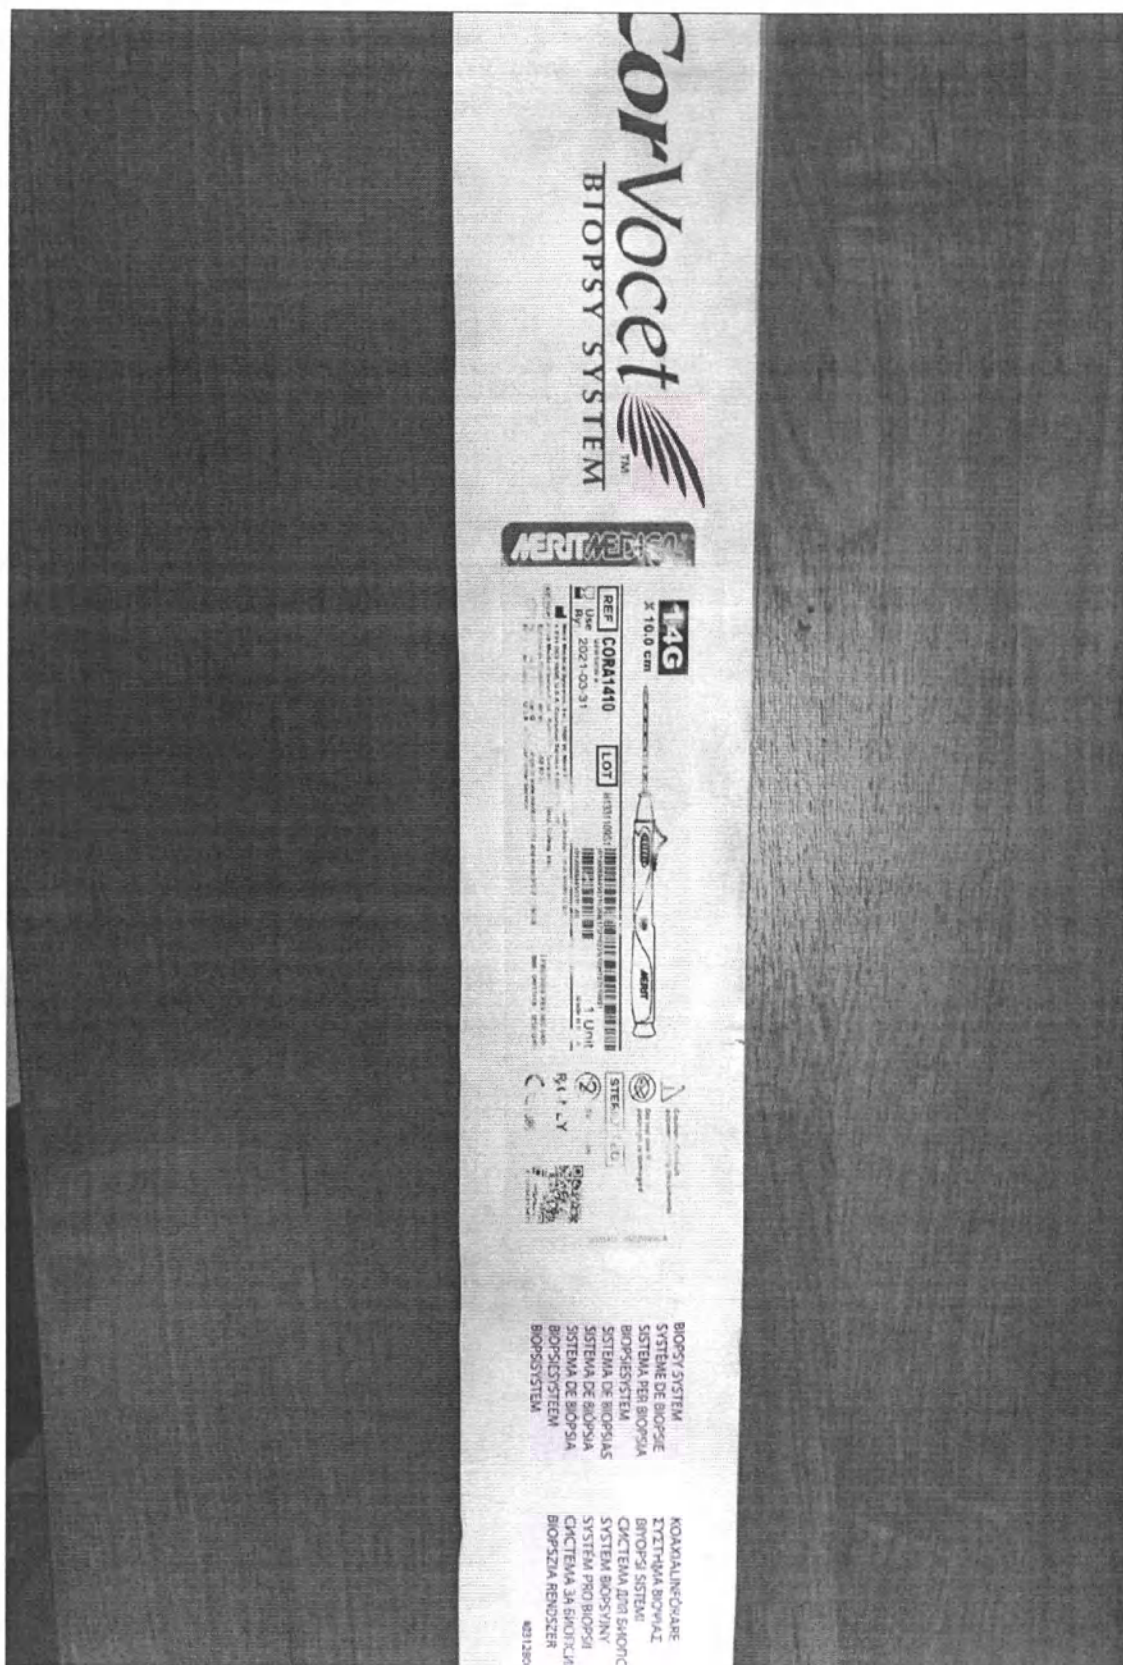


Образец маркировки набора

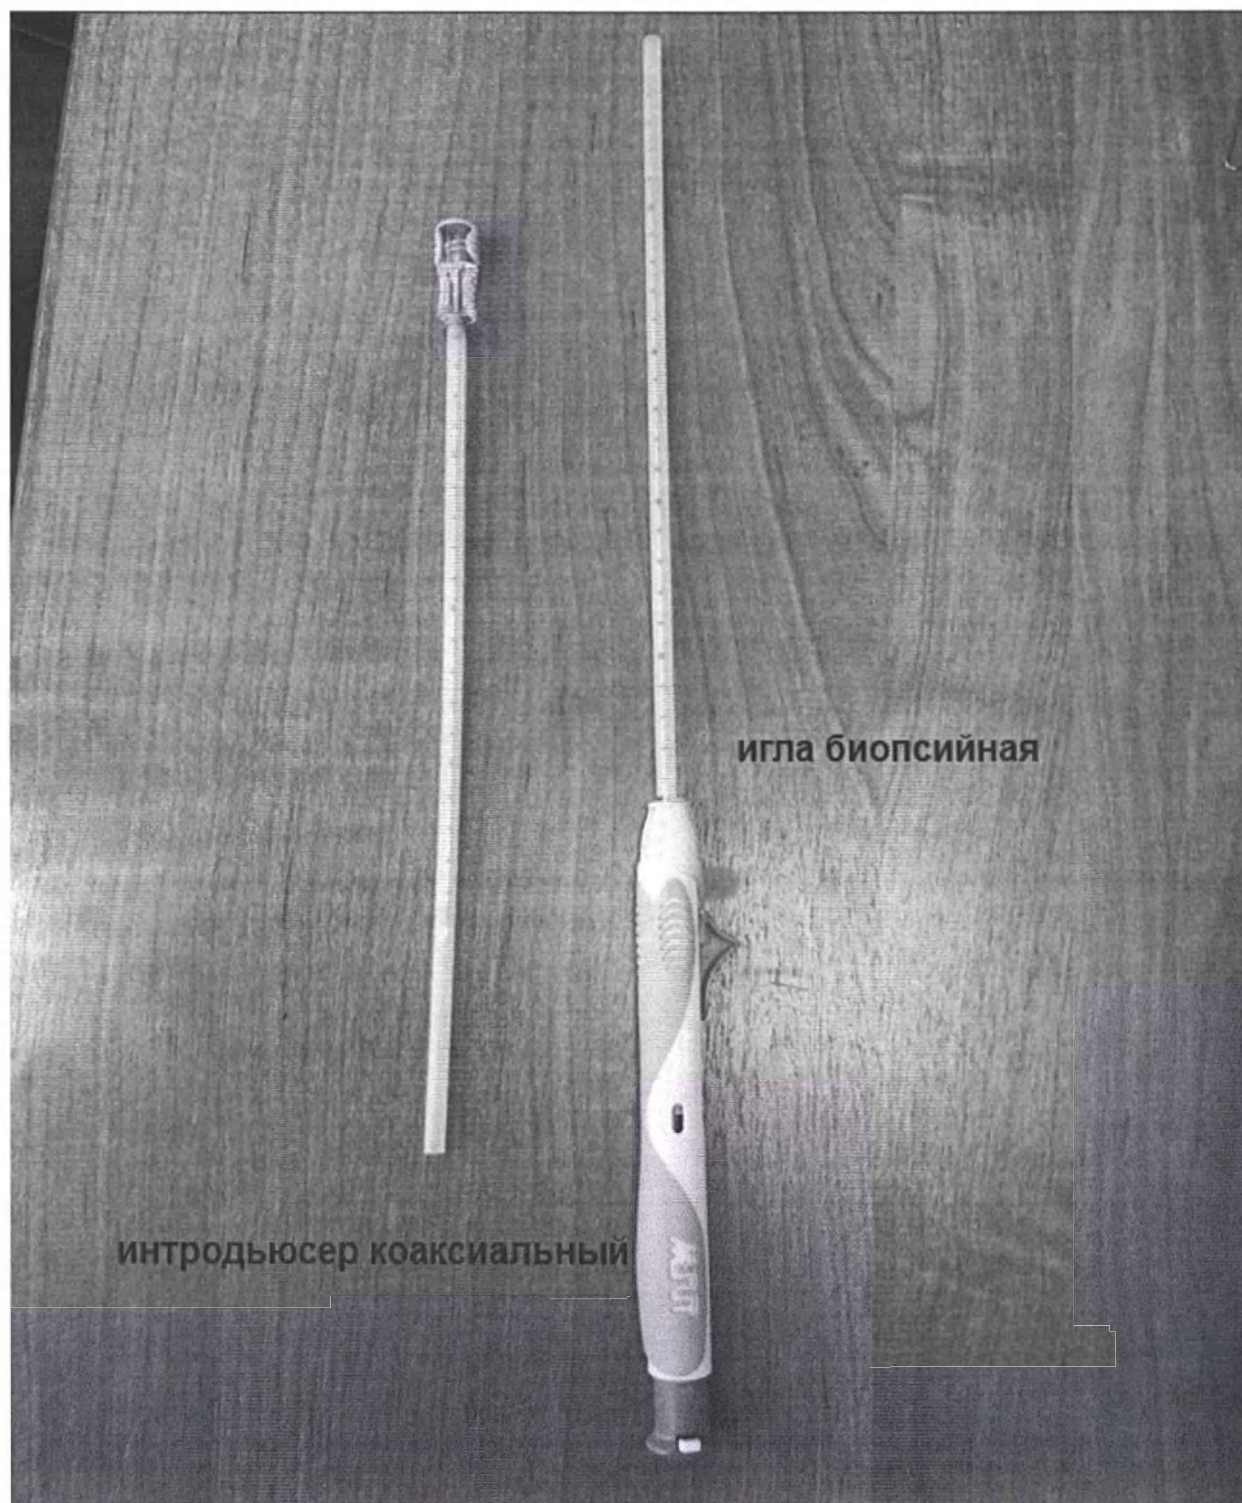

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocetTM, в составе:

- игла биопсийная,
- интродьюсер коаксиальный

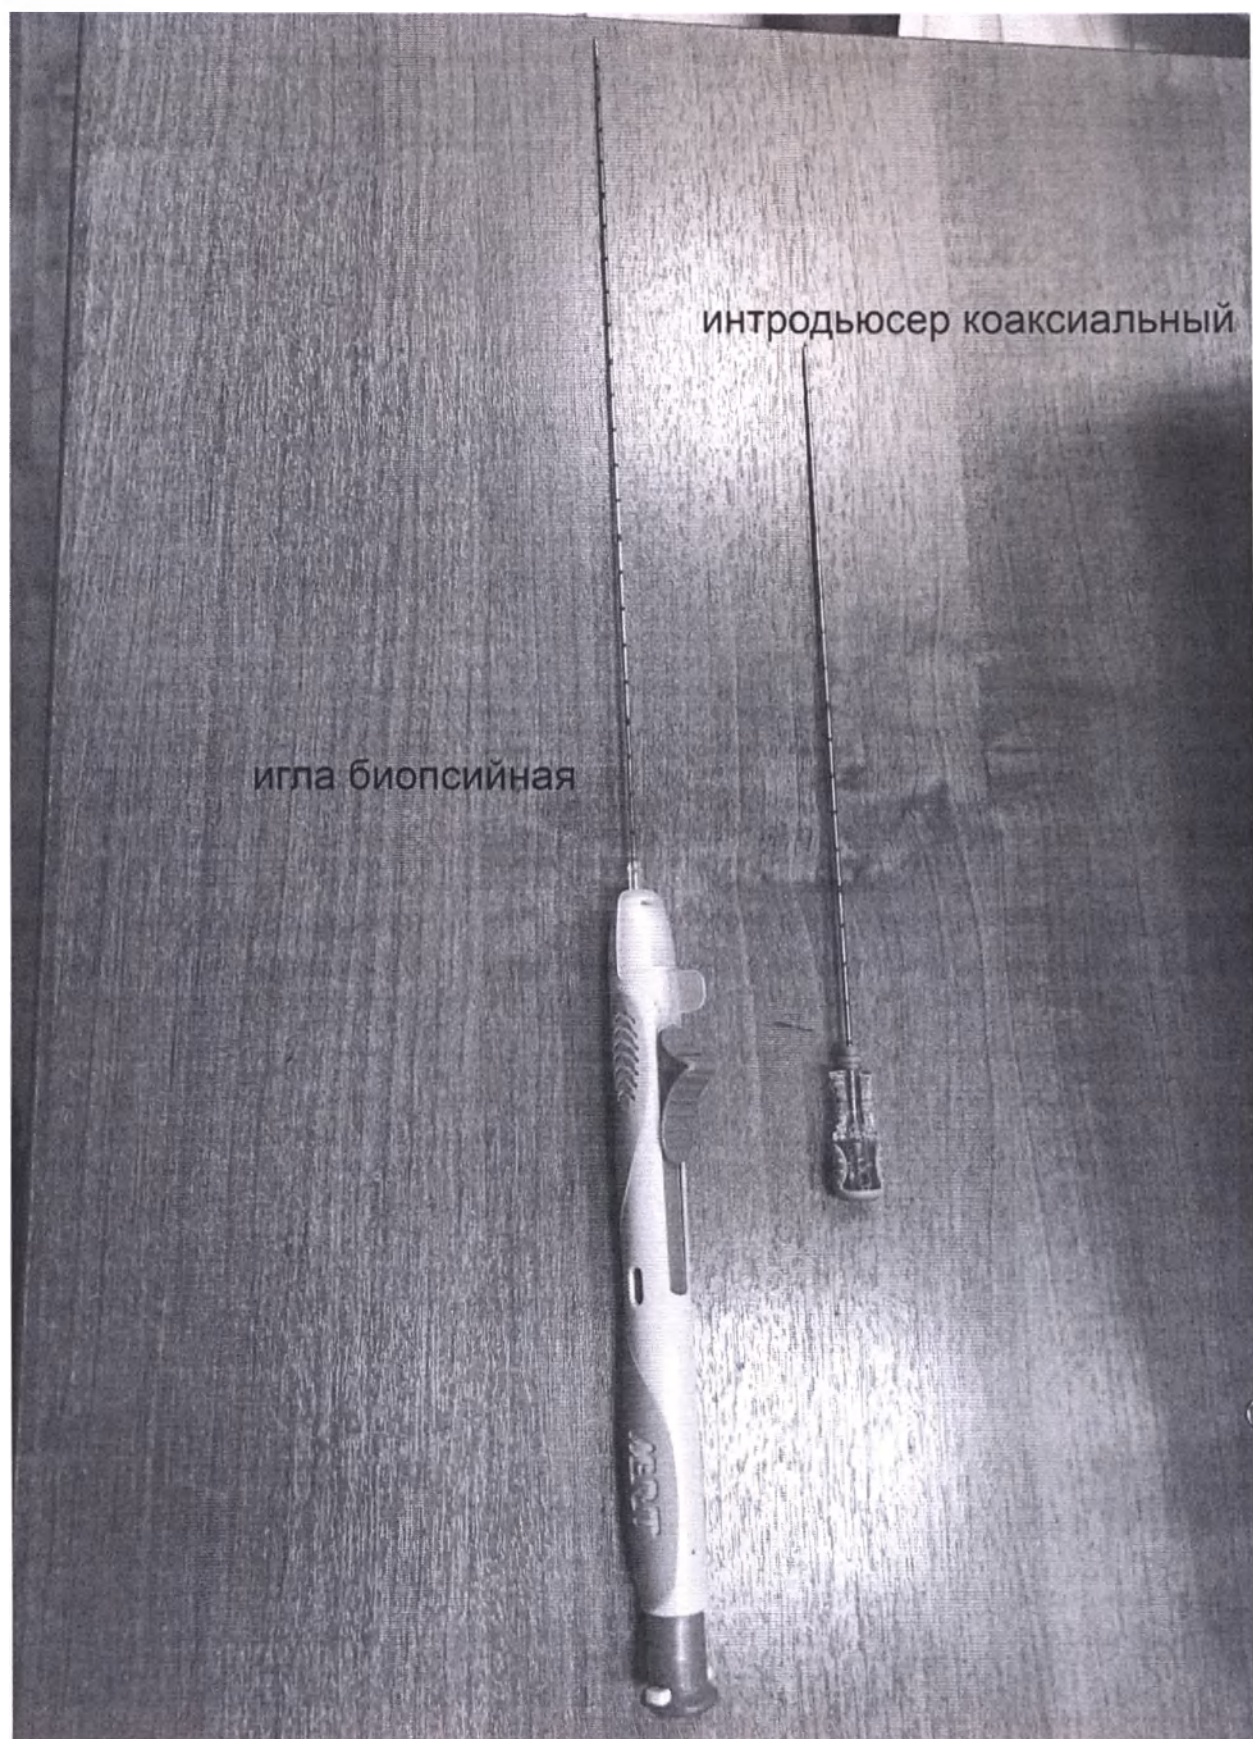


интродьюсер коаксиальный

игла биопсийная

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:

- игла биопсийная,
- интродьюсер коаксиальный

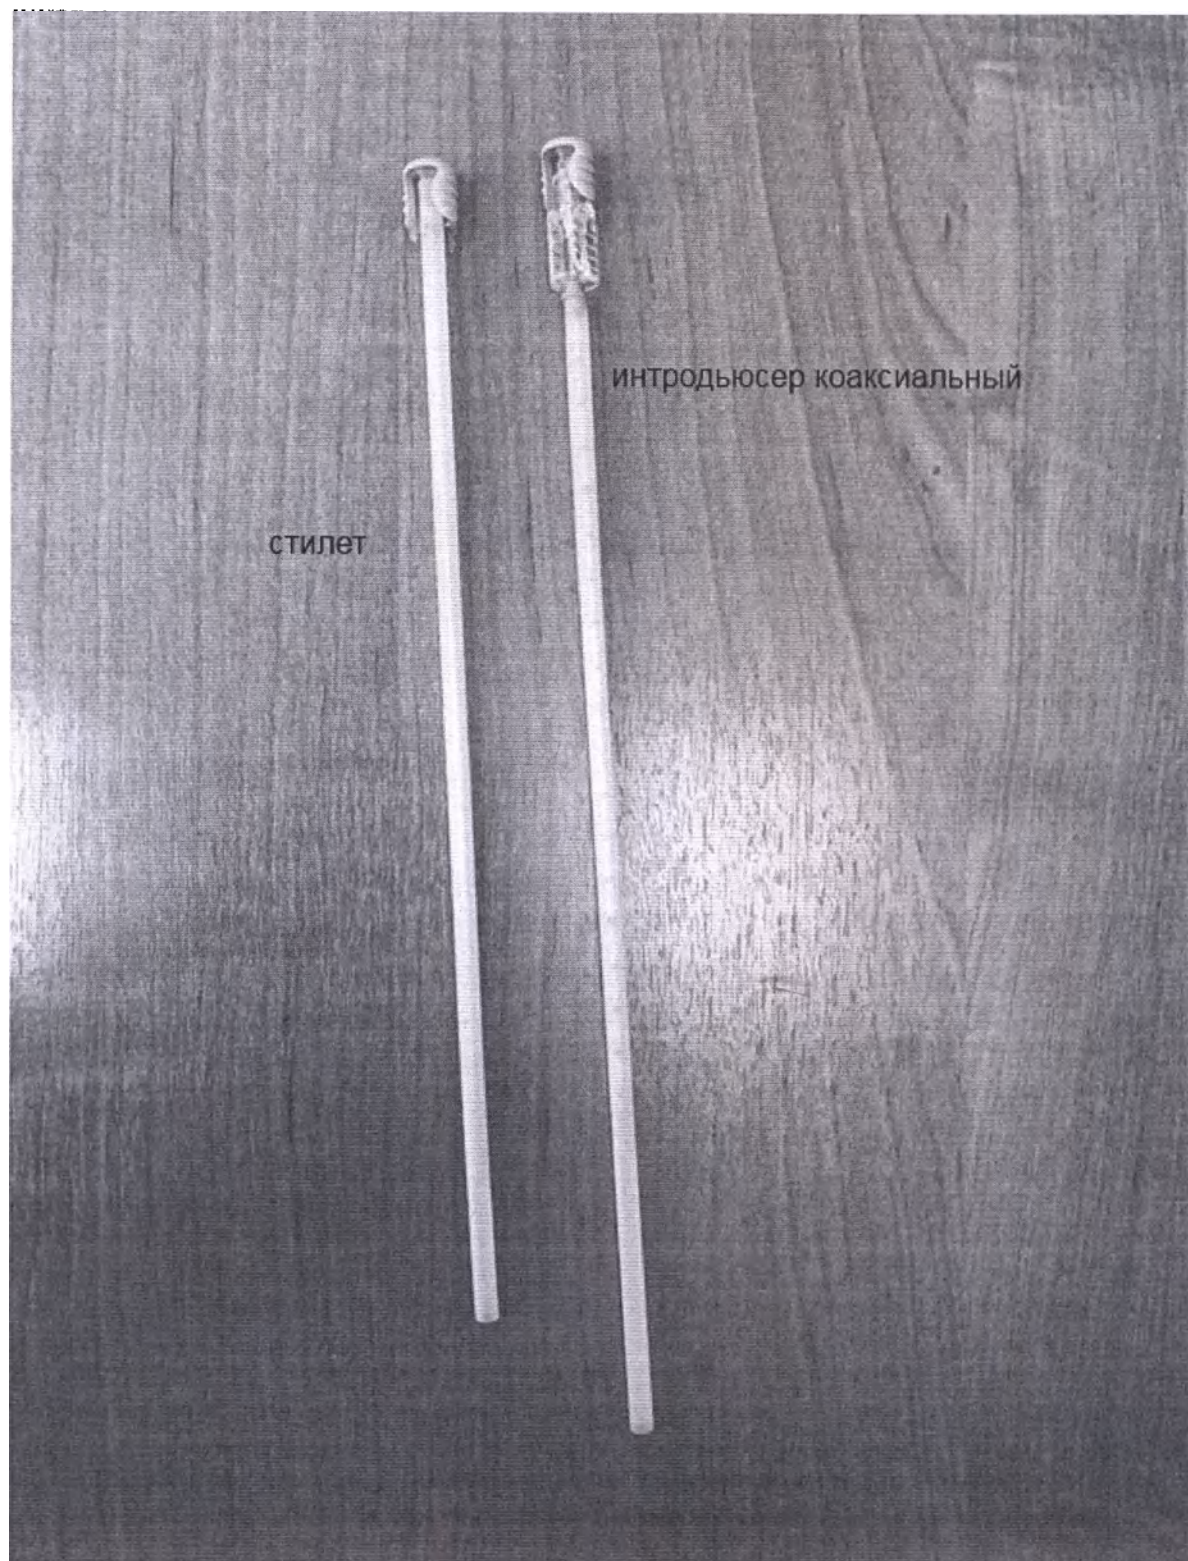

стилет

интродьюсер коаксиальный


Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей, в составе:

- интродьюсер коаксиальный,
- стилет




Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей, в составе:

- интродьюсер коаксиальный,
- стилет

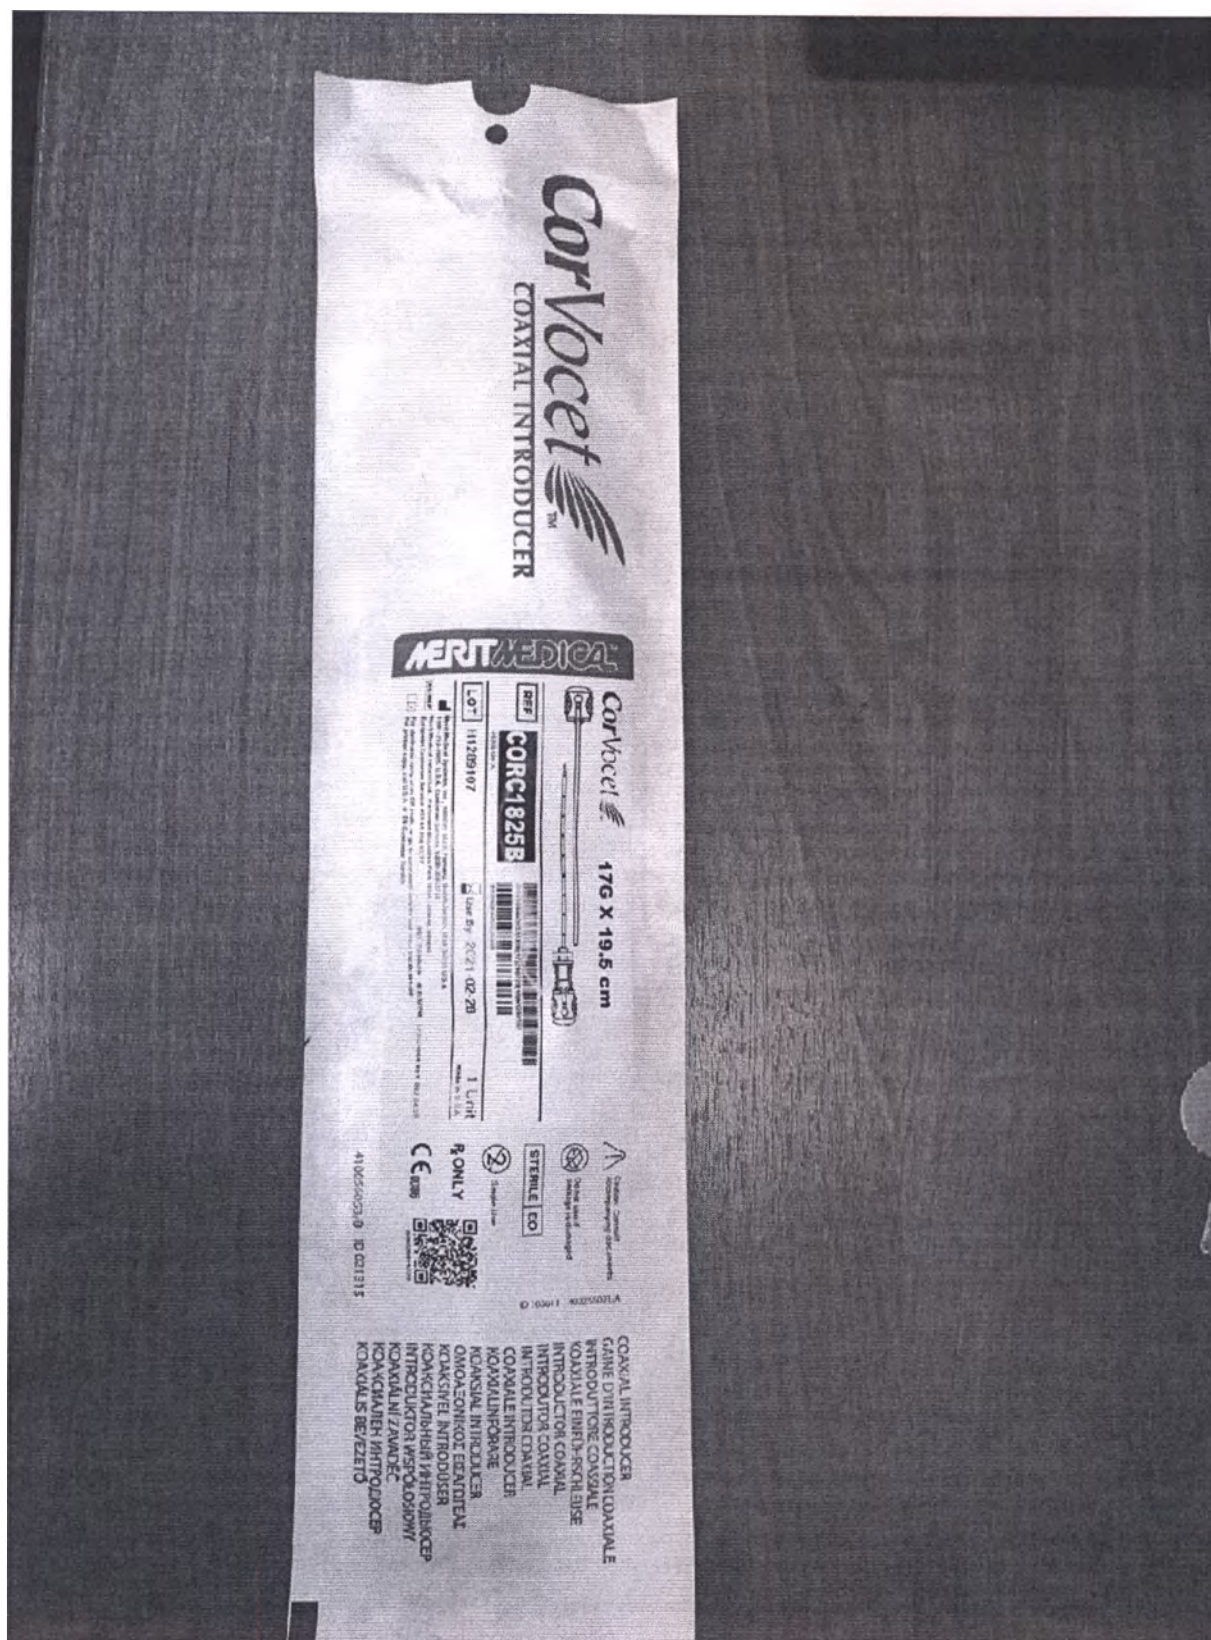


Образец маркировки набора

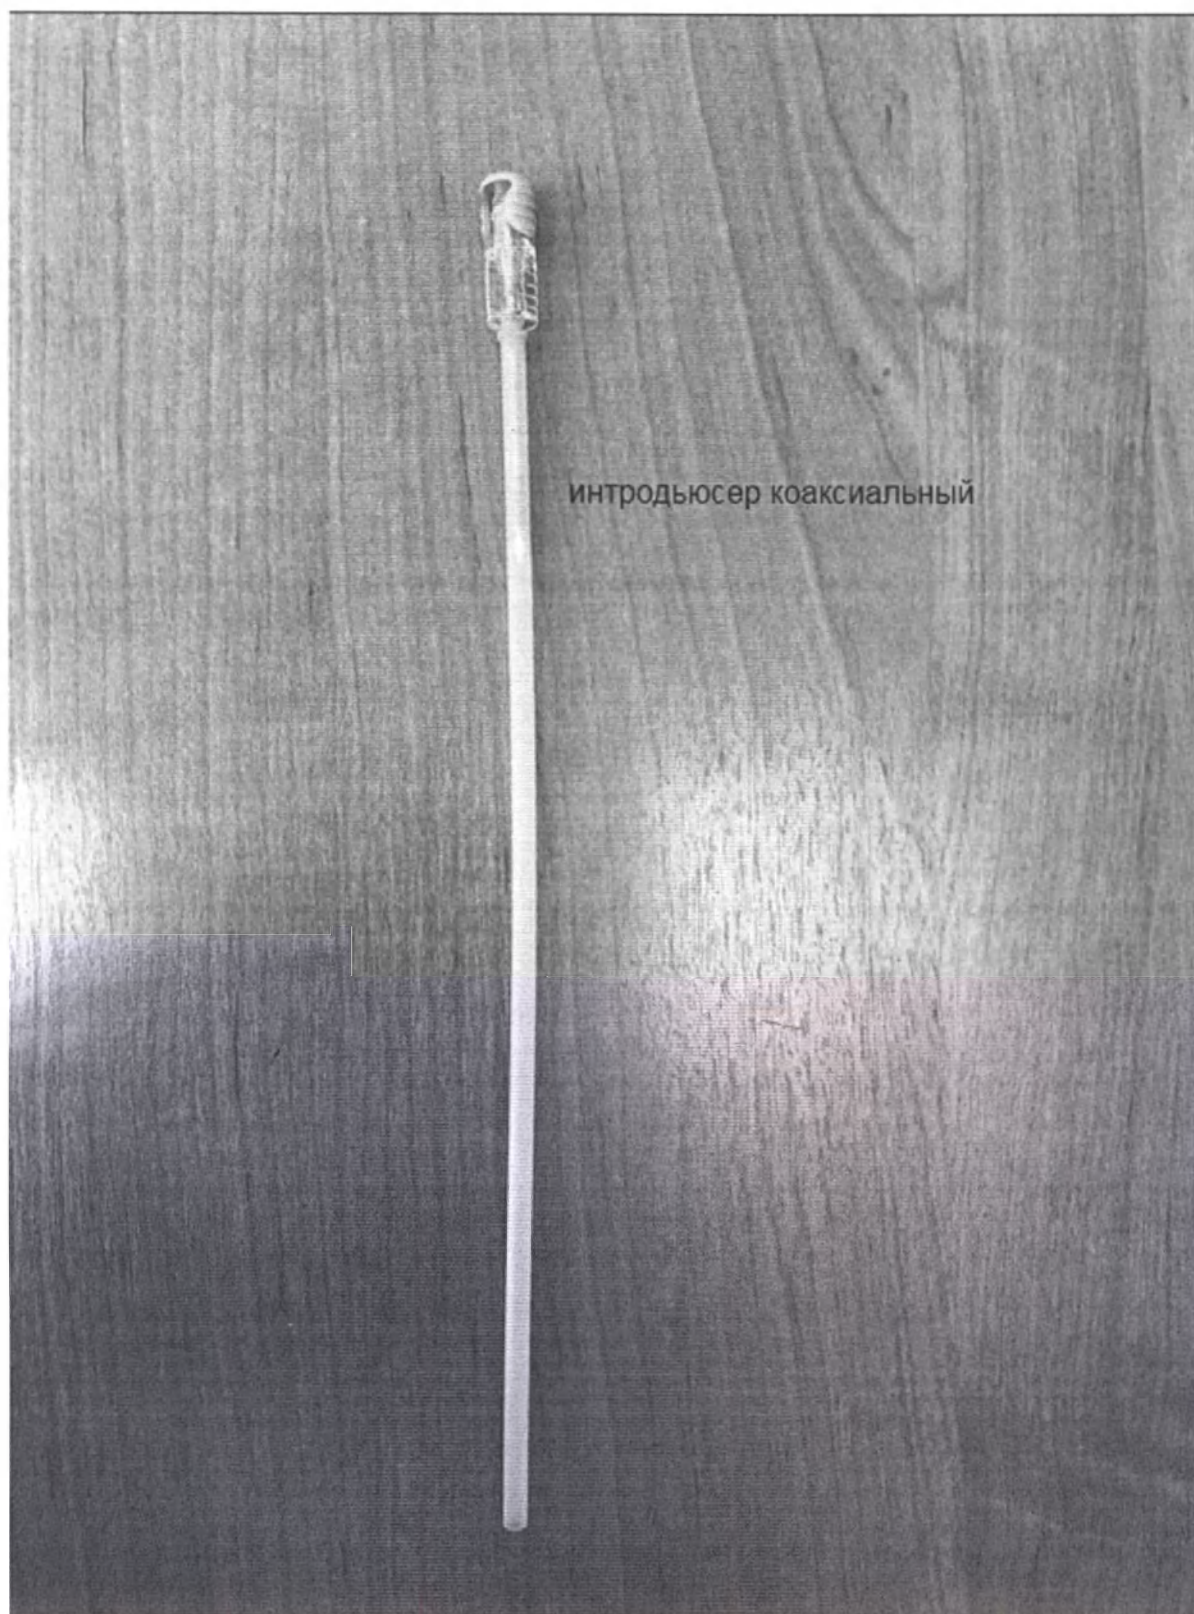


интродьюсер коаксиальный

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:
- интродьюсер коаксиальный

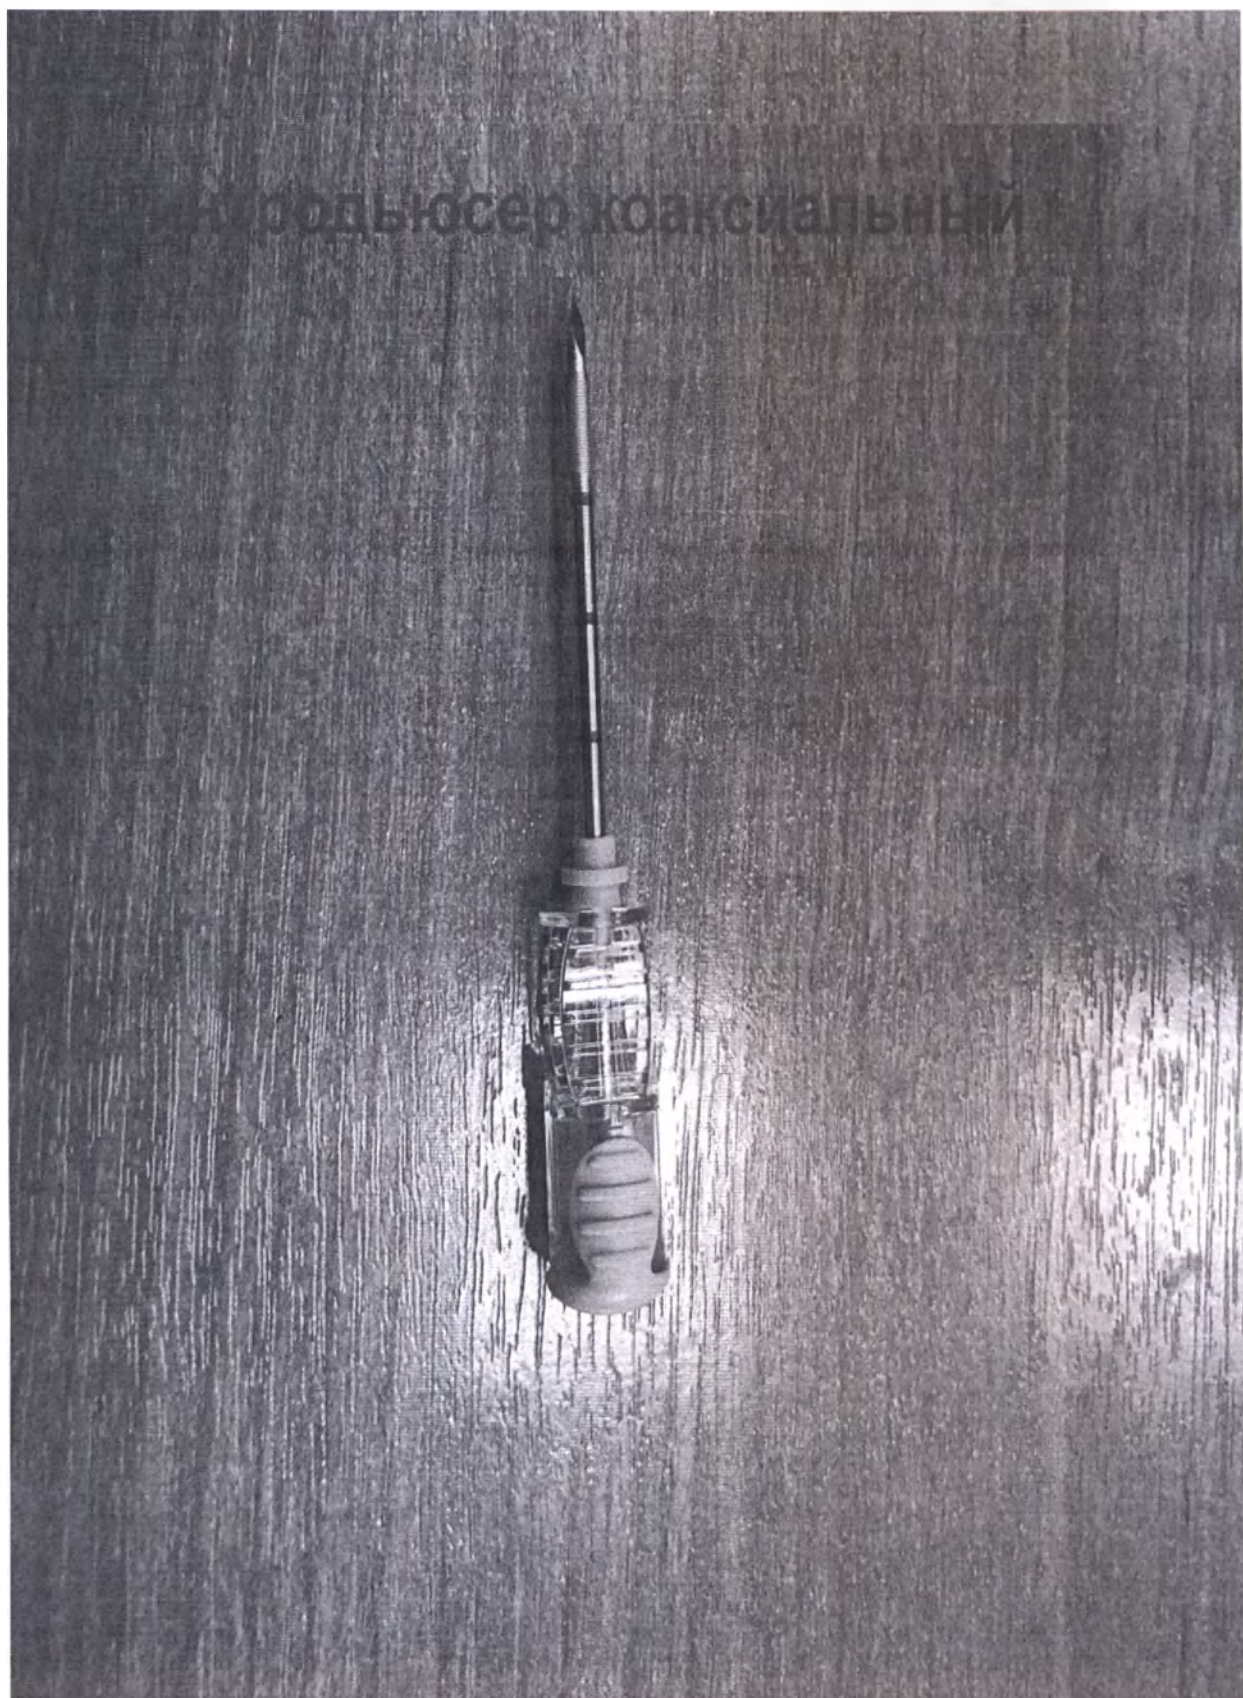

Набор для получения биопсийных образцов из мягких тканей CorVocet™, в составе:
- интродьюсер коаксиальный

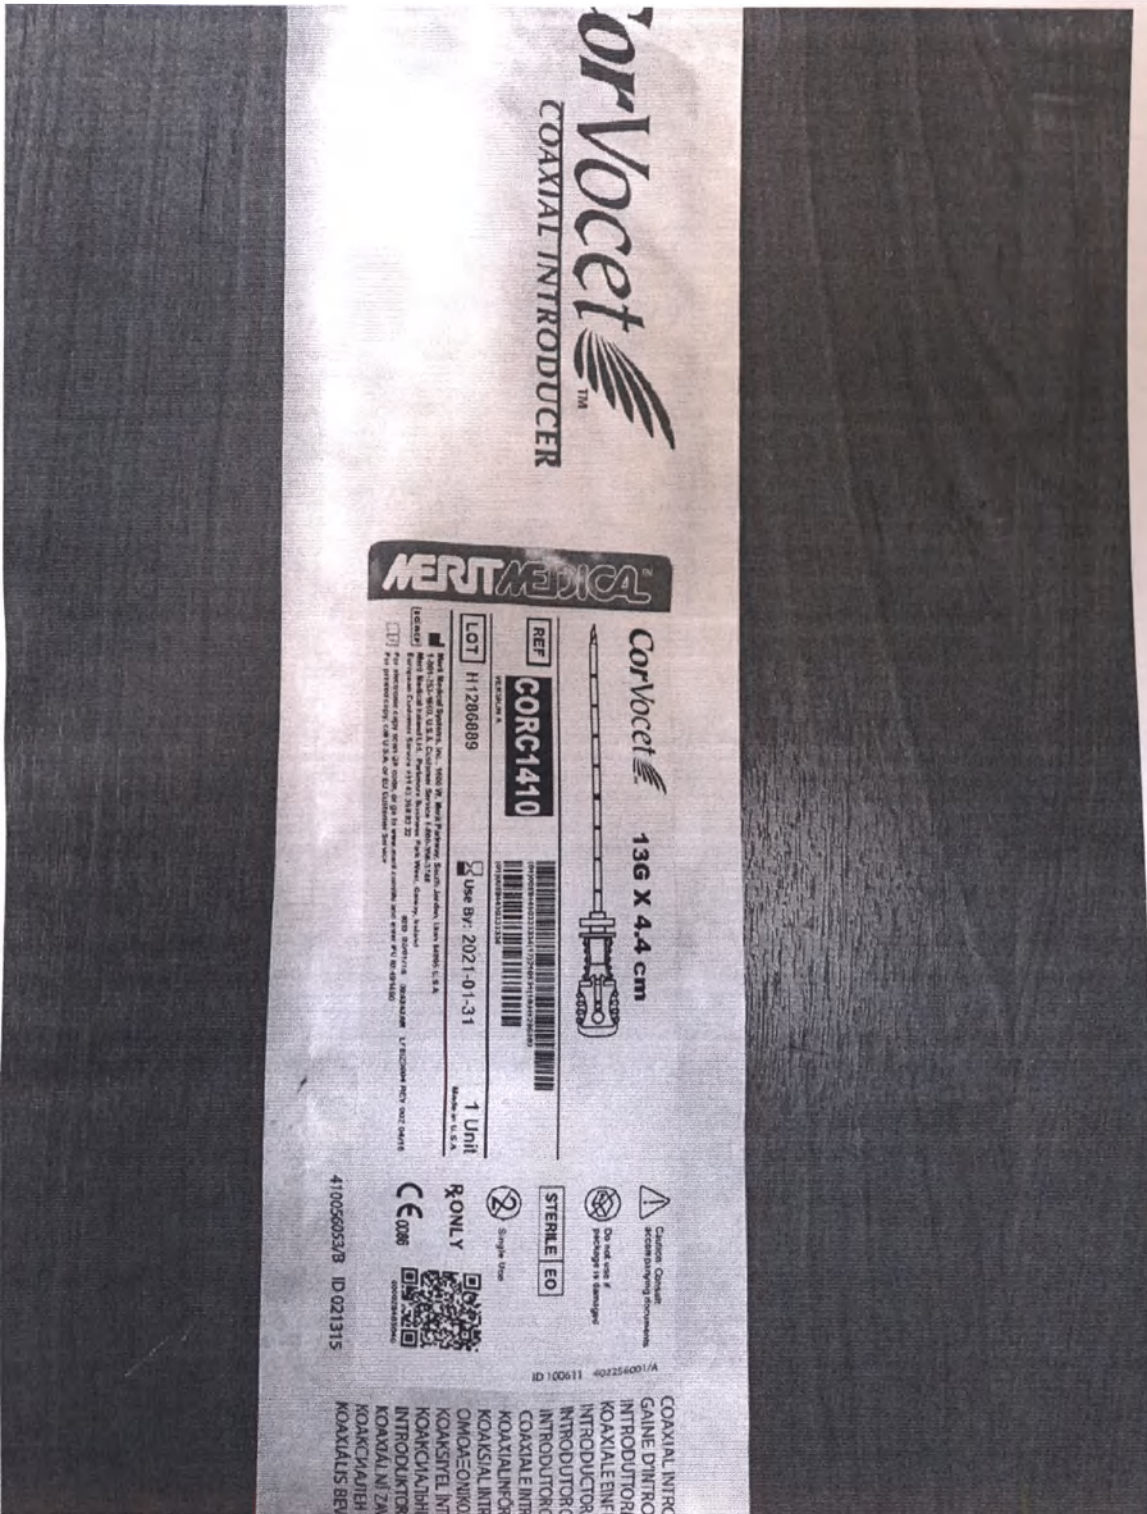

Образец маркировки набора

Прошито и пронумеровано

17 лист 66

Ген.директор /Матанов А.В./

