

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Эко-мед-с М»

Генеральный директор

Н.А.Ворошилов



2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор контрольных материалов МЕК-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК»

(Редакция 2)



Рис.1. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Вторичная упаковка. Ракурс 1



NIHON KOHDEN

REF

5DM02

MEK-5D

HEMATOLOGY CONTROL for five part differential

Contents: MEK-5DN x 2 vials
MEK-5DL x 2 vials
MEK-5DH x 2 vials



2018-08-05

LOT

MEK5D185

06/12



NIHON KOHDEN CORPORATION

1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan

EC REP

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH

Raiffeisenstrasse 10, D-61191 Rosbach, Germany



IVD



6124-908965

Рис.2. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Вторичная упаковка. Ракурс 2



Рис.3. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Вторичная упаковка. Ракурс 3

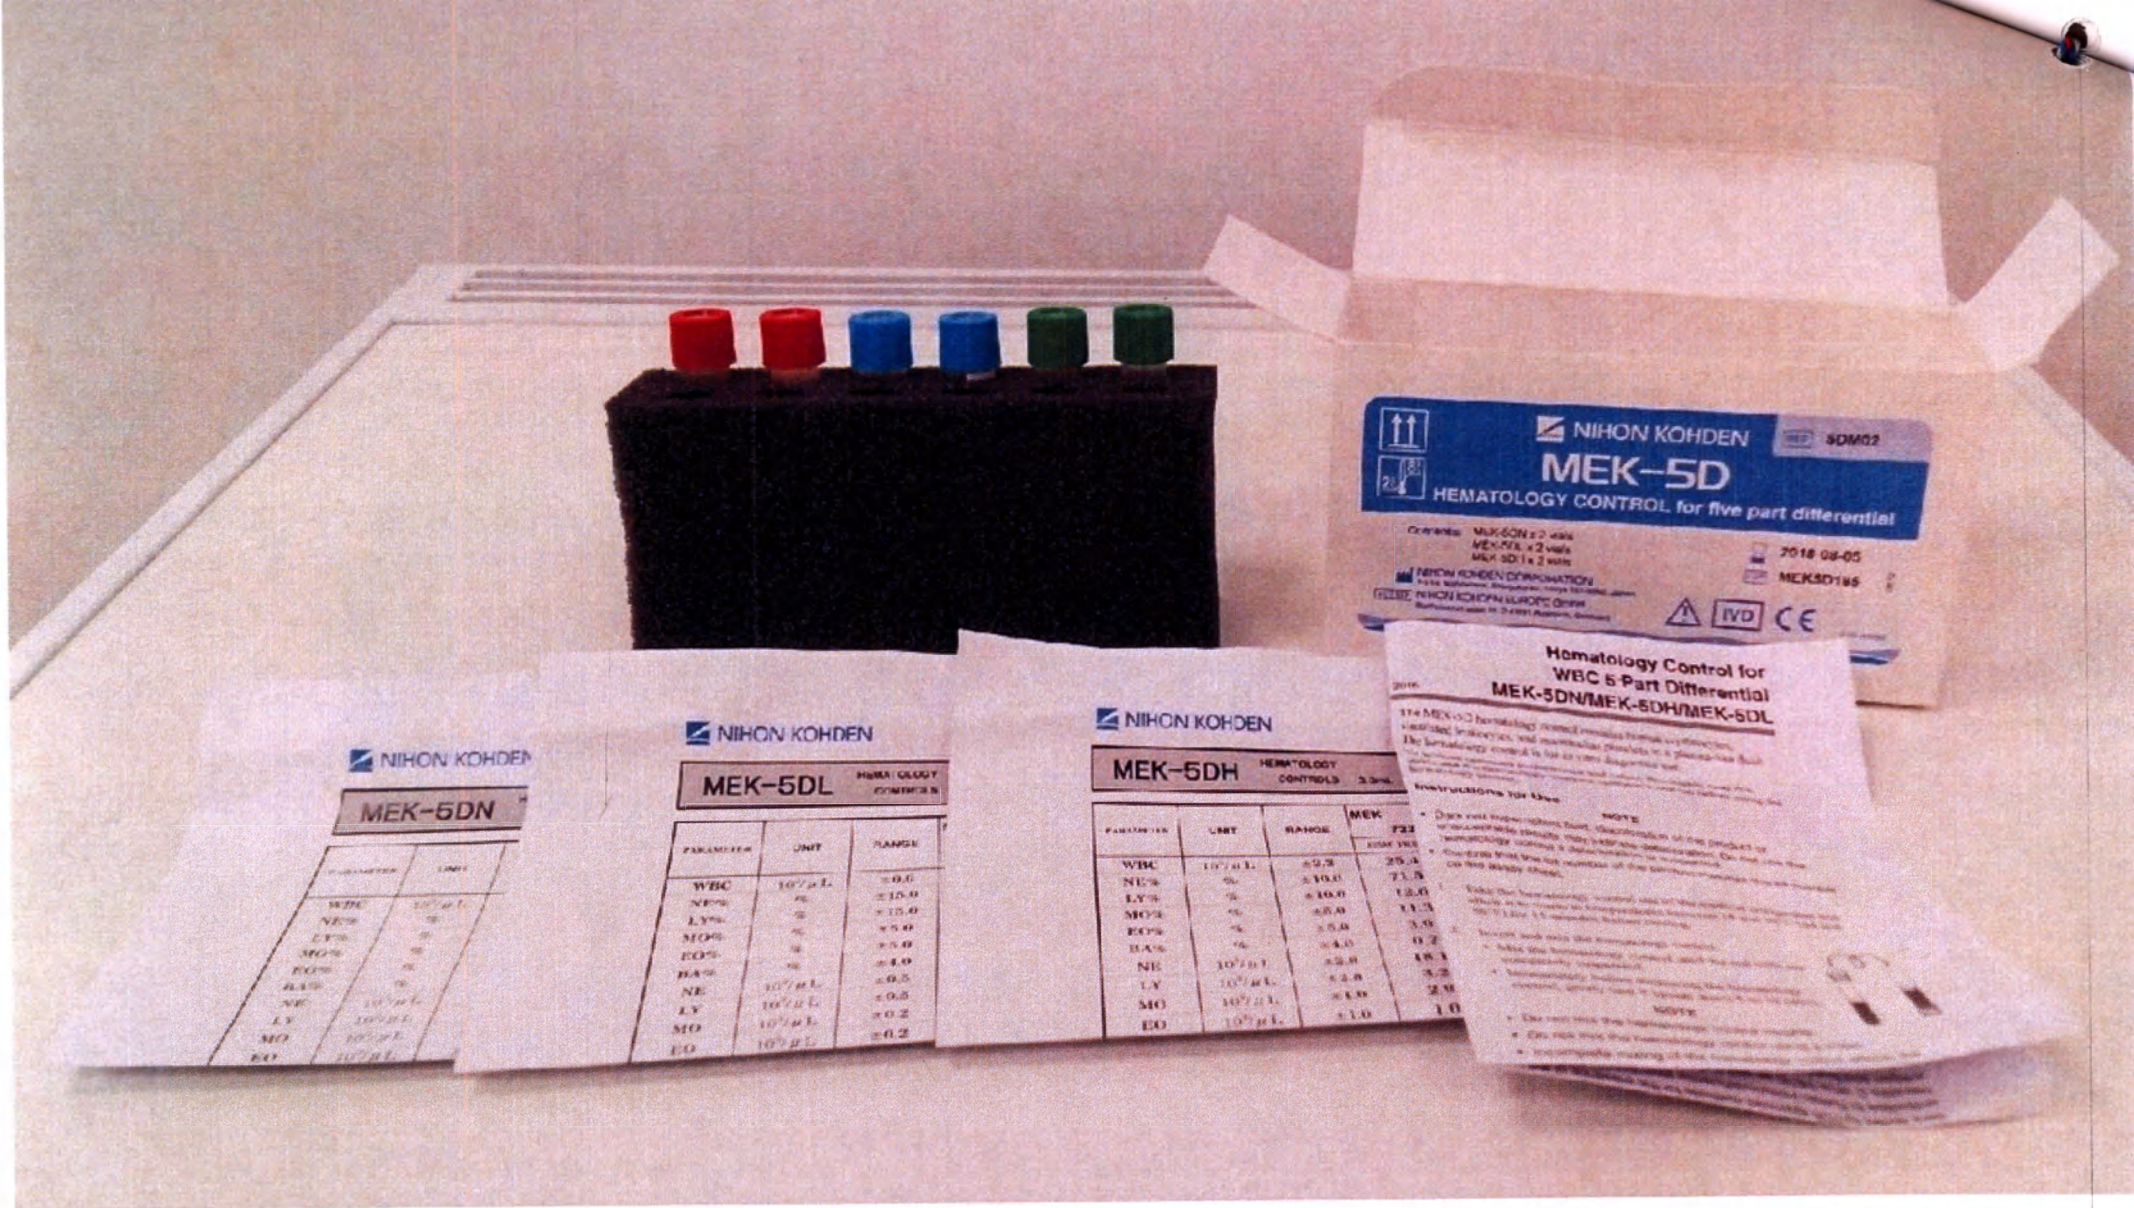


Рис.4. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК»

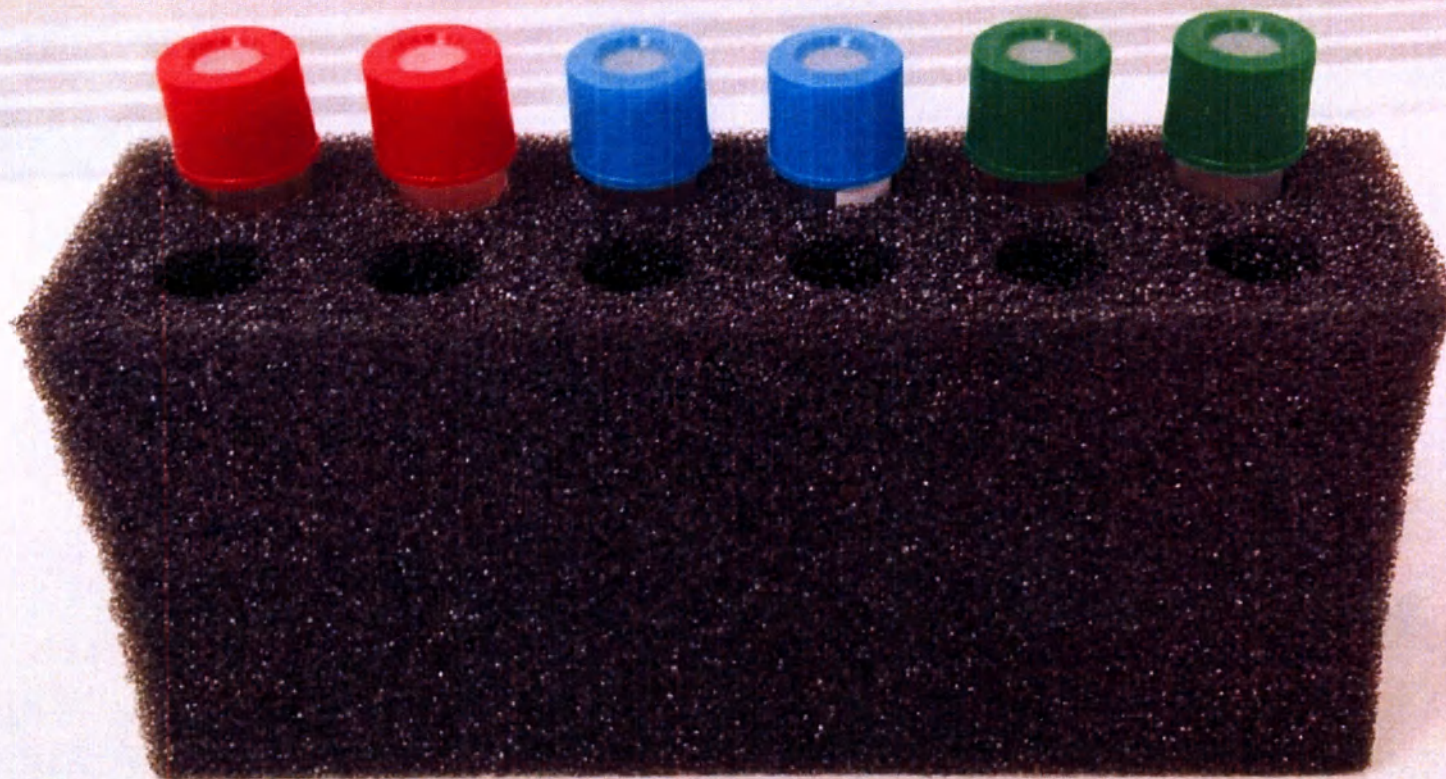


Рис.5. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирки в штативе из поролонa



Рис.6. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл. Ракурс 1



Рис.7. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл. Ракурс 2



Рис.8. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл. Ракурс 3



Рис.9. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, нормальный уровень (MEK-5DN), объем 3 мл. Ракурс 1



Рис.10. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, нормальный уровень (MEK-5DN), объем 3 мл. Ракурс 2



Рис.11. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, нормальный уровень (MEK-5DN), объем 3 мл. Ракурс 3



Рис.12. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл. Ракурс 1



Рис.13. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл. Ракурс 2



Рис.14. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Пробирка с контрольным материалом MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл. Ракурс 3



Рис.15. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК».
Макет маркировки пробирки с контрольным материалом MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл.



Рис.16. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Макет маркировки пробирки с контрольным материалом MEK-5D, нормальный уровень (MEK-5DN), объем 3 мл.



Рис.17. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК». Макет маркировки пробирки с контрольным материалом MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл.

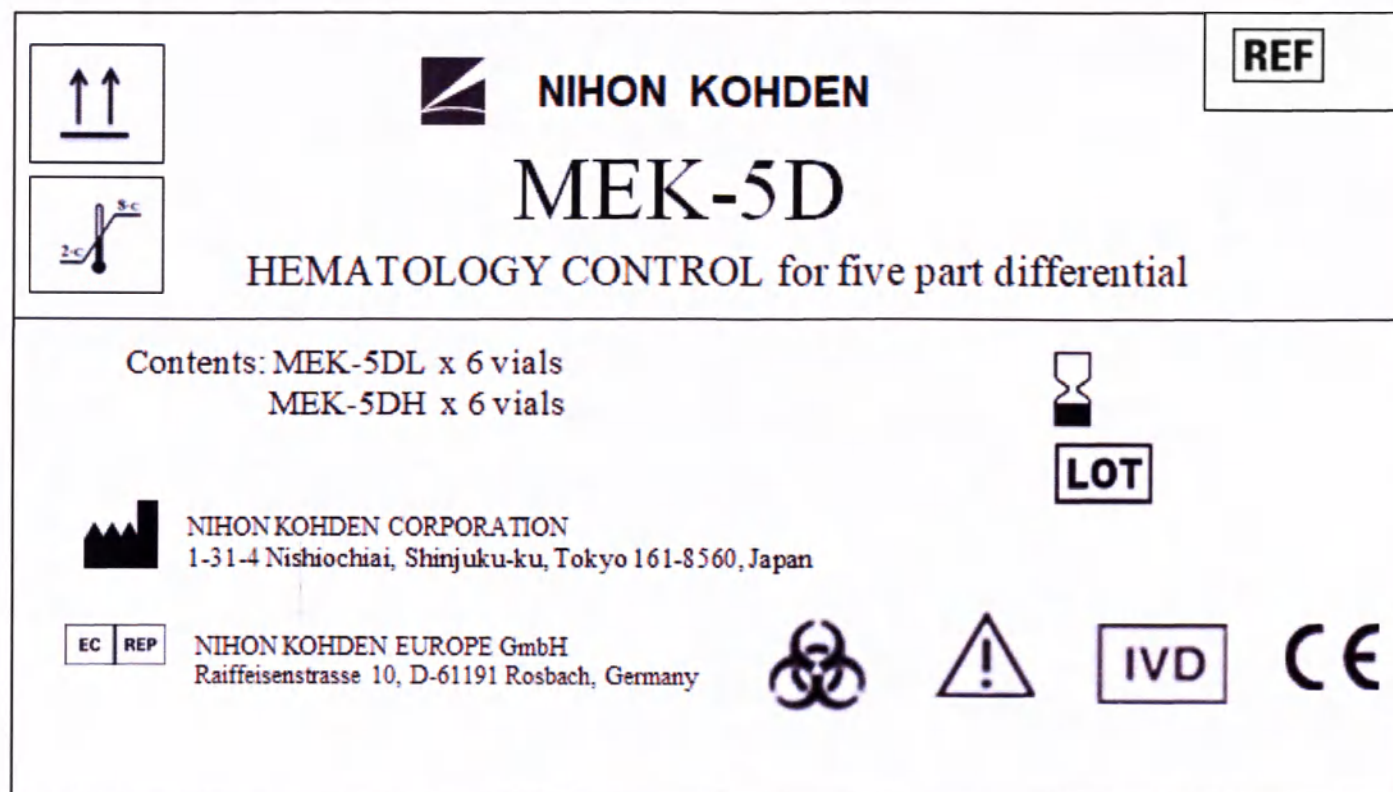


Рис.18. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК».

Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка) для Варианта поставки 1:

1. Контрольный материал MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл, 6 шт;
2. Контрольный материал MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл, 6 шт



Рис.19. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК».

Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка) для Варианта поставки 2:

1. Контрольный материал MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл, 2 шт;
2. Контрольный материал MEK-5D, нормальный уровень (MEK-5DN), объем 3 мл, 2 шт;
3. Контрольный материал MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл, 2 шт

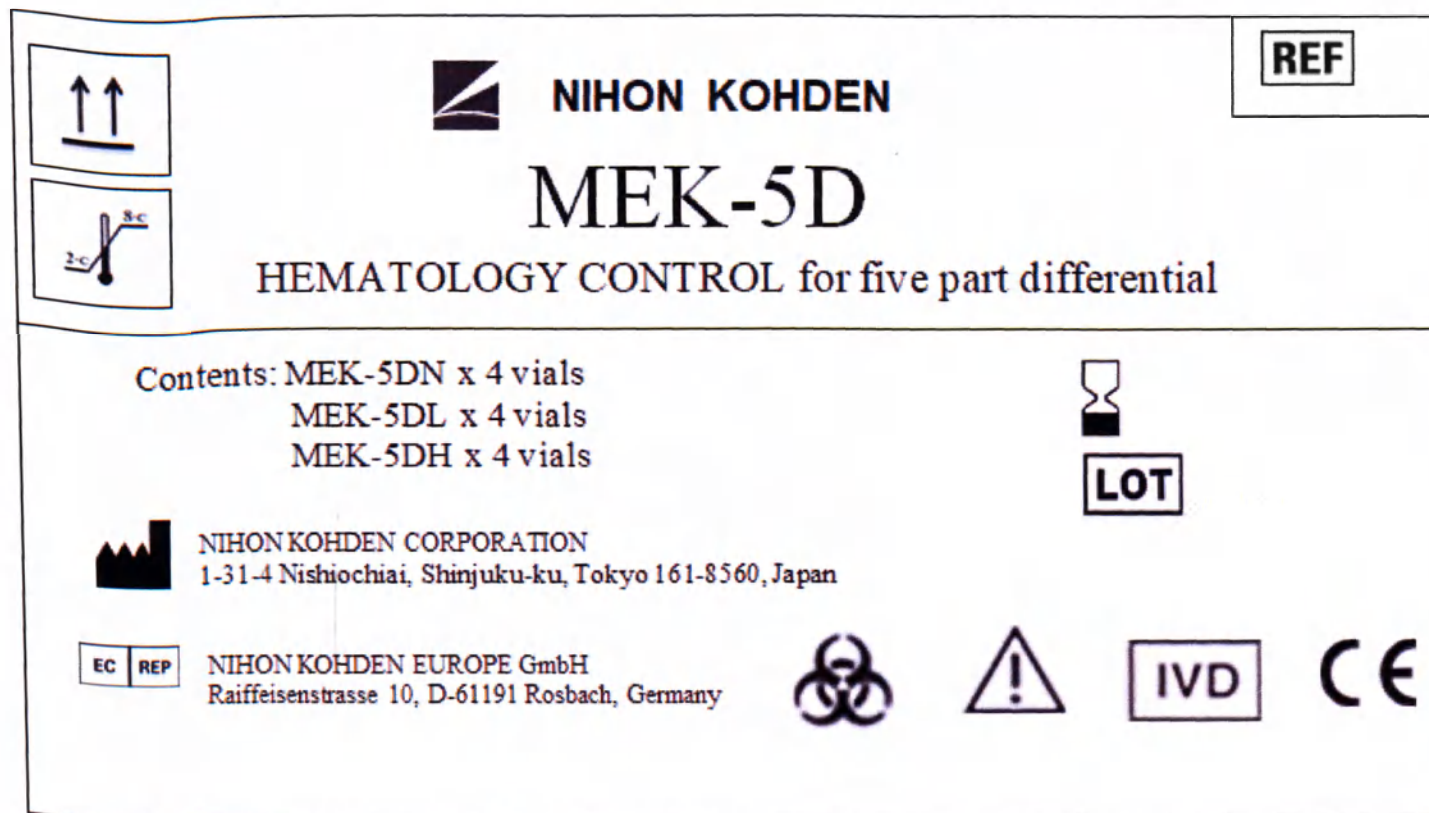


Рис.20. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «MEK».

Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка) для Варианта поставки 3:

1. Контрольный материал MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл, 4 шт;
2. Контрольный материал MEK-5D, нормальный уровень (MEK-5DN), объем 3 мл, 4 шт;
3. Контрольный материал MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл, 4 шт

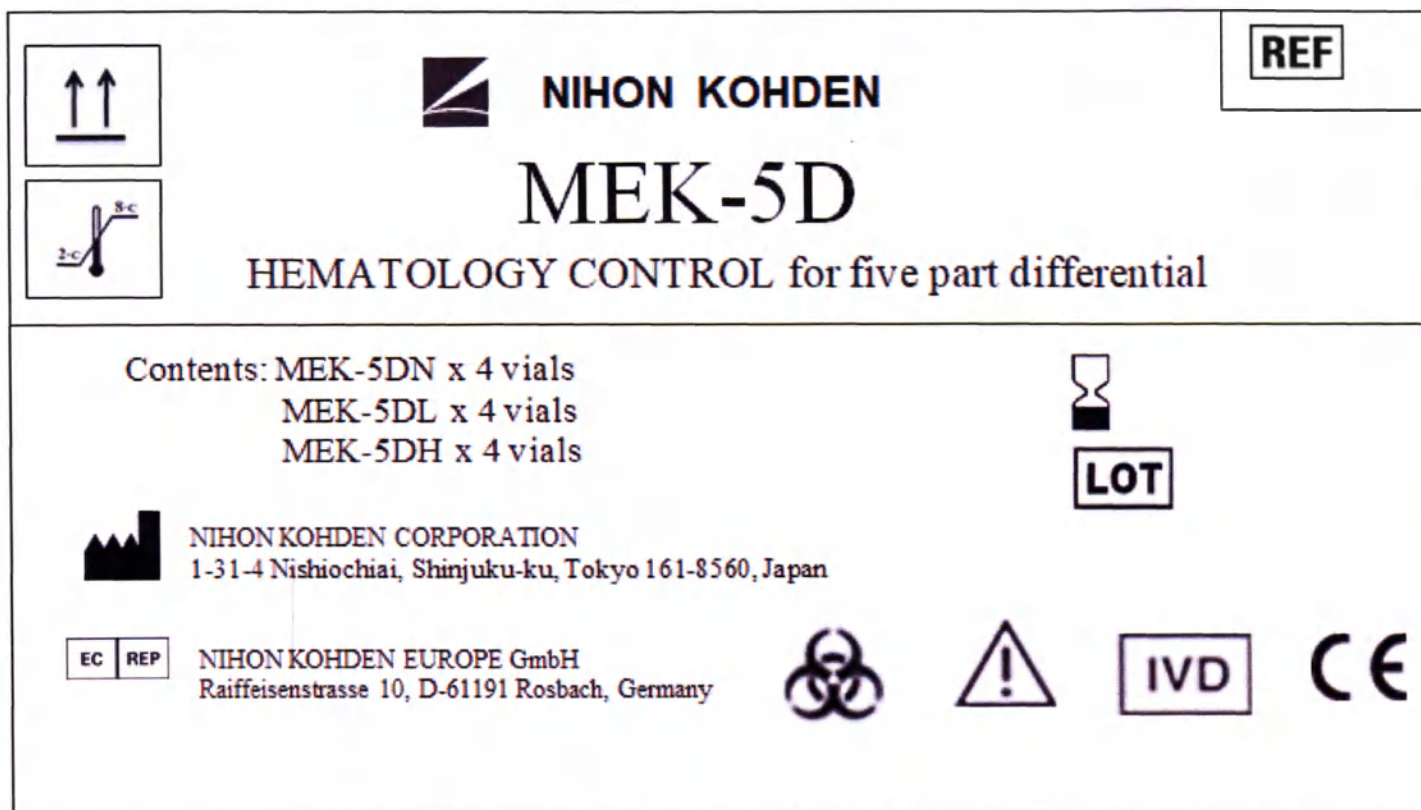


Рис.20. Набор контрольных материалов MEK-5D для 5-diff гематологических анализаторов «МЕК».

Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка) для Варианта поставки 3:

1. Контрольный материал MEK-5D, низкий уровень (MEK-5DL), объем 3 мл, 4 шт;
2. Контрольный материал MEK-5D, нормальный уровень (MEK-5DN), объем 3 мл, 4 шт;
3. Контрольный материал MEK-5D, высокий уровень (MEK-5DH), объем 3 мл, 4 шт

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 21
(Варварь один-два)
листов. Генеральный директор



/ Н.А.Ворошилов