


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения ферритина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Ферритин
Контрольные материалы (Alinity i Ferritin Controls)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**




Фотографическое изображение открытой упаковки «Ферритин Контрольные материалы (Alinity i Ferritin Controls)»

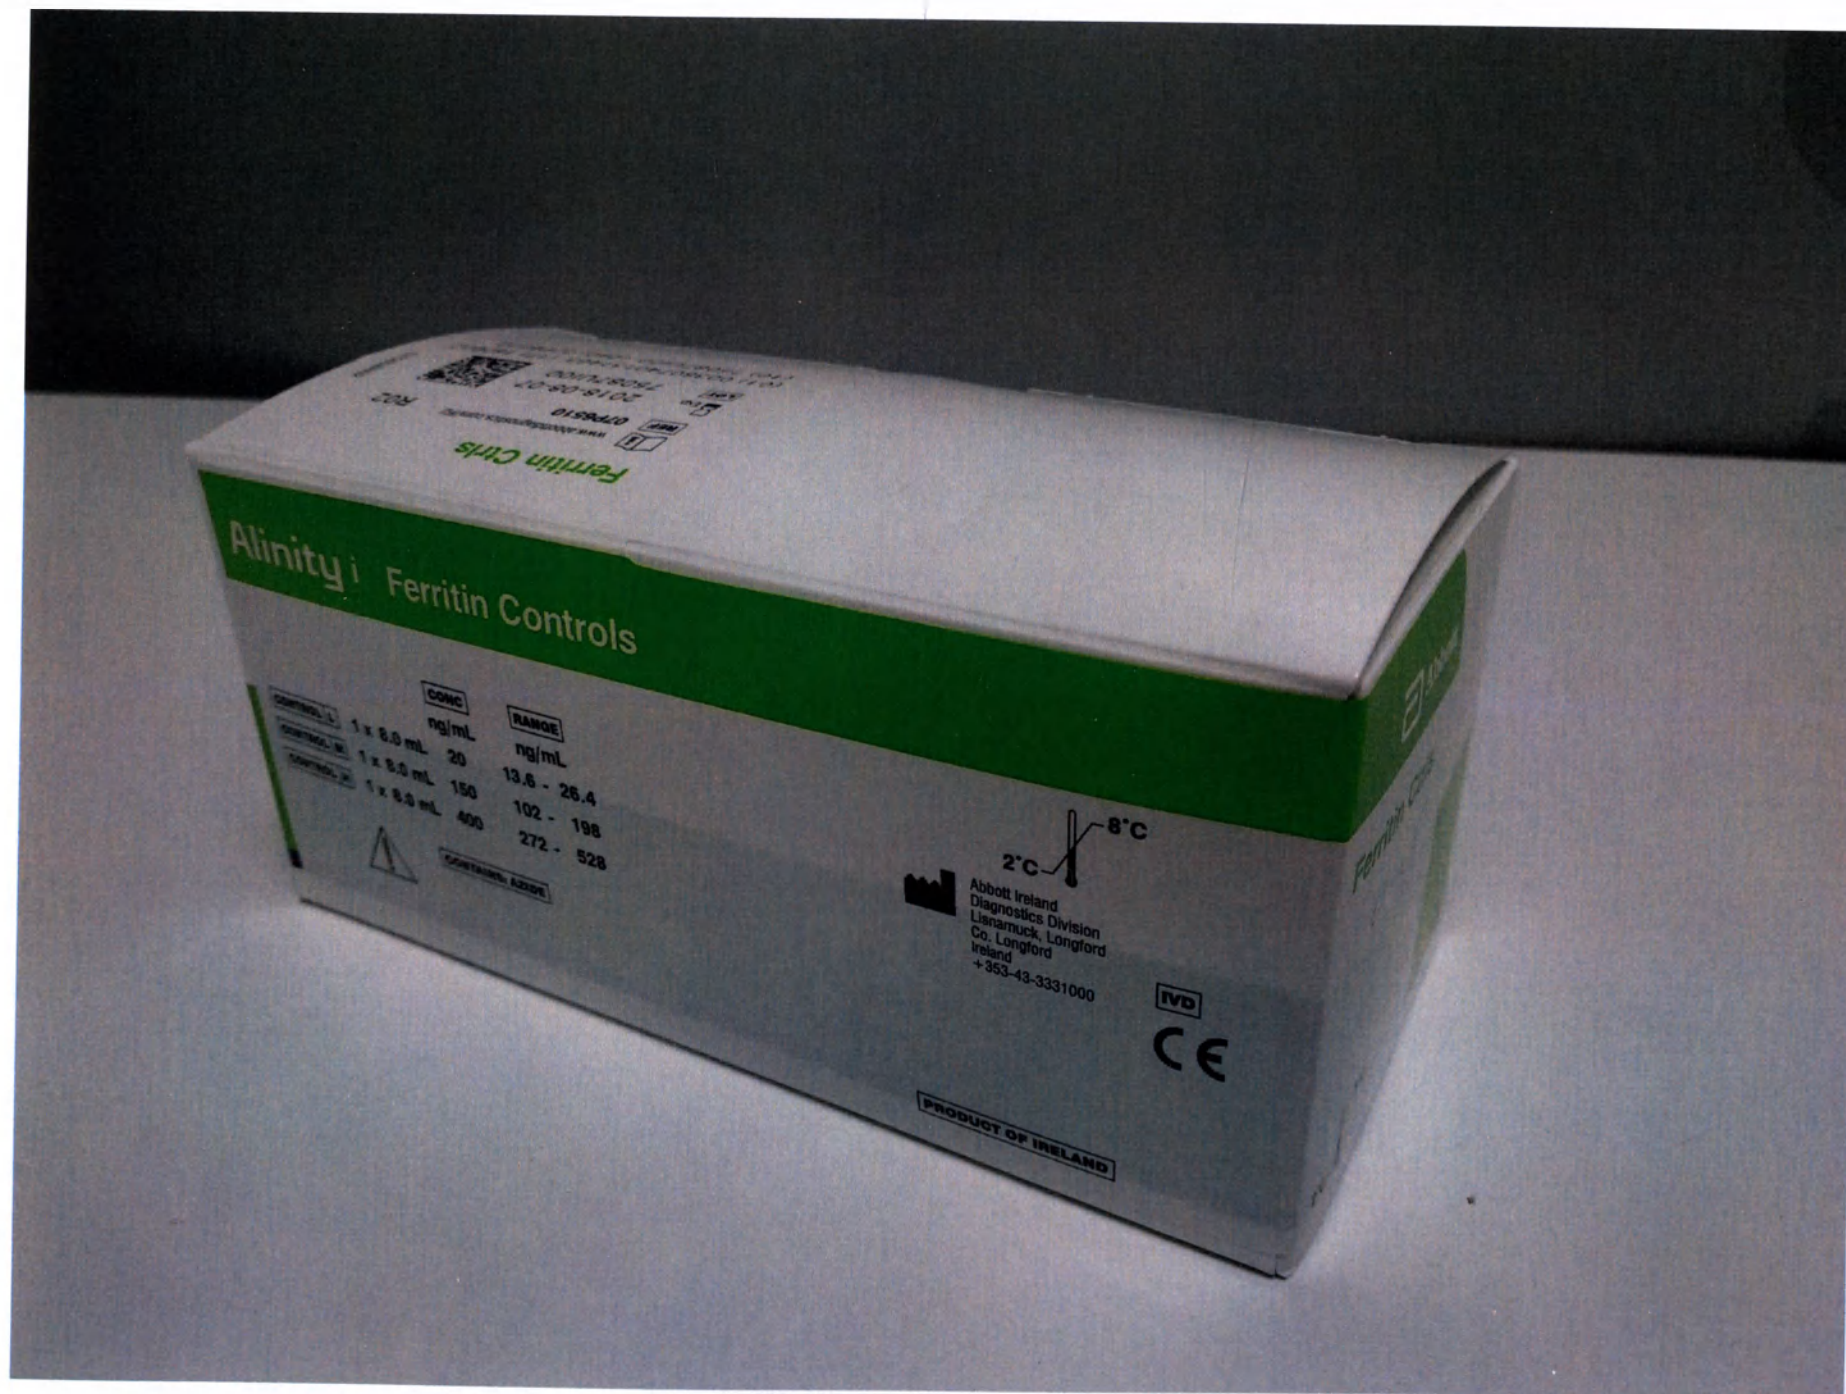

Фотографическое изображение упаковки и флаконов «Ферритин Контрольные материалы (Alinity i Ferritin Controls)»

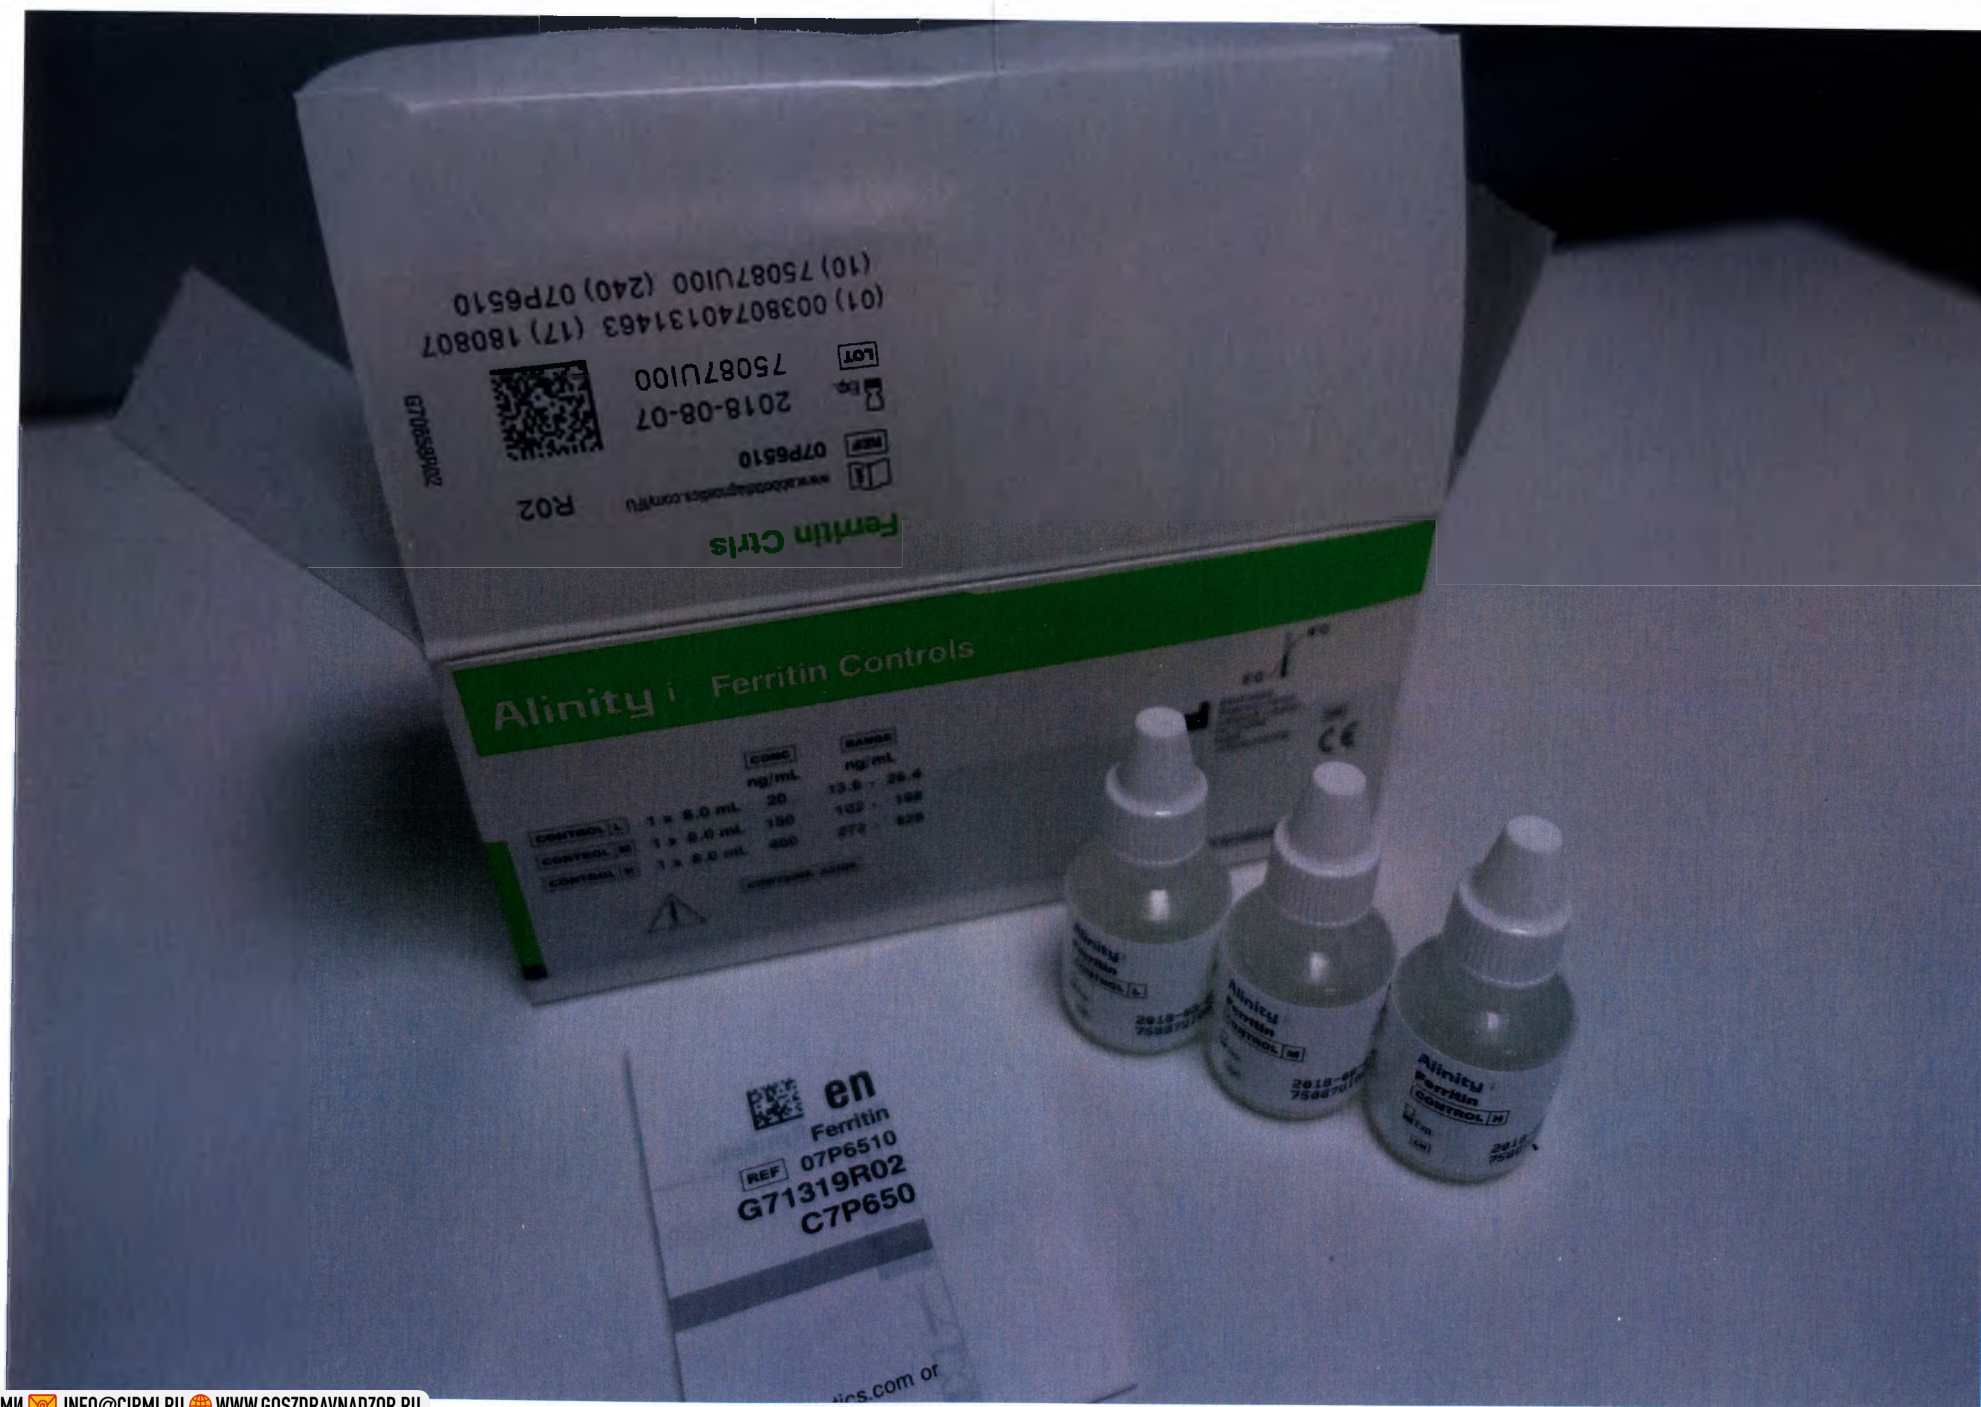

Фотографическое изображение флаконов «Ферритин Контрольные материалы (Alinity i Ferritin Controls)»

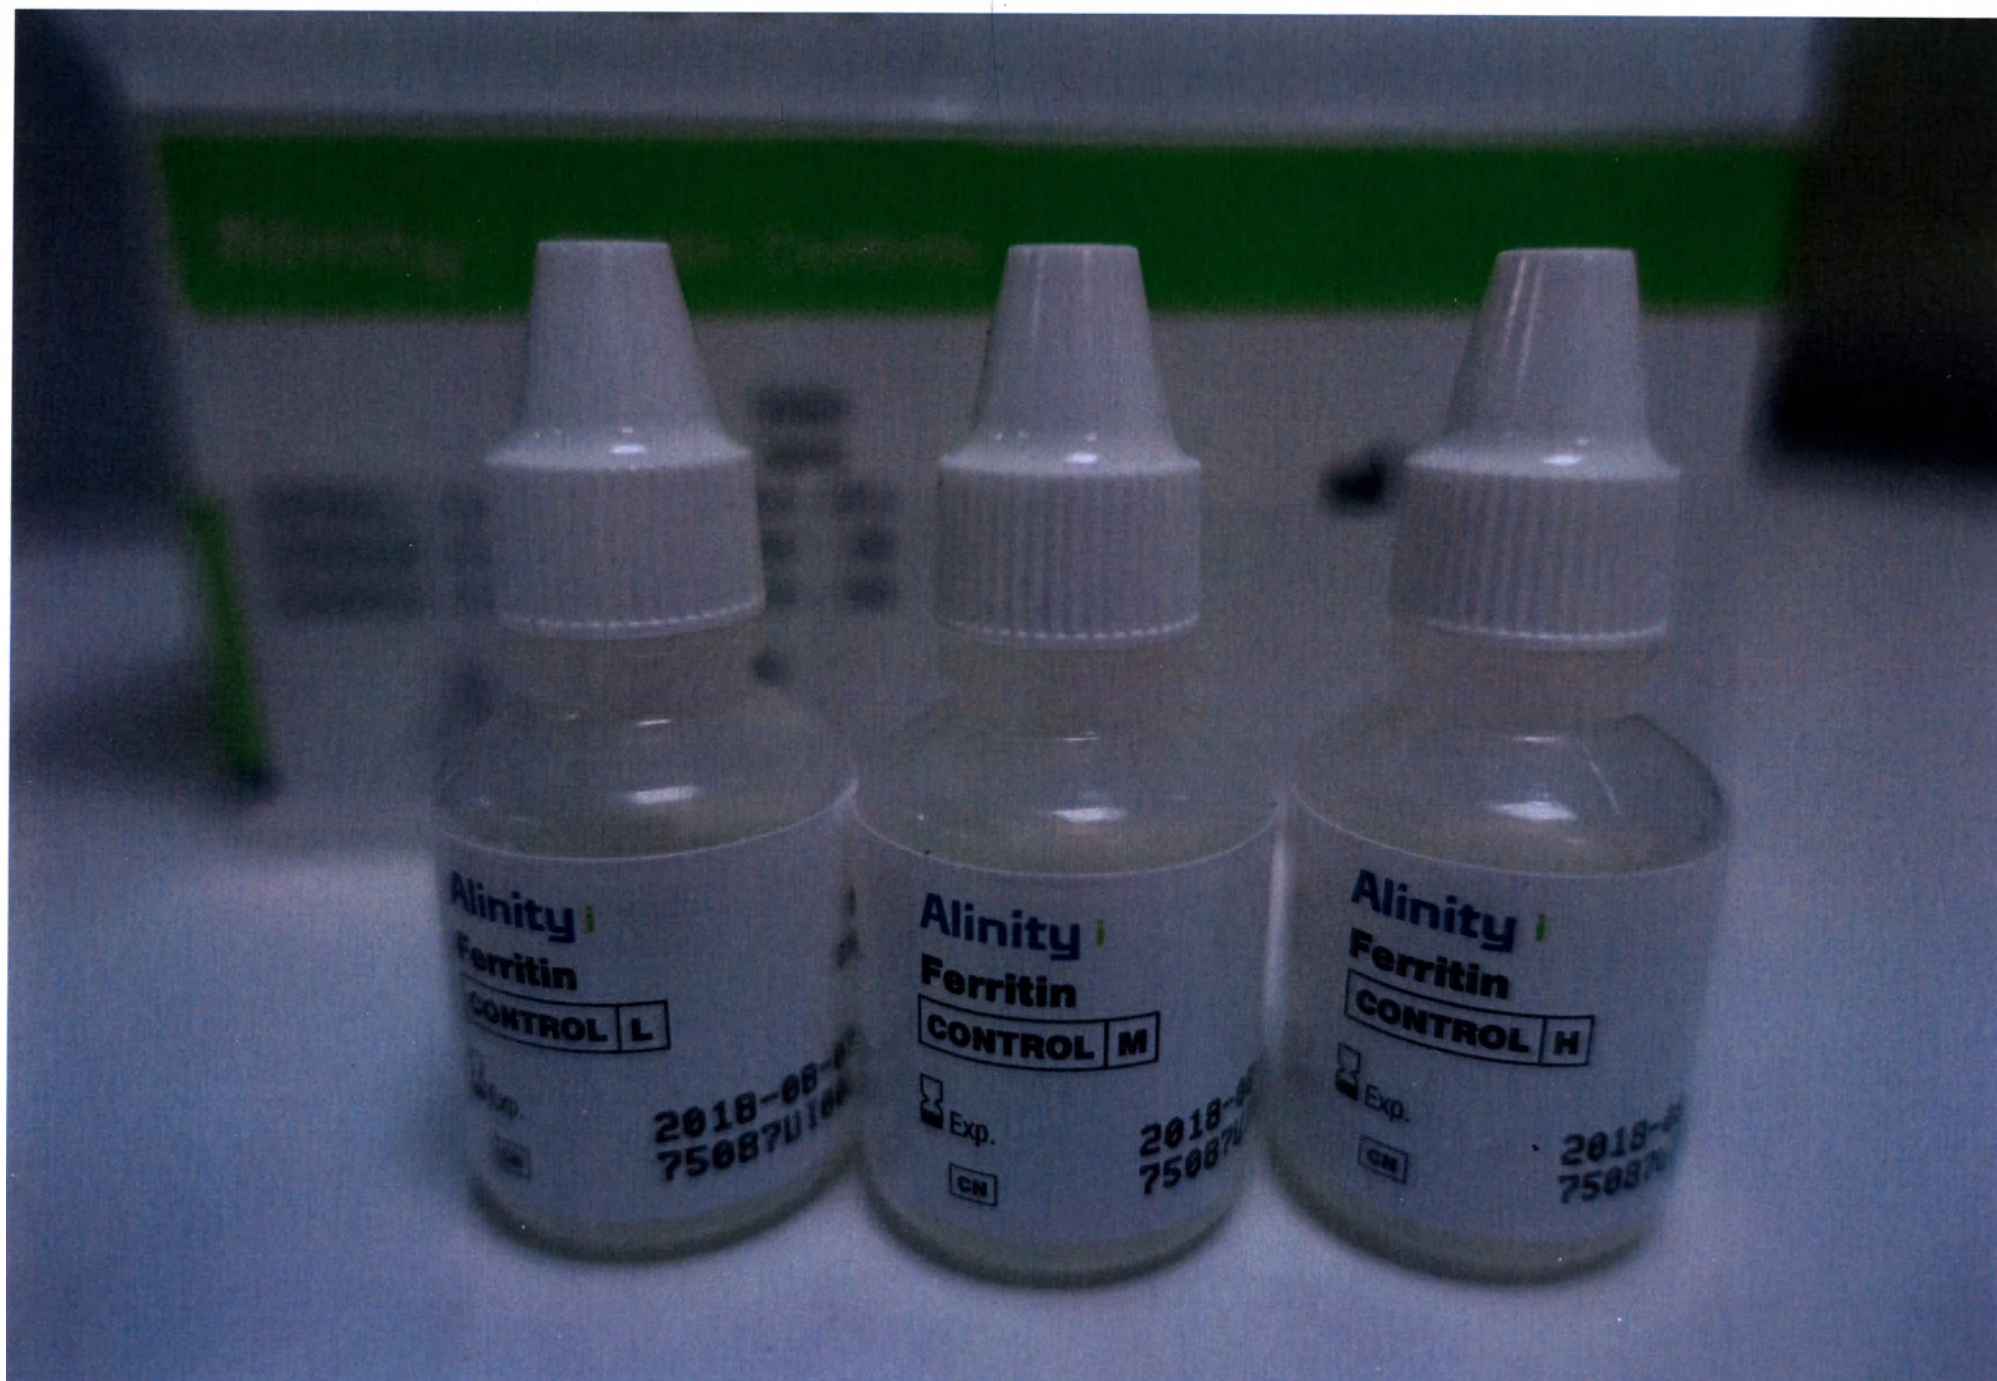

Фотографическое изображение флаконов «Ферритин Контрольные материалы (Alinity i Ferritin Controls)»



6 ЛИСТОВ

cb 

