



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Интерлин»
Колесников А. С.
«20» июня 2019 г.

**Фотографические изображения
Бандажи эластичные поддерживающие
по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в вариантах
исполнения
производства ООО «ИНТЕРЛИН»**

1. Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
- 1.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.
2. Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)
- 2.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.
3. Трусы-бандаж для беременных (код вида 219790)
- 3.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
4. Трусы-бандаж послеродовой с молнией (код вида 219790)
- 4.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.
5. Трусы-бандаж послеродовой без молнии с поясом (код вида 219790)
- 5.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.
6. Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками (код вида 219790)
- 6.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.
7. Трусы-бандаж послеоперационный для женщин с застёжкой (код вида 219790)
- 7.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.
8. Трусы-бандаж послеоперационный для женщин без застёжки (код вида 219790)
- 8.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.
9. Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
- 9.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.
10. Бандаж при пупочных грыжах (код вида 219810)
- 10.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.
11. Трусы-бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
- 11.1 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.


INTERLIN

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/ послеродовой)



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида
248370) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interlin-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на prod@interlin-k.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж для беременных
универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида
248370) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S,
M, L, XL, XXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.




Гарантийный срок
эксплуатации: 6 месяцев.

Размер L
Цвет серый

Дата изготовления:
нояб. 2018

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

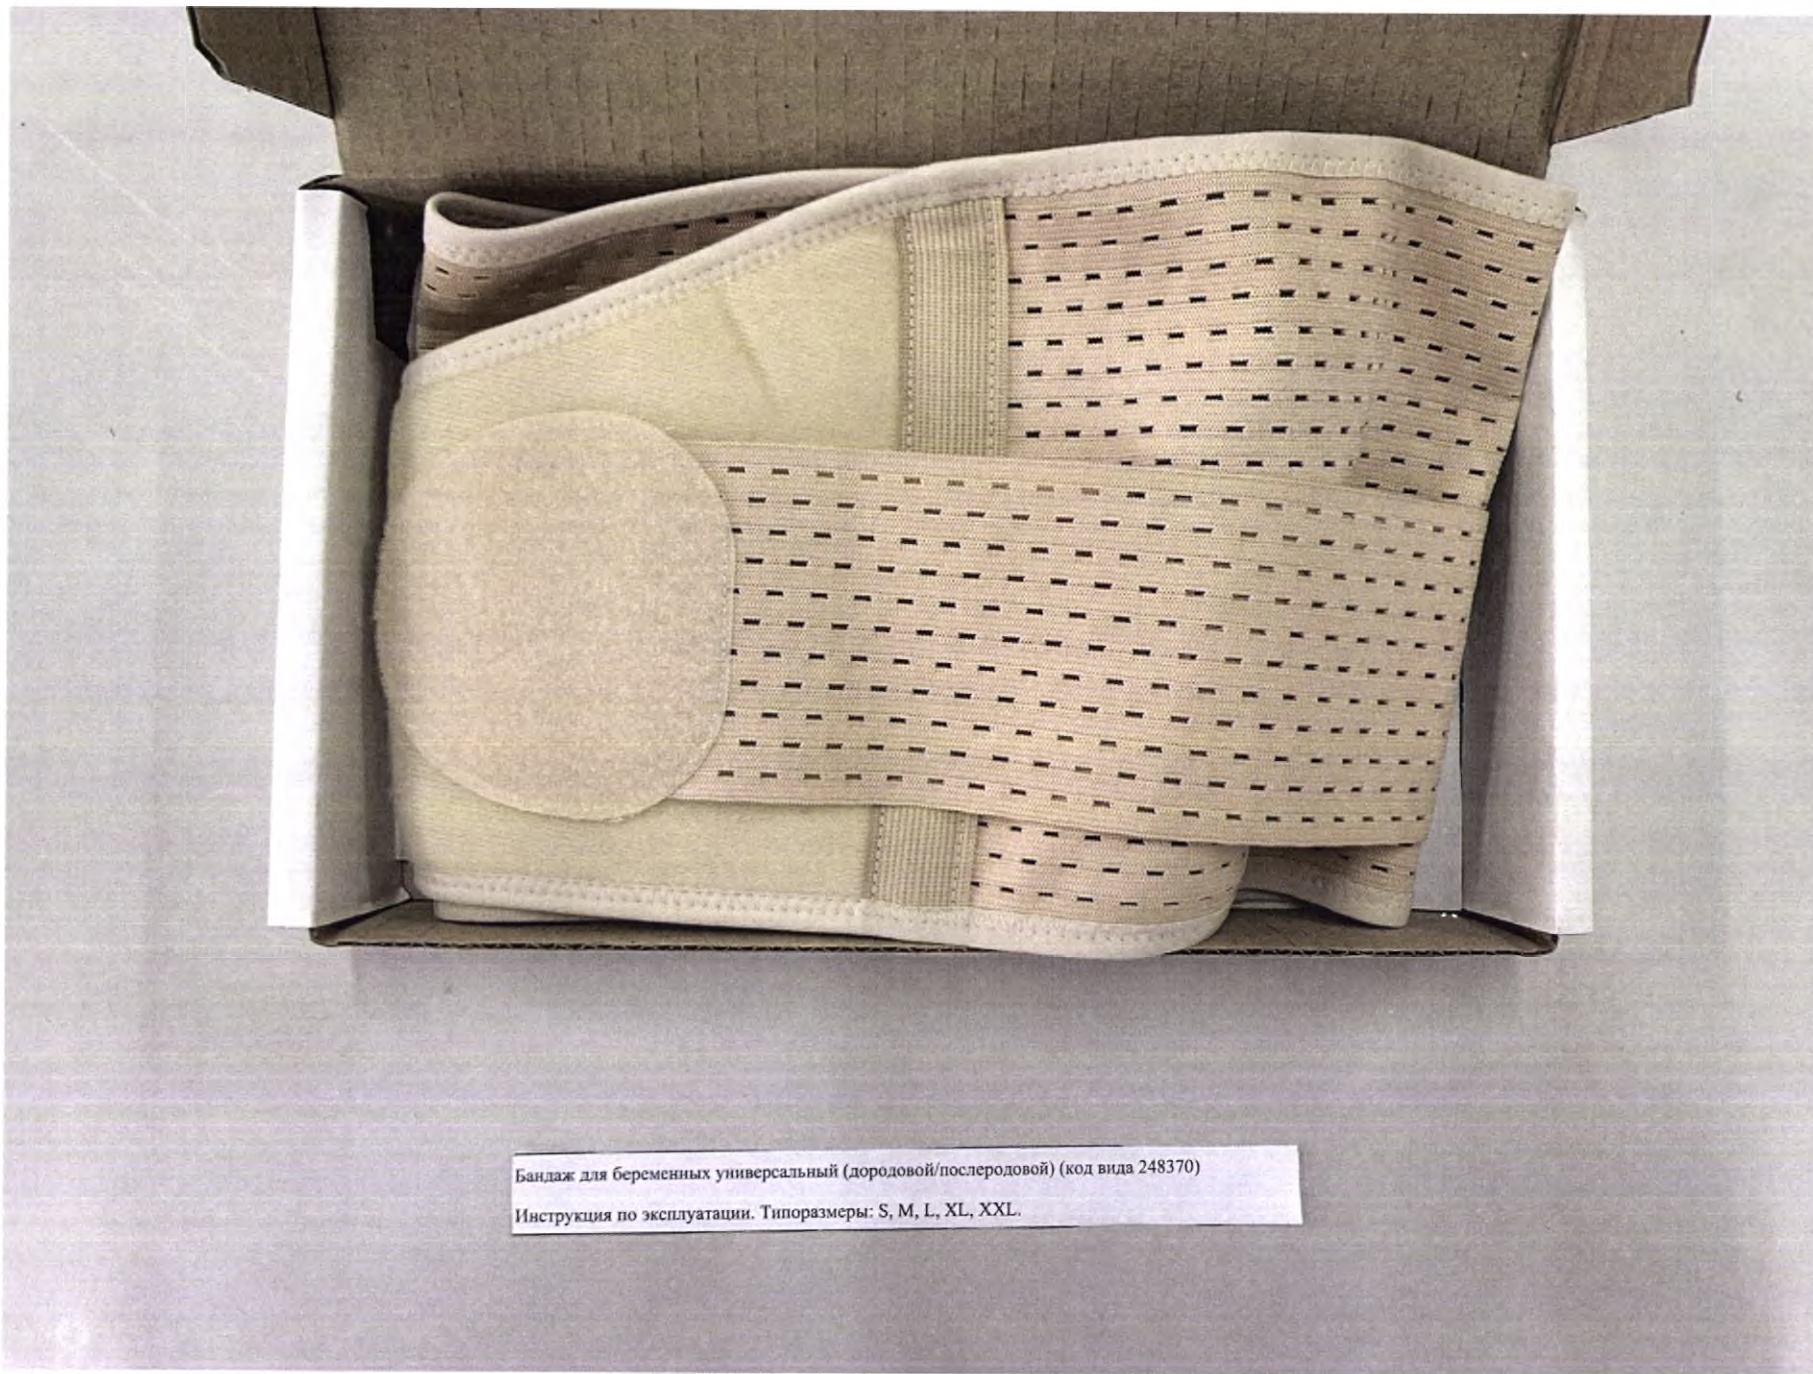

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Бандаж эластичный поддерживающий по ТУ 32.50.22-006-1133047-2018 в комплекте исполнения - Бандаж
беременный универсальный (дородовой/послеродовой). Инструкция по эксплуатации

Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Возможное активное использование изделия: белий, бежевый, розовый

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ООО «ЦИРМИ», РФ, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1, Литера У, У1, п.2 и
Телефон 8(495)150-26-34, веб-сайт интернет.рф, e-mail: info@cirmi.ru
ООО «ЦИРМИ» 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1, Литера У, У1, п.2 пом.240-1,
8(495)150-26-34, веб-сайт интернет.рф, e-mail: info@cirmi.ru
info@cirmi.ru

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Назначение: поддерживающий пояс талии в период беременности и по желанию женщины (срок родов,
заболевания позвоночника, протектирование в т.д.)


ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Изделие предназначено для индивидуального использования в лечебных и профилактических целях по
желанию женщины для женщин в период беременности начиная с 22-ой недели, для поддержки мышечной
системы живота, снижения нагрузки на позвоночник и тазобедренный сустав, для профилактики
осложнений (таких как беременность). Изделие предназначено для применения в лечебно-профилактических
учреждениях, реабилитационных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также в
индивидуальном пользовании. Рискан, абсолютных противопоказаний к применению и побочных эффектов
таких как беременность не выявлено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Изделие относится к классу I по ГОСТ Р 54236-2018, предназначенное для индивидуального использования

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

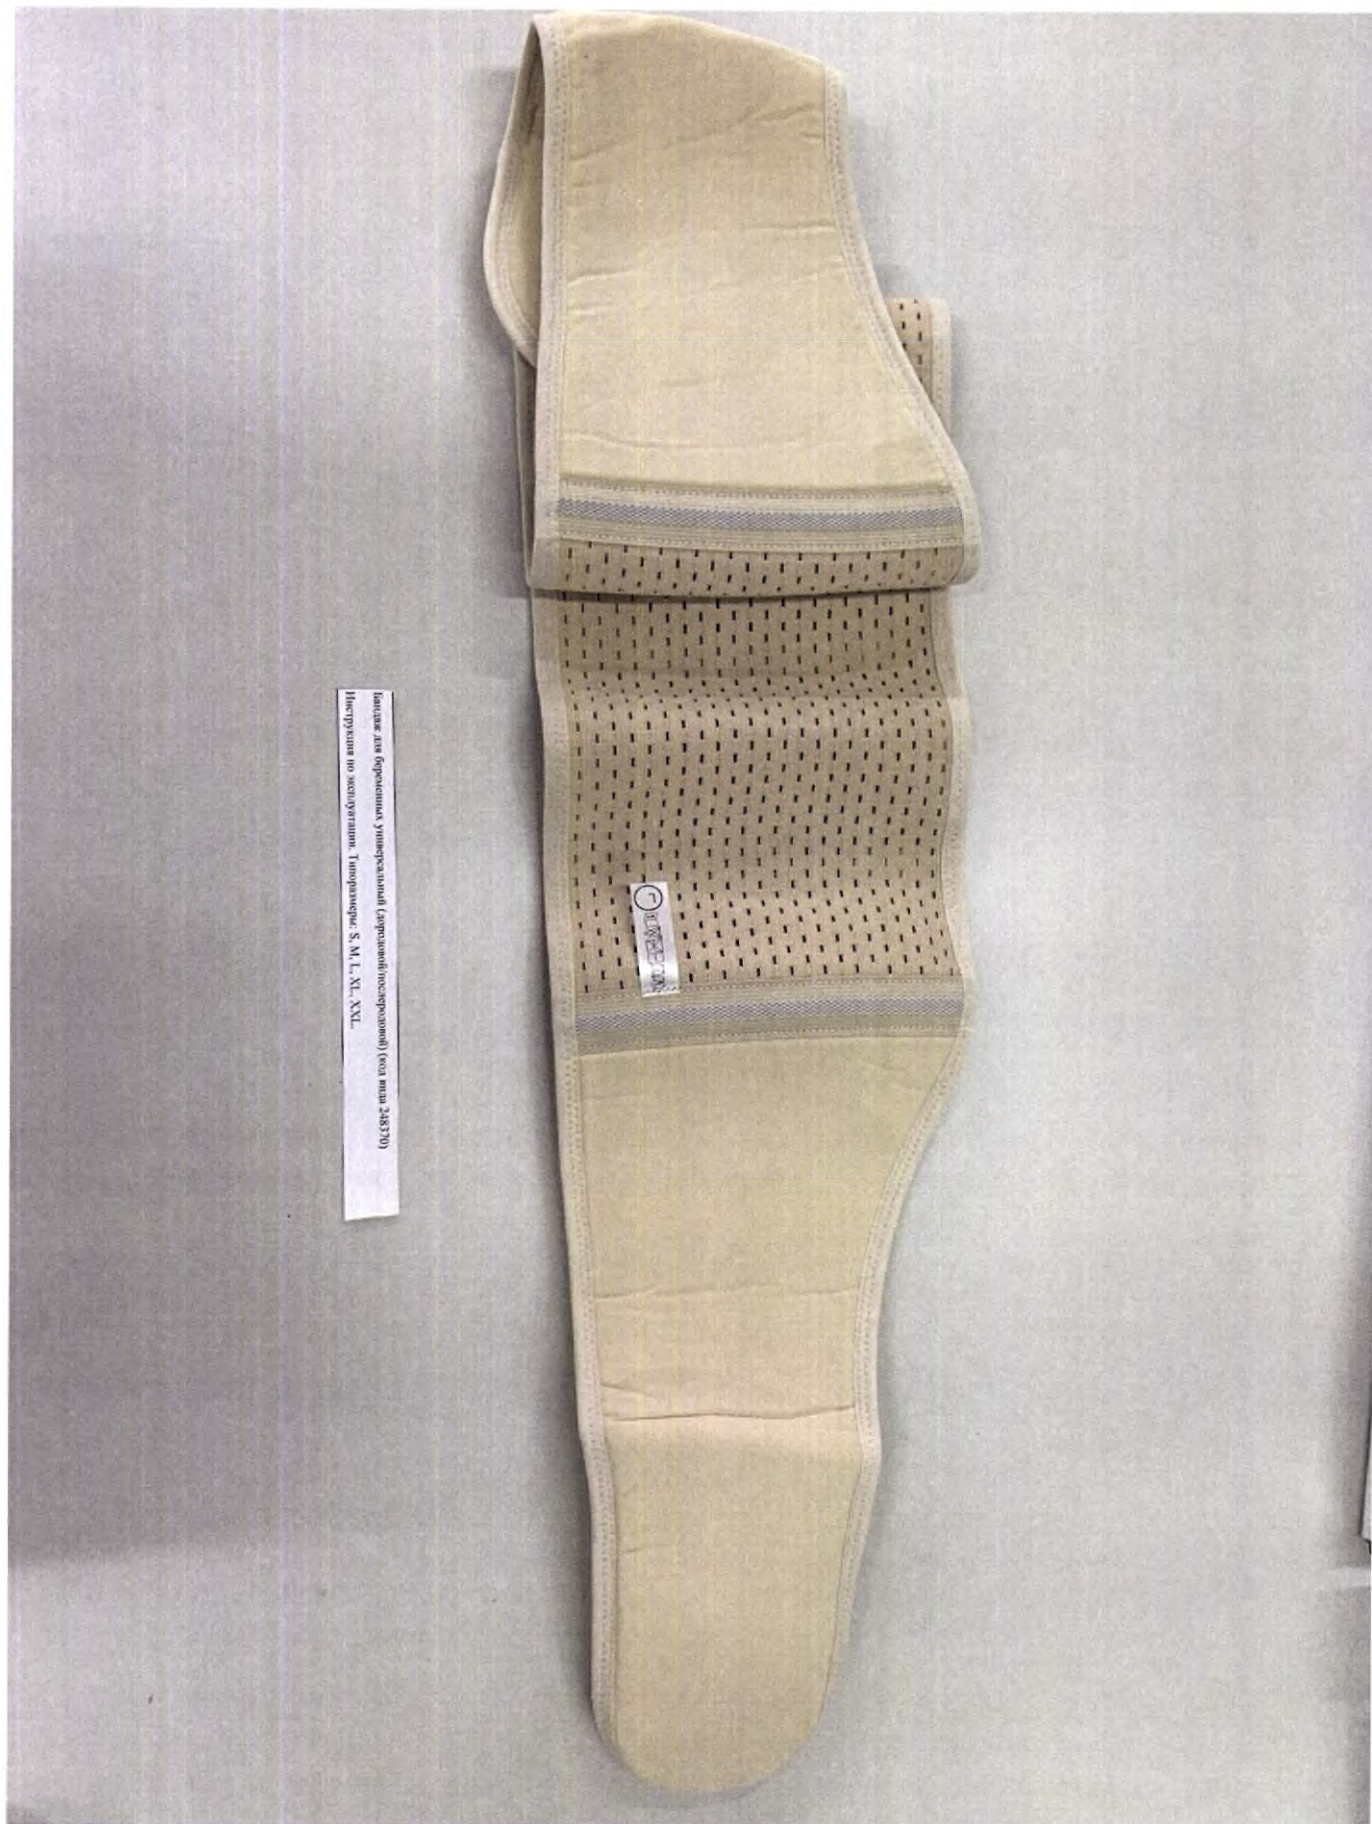

Бинтаж для фиксации универсальный (аппаратный неоспоронный) (код нмк 34870)
Изделие по сертификату. Типоразмер: S, M, L, XL, XXL.


INTERLIN

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/ послеродовой)



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида
248370) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт: interline-k.ru, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на profeedback-k.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж для беременных
универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида
248370) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S,
M, L, XL, XXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.




Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев.

Размер *M*
Цвет *бел*

Дата изготовления:
нояб 2018

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

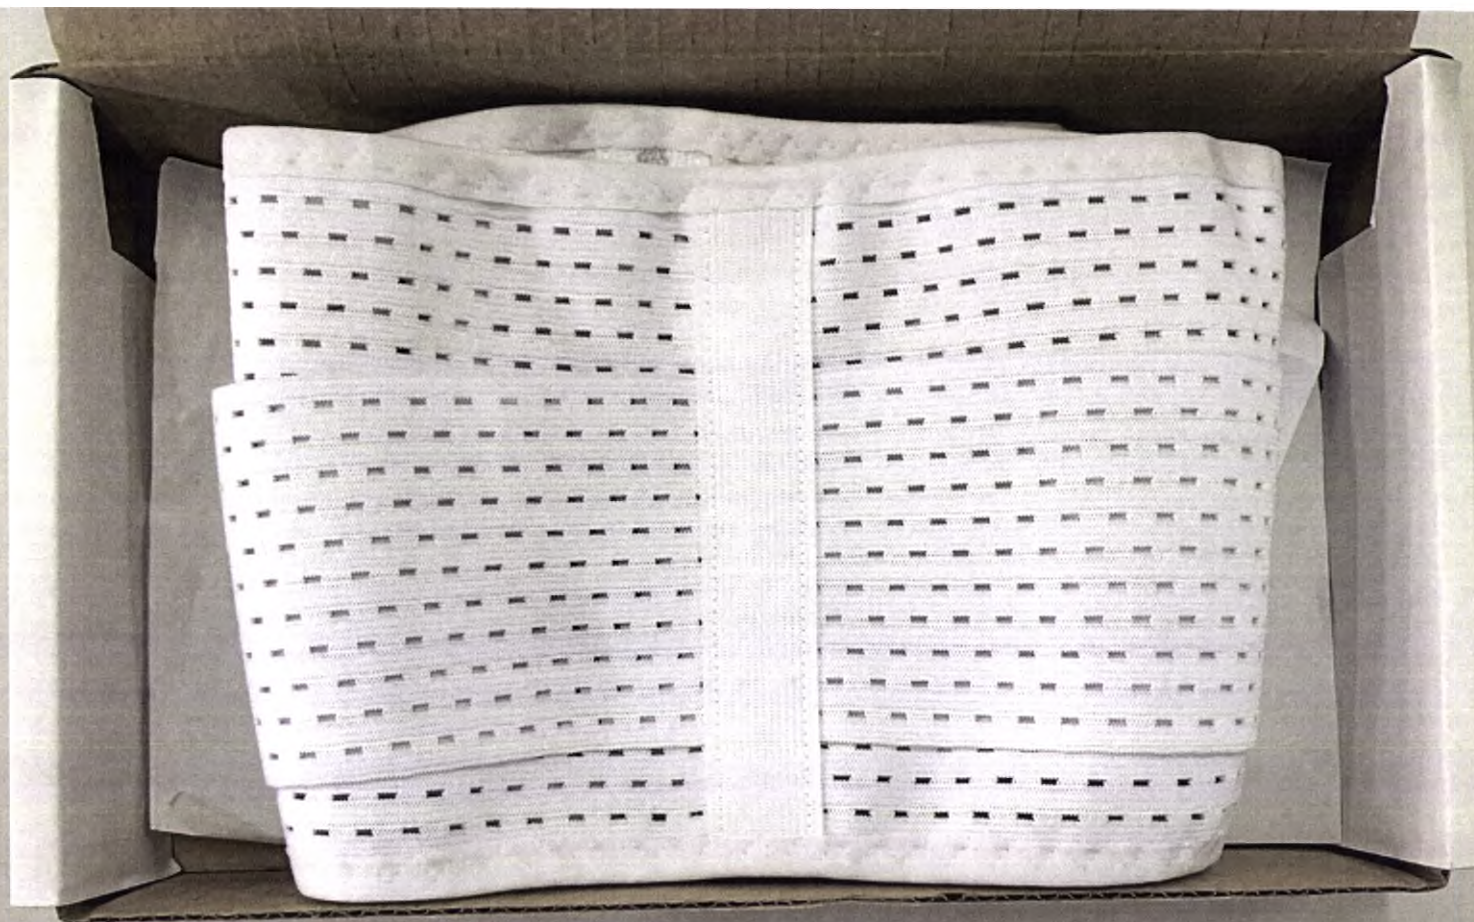

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Бандаж для беременных универсальный (эрозивной неоспорозной) (код мата 248370)
Изготовлен по технологии: Тонкотканый, S, M, L, XL, XXL




INTERLIN

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/ послеродовой)



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида
248370) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на prod@interline-k.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж для беременных
универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида
248370) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S,
M, L, XL, XXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.




Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев.

Размер **M**
Цвет **роз**

Дата изготовления:
нояб. 2018

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)


Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

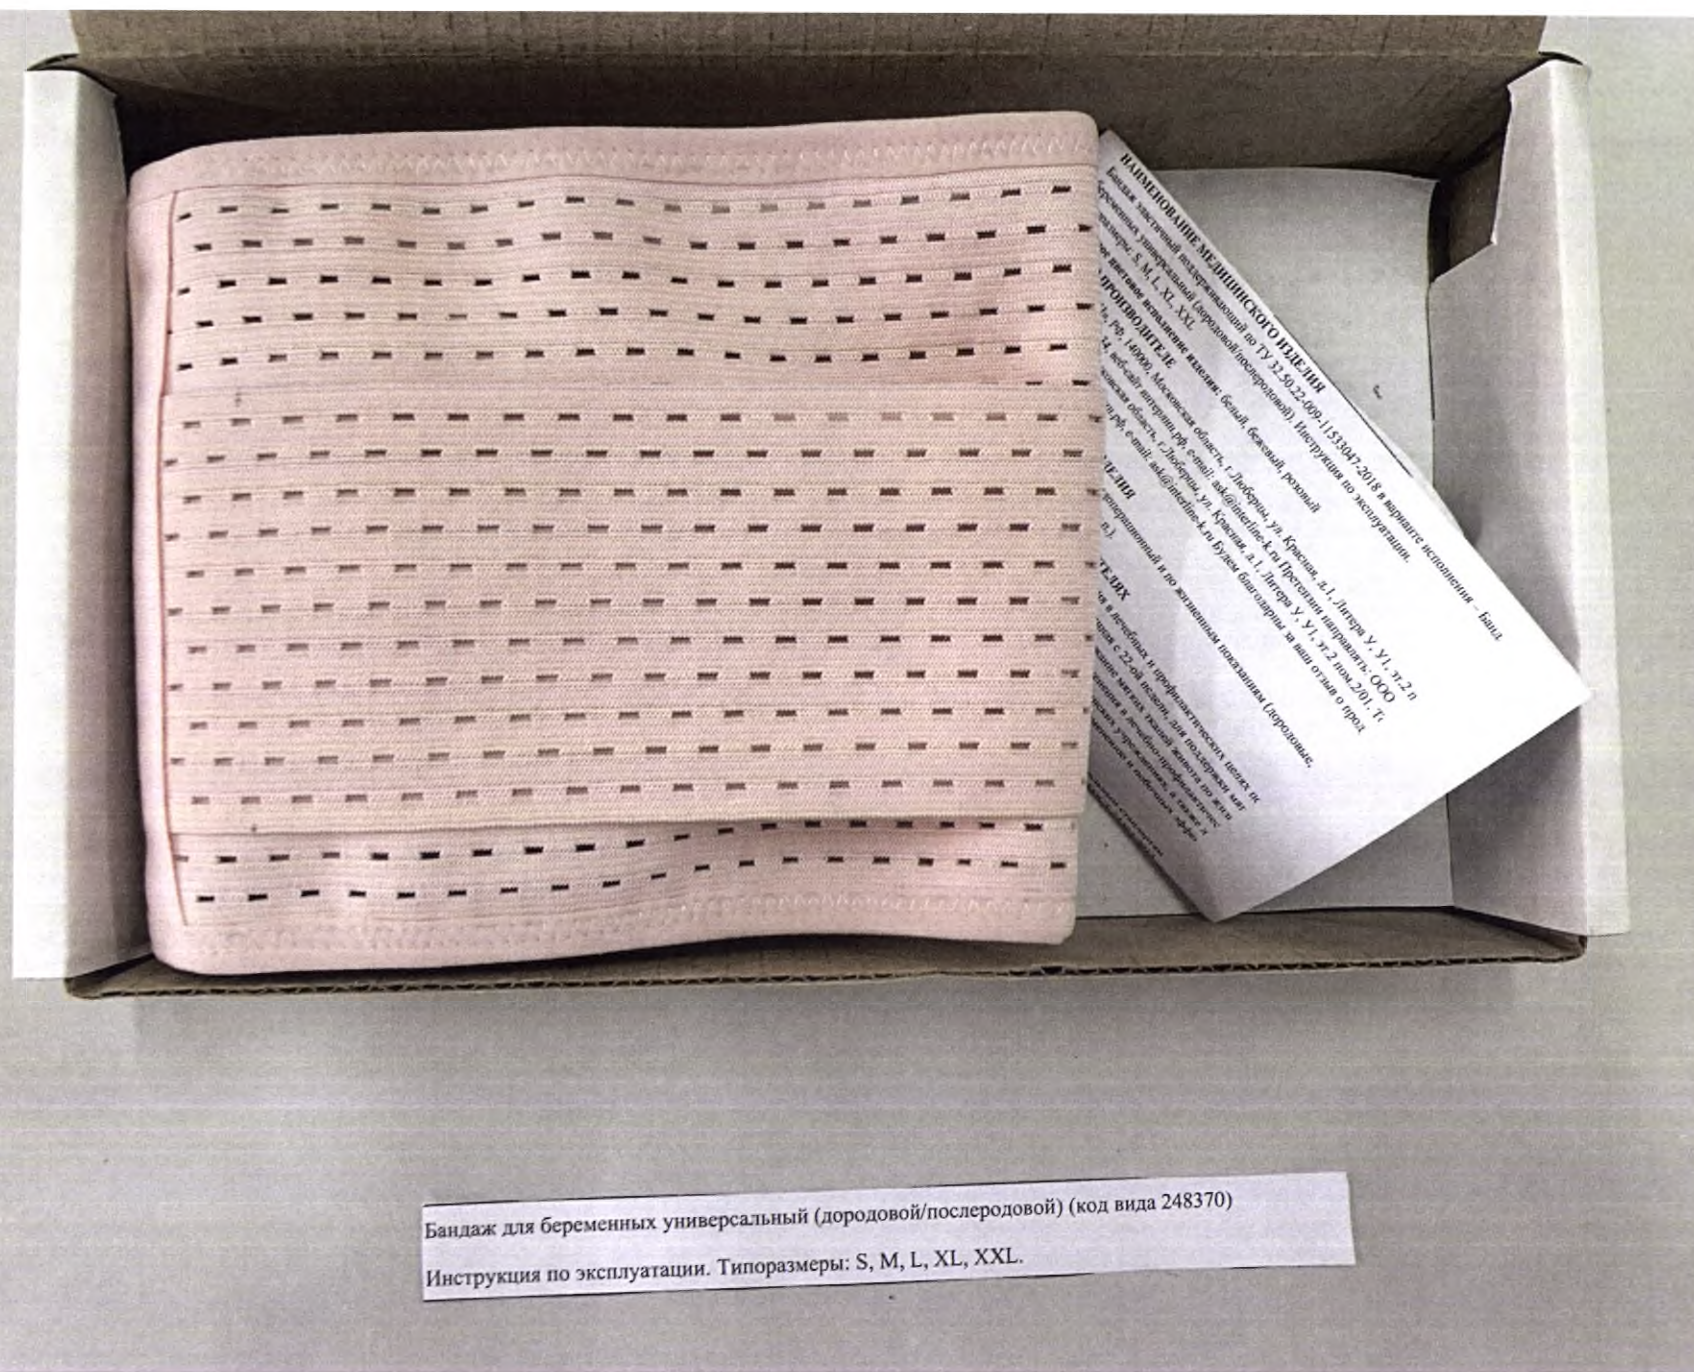

Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж для беременных универсальный (дородовой/послеродовой) (код вида 248370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

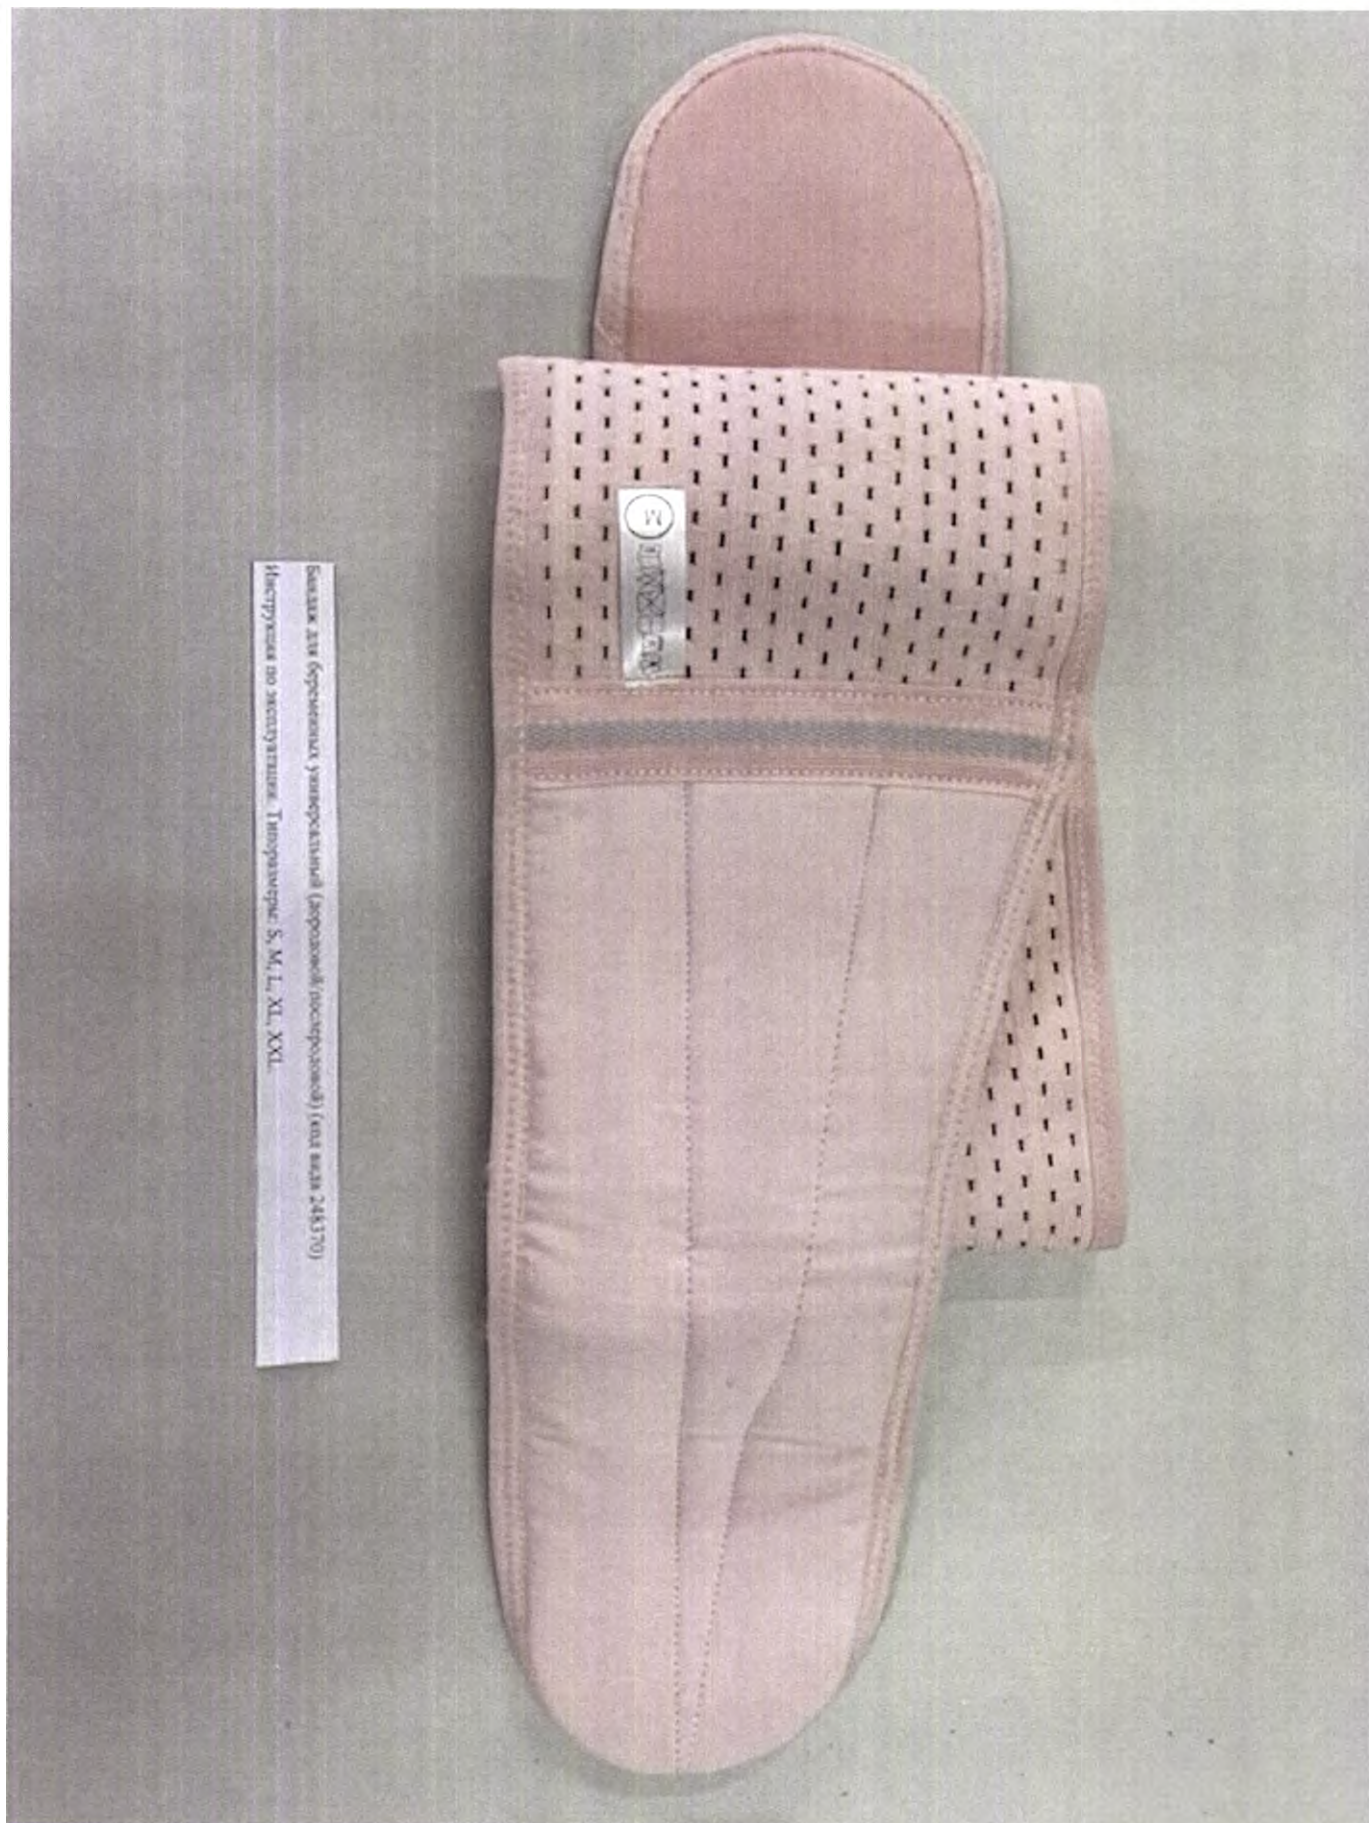

Бандаж для беременных универсальный (артериальный/государственный) (код вида 244370)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL


INTERLIN

Бандаж для беременных дородовой




Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на prod@interline-k.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж для беременных
дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL,
XXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев.

Размер *M*
Цвет *бел*

Дата изготовления:
нояб. 2018

Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Бандаж эластичный поддерживающий по ТУ 32.50.22.009-1153047-2018 в варианте исполнения - Бандаж для беременных дородовой. Инструкция по эксплуатации.

Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL

Возможное использование изделия: белый, бежевый, розовый

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ООО «ИНТЕР-ЛИН» РФ, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1, Литера У, У1, эт.2 пом.2-01.
Телефон 8(495)150-26-34, веб-сайт интернет.рф, e-mail: ask@interline-k.ru Претензии направлять: ООО «ИНТЕР-ЛИН» 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1, Литера У, У1, эт.2 пом.2-01. Телефон 8(495)150-26-34, веб-сайт интернет.рф, e-mail: ask@interline-k.ru Бузем благодарим за ваш отзыв о продукции на prod@interline-k.ru

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Назначение: поддержание мягких тканей в пренатальный и по-жизненным показаниям (дородовые, при заболеваниях позвоночника, протрузиях и т.д.)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Изделие предназначается для индивидуального использования в лечебных и профилактических целях по жизненным показаниям для женщин в период беременности и после, поддержание мягких тканей по жизненным показаниям (во время беременности). Изделие предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для индивидуального использования. Рисков, абсолютных противопоказаний к применению и побочных эффектов, связанных с применением не выявлено.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Изделие относится к классу I по ГОСТ Р 58236-2018, производится согласно национальным стандартам ГОСТ Р 58236-2018, материалы, применяемые в производстве, подлежат обязательному контролю по ГОСТ 24297-2012. Вязка климатического исполнения УХТ 4.2 по ГОСТ 15150. Поверхность бандажа - гладкая, без порочащих включений, заусениц, острокромки и других дефектов. Цвет изделия - равномерный, без выцветания. По гигиеническим, санитарно-гигиеническим показателям бандаж отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям, и соответствует с кожей. Устойчив к санитарно-гигиенической обработке по ГОСТ Р 52770.


Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

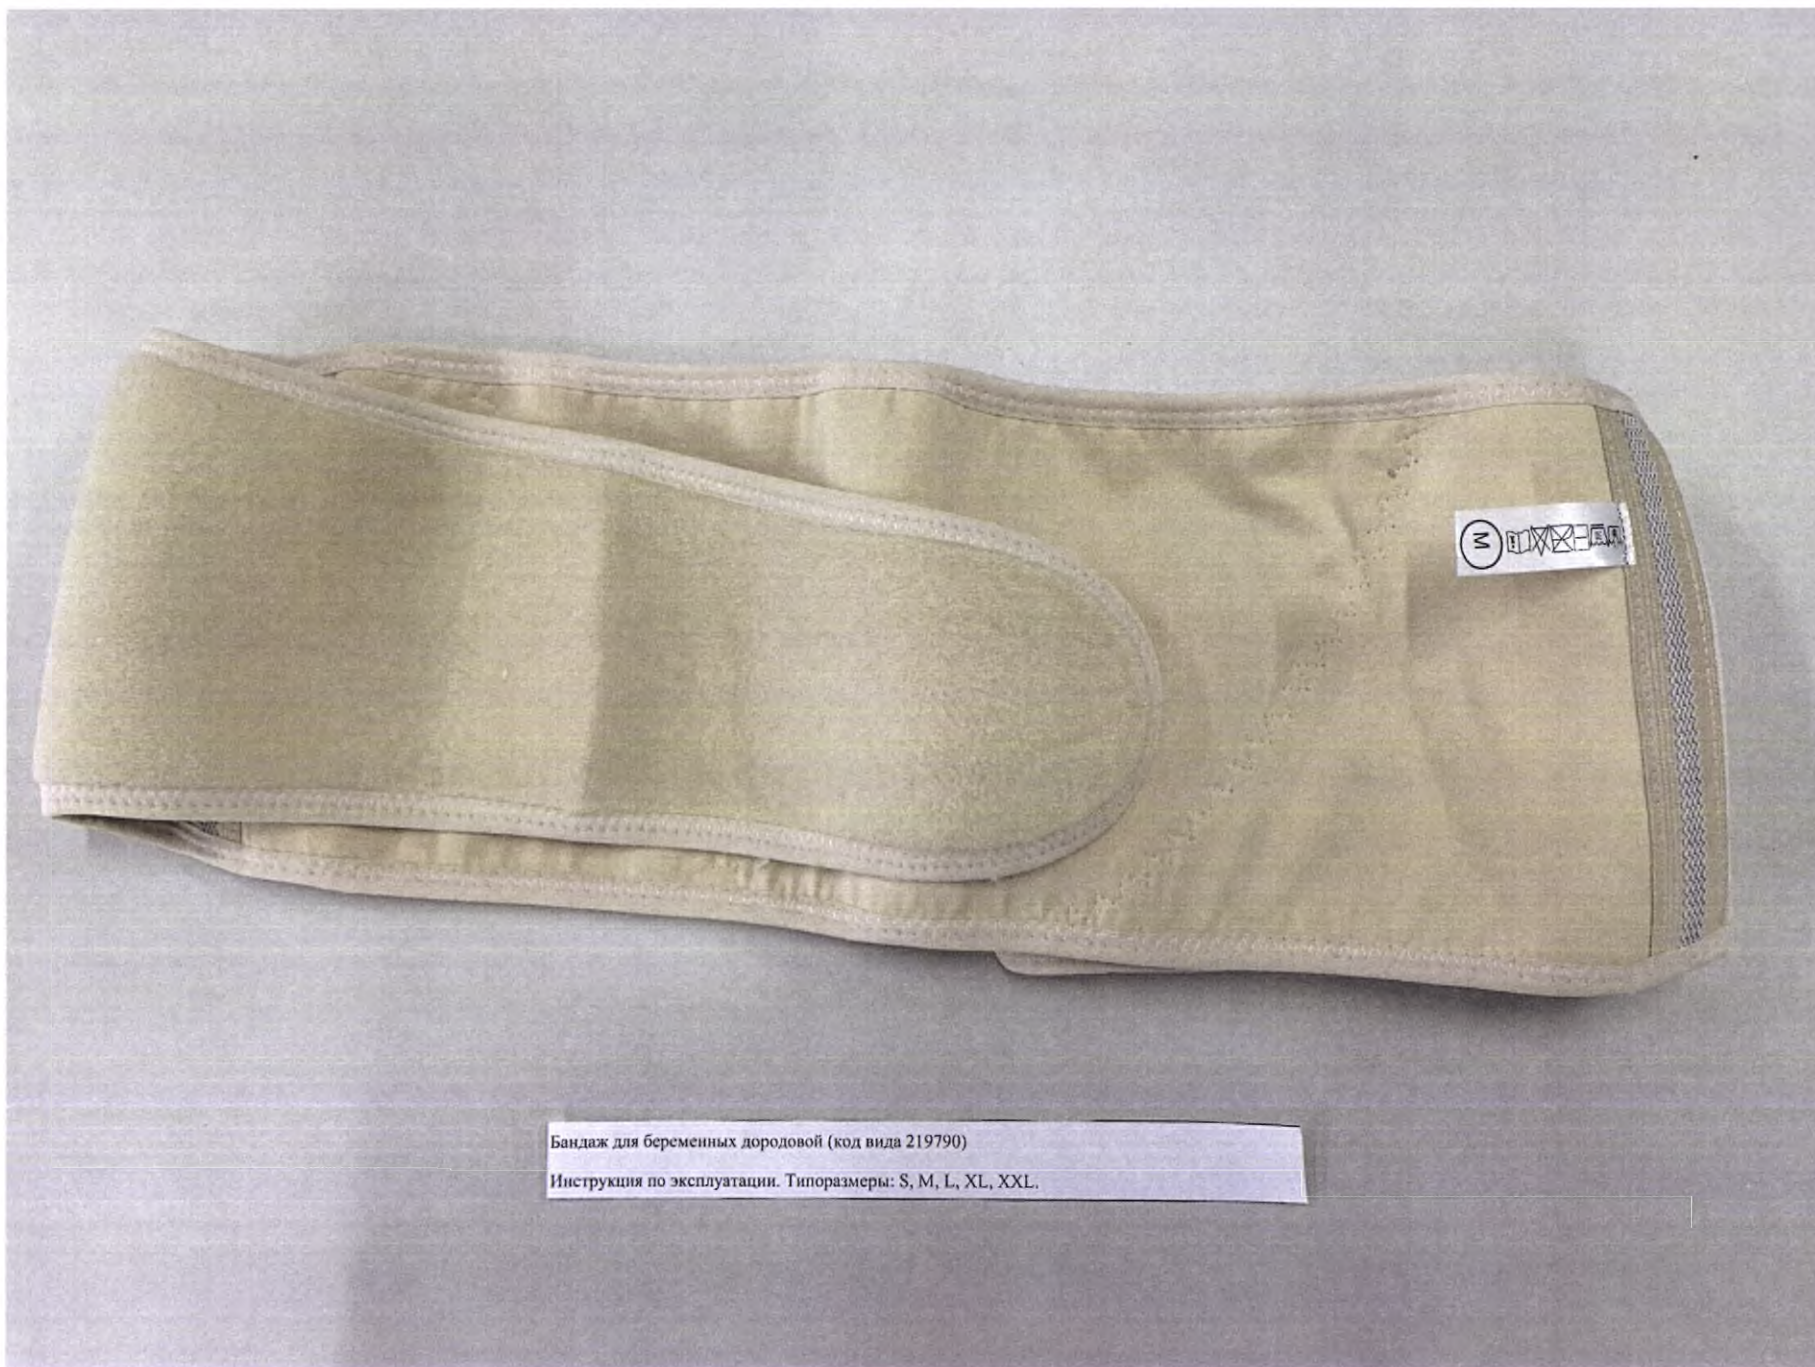

Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.


INTERLIN

Бандаж для беременных дородовой



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом.2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interlin.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на probandinterlin.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж для беременных
дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL,
XXL

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев.

Размер

Цвет


L

Бел

Дата изготовления:
конт. 2018

Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

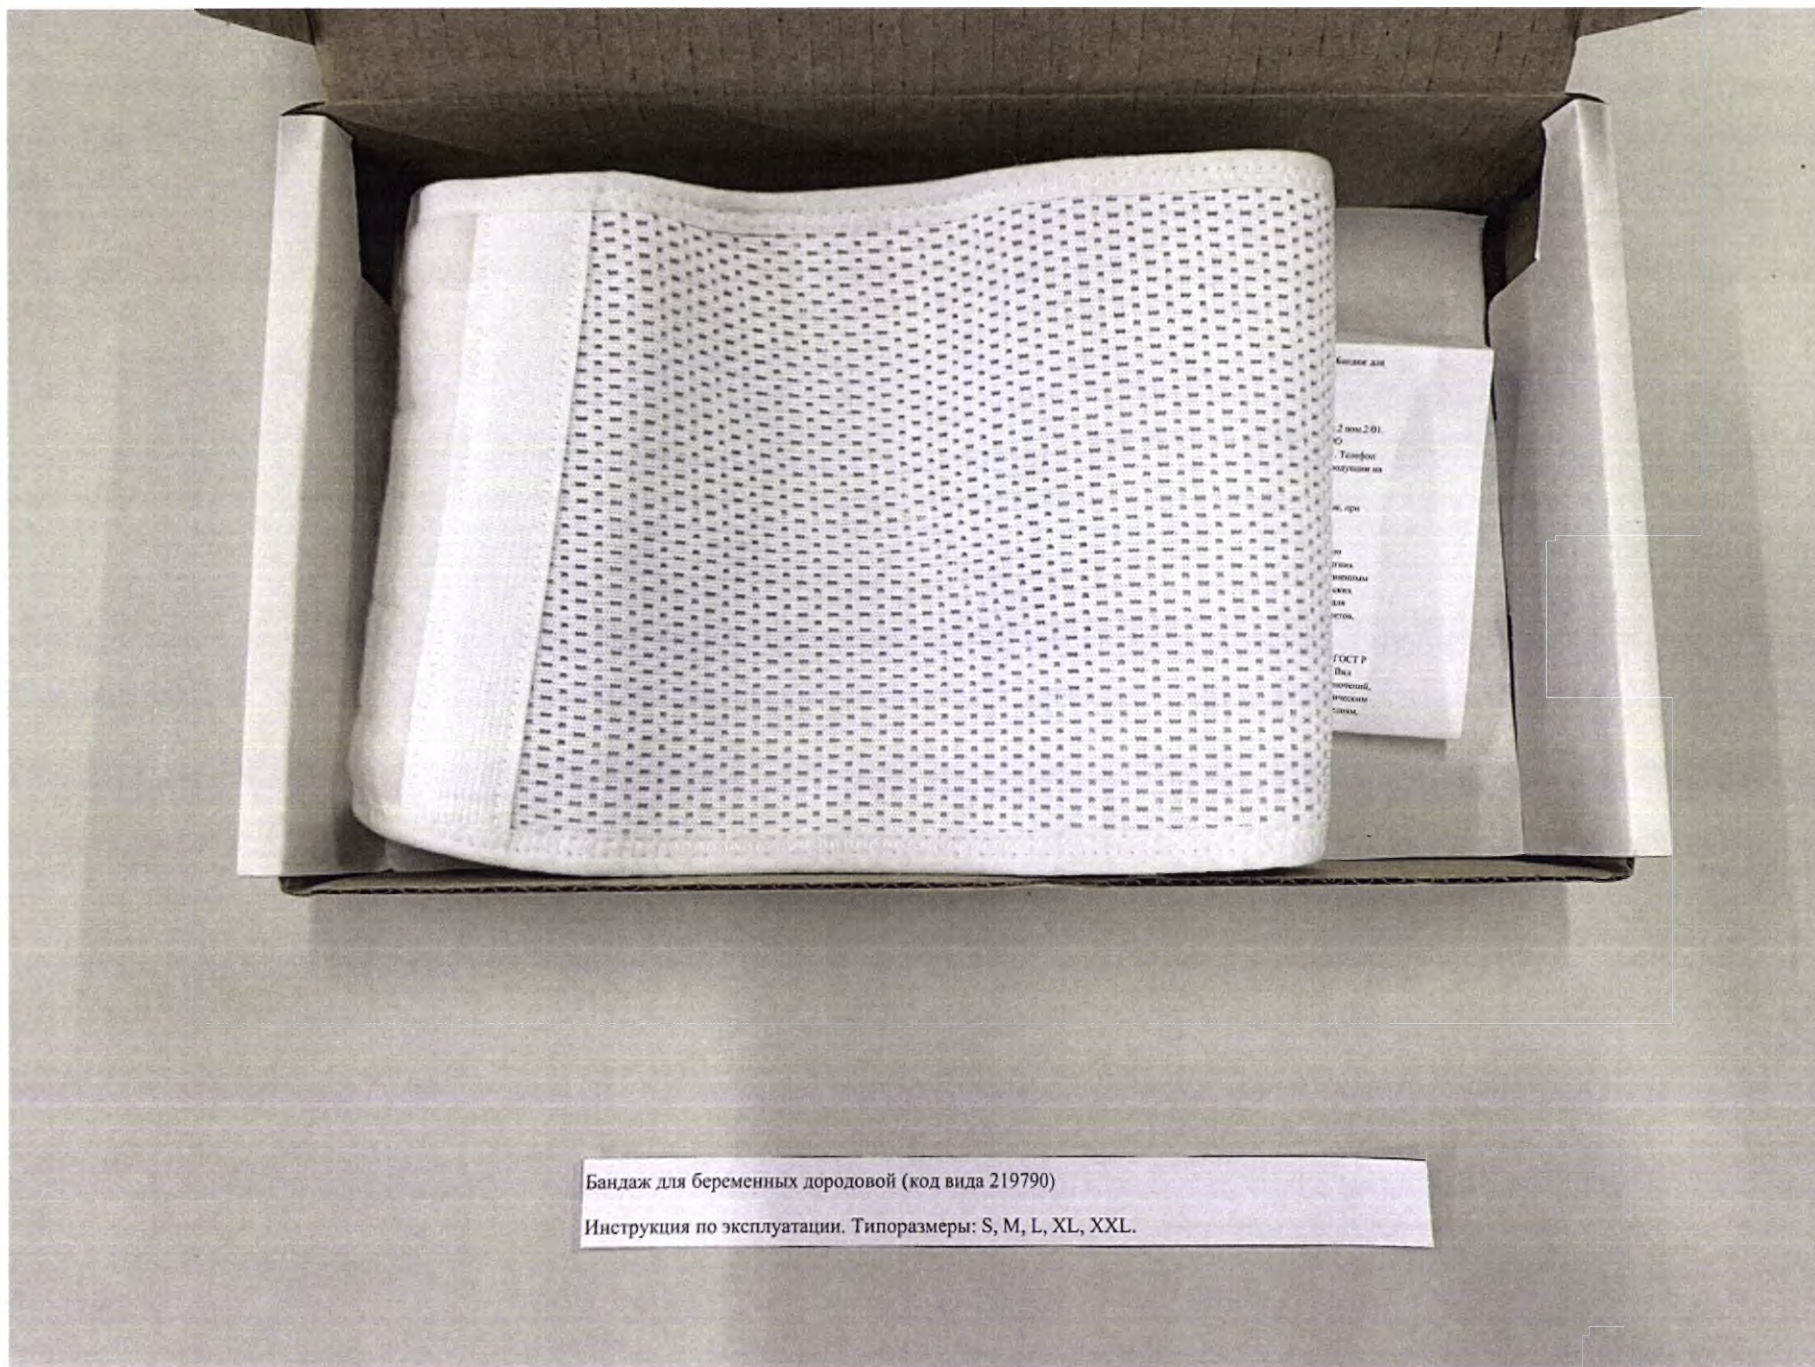

Бандаж для

2 мм 2 01.

Ю

Телефон

материал из

м. 000

00

0000

000000

000

0000

ГОСТ Р

Вс

000000

000000

00000

Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Бандаж эластичный для беременных по ГОСТ 21979-2018
Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL
Выполнение и проверка качества: Казань: Белый, Бокс, розовый
ООО «ИМПЕРИЯ»
Телефон: 8(955)50-38-34, веб-сайт: www.imperia.ru, e-mail: info@imperia.ru
«ИМПЕРИЯ» 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Косовая, д.1, литеры У, У1, У2, код 201.
Назначение: поддержка матки, профилактика и лечение заболеваний и по жизненным показаниям (срочное, при
абсолютных показаниях, при беременности и т.д.)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Изделие предназначено для беременных женщин в период беременности и родов, для профилактики и лечения заболеваний, связанных с беременностью. Изделие предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях, районных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для домашнего использования.


ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Изделие относится к классу I по ГОСТ Р 5236-2018, производится согласно техническим стандартам ГОСТ Р 5236-2018, материал, применяемый в производстве, соответствует требованиям ГОСТ 21979-2018. Изделие предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях, районных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для домашнего использования.

Условия хранения: в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от влаги и пыли. Срок хранения: 3 года. Условия транспортировки: в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от влаги и пыли. Срок хранения: 3 года.

Бандаж для беременных дорожной (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Бандаж для беременных дорожной (код вида 219790)
Инструкции по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



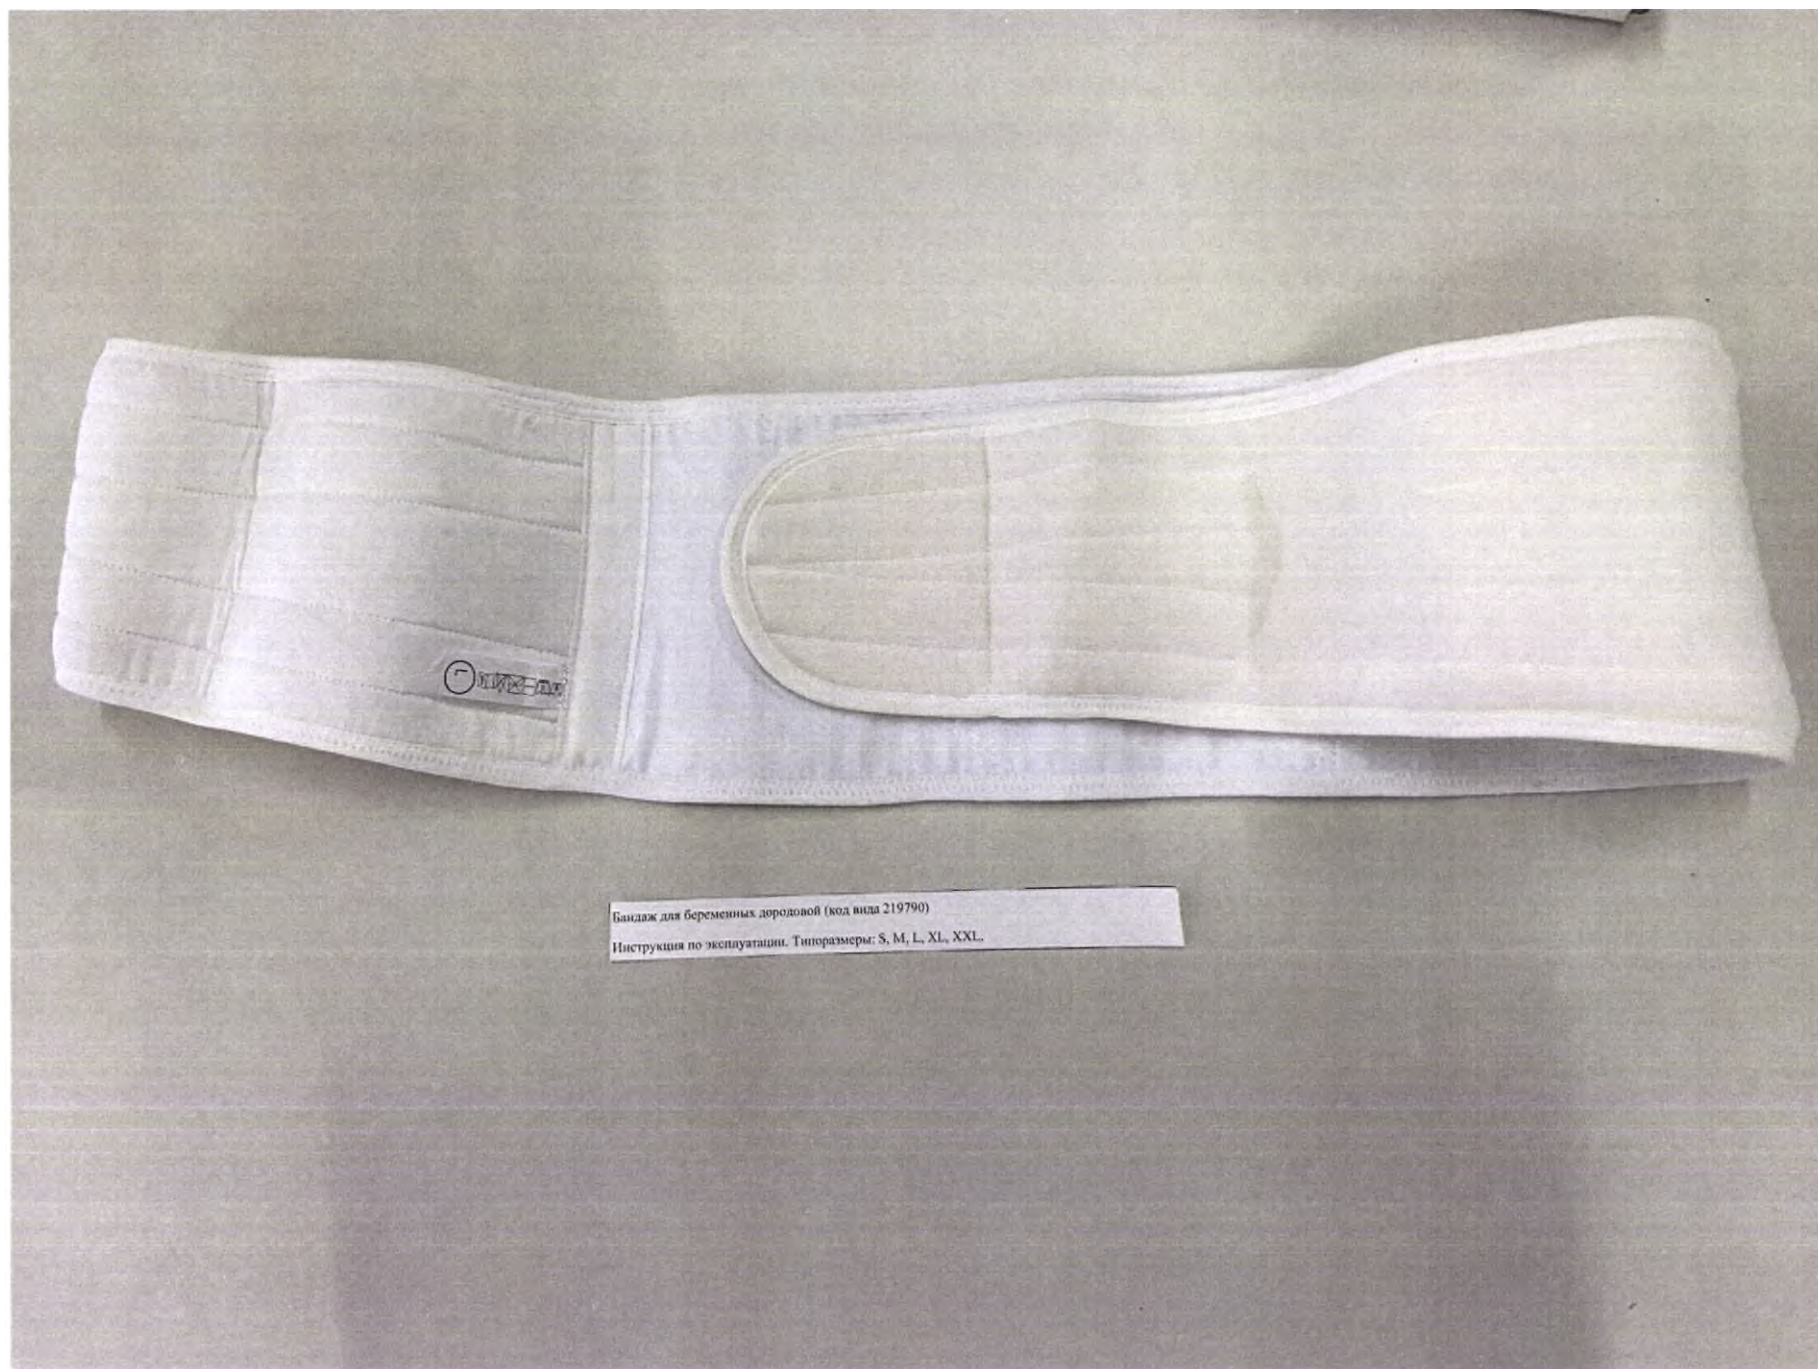

Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.


INTERLIN

Бандаж для беременных дородовой



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д. 1, лит. У, У1, эт. 2, пом. 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interline.ru, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на prod@interline-k.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж для беременных
дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL,
XXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев.

Размер

L

Цвет

роз

Дата изготовления:
к-мб, 2018

Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.




Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)


Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж для беременных дородовой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

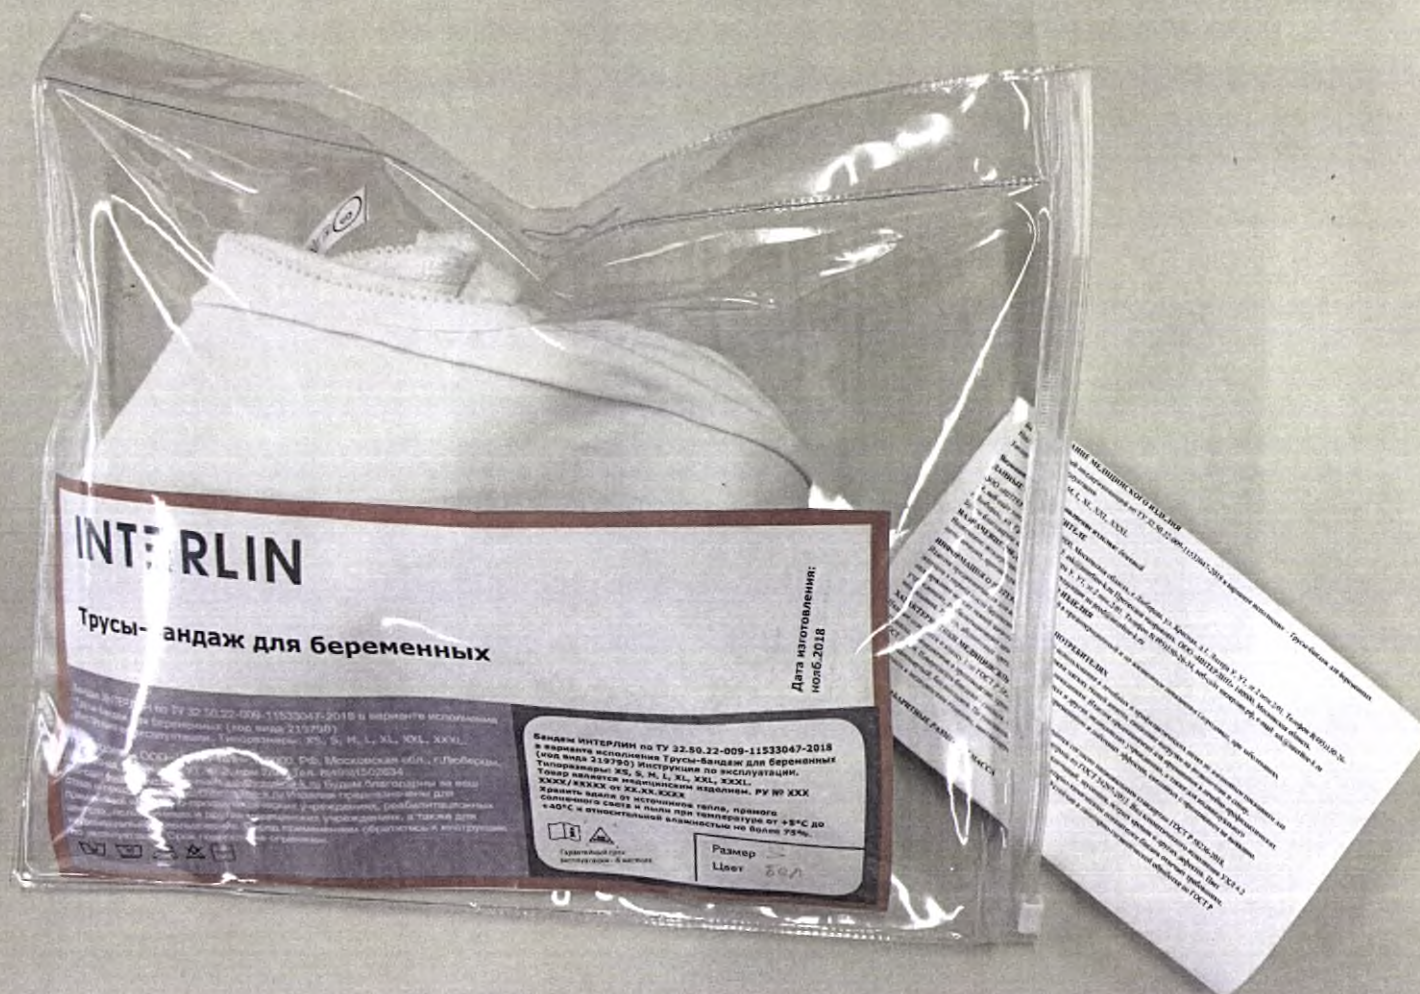

Трусы-бандаж для беременных (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

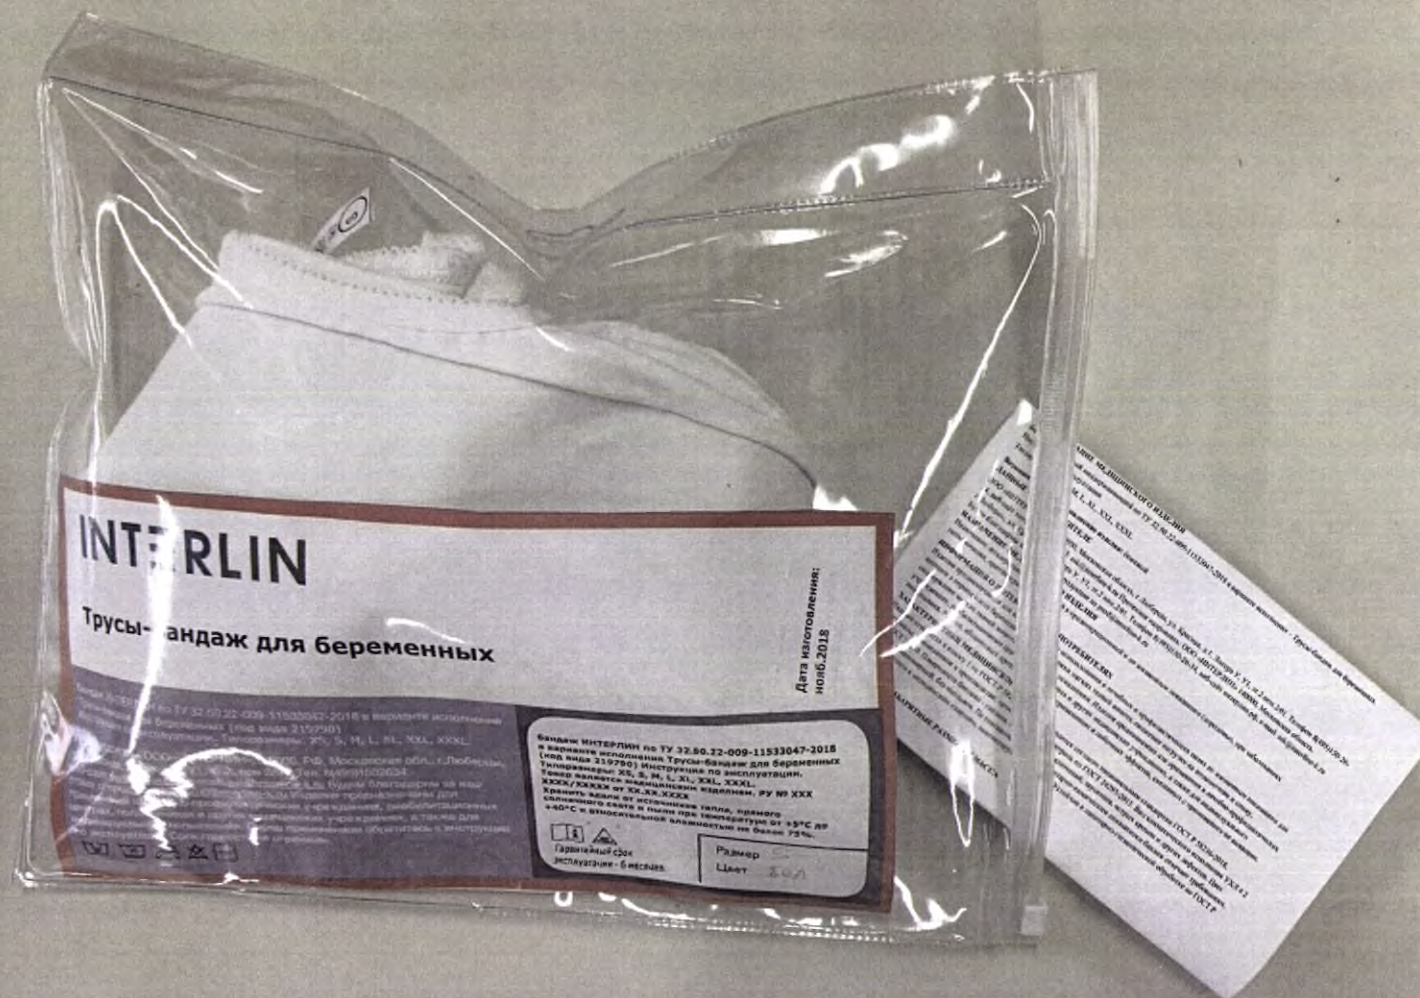

Трусы-бандаж для беременных (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.



Трусы-бандаж для беременных (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.



Трусы-бандаж для беременных (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.




INTERLIN

Трусы-бандаж послеродовой с молнией

Дата изготовления:
нояб. 2018

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения Трусы-бандаж послеродовой с молнией (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом.2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт: www.interlin.ru, e-mail: zak@interlin.ru Будем благодарны за ваш отзыв о продукции на info@interlin.ru. Изделия предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для индивидуального использования. Перед применением обратитесь к инструкции по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения Трусы-бандаж послеродовой с молнией (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Хранить вдали от источников тепла, прямого солнечного света и влаги при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 75%.



Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев

Размер **M**
Цвет **беж**

Трусы-бандаж послеродовой с молнией (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.


ООО ЦНПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Трусы-бандаж послеродовой с молнией (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



Трусы-бандаж послеродовой с молнией (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

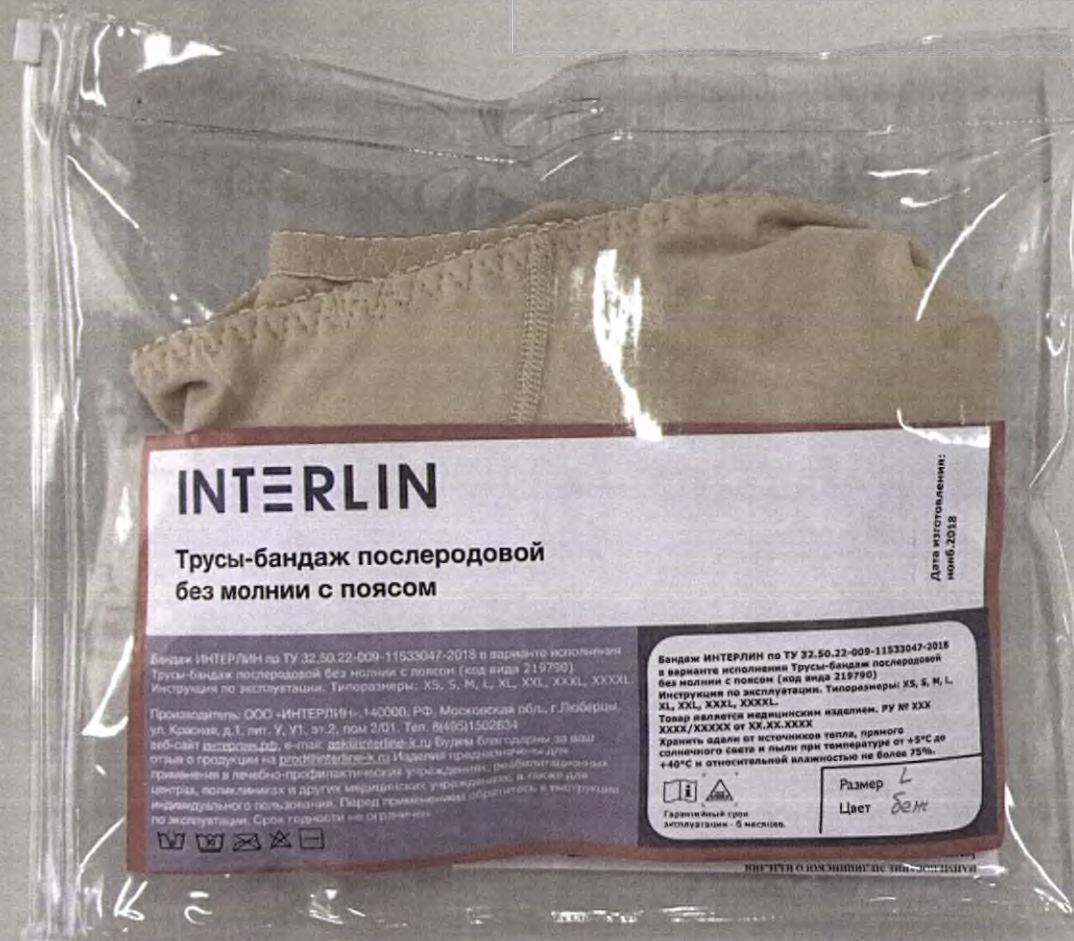


INTERLIN

**Трусы-бандаж послеродовой
без молнии с поясом**

Дата изготовления:
нояб. 2018

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Трусы-бандаж послеродовой без молнии с поясом (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, У1.2, пом. 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт: roszdrav.ru, e-mail: zak@roszdrav.ru или будем благодарны за ваш
отклик о продукции на zak@roszdrav.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального использования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Трусы-бандаж послеродовой
без молнии с поясом (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL, XXXXL.
Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Хранить away от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Гарантийный срок
эксплуатации - 5 месяцев.

Размер **L**
Цвет **беж**

Трусы-бандаж послеродовой без молнии с поясом (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Трусы-бандаж послеродовой без молнии с поясом (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



Трусы-бандаж послеродовой без молнии с поясом (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками (код вида 219790)
 Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

КАНОНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Бандаж послеродовой с крючками-застежками. Бюджетная версия
Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Данные о производителе:
ООО «ИНТЕРЛИН», ИНН 50/0000000000, ОГРН 1055000000000, адрес: 440000, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 100, стр. 1, этаж 1-й, пом. 101. Контактный телефон: 8(800) 100-1000. Веб-сайт: www.interlin.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Назначение: послеродовый бандаж с крючками-застежками. Предназначен для поддержки живота и таза после родов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ ПОТРЕБИТЕ
Назначение: послеродовый бандаж с крючками-застежками. Предназначен для поддержки живота и таза после родов.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54230-2014. Изделие предназначено для послеродового бандажирования.


Полная информация о товаре и производителе доступна на официальном сайте производителя.

INTERLIN

Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками (код вида 219790). Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 440000, Р.б. Самарская обл., г. Любимый, ул. Красная, д. 1, лит. У, У1, эт. 2, пом. 201. Тел. 8(800) 100-1000. Веб-сайт: www.interlin.ru, e-mail: info@interlin.ru. Будем благодарны за ваш отзыв о продукции на www.interlin.ru. Изделие предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для домашнего использования. Перед применением обратитесь к инструкции по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками (код вида 219790). Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Товар является медицинским изделием. RU № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX. Хранить вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 75%.



Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев.

Размер L
Цвет Беж

Дата изготовления: июль 2018

Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



Трусы-бандаж послеродовой с крючками-застежками (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL




INTERLIN

**Трусы-бандаж
послеоперационный для
женщин с застёжкой**

Дата изготовления:
нояб 2018

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Трусы-бандаж послеоперационный для женщин с застёжкой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт www.interline-k.ru, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш
отклик о продукции на ask@interline-k.ru Модели предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратиться к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Трусы-бандаж
послеоперационный для женщин с застёжкой (код вида
219790) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS,
S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

Товар является медицинским изделием. РУ ИИ ХХХ
ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Хранить away от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.


Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев.

Размер *S*
Цвет *бел*

Трусы-бандаж послеоперационный для женщин с застёжкой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.


ООО ЦИРМИ [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru) WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Груды-бандж послеоперационный для женщин с застежкой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



Трусы-бандаж послеоперационный для женщин с застежкой (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.

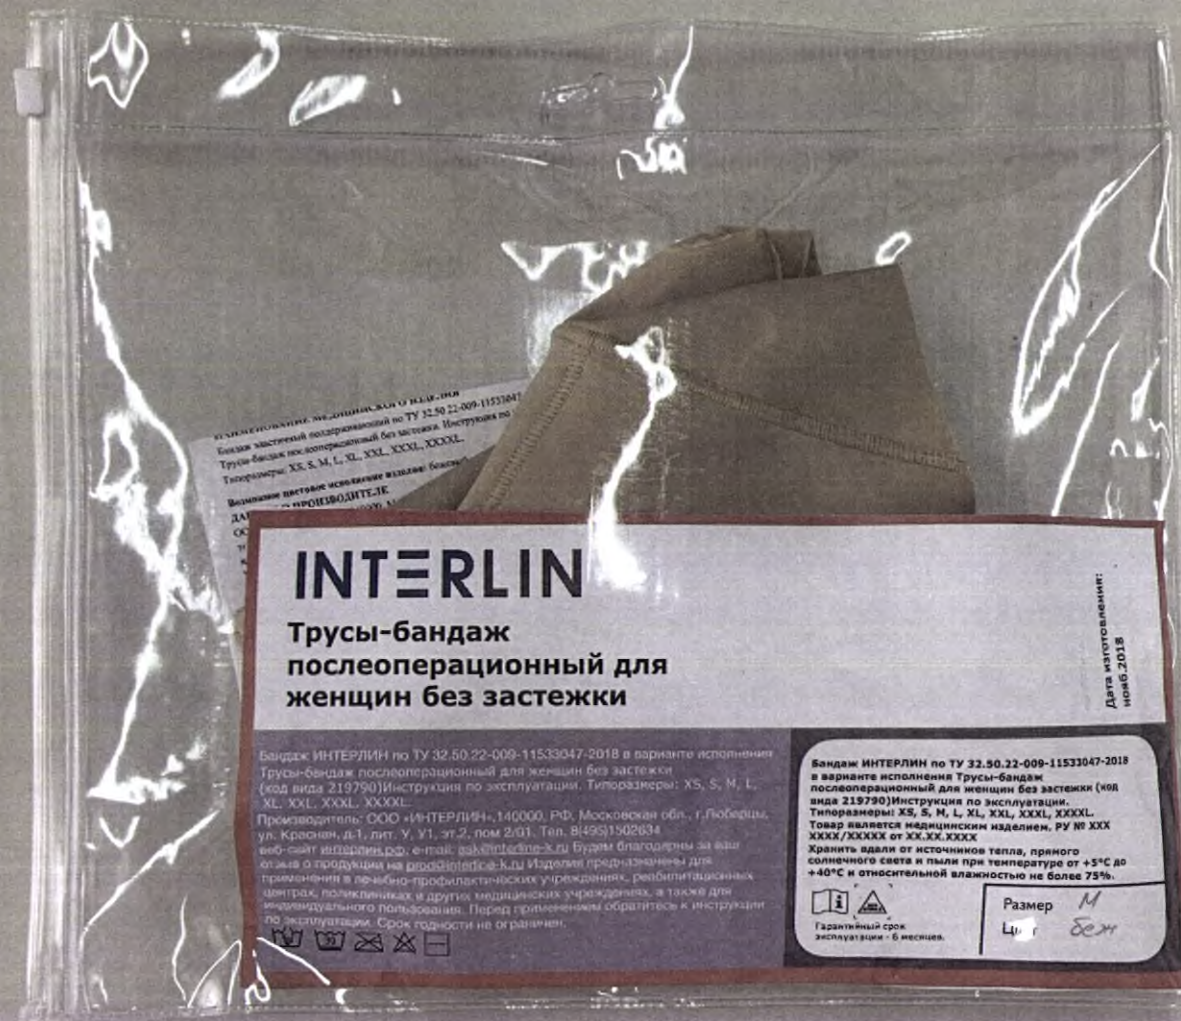


INTERLIN

**Трусы-бандаж
послеоперационный для
женщин без застёжки**

Дата изготовления:
нояб. 2018

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Трусы-бандаж послеоперационный для женщин без застёжки
(код вида 219790) Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL, XXXXL.
Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Косыгина, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом.2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interlin.ru, e-mail: sales@interlin.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на feedback@interlin.ru Изделия предназначены для
применения в педиатрико-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Трусы-бандаж
послеоперационный для женщин без застёжки (код
вида 219790) Инструкция по эксплуатации.
Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.
Товар является медицинским изделием, РУ № XXX
XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Хранить удаленно от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Размер **M**
Цвета **беж**

Трусы-бандаж послеоперационный для женщин без застёжки (код вида 219790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



Трусы-бандаж послеоперационный для женщин без застежки (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.



Трусы-бандаж послеоперационный для женщин без застежки (код вида 219790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.


INTERLIN

Бандаж при паховых грыжах



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.


Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на prod@interline-k.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж при паховых грыжах
(код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL,
XXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев

Размер *M*
Цвет *бел*

Дата изготовления:
нояб.2018


Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

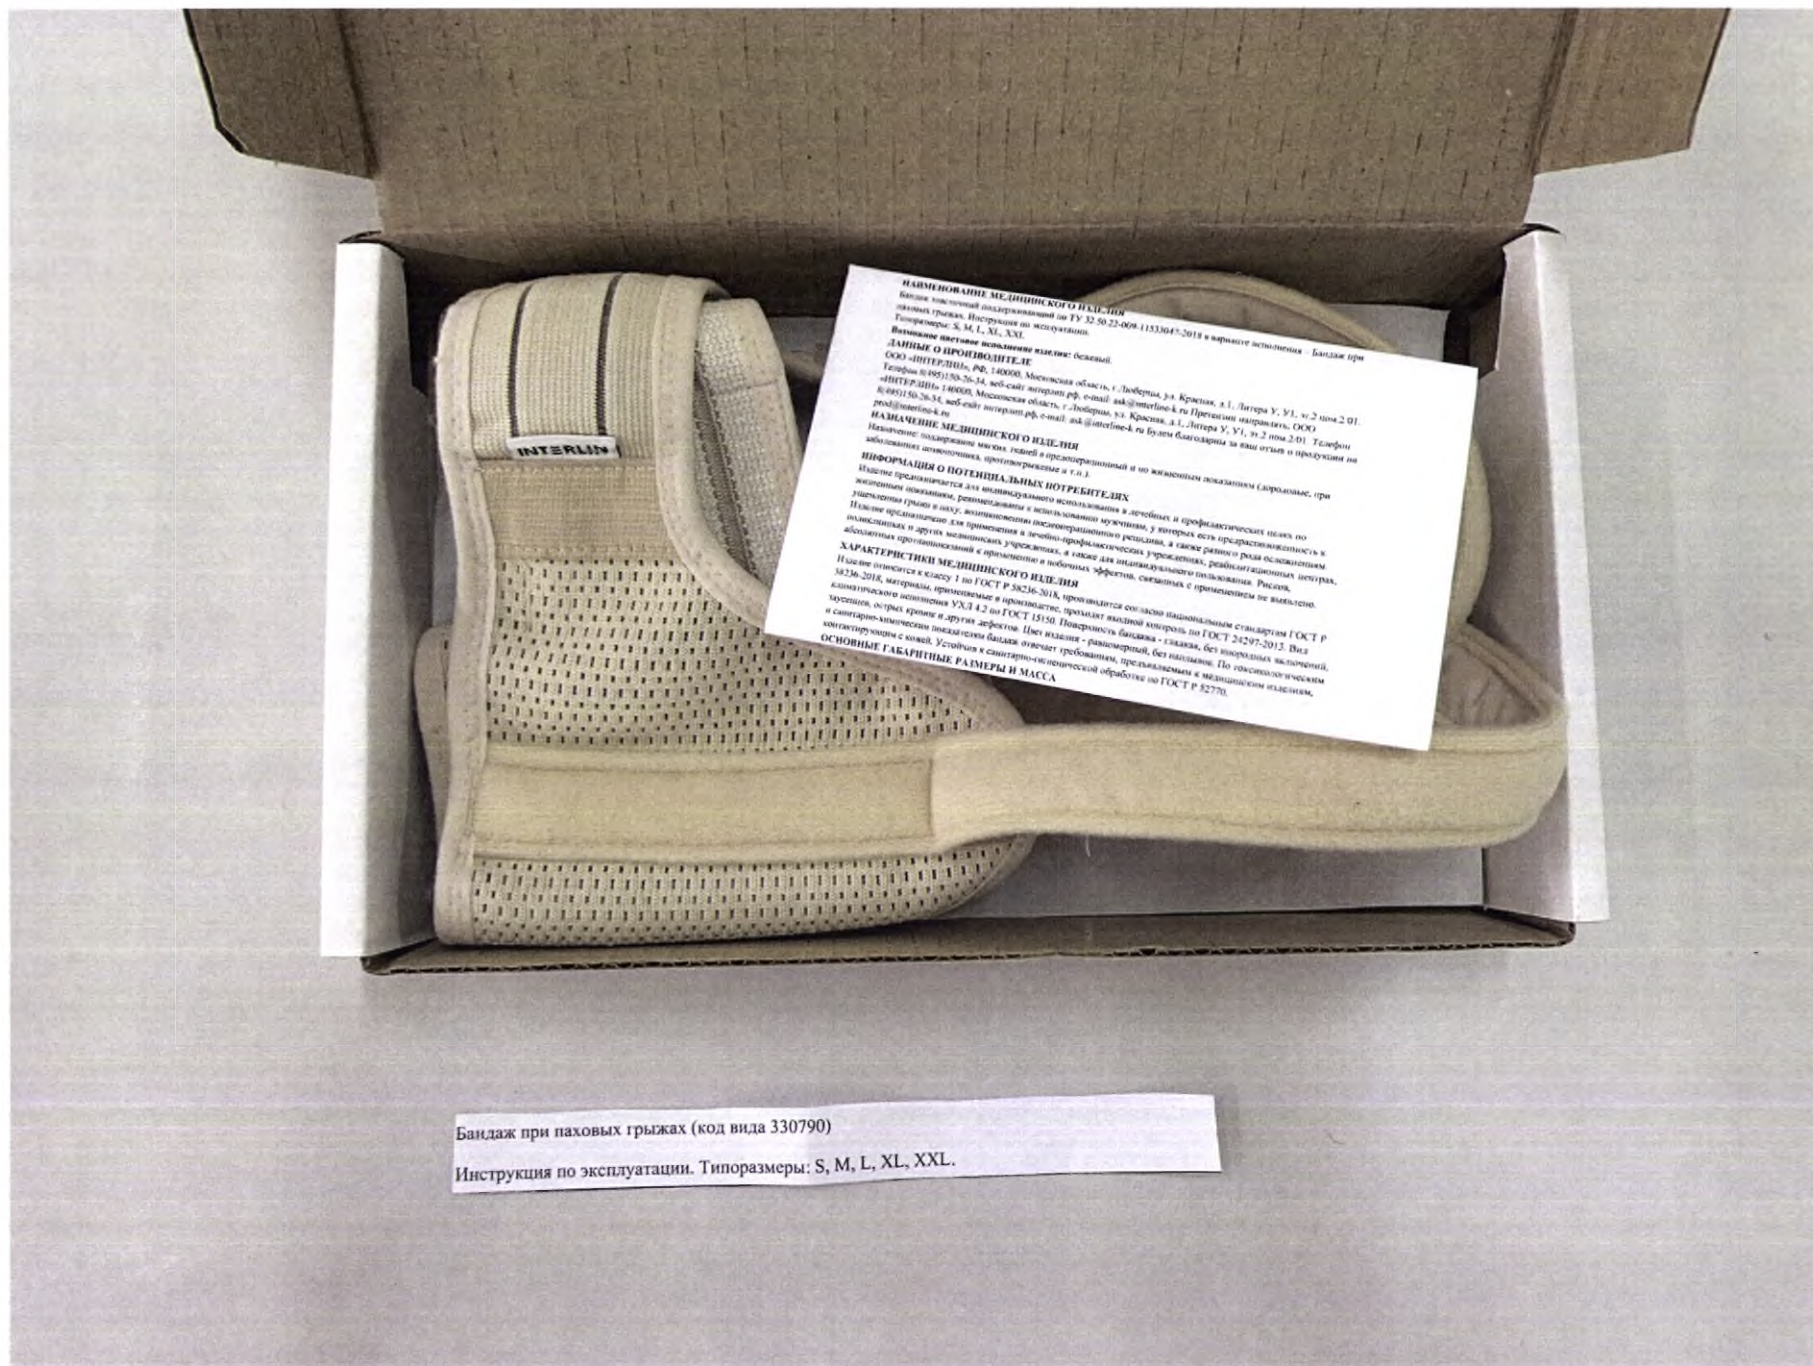

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Патентованные: S, M, L, XL, XXL

ВНИМАНИЕ! Изделие является изделием медицинского назначения.
ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ОАО «ИНТЕРЛИН», РФ, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Крестов, д. 1, Литера У, У1, п. 2 пом. 2-01.
Телефон: (495) 150-26-34, веб-сайт: interline-k.ru
«ИНТЕРЛИН» (г. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Крестов, д. 1, Литера У, У1, п. 2 пом. 2-01).
Телефон: (495) 150-26-34, веб-сайт: interline-k.ru

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Патентованные: S, M, L, XL, XXL

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Изделие предназначено для индивидуального использования в лечебных и профилактических целях по медицинским показаниям, рекомендовано к использованию мужчинами, у которых есть предрасположенность к паховым грыжам в анамнезе, истончению мышц брюшного пресса, а также раны и раны осложненные к абсцессам и другим гнойным заболеваниям, в том числе для индивидуального использования. Риск, связанный с применением изделия, не выявлен.


ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Изделие относится к классу 1 по ГОСТ Р 58236-2018, производится согласно национальному стандарту ГОСТ Р 58236-2018, материалы, применяемые в производстве, подлежат обязательному контролю по ГОСТ Р 58236-2018, материалы, применяемые в производстве, подлежат обязательному контролю по ГОСТ Р 58236-2018, материалы, применяемые в производстве, подлежат обязательному контролю по ГОСТ Р 58236-2018.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

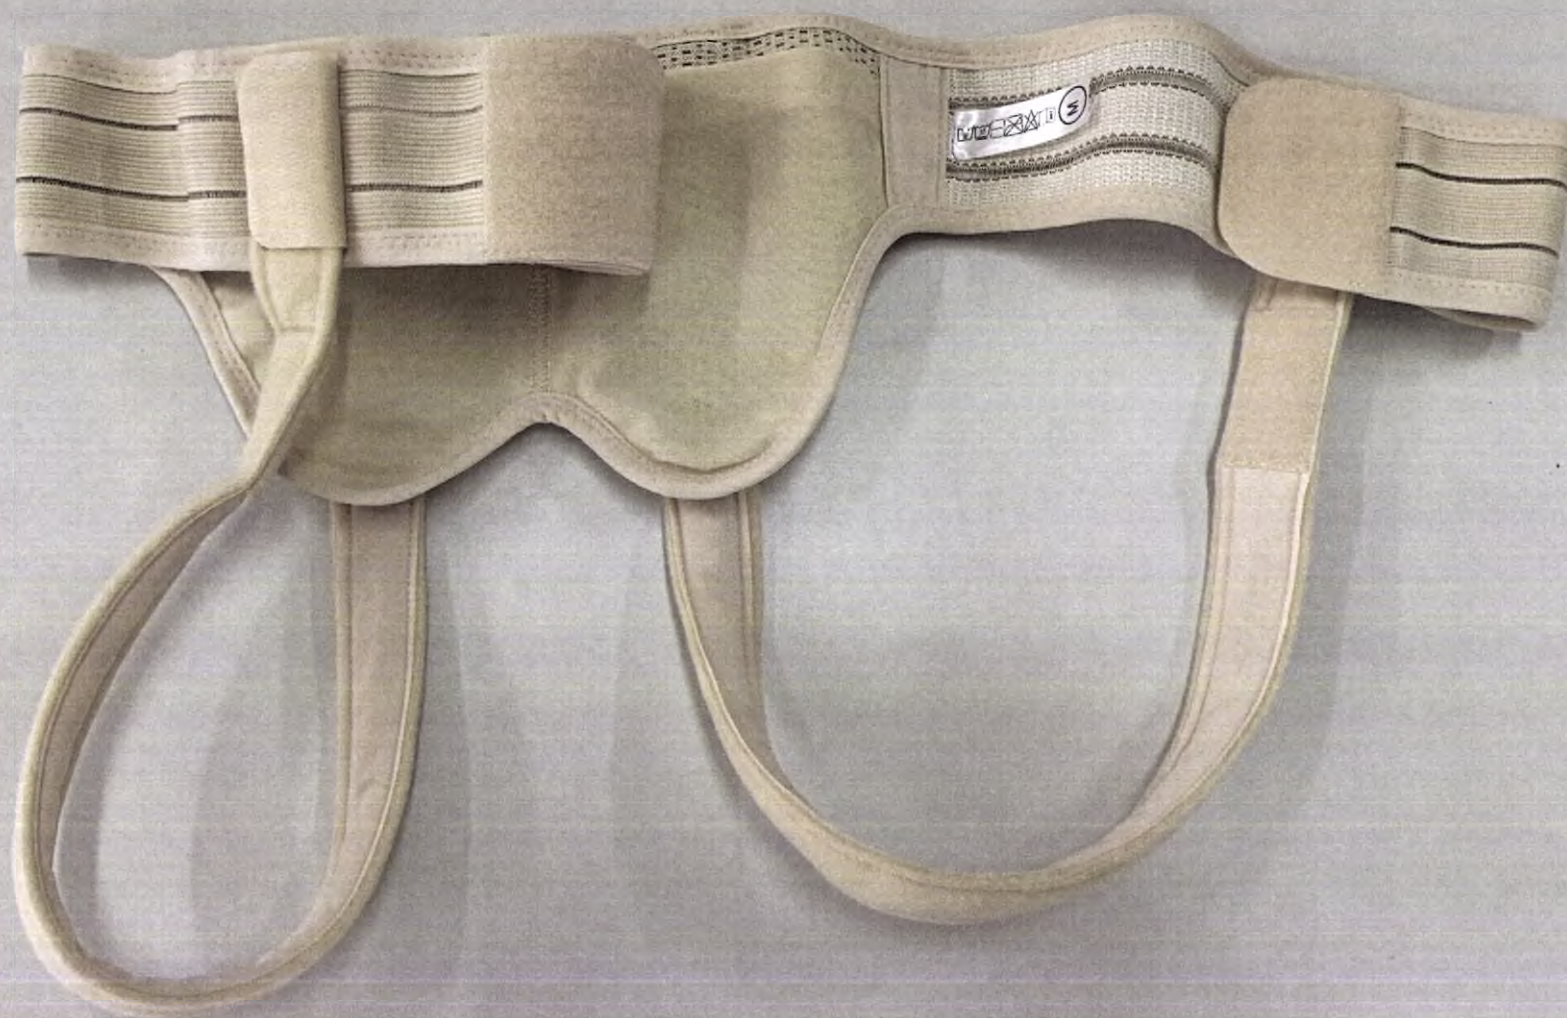

Бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.


INTERLIN

Бандаж при пупочных грыжах



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Бандаж при пупочных грыжах (код вида 219810)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.


Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, лит. У, У1, эт.2, пом 2/01. Тел. 8(495)1502634
веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interlin-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв о продукции на prod@interlin-k.ru Изделия предназначены для
применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для
индивидуального пользования. Перед применением обратитесь к инструкции
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Бандаж при пупочных грыжах
(код вида 219810) Инструкция по эксплуатации.

Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.
Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Гарантийный срок
эксплуатации - 6 месяцев

Размер

Цвет

S
Бел

Дата изготовления:
нояб. 2018


Бандаж при пупочных грыжах (код вида 219810)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж при пупочных грыжах (код вида 219810)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.

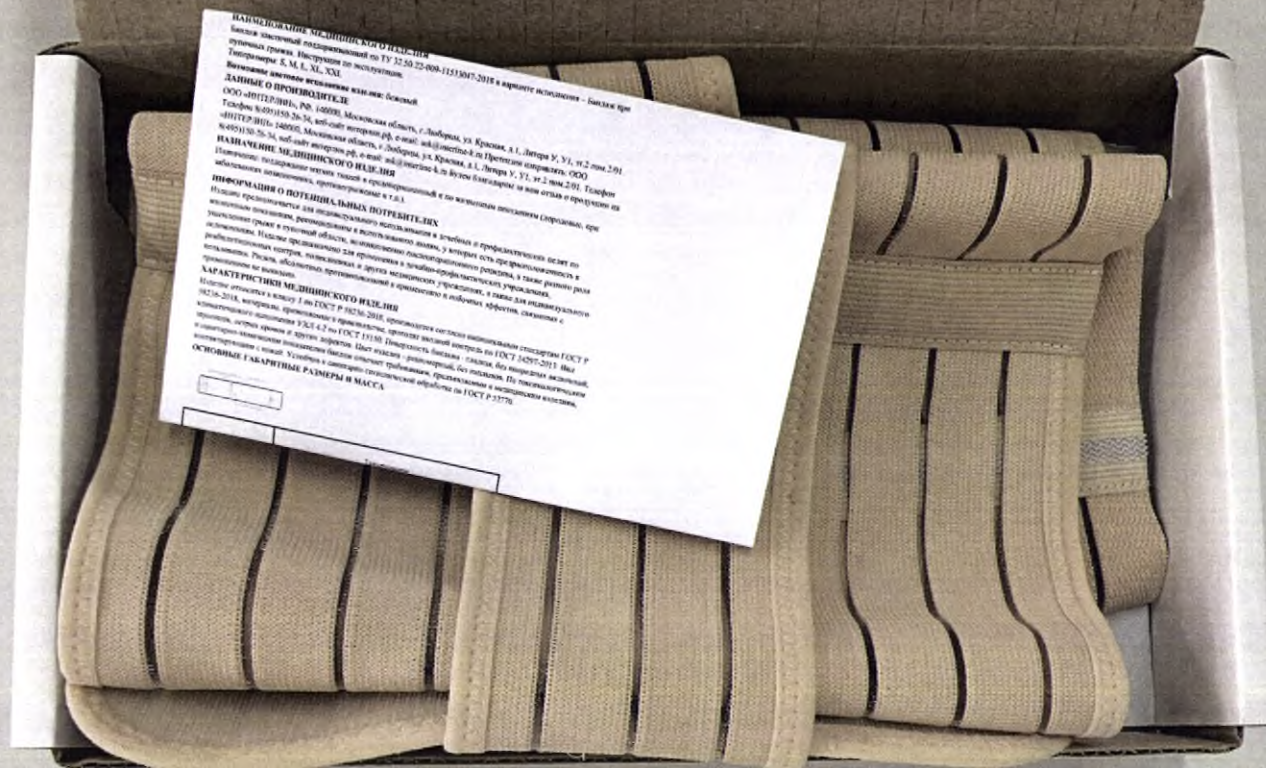

Бандаж при пупочных грыжах (код вида 219810)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж при пупочных грыжах (код вида 219810)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.



Бандаж при пупочных грыжах (код вида 219810)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: S, M, L, XL, XXL.




INTERLIN

**Трусы-бандаж при паховых
грыжах**

Дата изготовления:
нояб.2018

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения
Трусы-бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Косовая д.1, лит. V, У1, эт.2, пом 2/01, Тел. 8(495)1502634
сайт: www.interline-k.ru, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш
отзыв в продукции на prod@interline-k.ru Изделия предна-
значены в лечебно-профилактических учреждениях,
центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях
для индивидуального пользования. Перед применением
по эксплуатации. Срок годности не ограничен.



Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Трусы-бандаж при паховых
грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S,
M, L, XL, XXL.

Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.



Гарантия от
эксплуатации. В течение.

Размер **S**
Цвет **чёрн**

Трусы-бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.



INTERLIN

**Трусы-бандаж при паховых
грыжах**

Дата изготовления
нояб. 2018

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 в варианте исполнения 3
Трусы-бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.
Производитель: ООО «Интелли-Мед», 1440000, РФ, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Космонавта Д.П. Леонова, д.1, стр.1, этаж 2/01. Тел.: 8(495)1502634
Бандаж предназначен для фиксации паховых грыж. Будем рады, если наша
продукция найдет применение в ваших учреждениях. Изделия предназначены для
использования в лечебно-профилактических учреждениях, а также для домашнего
использования. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Срок годности не ограничен.

Бандаж ИНТЕРЛИН по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018
в варианте исполнения Трусы-бандаж при паховых
грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S,
M, L, XL, XXL.
Товар является медицинским изделием. РУ № XXX
XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Хранить вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажностью не более 75%.


Размер *S*
Цвет *серый*

Трусы-бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)
Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.



Трусы-бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.

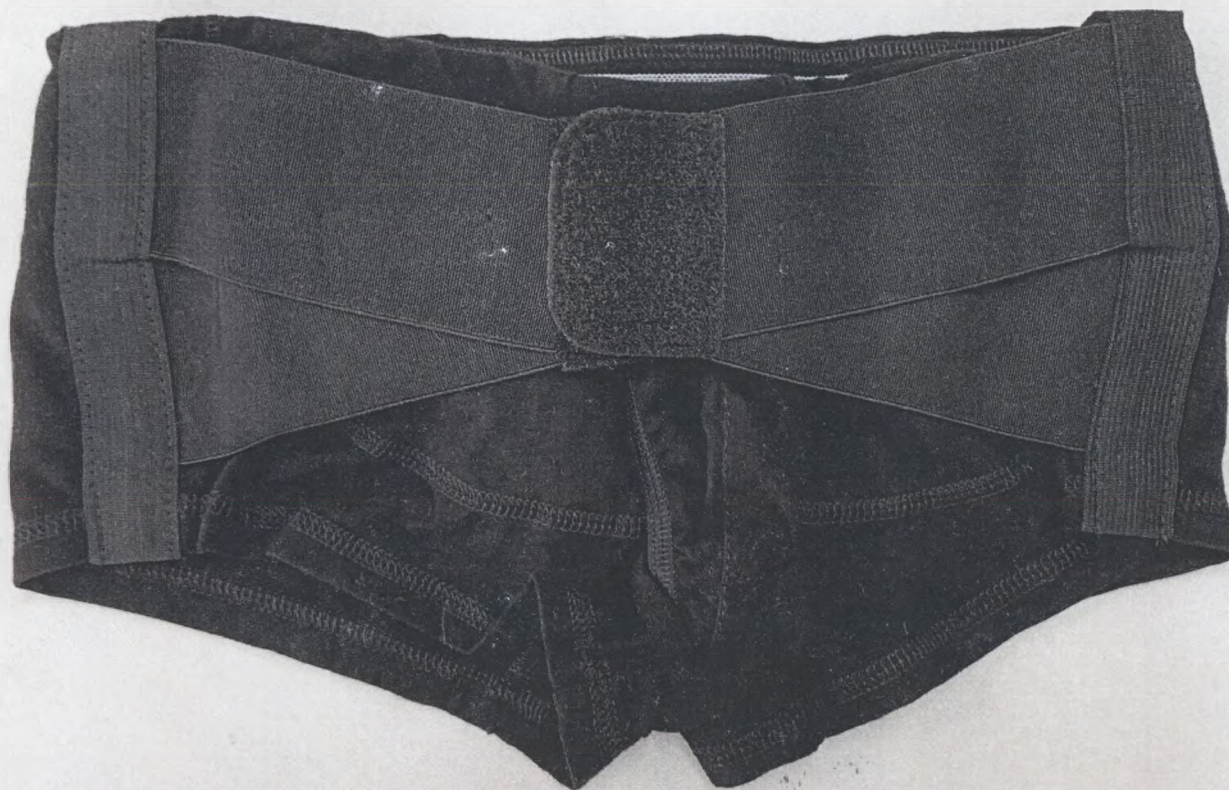

Трусы-бандаж при паховых грыжах (код вида 330790)

Инструкция по эксплуатации. Типоразмеры: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
000 ЦИРМИ
КОПЕСНИКОВ А.С.

Итого 169
лист 66