


Фотографические изображения медицинского изделия
Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019



МЕДПЛАНТ	арт.
Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 1, в сумке универсальной раскладной СУР-01	
РУ № ____/____ от ____ г. Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019	
Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации	
Дата выпуска: __ кв. 20__ г.	PC
Срок хранения, номер партии: см. в экспл. док.	EN ISO 13485: ____
Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318. тел. +7 (495) 223-6016	

Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 1, в сумке универсальной раскладной СУР-01: общий вид, маркировка

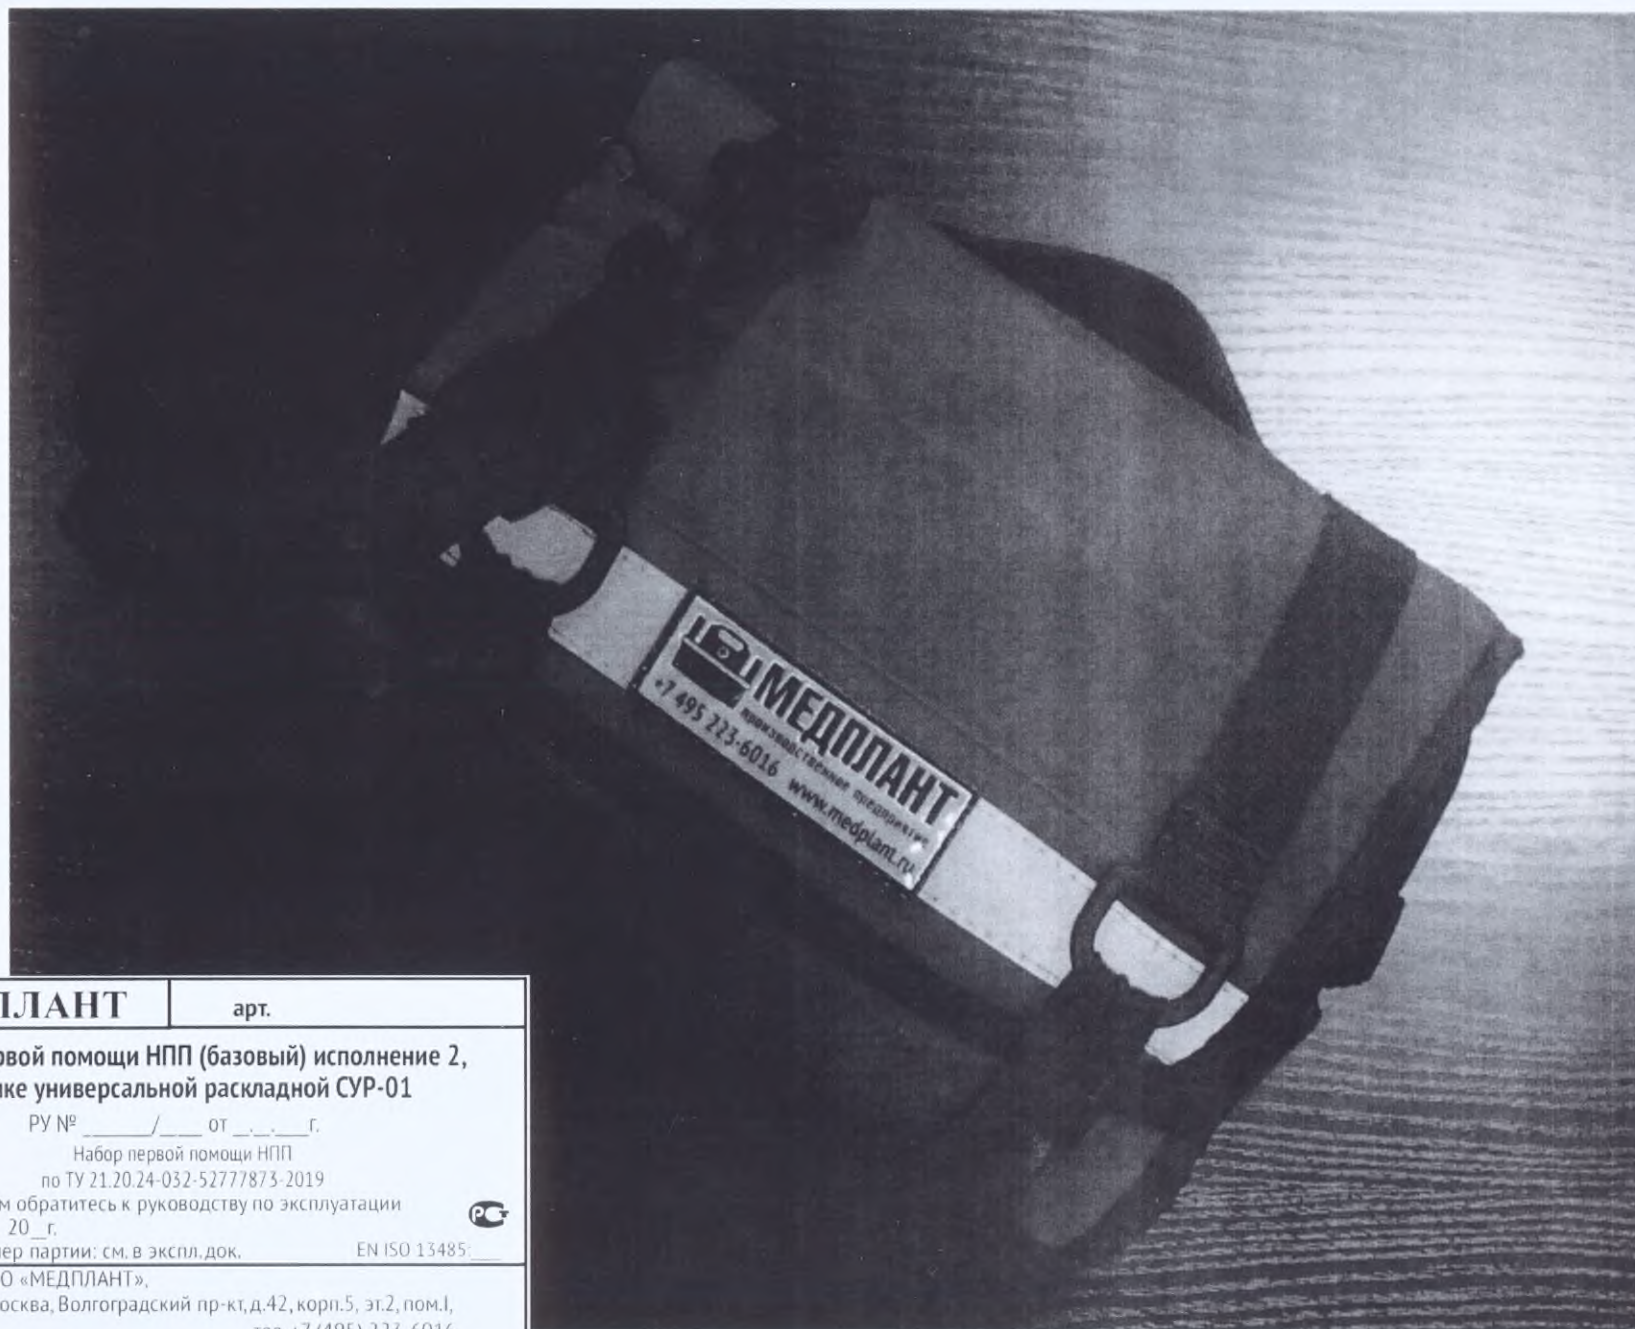


МЕДПЛАНТ	арт.
Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 2, в сумке универсальной раскладной СУР-01	
РУ № ____/____ от ____ г. Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-5277873-2019	
Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации Дата выпуска: __ кв. 20__ г.	
Срок хранения, номер партии: см. в эксл. док.	
Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318.	
EN ISO 13485:____	

Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 2, в сумке универсальной раскладной СУР-01: общий вид, маркировка



Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 2, в сумке универсальной раскладной СУР-01

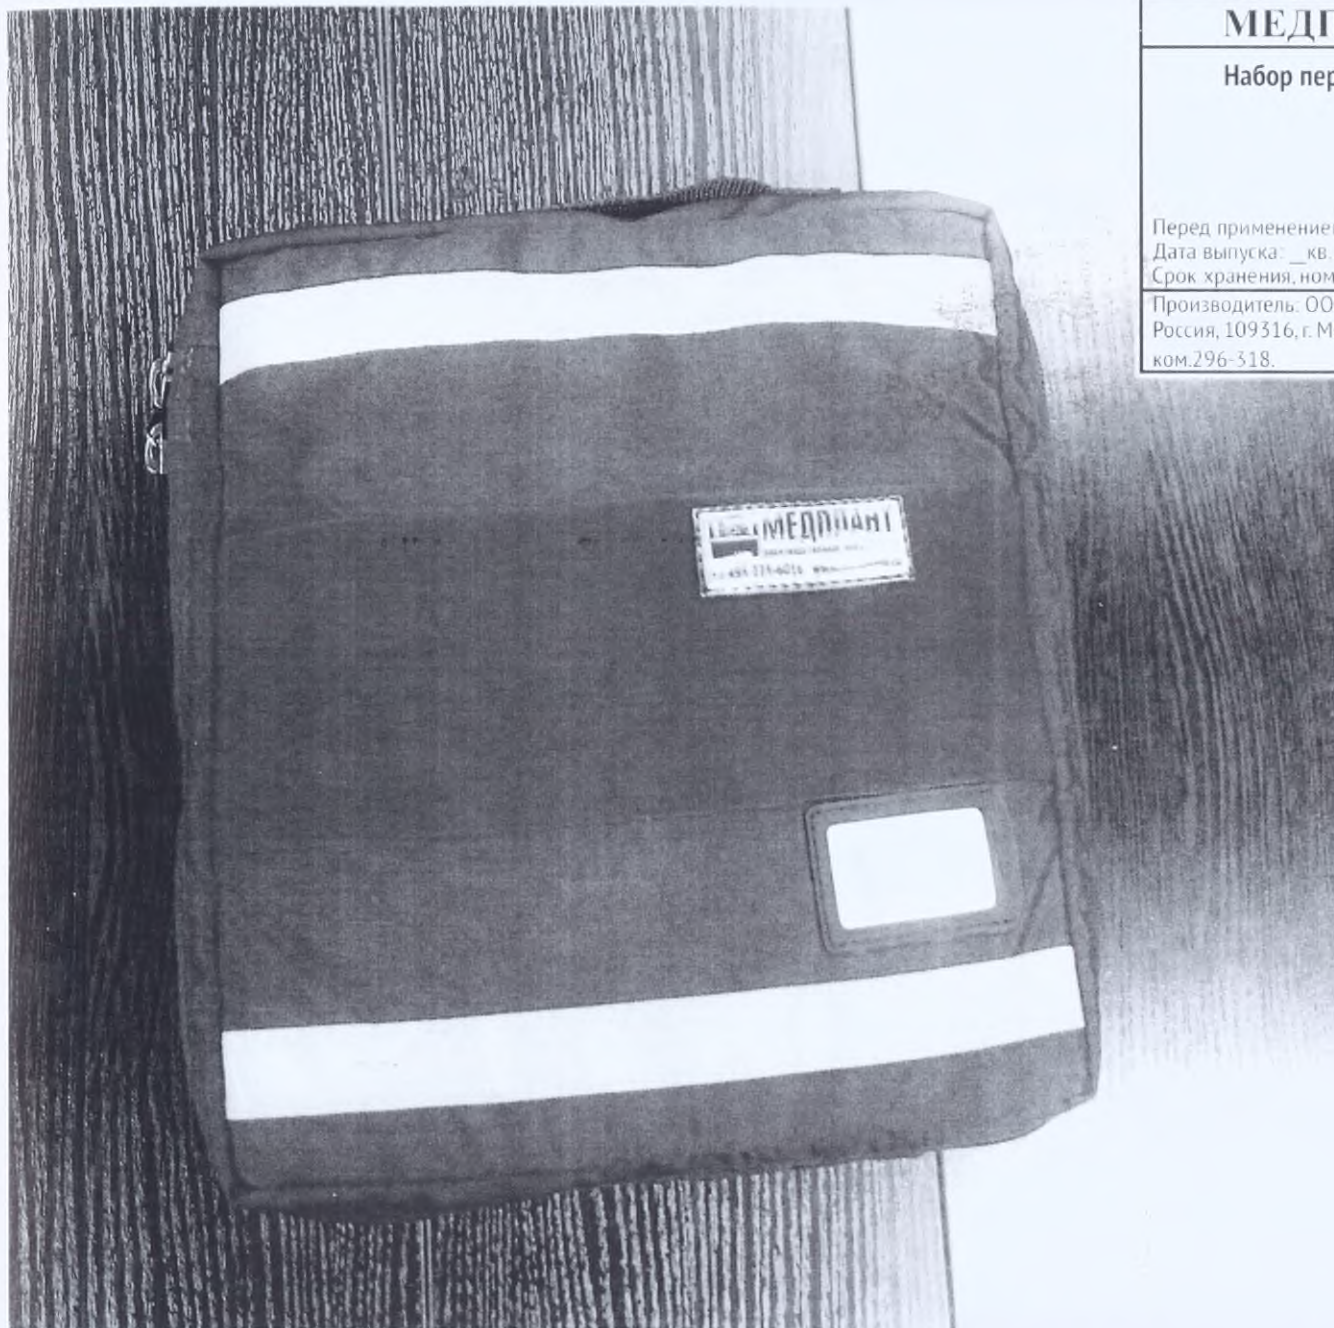


МЕДПЛАНТ	арт.
Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 1, в сумке-чехле «Волонтер-3» РУ № ____/____ от ____ г. Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019 Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации Дата выпуска: __ кв. 20__ г. Срок хранения, номер партии: см. в экспл. док. EN ISO 13485 Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318. тел. +7 (495) 223-6016	

Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 1, в сумке-чехле «Волонтер-3»: общий вид, маркировка



Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 1, в сумке-чехле «Волонтер-3»

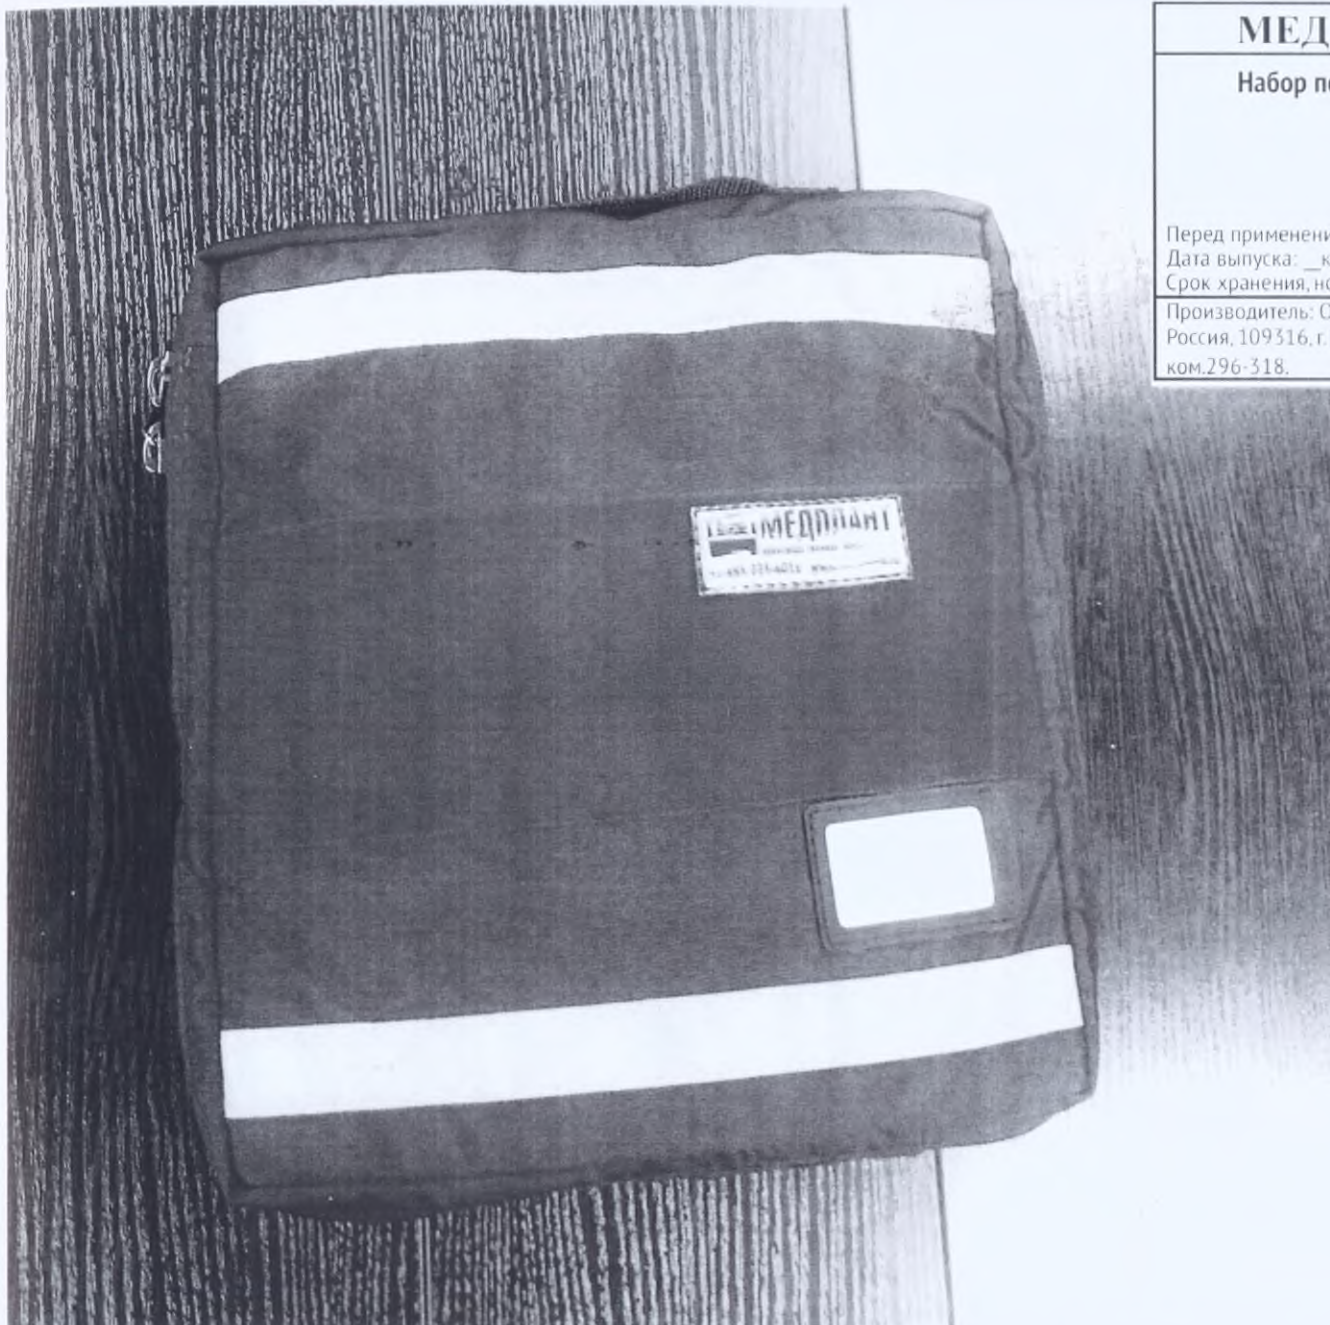


МЕДПЛАНТ	арт.
Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 2, в сумке-чехле «Волонтер-3» РУ № ____/____ от ____ г. Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019 Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации Дата выпуска: __ кв. 20__ г. Срок хранения, номер партии: см. в эксл. док. EN ISO 13485: ____ Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318. тел. +7 (495) 223-6016	

Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 2, в сумке-чехле «Волонтер-3»: общий вид, маркировка



Набор первой помощи НПП (базовый) исполнение 2, в сумке-чехле «Волонтер-3»

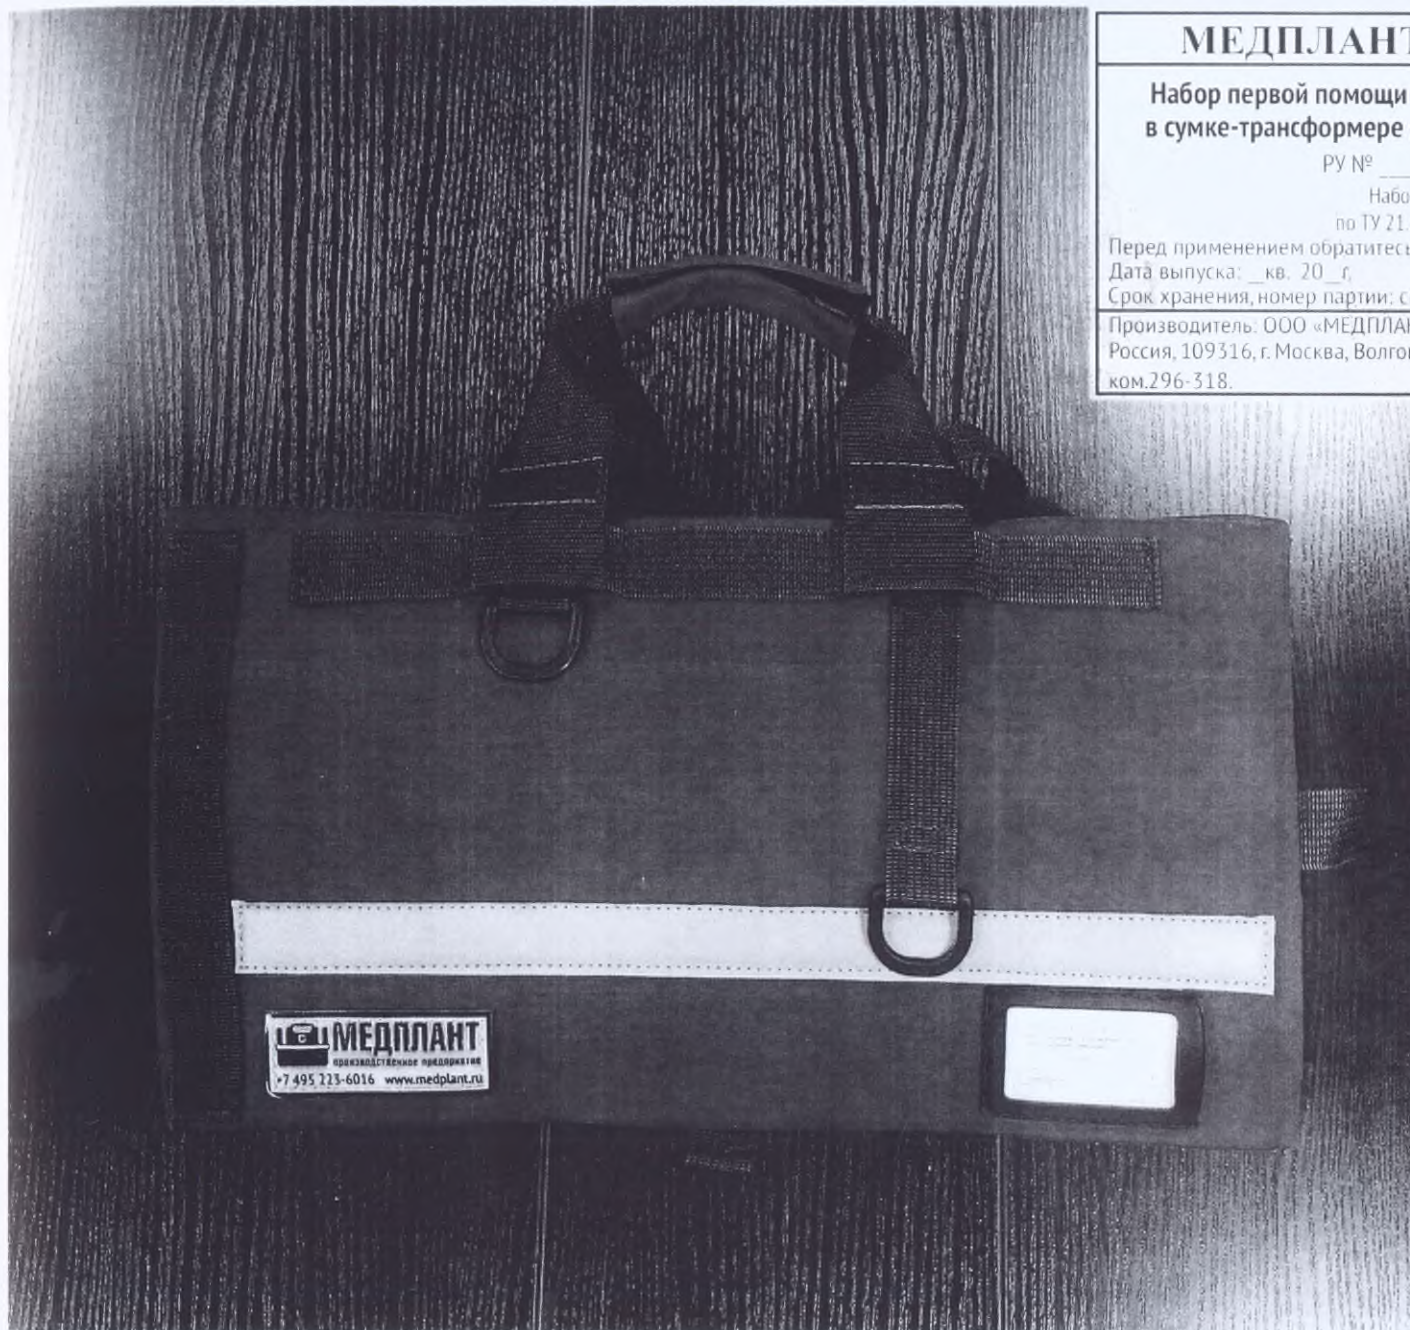


МЕДПЛАНТ	арт.
Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 1, в сумке-трансформере универсальной раскладной СУРт-01	
РУ № ____/____ от ____ г.	
Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-052-52777873-2019	
Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации	
Дата выпуска: __ кв. 20__ г.	PG
Срок хранения, номер партии: см. в экпл. док.	EN ISO 13485: ____
Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318.	
тел. +7 (495) 223-6016	

Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 1, в сумке-трансформере универсальной раскладной СУРт-01: общий вид, маркировка



Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 1, в сумке-трансформере универсальной раскладной СУРП-01

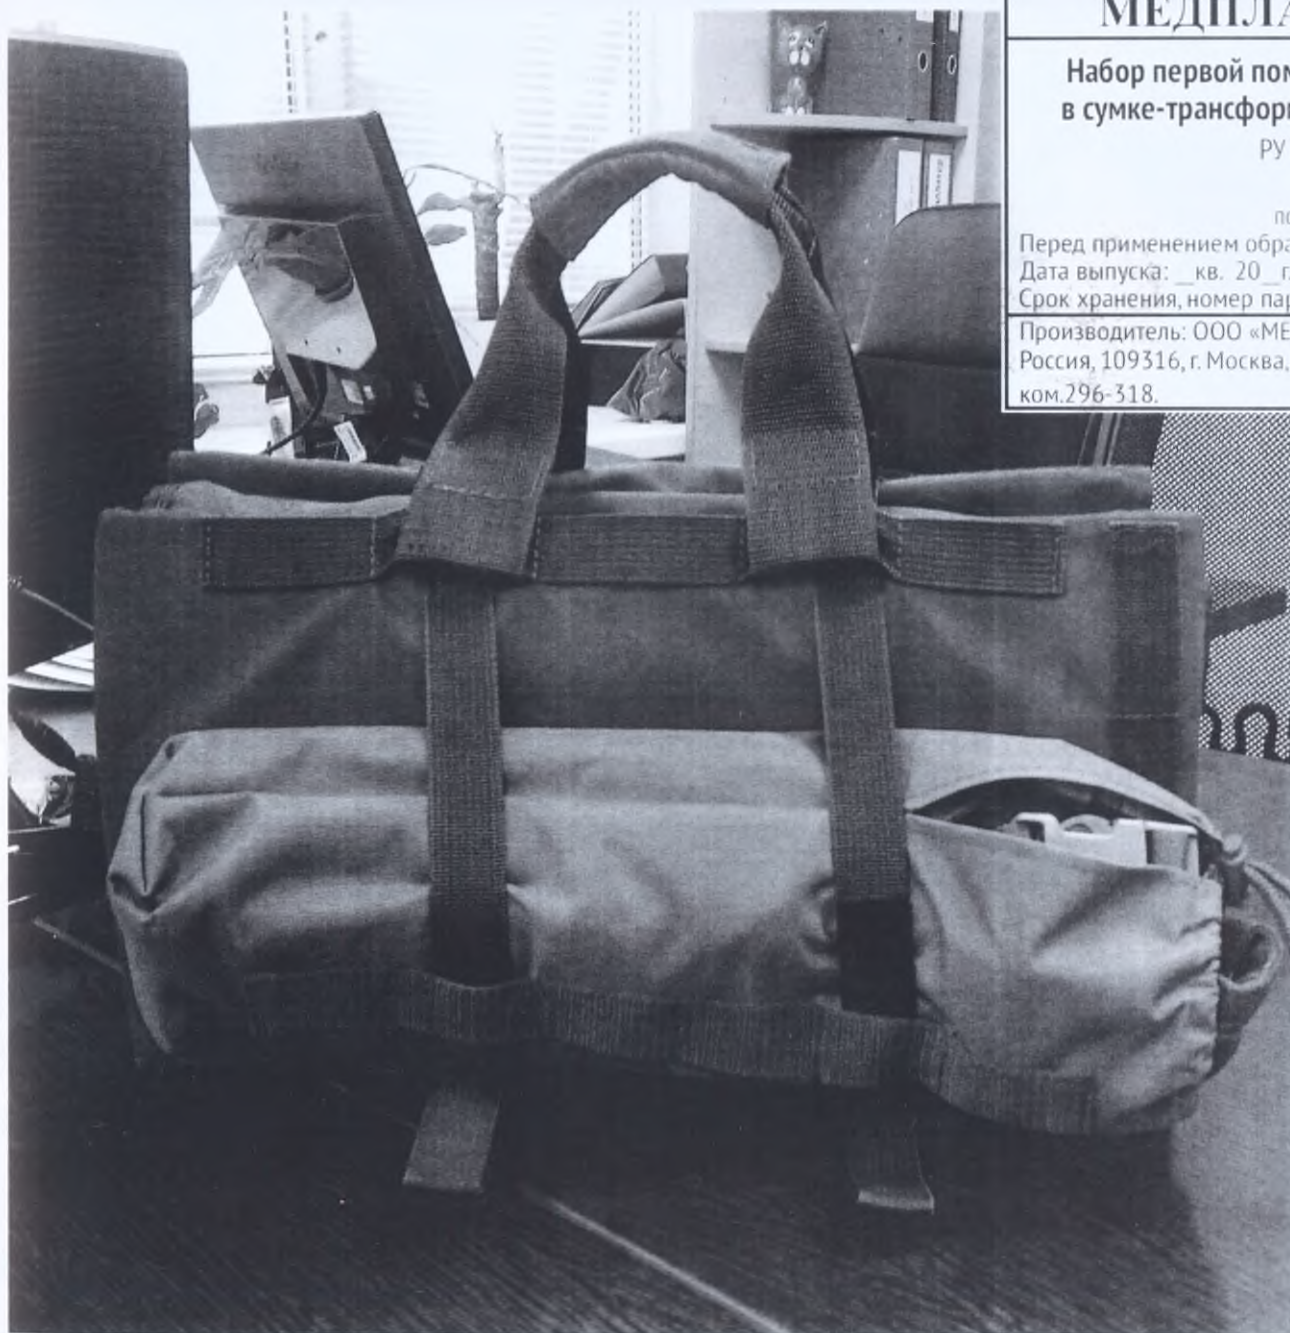

МЕДПЛАНТ

арт.

**Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 2,
в сумке-трансформере универсальной раскладной СУРт-01**

РУ № ____/____ от ____ г.

Набор первой помощи НПП

по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019

Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации

Дата выпуска: ____ кв. 20 ____ г.

Срок хранения, номер партии: см. в экпл. док.

EN ISO 13485: ____



Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ»,

Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1,

ком.296-318.

тел. +7 (495) 223-6016

Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 2, в сумке-трансформере универсальной раскладной СУРт-01: общий вид, маркировка



Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 2, в сумке-трансформере универсальной раскладной СУРт-01




МЕДПЛАНТ	арт.
Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 1, в рюкзаке «Волонтер-4»	
РУ № ____/____ от ____ г.	
Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019	
Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации	
Дата выпуска: __ кв. 20__ г.	
Срок хранения, номер партии: см. в экпл. док.	
Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318.	
тел. +7 (495) 223-6016	



Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 1, в рюкзаке «Волонтер-4» : общий вид, маркировка



Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 1, в рюкзаке «Волонтер-4»

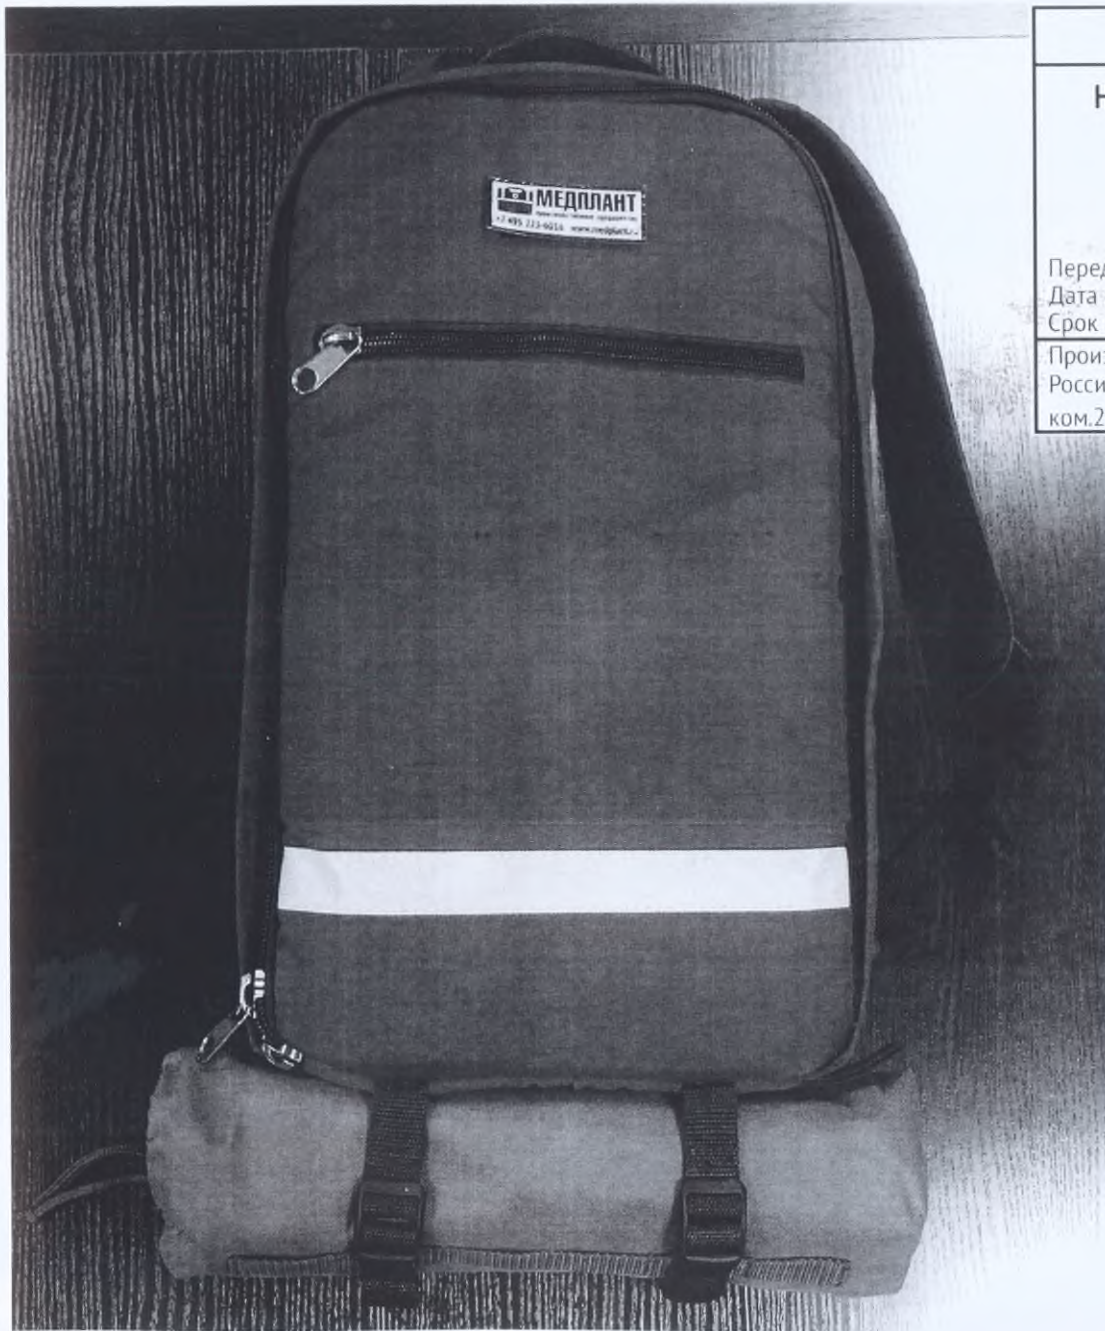

МЕДПЛАНТ	арт.
Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 2, в рюкзаке «Волонтер-4» РУ № ____ / ____ от ____ г. Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019 Перед применением обратитесь к руководству по эксплуатации Дата выпуска: __ кв. 20__ г. Срок хранения, номер партии: см. в эксл. док. EN ISO 13485: ____	
Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318. тел. +7 (495) 223-6016	

Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 2, в рюкзаке «Волонтер-4» : общий вид, маркировка



Набор первой помощи НПП (расширенный) исполнение 2, в рюкзаке «Волонтер-4»



Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 14

Цифрами

(синадзатъ)

прописью

) ЛИСТОВ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Должность ФИО

ХАРДИНА С.М.


Подпись

С.М. Хардина

**Фотографические изображения изделий, входящих
в набор первой помощи НПП (базовый)**




Жгут кровоостанавливающий

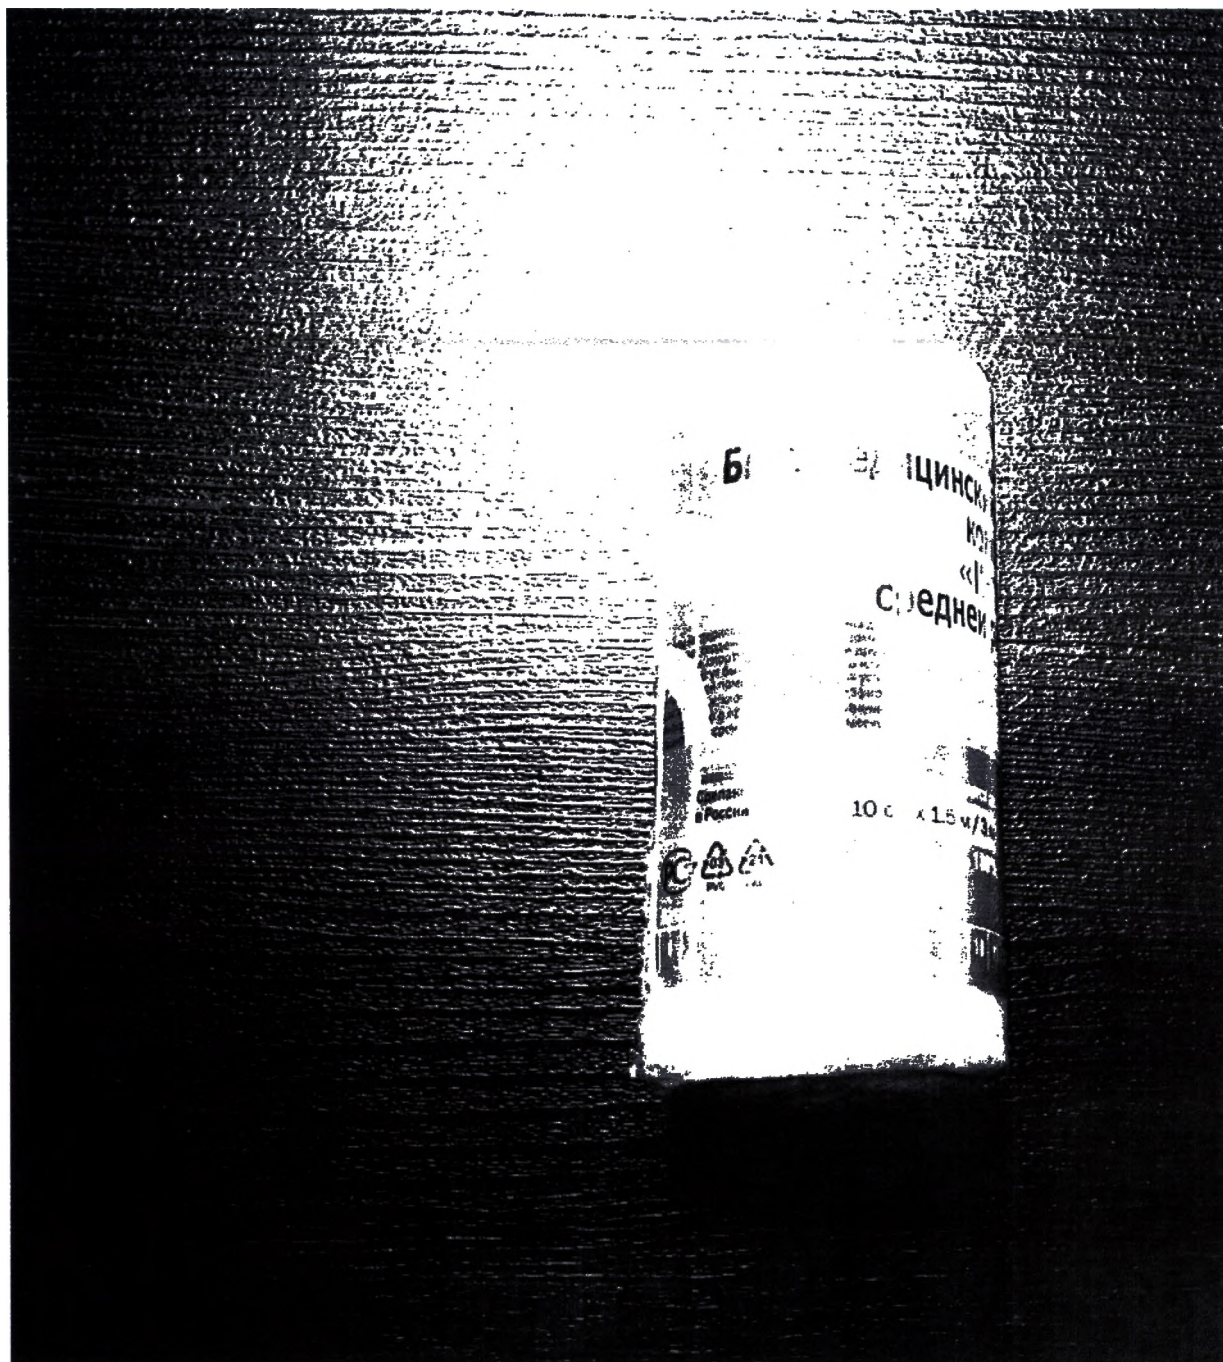

Бинт эластичный рулонный

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
ОМ ТРЕХ СТОРОН

ИЗЯЖИМ ЛТИ



ТУ 9393-012-46838-010-20

РФ 2007/01084 от 30.09.

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ»

г. Москва, 101000



ул. Савская, дом 32 стр. 2 пом. 2

производства: Россия 143984

г. Ярославль, ул. Железнодорожная, д. 6

телефон (495) 528-51-09



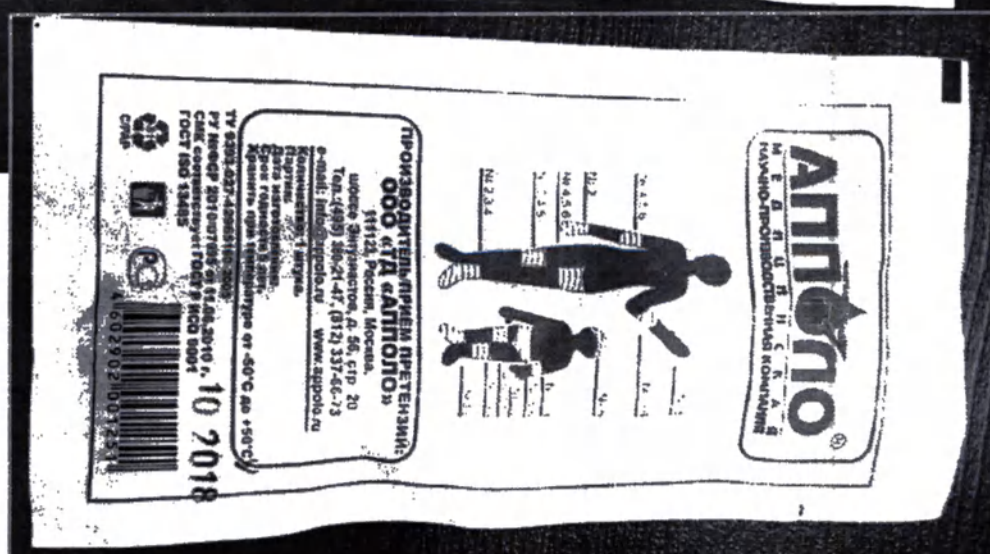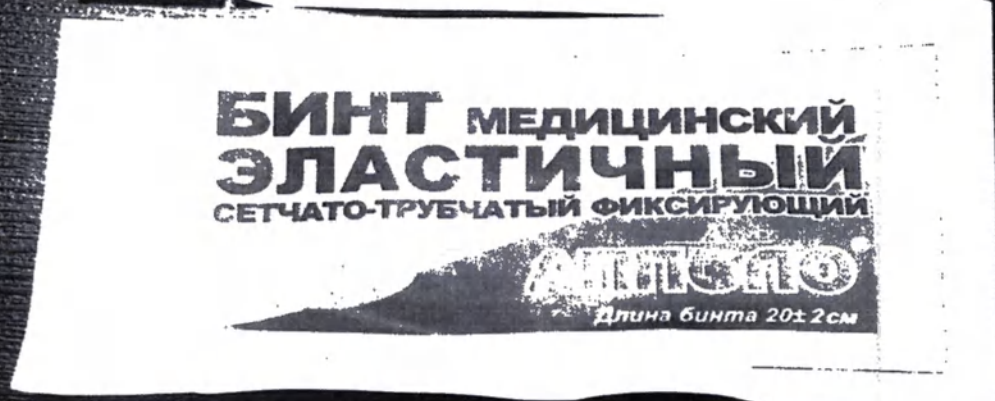



Телесного цвета. На полимерной основе.

Предназначен для обработки мелких ран, порезов, царапин. Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. Для нормальной и чувствительной кожи. Изготовлен с применением акрилового клея и антисептического вещества - акринол.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Не токсично, однократного применения, не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Производитель: Чанчжоу Хуалян Медл Дрессинг Ко., Лтд. / Changzhou Huailan Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhougu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

По адресу: ООО Сана, 302008, Орел, ул. Высоковольтная, д. 2Г, тел: +7 (4862)44-02-92,

e-mail: sanarel@mail.ru.

Дата изготовления / Mfg date:

04.2018

Срок годности / Use before:

04.2023

Партия № / LOT:

042018



STERILE EO



4 612734 850132

Рег. Уд. № ФСЗ 2011/09594 от 20.04.2011

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9x7,2 см

Производитель: Чанчжоу Хуалянь Хеалф Дрессинг
Ко., Лтд. / Changzhou Hualian Health Dressing Co.,
Ltd. / Zhengzhou Town 213144

China.

По заказу: ООО «Сана», Орел, ул.

Высоковольтная, д. 2Г,

тел: +7 (4862) 44-02-92, e-mail: sanaorel@mail.ru.

Дата изготовления / Mfg date: 01.06.2018


Срок годности / Use before: 01.06.2023

Партия № / LOT: 01062018


Лейкопластырь 2x500 см

Получен для репродуцирования по договору



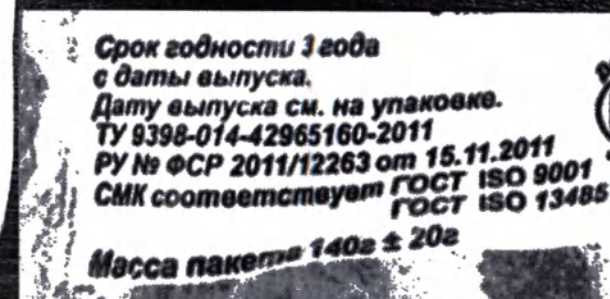

Пакет-контейнер гипотермический

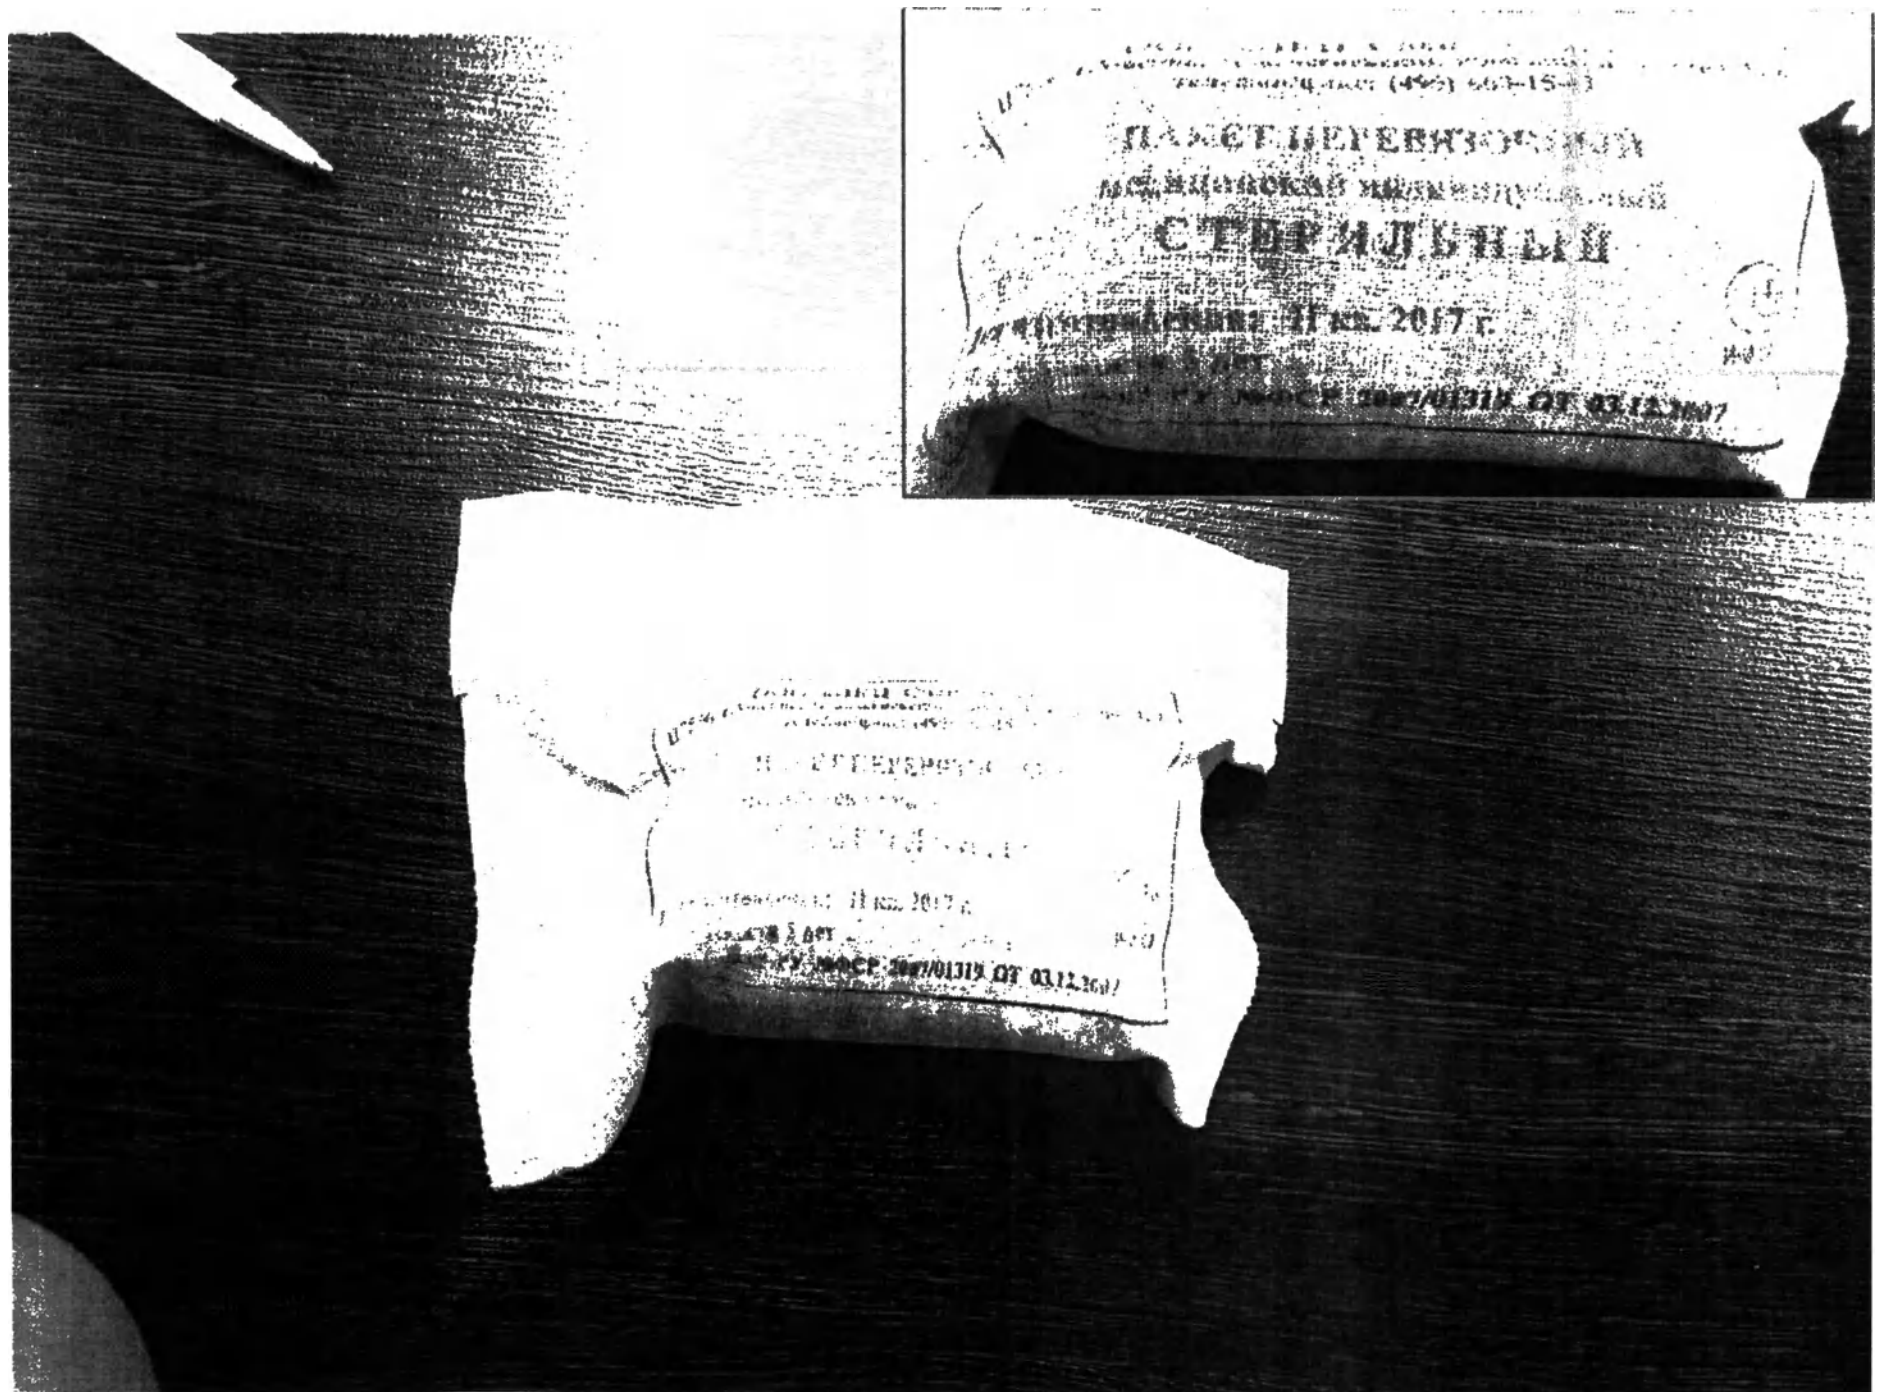

Пакет перевязочный стерильный в герметичной упаковке



Устройство для проведения искусственного дыхания

Маски медицинские из нетканых материалов

«СпецМедЗащита»

Производитель : ООО «Казанская фабрика

«СпецМедЗащита».

ТУ 9398-001-6

Рег. уд. № ФС... 07908 от 07.07.2016 г.

Дата выпуска: 1 квартал 2018 г. Срок хранения: 5 лет.

Условия хранения – Т-0+/-35°, влажность не более 85%

Маски медицинские из нетканых материалов

«СпецМедЗащита»

Производитель : ООО «Казанская фабрика

«СпецМедЗащита».

ТУ 9398-001-6

Рег. уд. № ФС... 07908 от 07.07.2016 г.

Дата выпуска: 1 квартал 2018 г. Срок хранения: 5 лет.

Условия хранения – Т-0+/-35°, влажность не более 85%

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками




Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2558 от 10.04.2015 г.
использованный стерильный бинт относится к отходам класса Б и утилизируется
в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению
с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Бинт медицинский 7м x 14см стерильный




Бинт медицинский 5м x 10см стерильный

противообморочная



Спасибо, что вы обратились к нам!
Салфетка для стимуляции дыхания
с раствором аммиака (2%)
по ГОСТ 13150 (от -50°C до +50°C)
Срок годности 5 лет.



Номер партии:
Дата изготовления:

противообморочная

ООО "РАДИАН-МЕД", Россия, 300004, г. Тула,
ул. Торжеский пр-д, д. 10,
(49) 25-11-73

Адрес производства: ООО «Тульская
фармацевтическая фабрика», Россия, 300004,
г. Тула, ул. Торжеский пр-д, д. 10.

Медицинское изделие

Салфетка для стимуляции дыхания "РАДИАН"

с 2% раствором аммиака водного

1 шт

ТУ 9398-001-86566053-2009
ПУ № ФСР 2009/06146 от 30 октября 2014 г.

Типоразмер изделия - большой

противообморочная

САЛФЕТКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

ИЗ НЕ ТКАНОГО МАТЕРИАЛА

С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

Назначение: для использования в качестве антисептического и дезинфицирующего средства.

Способ применения: вынуть салфетку, обработать место повреждения кожи.

Состав: салфетка, пропитанная 3% раствором перекиси водорода.

Размер: 130 мм х 130 мм

Меры предосторожности: использовать только по назначению.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

ТУ 9393-053-42965160-2012

РУ № РЗН 2013/716 от 31.05.2013 г.

(срок действия не ограничен)

СМК соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ ISO 13485

Хранить: при температуре от +5°C до +25°C.

Партия: см. на шве, первые 2 цифры

Дата изготовления: см. на шве, последние 4 цифры

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

АППОЛО

МЕДИЦИНСКАЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Производитель/прием претензий:

ООО «ТД «АППОЛО»

111123, Россия, г. Москва,

Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20

Тел./факс: (495) 380-21-47, 215-08-13


e-mail: info@appolo.ru, www.appolo.ru




ВНИМАНИЕ!
В течение срока годности средства не использовать
дату и номер партии, указанные на упаковке, для
необходимости контроля качества продукта.




Салфетка с перекисью водорода

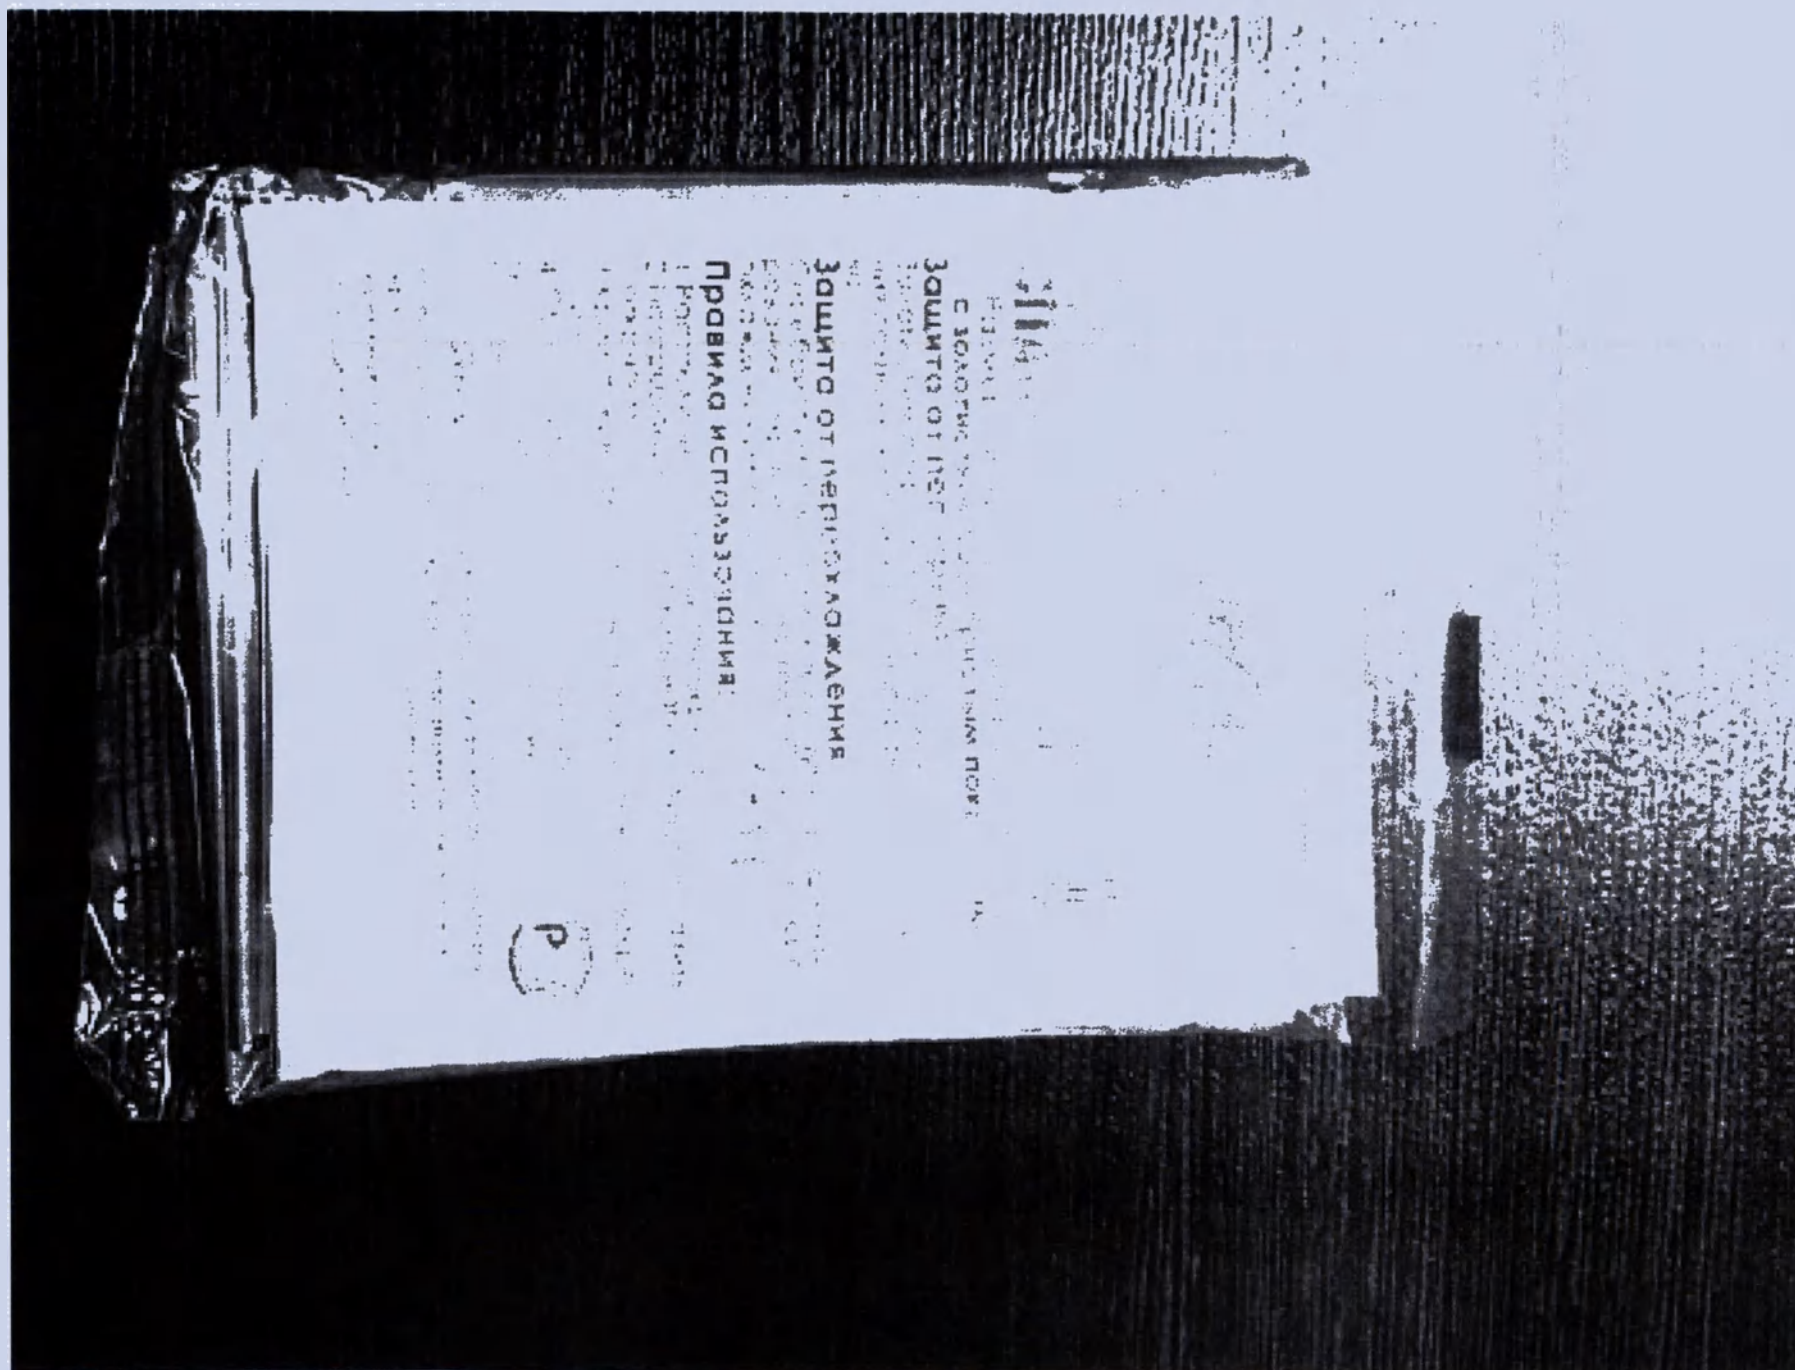

Покрывало спасательное

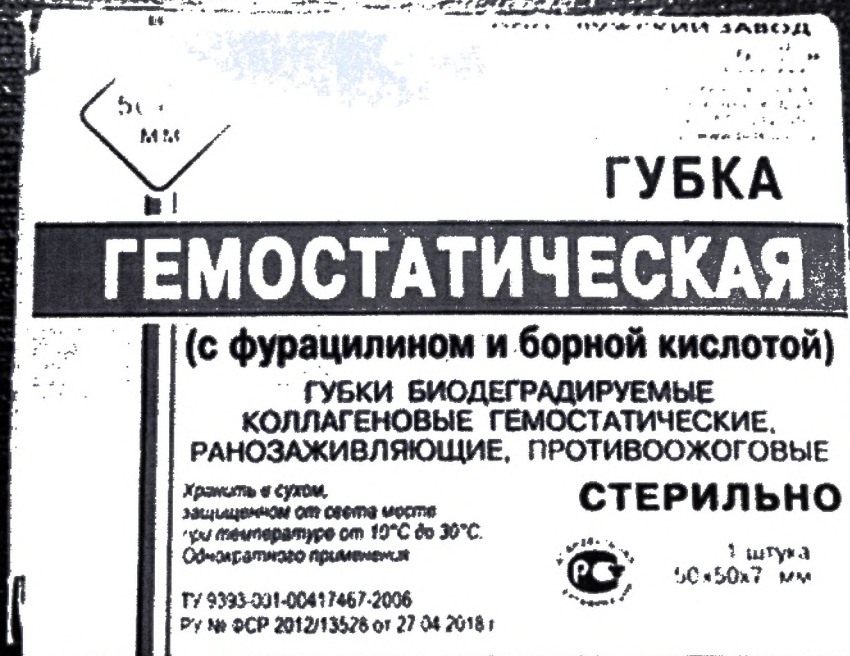

Пластина кровоостанавливающая (губка гемостатическая)

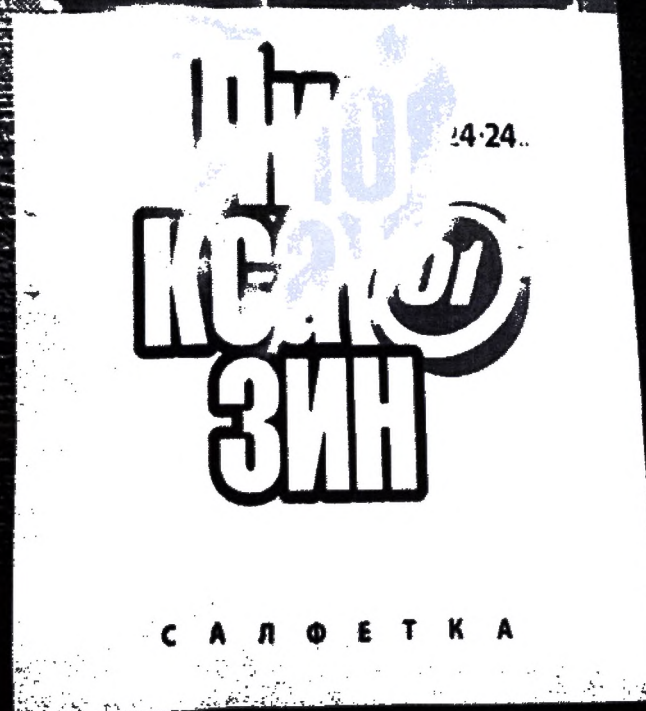

Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое

СТЕРИЛЬНО

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГИДРОГЕЛЕВОЕ ПРОТИВООЖОГОВОЕ

Состав:
 Базис
 Дезинфектант
 Назначение
 Длительность действия
 Показания к применению
 Противопоказания
 Побочные действия
 Условия хранения
 Срок годности
 Условия транспортировки
 Упаковка
 Прокладка
 Противопоказания
 Побочные действия
 Условия хранения
 Срок годности
 Условия транспортировки
 Упаковка
 Прокладка


Условия хранения:
 Хранить при температуре от +5 до +25 °С.
 Хранить в недоступном для детей месте.
 Не применять по истечении срока годности.

Утилизации
 Образовавшиеся отходы и отработанные изделия (салфетки, складируются в контейнеры для отходов) и утилизируются в соответствии с СанПиН 118/02-01-2003.

Сведения о производителе:
 ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
 141402, Московская область,
 г. Химки, Вашутинское шоссе, 11
 тел./факс: +7 (495) 789-6555
info@atompharm.ru
WWW.LIOXAZIN.RU

Номер партии, дата изготовления и дата окончания срока годности:
 указаны на шве упаковки.
 Для однократного применения

STERILE R

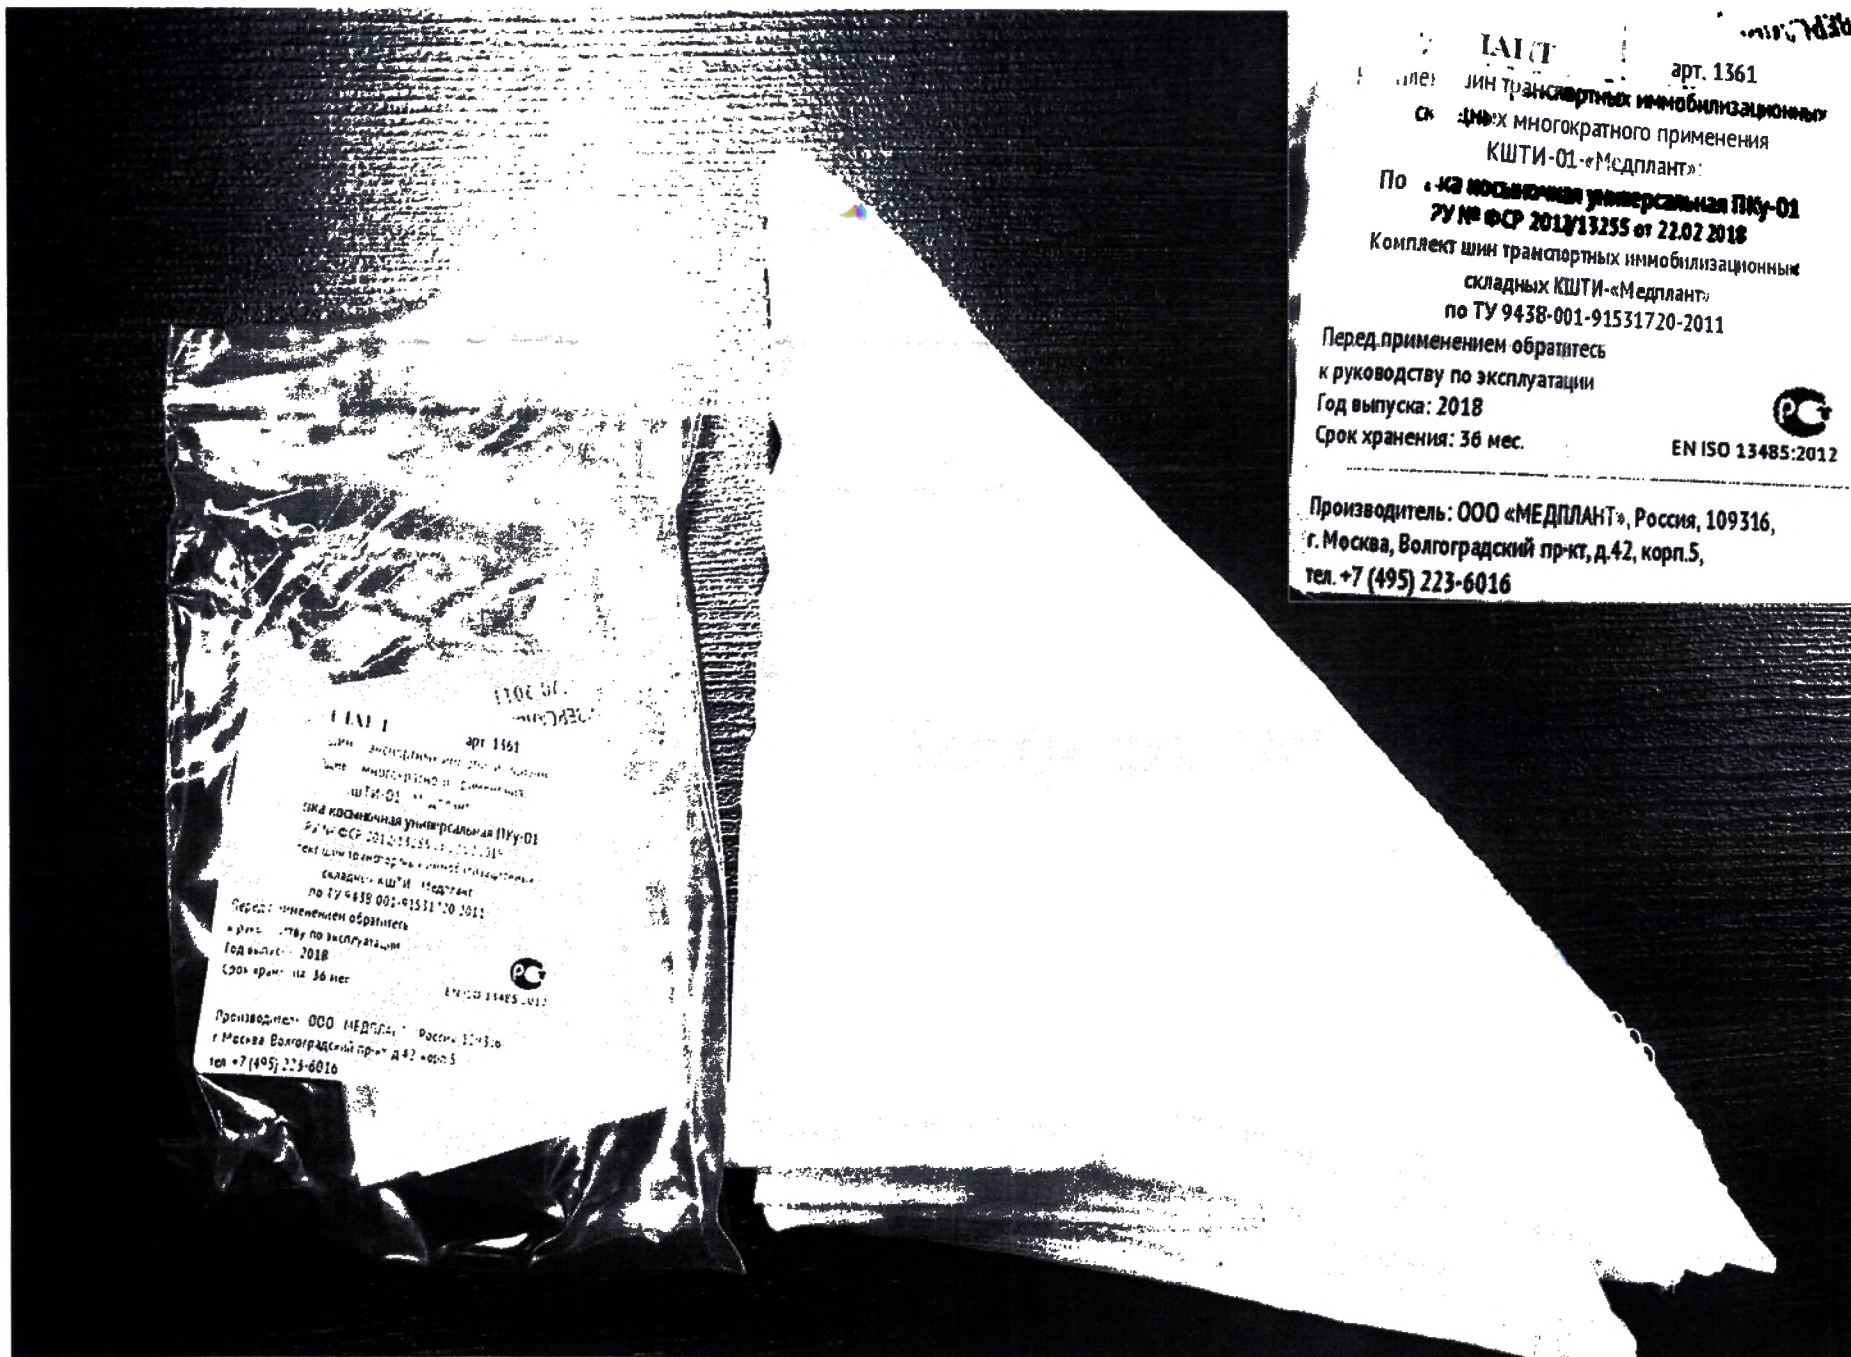

Повязка косыночная

IAI CT арт. 1361
 Комплект шин транспортных иммобилизационных
 складных КШТИ-01 «Медплант»
 По ГОСТ 2012/13255 от 22.02.2018
 Комплект шин транспортных иммобилизационных
 складных КШТИ-01 «Медплант»
 по ТУ 9438-001-91531720-2011
 Перед применением обратитесь
 к руководству по эксплуатации
 Год выпуска: 2018
 Срок хранения: 36 мес.
 EN ISO 13485:2012
 Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
 г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,
 тел. +7 (495) 223-6016

Смотровые латексные перчатки размер М
По заказу ООО «Фарм-Глобал», Россия, г. Москва, ул.
Мясницкая, 30/1/2-стр.2.
Изготовлено: Топ Глав Сди Бхд, (Малайзия).
Рег. уд. № ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009
Дата выпуска: апрель 2018 г. Срок годности: 5 лет.
Партия №: 210028936LPZA
Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла
(температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных
лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и
озона.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: продукты, сделанные из натурального
каучукового латекса могут вызывать аллергическую реакцию.
Не предназначены для использования в качестве основной
химической защиты.

Смотровые латексные перчатки размер М
По заказу ООО «Фарм-Глобал», Россия, г. Москва, ул.
Мясницкая, 30/1/2-стр.2.
Изготовлено: Топ Глав Сди Бхд, (Малайзия).
Рег. уд. № ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009
Дата выпуска: апрель 2018 г. Срок годности: 5 лет.
Партия №: 210028936LPZA
Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла
(температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных
лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и
озона.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: продукты, сделанные из натурального
каучукового латекса могут вызывать аллергическую реакцию.
Не предназначены для использования в качестве основной
химической защиты.



Перчатки медицинские нестерильные (пара)



APEXMED
Guedel oropharyngeal airway - 70 mm
Воздуховод • 70 мм

Open here
Открыть здесь

Apexmed International B.V., Keizersgracht
62-64, 1015 CS, Amsterdam,
the Netherlands. Made in China (China).

Организация, уполномоченная на принятие
и удовлетворение требований от потребителей
в отношении товара ненадлежащего качества:
ООО "Апексмед Рус", ул. Просторная, д.7, стр.3,
107382, Москва, Россия.

STERILE
NON-FOOD

RU № ФСЗ 2011/10168
от 21.07.2011

LOT 17034
REF 0128-00-07
2017-04
2022-03

41239
05.07.2019

Воздуховод полимерный одноразовый №1 (70 мм)

АРЕХМЕД
Guedel oropharyngeal airway
Воздуховод

Length/Длина: 90 mm/мм

Арехмед International B.V., Keizersgracht
 62-64, 1015 CS, Amsterdam, the
 Netherlands. Made in China (Сделано в Китае).

Организация, уполномоченная на принятие
 и удовлетворение требований от потребителей
 в отношении товара ненадлежащего качества:
 ООО "МЕДИКОМ", ул. Космонавтов, д. 18, к. 2,
 129301, Москва, Россия.



STERILE EO
 NON-TOXIC

ПУ № ФСЗ 2011/10180 от 21.07.2011

LOT 16655
 REF 0128-00-09
 2016-12
 2021-11



Open here
 Открыть здесь

Воздуховод полимерный одноразовый №3 (90 мм)



Салфетка марлевая стерильная (упаковка)

**Салфетки антисептические из бумажного
текстилеподобного материала стерильные**
«М.Г. Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт)

Назначение: для дезинфекции поверхностей, обработки кожи, приборов и других поверхностей.

Состав: нетканый текстильный материал, пропитанный 70 % этиловым спиртом.

Размер: салфетки: 135x185 мм

Способ применения: вскрыть упаковку по линии надреза, развернуть салфетку, обработать поверхность.

Выпуск: № 0393-001-51276505

Рег.удост. № 09/05438 от 26.07.20

Срок годности: 12 месяцев, указан на упаковке.

Производитель: «М.Г. Асептика»

Юридический адрес: 11944, Россия, г. Москва, ул. Электролюбовная, д. 9, стр. 3, пом. 2. Тел.: +7(495)660-18-00. www.aseptica.ru

Условия хранения: хранить при температуре от + 5° С до + 40° С в недоступном для детей месте.

Не допускать воздействия на упаковку прямых солнечных лучей.

Способ утилизации: как отходы класса А или Б по СанПин 2.1.7.2790-10.




Салфетка спиртовая



Ручка шариковая



РЕСУРСНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА
ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ




Справочник по *первой* *ПОМОЩИ*

...ответительно можете оказать помощь!

Москва 2018 г.

**Фотографические изображения изделий, входящих
в набор первой помощи НПП (расширенный)**

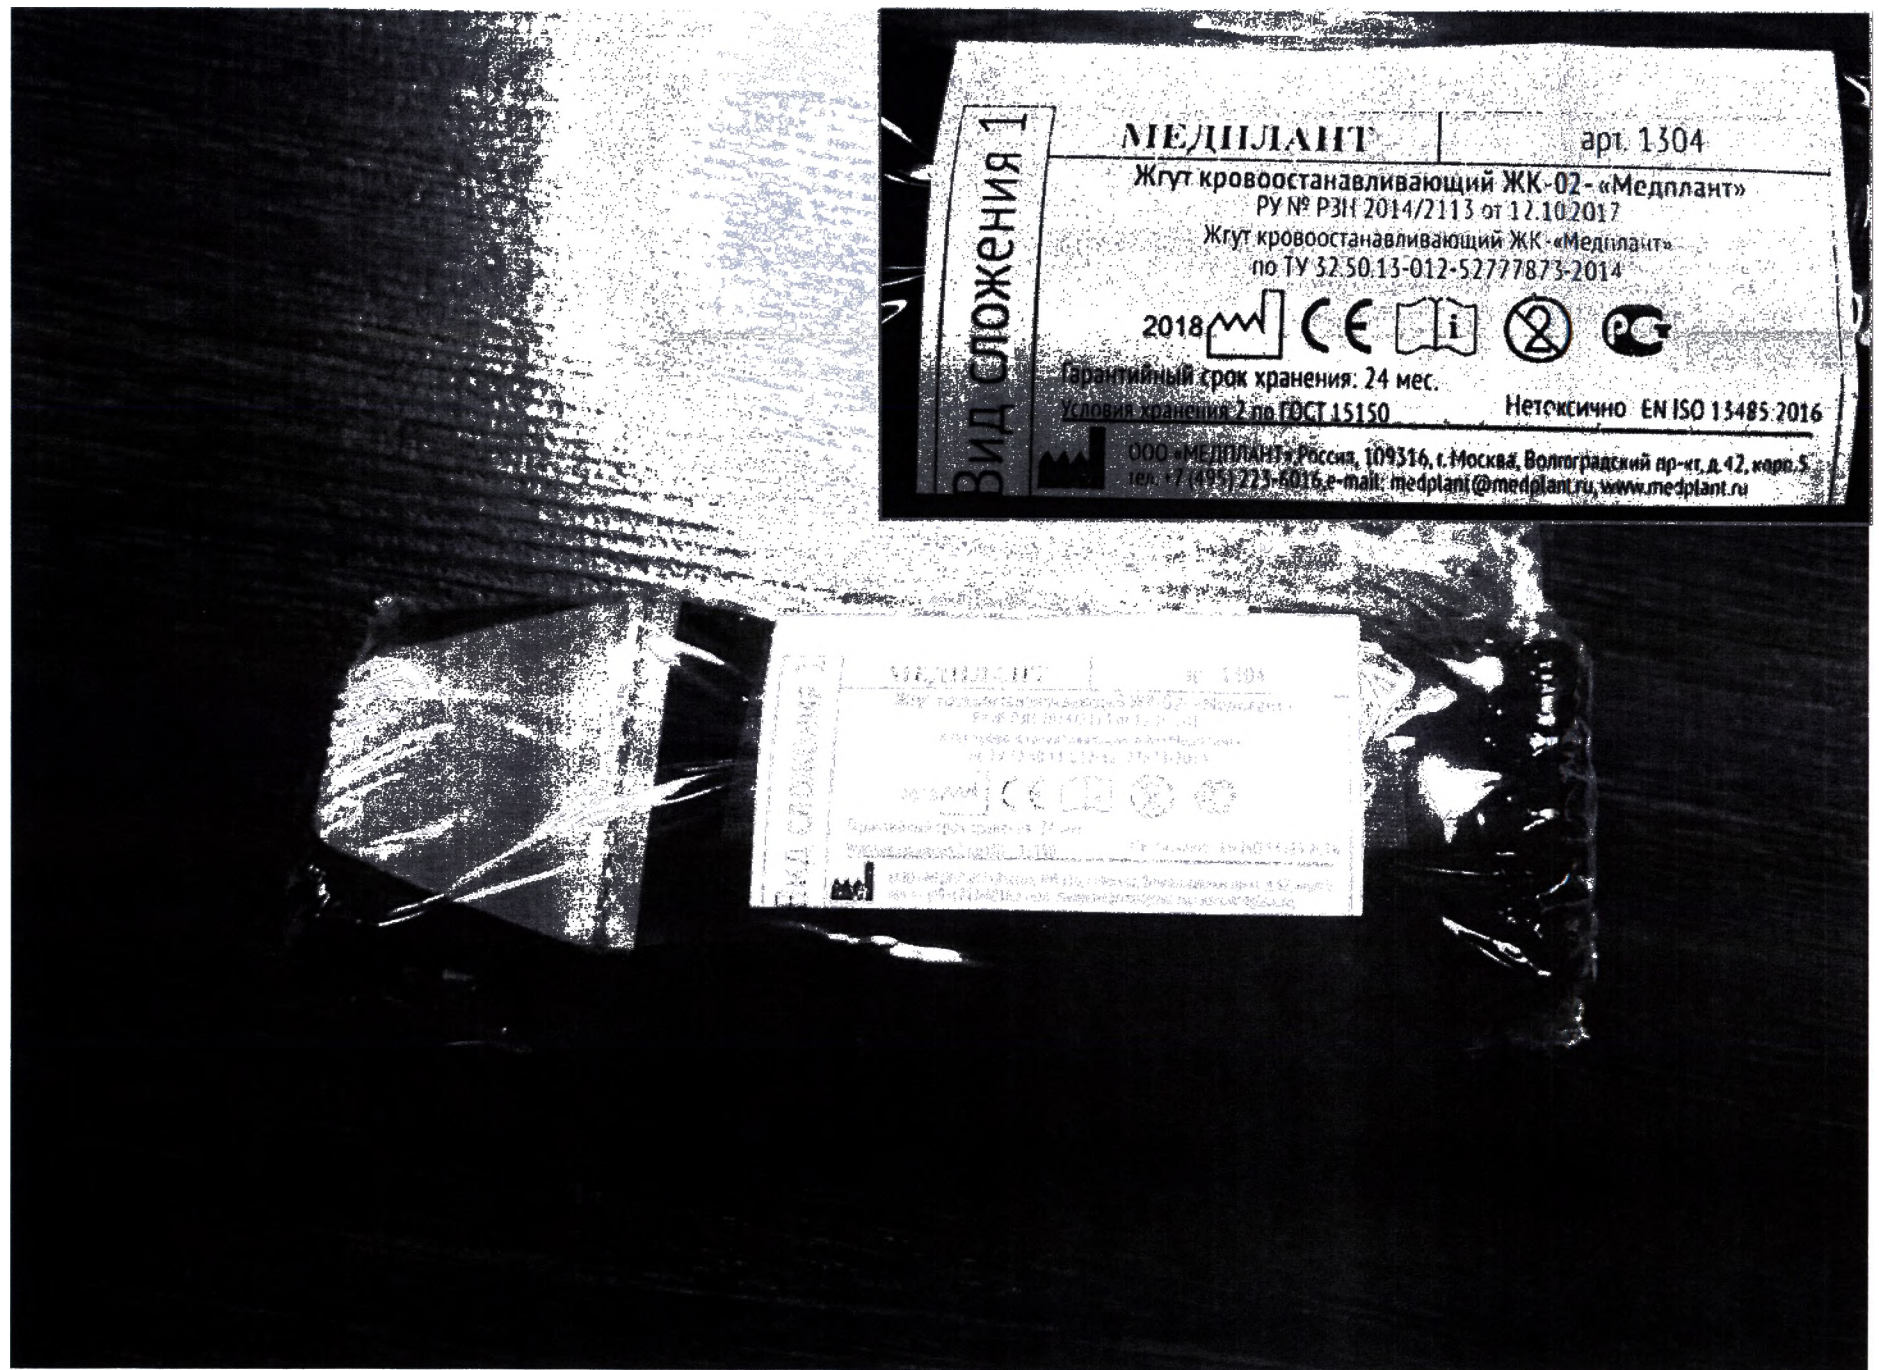




Жгут кровоостанавливающий

Э И Р

ОМРЕ.ХС.ОР

ИСТЯЖЕМ СТИ

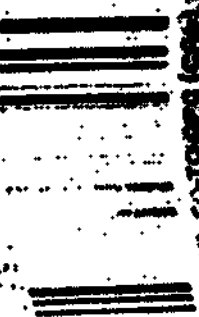[illegible]

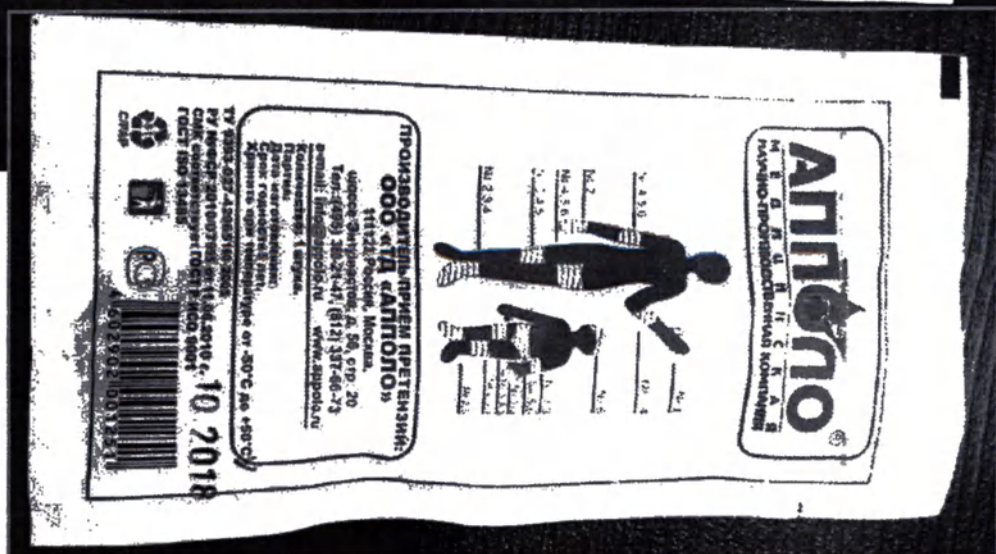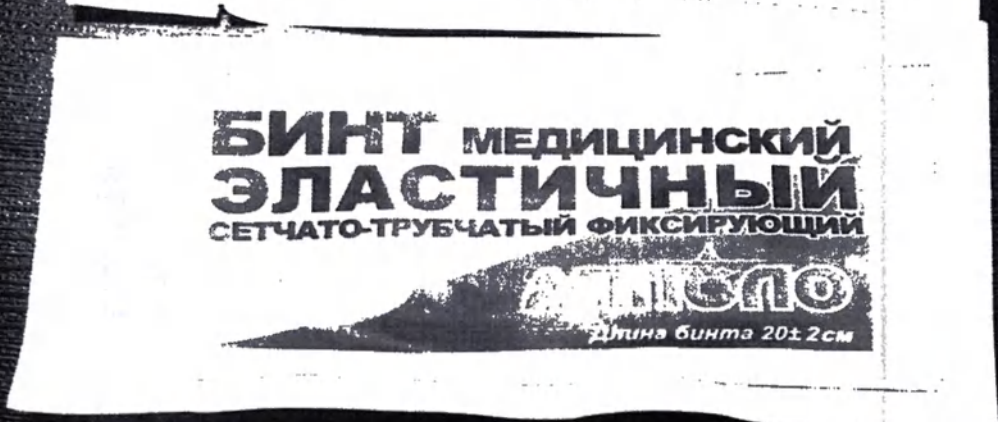



Телесного цвета. На полимерной основе.
 Предназначен для обработки мелких ран, порезов, царапин. Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. Для нормальной и чувствительной кожи. Изготовлен с применением акрилового клея и антисептического вещества - акринол. Не использовать по истечении срока годности.
 Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Не токсично, однократного применения, не применять в случае нарушения целостности упаковки.
 Производитель: Чанчжоу Хуалинь Хелф Дрессинг Ко., Лтд. / Changzhou Huallian Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhonggu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.
 По заказу: ООО Сана, 503018, Орск, ул. Высоковольтная, д. 27. Тел: +7 (4862) 44-02-92, e-mail: sanaorel@mail.ru.
 Дата изготовления / Mfg date: 04.2018
 Срок годности / Use before: 04.2023
 Партия № / Lot: 042018



STERILE EO



4 612734 850132

Per. Уд. № ФСЗ 2011/09594 от 20.04.2011

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9x7,2 см

Производитель: Чанчжоу Хуалинь Хелф Дрессинг
Co., Ltd. / Changzhou Hualian Health Dressing Co.,
Ltd., No. 55 Yuejin Road, Zhougu Town 213144
Changzhou, Jiangsu Province, People's Republic of China.

По заказу: ООО Сана, 302008, Орел, ул.

Высоковольтная, д. 2Г,

тел: +7 (4862) 44-02-92, e-mail: sanaorel@mail.ru

Дата изготовления / Mfg date: 01.06.2018

Срок годности / Use before: 01.06.2023

Партия № / LOT: 01062018


Reg. № ФСЗ 2011/07553 от 20.04.2011




Лейкопластырь 2x500 см



Ножницы для разрезания повязок по Листеру

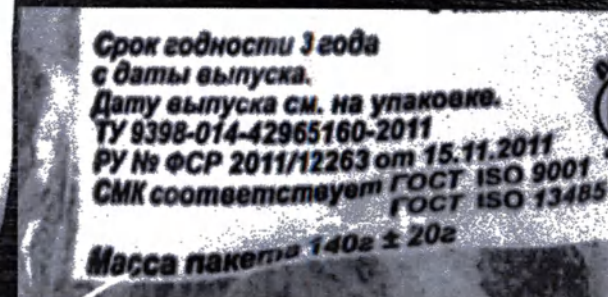

Пакет-контейнер гипотермический

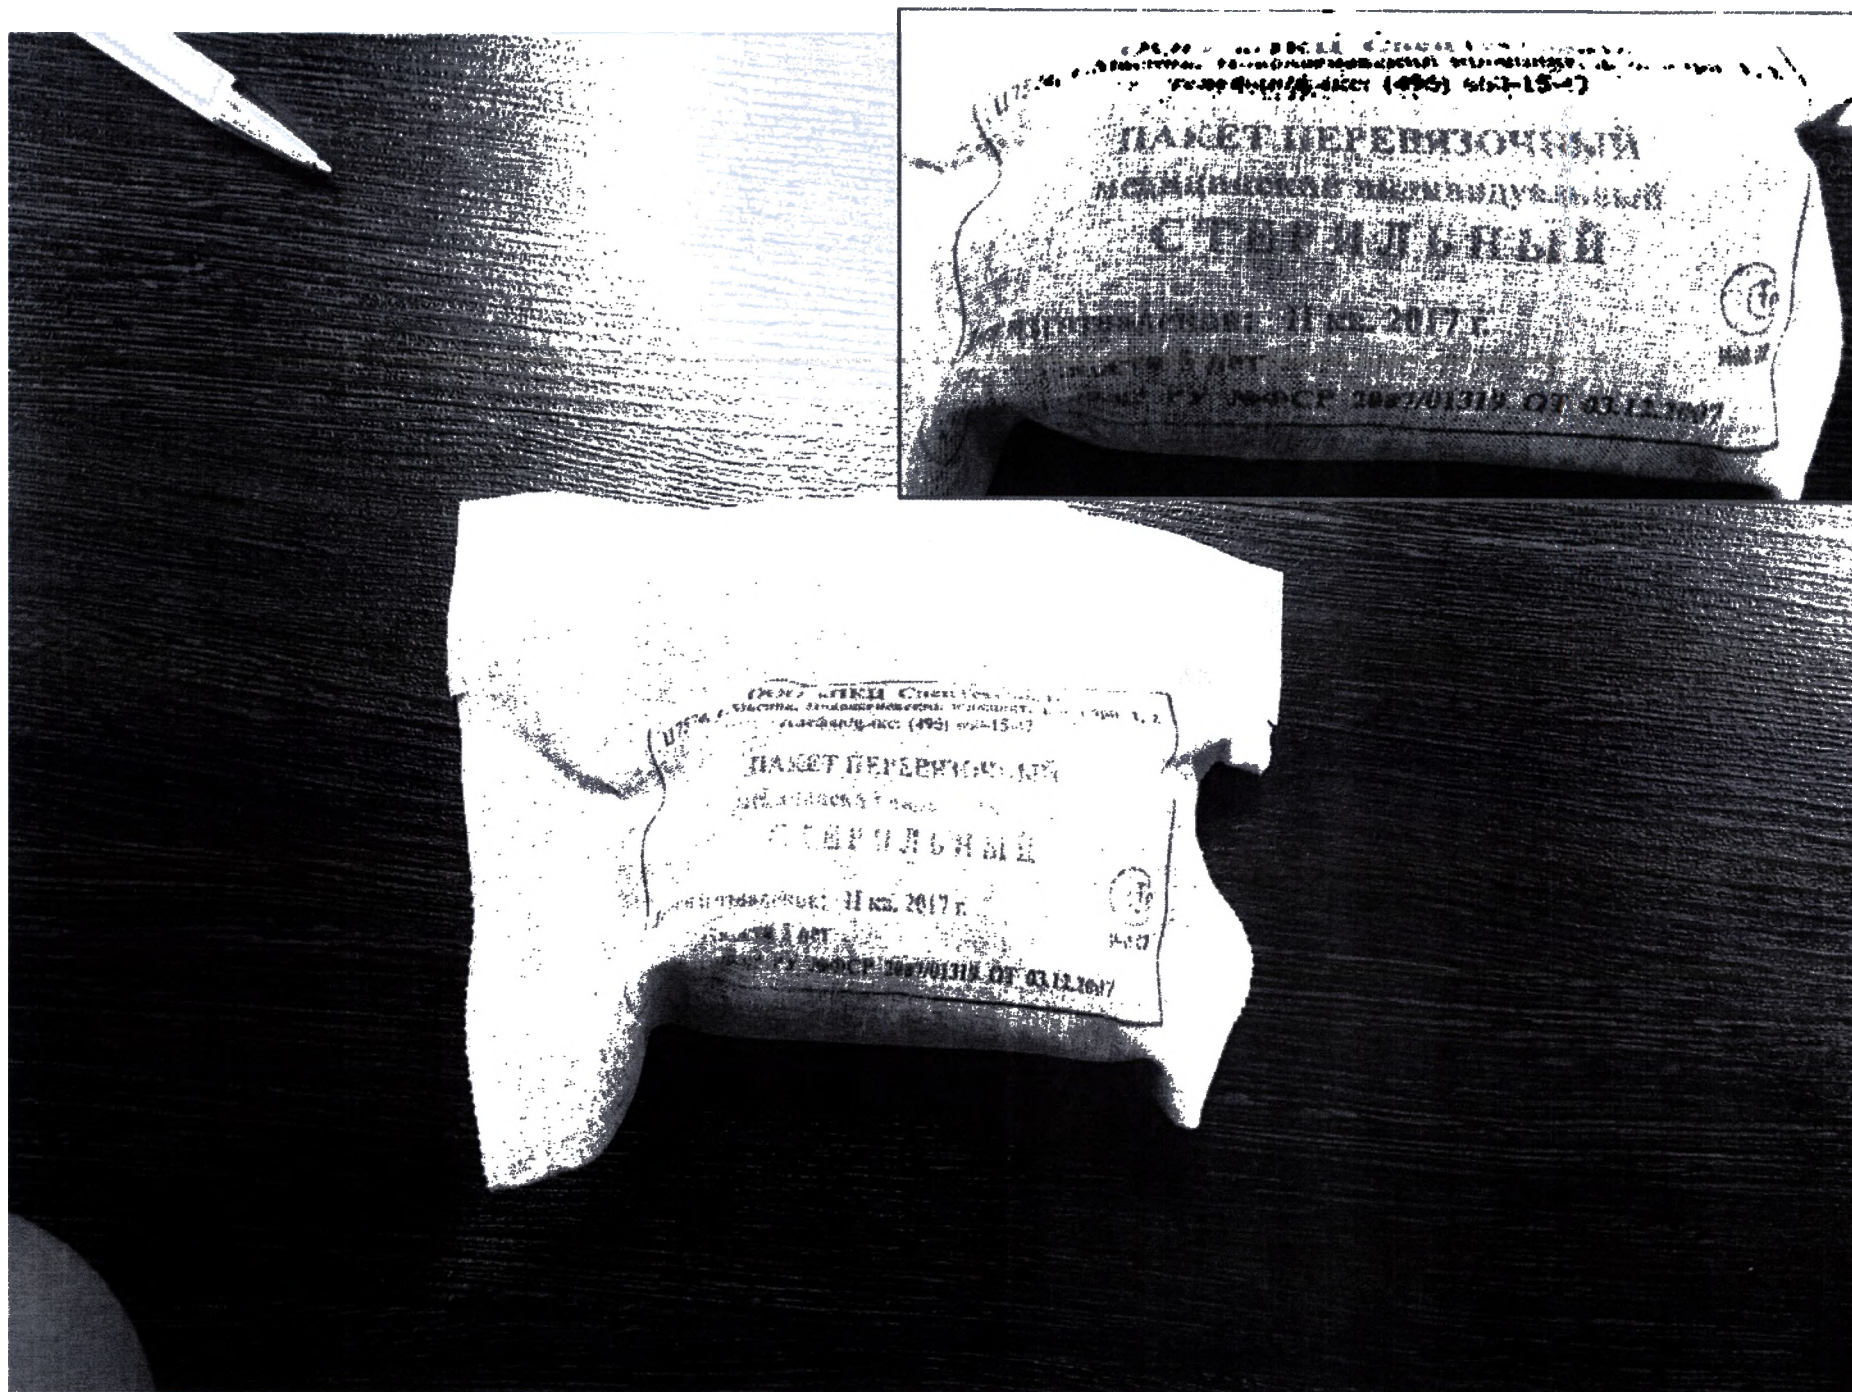

Пакет перевязочный стерильный в герметичной упаковке



Устройство для проведения искусственного дыхания

Маски медицинские из нетканых материалов

«СпецМедЗащита»

Производитель : ООО «Казанская фабрика

«СпецМедЗащита».

ТУ 9398-001-6

Рег. уд. № ФС. 07908 от 07.07.2016 г.

Дата выпуска: 1 квартал 2018 г. Срок хранения: 5 лет.

Условия хранения – Т-0+35°, влажность не более 85%

Маски медицинские из нетканых материалов

«СпецМедЗащита»

Производитель : ООО «Казанская фабрика

«СпецМедЗащита».

ТУ 9398-001-6

Рег. уд. № ФС

Дата выпуска: 1 квартал 2018 г. Срок

Условия хранения – Т-0+35°, влажность не более 85%

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками





Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2558 от 10.04.2015 г.
 использованный стерильный бинт относится к отходам класса Б и утилизируется
 в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению
 с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного
 санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Бинт медицинский 7м x 14см стерильный



Бинт медицинский 5м x 10см стерильный

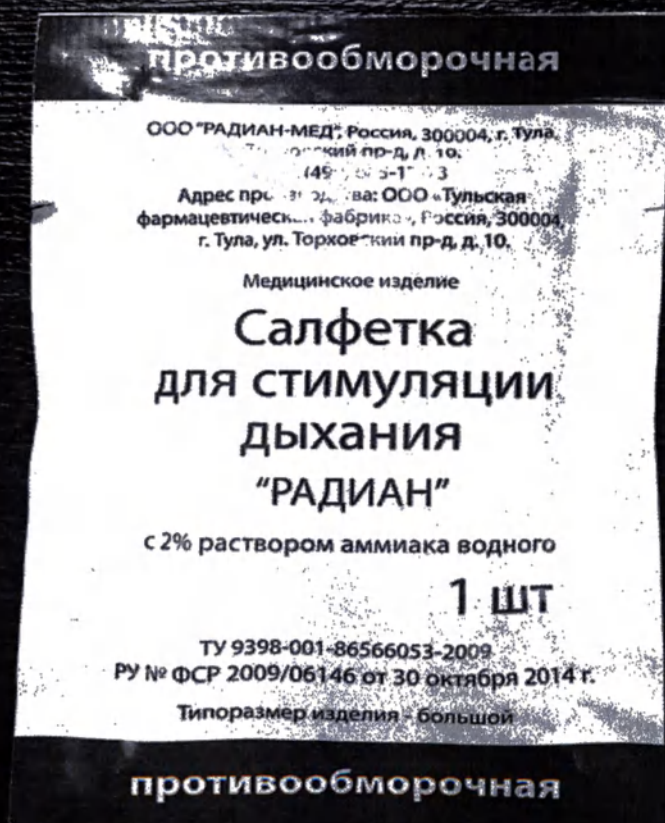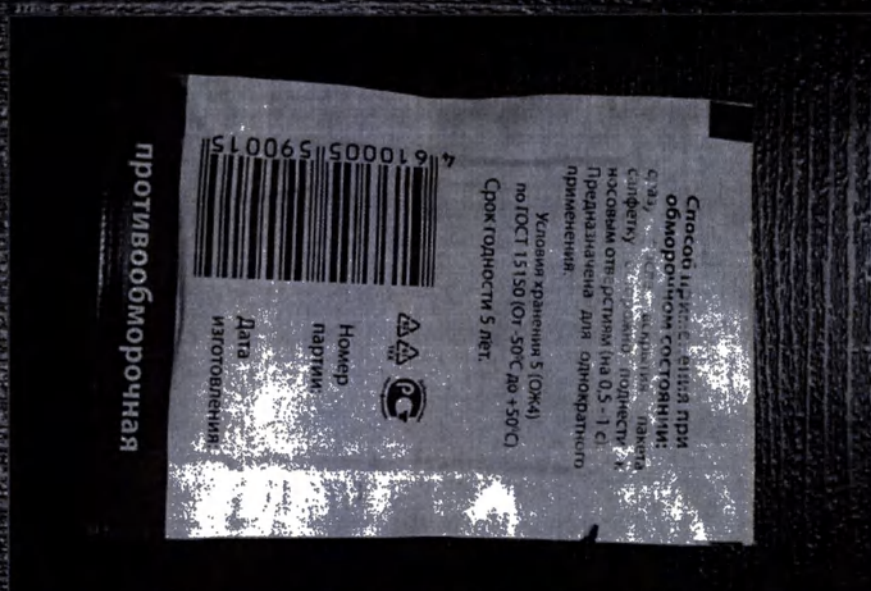

САЛФЕТКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

ИЗ НЕ ТКАНОГО МАТЕРИАЛА

С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

Назначение: для использования в качестве антисептического и дезинфицирующего средства

Способ применения: достаньте салфетку, обработайте место повреждения кожи.

Состав: салфетка, пропитанная 3% раствором перекиси водорода.

Размер: 130 мм x 180 мм

Меры предосторожности: использовать только по назначению.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

ТУ 9393-053-42965160-2012

РУ № РЗН 2013/716 от 31.05.2013 г.

(срок действия не ограничен)

СМК соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ ИСО 13485

Хранить: при температуре от +5°C до +25°C.

Партия: см. на шве, первые 2 цифры

Дата изготовления: см. на шве, последние 4 цифры

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

АППОЛО
МЕДИЦИНСКАЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Производитель/прием претензий:

ООО «ТД «АППОЛО»

111123, Россия, г. Москва,

Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20


Тел./факс: (495) 380-21-47, 215-08-13

e-mail: info@appolo.ru, www.appolo.ru



ВНИМАНИЕ!

В процессе транспортировки и хранения
допускается выделение влаги, что
не влияет на качество изделия

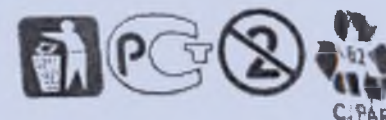

С:РАР



Салфетка с перекисью водорода

АМТЕ-10

П СПАСАЮЩЕЕ

Резиновый коврик с золотистым декоративным покрытием

Защита от перегрева

Защитный коврик предотвращает перегрев и повреждение поверхности, на которой используется.

Защита от переохлаждения

Стеклопакет и коврик предотвращают переохлаждение и повреждение поверхности, на которой используется.


Правила использования:

1. Разложить коврик на ровной поверхности.
 2. Подложить коврик под стеклопакет.
 3. Коврик предотвращает повреждение поверхности, на которой используется.
 4. Коврик предотвращает повреждение поверхности, на которой используется.
- Срок годности: 10 лет.
- Срок хранения: 10 лет.
- Срок эксплуатации: 10 лет.
- Срок службы: 10 лет.
- Срок действия: 10 лет.
- Срок годности: 10 лет.
- Срок хранения: 10 лет.
- Срок эксплуатации: 10 лет.
- Срок службы: 10 лет.
- Срок действия: 10 лет.






Пластина кровоостанавливающая (губка гемостатическая)

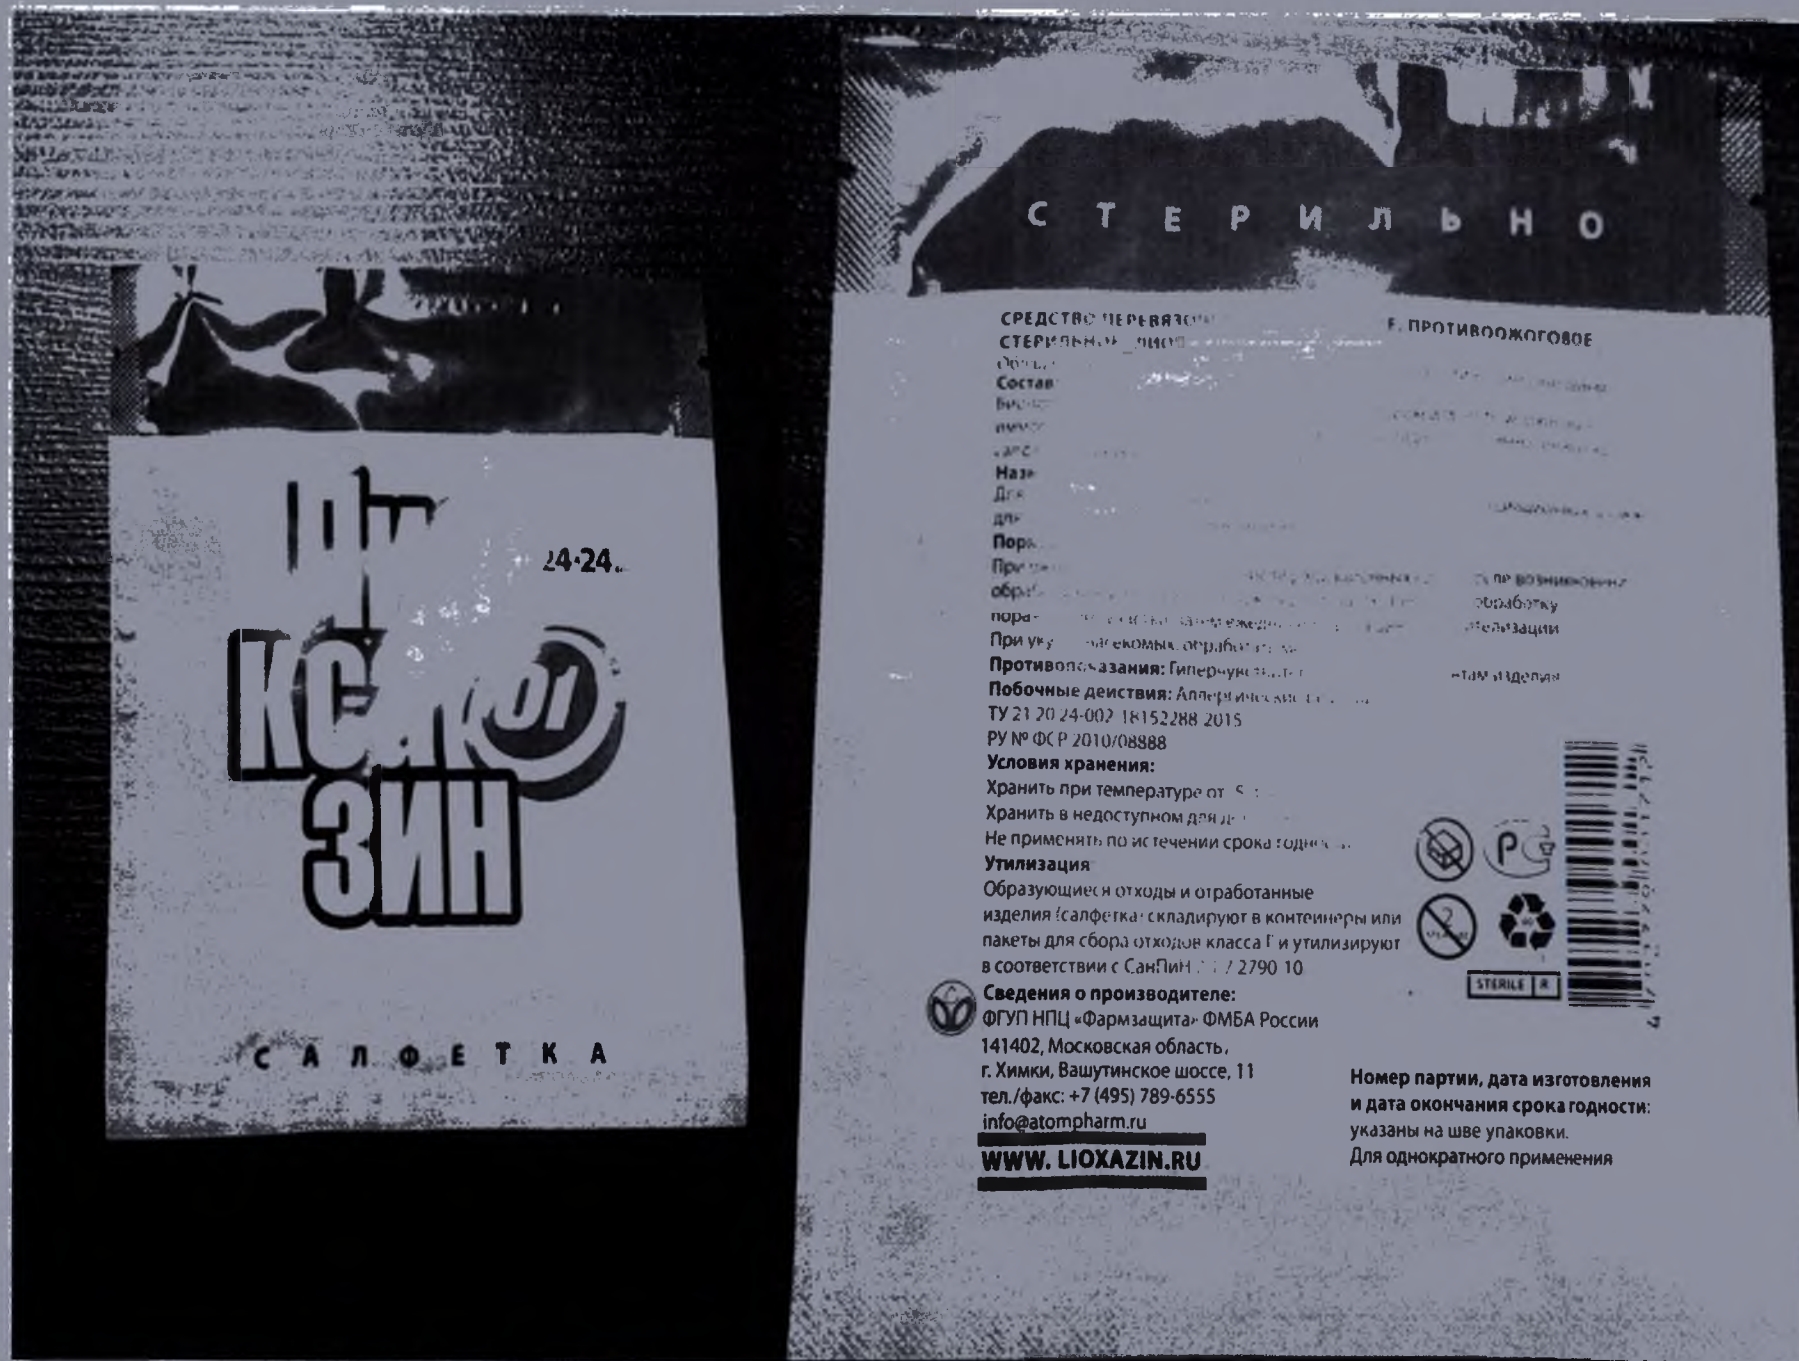


Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое

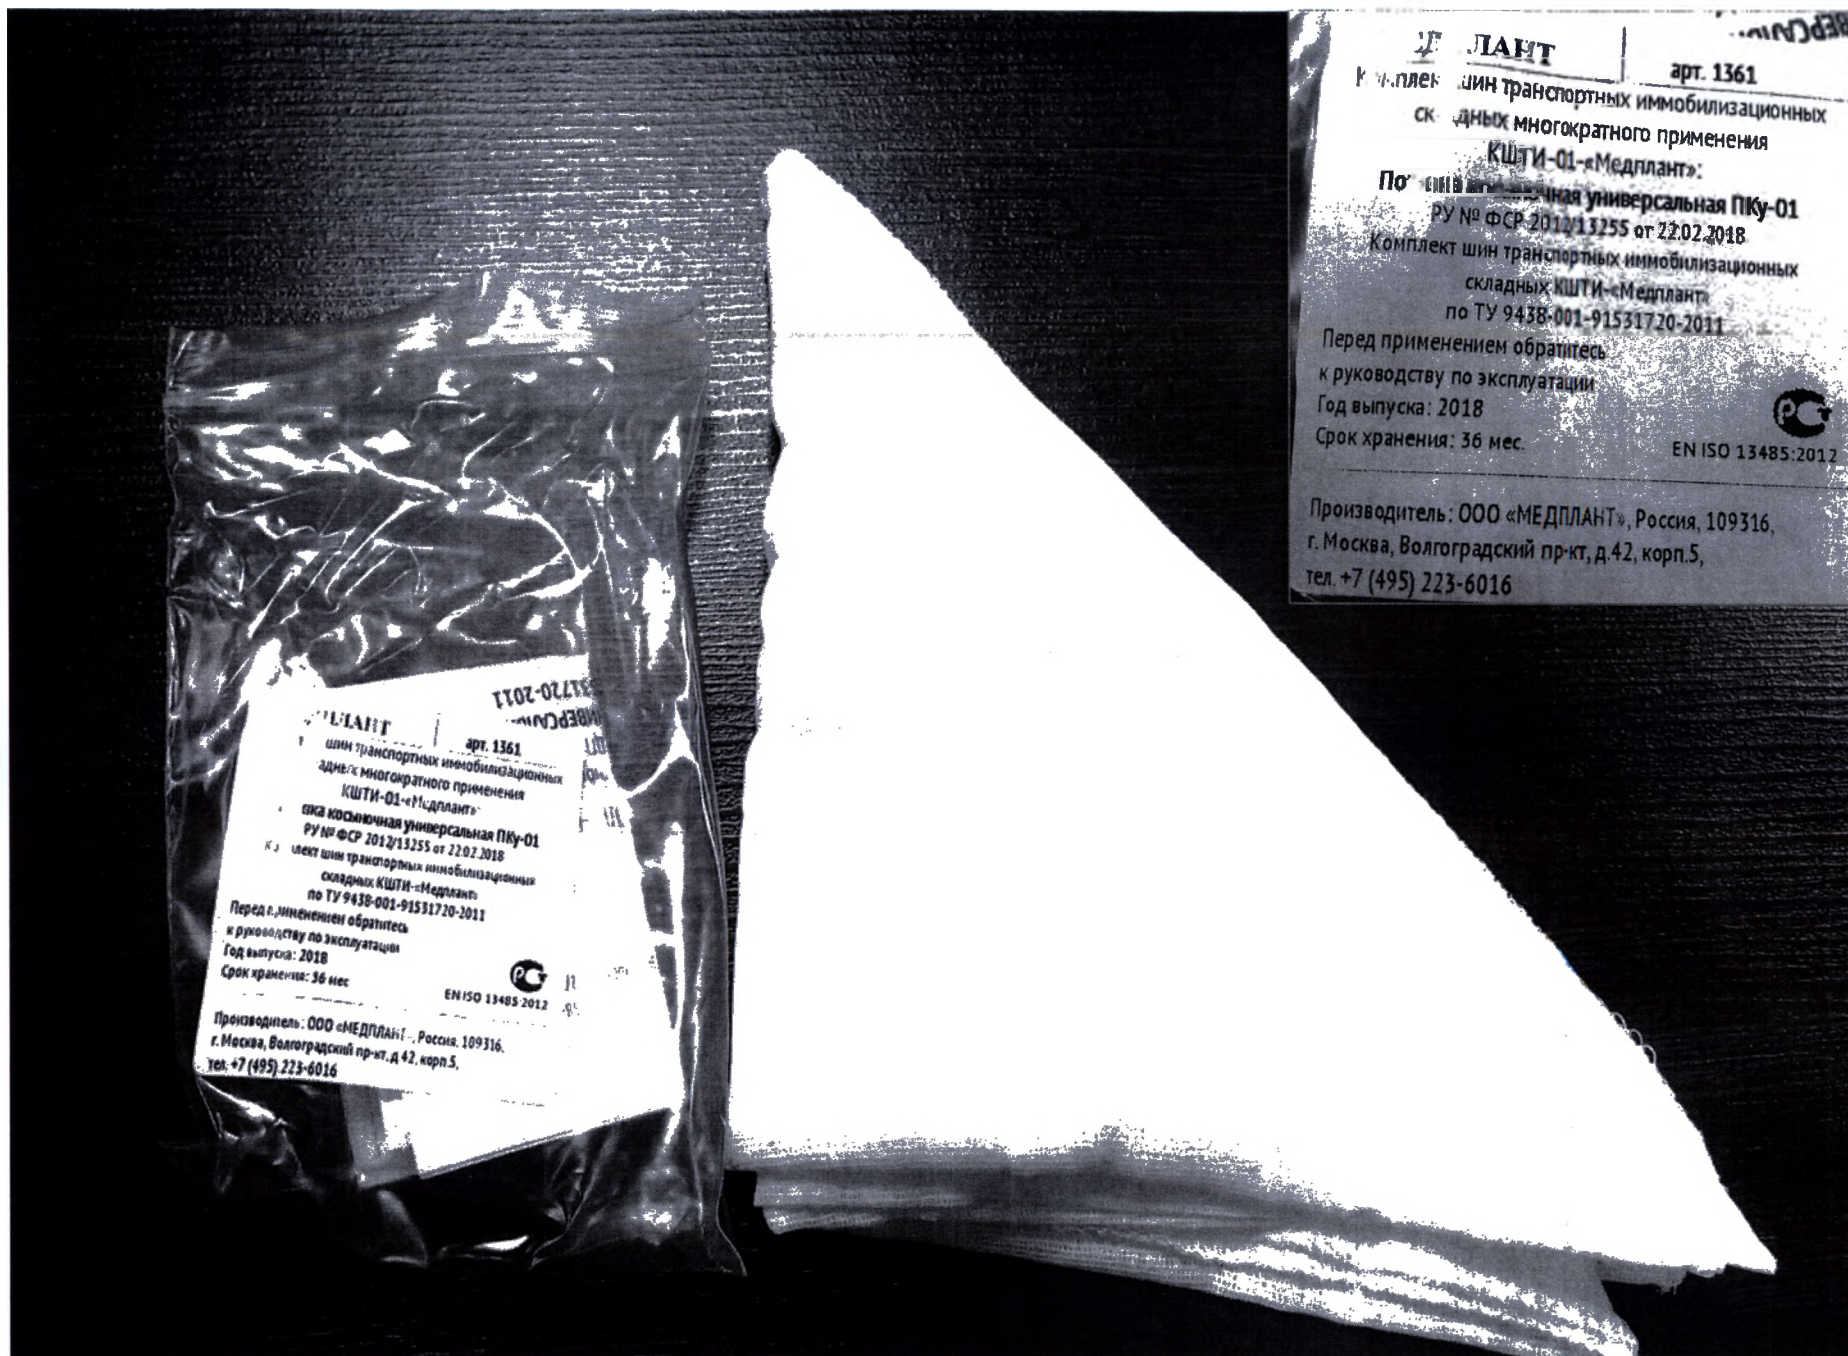


Повязка косыночная

Смотровые латексные перчатки размер М
По заказу ООО «Фарм-Глобал», Россия, г. Москва, ул.
Мясницкая, 30/1/2-стр.2.
Изготовлено: Топ Глав Сдн Бхд, (Малазия).
Рег. уд. № ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009
Дата выпуска: апрель 2018 г. Срок годности: 5 лет.
Партия №: 210028936LPZA
Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла
(температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных
лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и
озона.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: продукты, сделанные из натурального
каучукового латекса могут вызывать аллергическую реакцию.
Не предназначены для использования в качестве основной
химической защиты.

Смотровые латексные перчатки размер М
По заказу ООО «Фарм-Глобал», Россия, г. Москва, ул.
Мясницкая, 30/1/2-стр.2.
Изготовлено: Топ Глав Сдн Бхд, (Малазия).
Рег. уд. № ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009
Дата выпуска: апрель 2018 г. Срок годности: 5 лет.
Партия №: 210028936LPZA
Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла
(температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных
лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и
озона.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: продукты, сделанные из натурального
каучукового латекса могут вызывать аллергическую реакцию.
Не предназначены для использования в качестве основной
химической защиты.

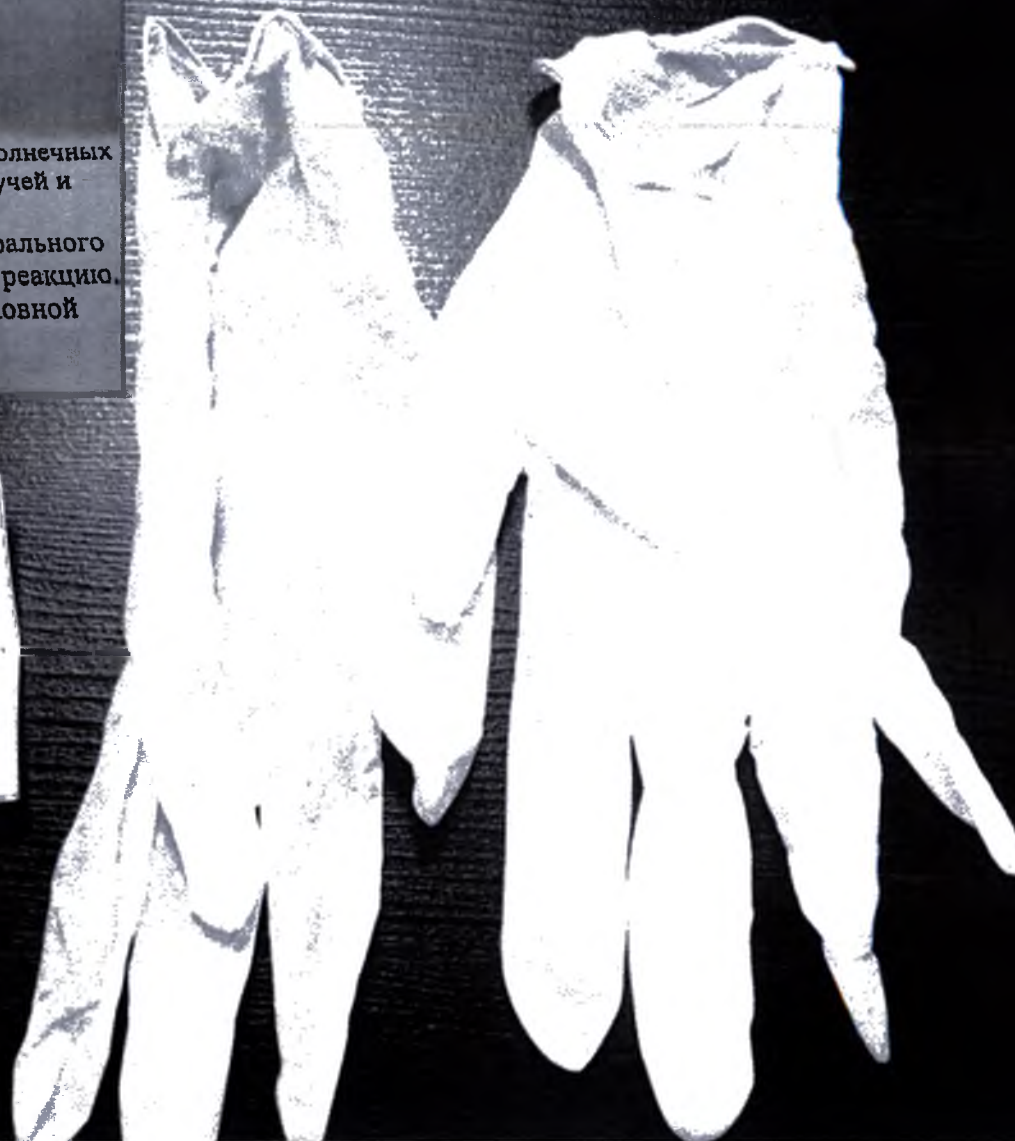

Перчатки медицинские нестерильные (пара)

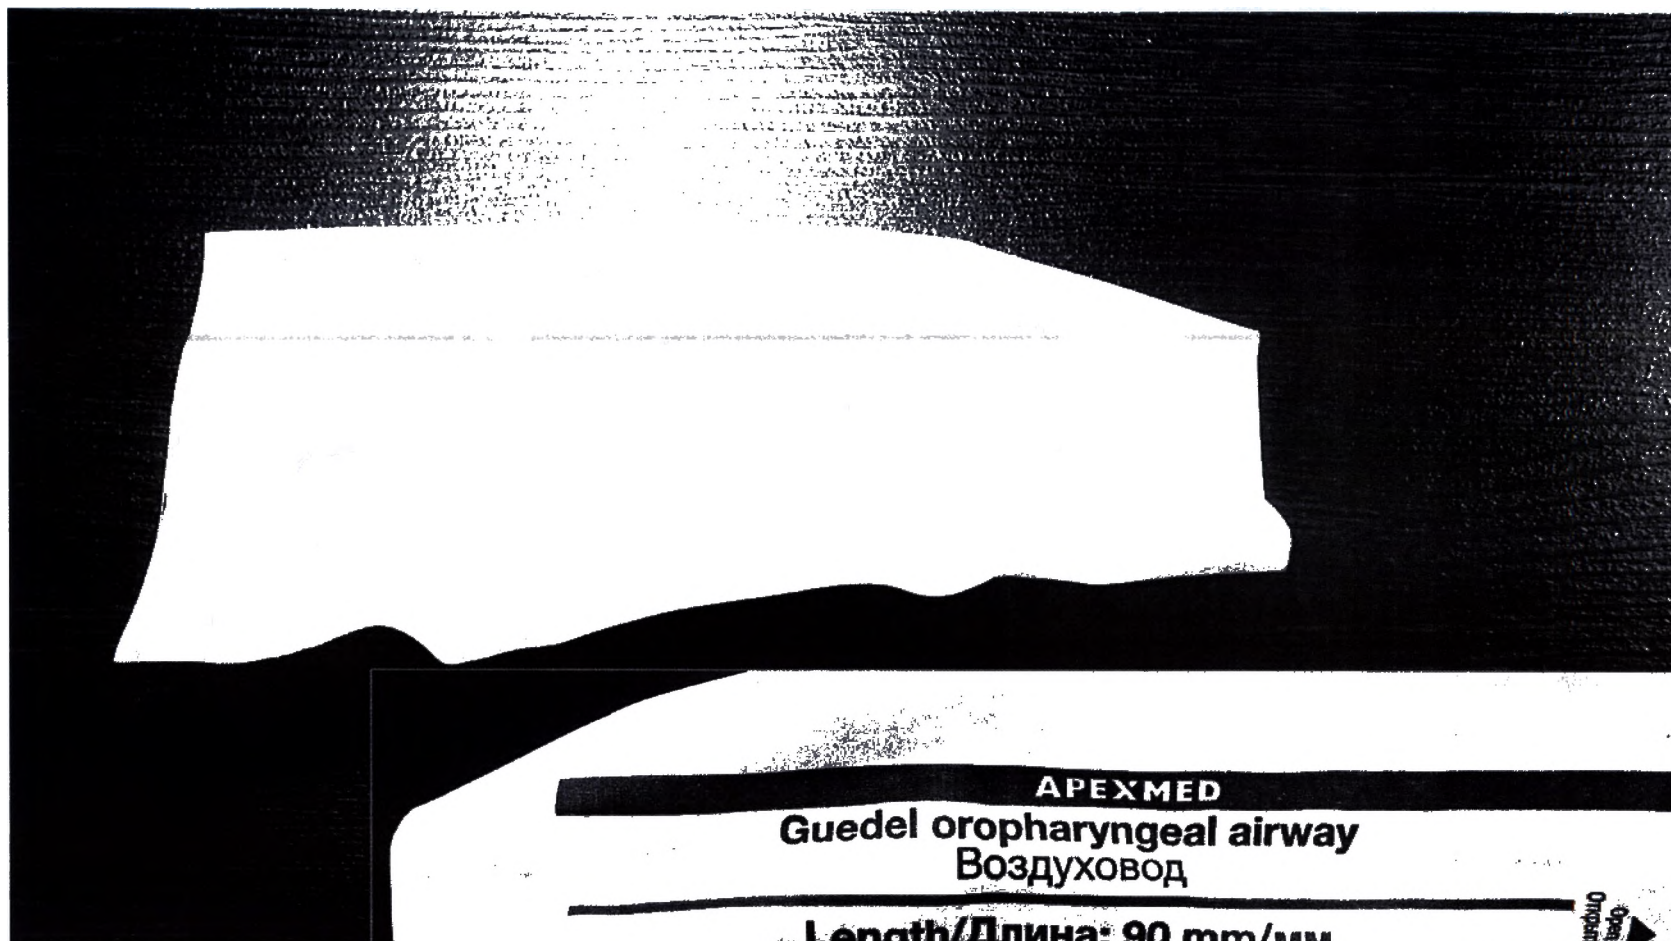

АРЕХМЕД
Guedel oropharyngeal airway
Воздуховод

Length/Длина: 90 mm/мм

Apexmed International B.V., Keizersgracht
62-64, 1015 CS, Amsterdam, the
Netherlands. Made in China (Сделано в Китае).

Организация, уполномоченная на принятие
и удовлетворение требований от потребителей
в отношении товара ненадлежащего качества:
ООО "МЕДИКОМ", ул. Космонавтов, д. 18, к. 2,
129301, Москва, Россия.

STERILE EO
NON-TOXIC

РУ № ФСЗ 2011/10188 от 21.07.2011

LOT 16655
REF 0128-00-09
2016-12
2021-11

18164 966750

Воздуховод полимерный одноразовый №3 (90 мм)



Салфетка марлевая стерильная (упаковка)

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.1» Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт)

Назначение: для дезинфекции поверхностей, обработки кожи, приборов и других.

Состав: нетканый текстиль из бумажного материала, пропитанный 70% этиловым спиртом.

Размер салфетки: 135x185 мм

Способ применения: вскрыть упаковку по линии надреза, развернуть салфетку и обработать поверхность.

Выпуск: 9393-001-5127650

Рег.удост. Роспотребнадзора № Ф.1.09/05438 от 26.07.2019

Срок годности: 12 месяцев, указан на упаковке.

Производитель: ООО «Асептика»

Юридический адрес: 125040, Россия, г. Москва, ул. Электропролетарская, д. 9, стр. 3, пом. 2. Тел.: +7(495)660-18-00. www.aseptica.ru

Условия хранения: хранить при температуре от +5°С до +40°С в недоступном для детей месте.


Не допускать воздействия на упаковку прямых солнечных лучей.

Способ утилизации: как отходы класса А или Б по СанПин 2.1.7.2790-10.



STERILE R 4 607174 650053

Салфетка спиртовая

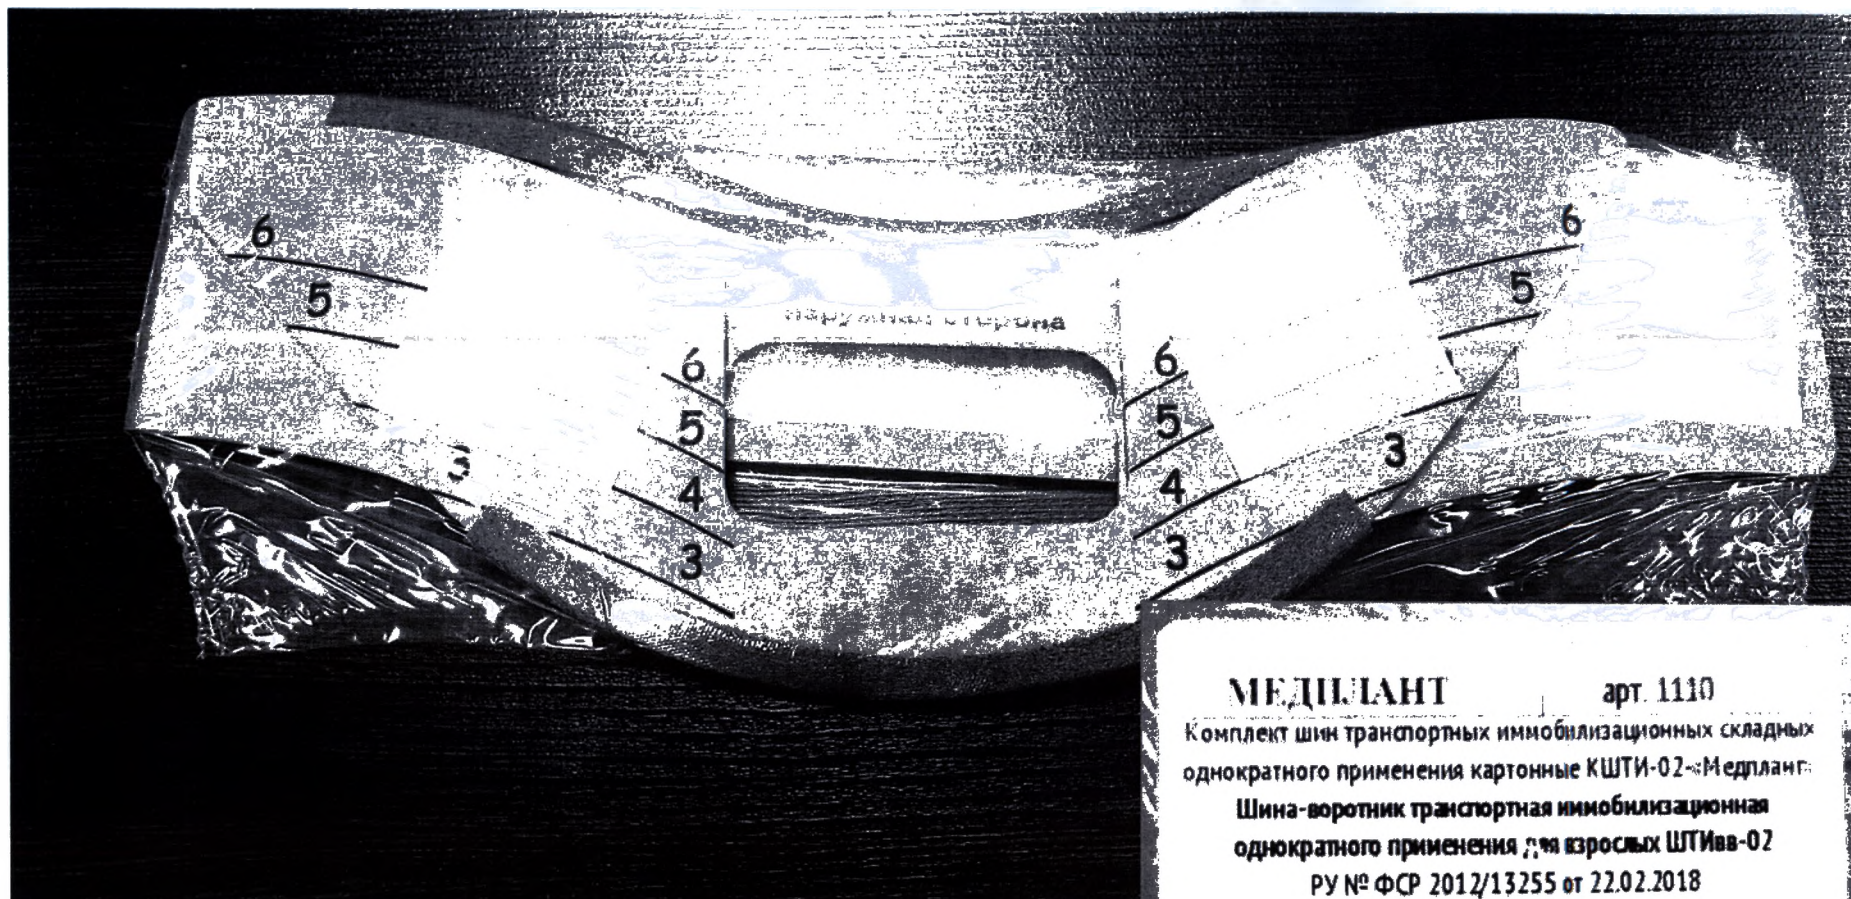

МЕДПЛАНТ

арт. 1110

Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
однократного применения картонные КШТИ-02 «Медплант»

Шина-воротник транспортная иммобилизационная
однократного применения для взрослых ШТИва-02

ПУ № ФСР 2012/13255 от 22.02.2018

Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных КШТИ «Медплант»
по ТУ 9438-001-91531720-2011

Перед применением обратитесь
к руководству по эксплуатации

Год выпуска: 2018

Срок хранения: 36 мес.


Нетоксично



EN ISO 13485:2012


Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,
тел. +7 (495) 223-6016

Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых

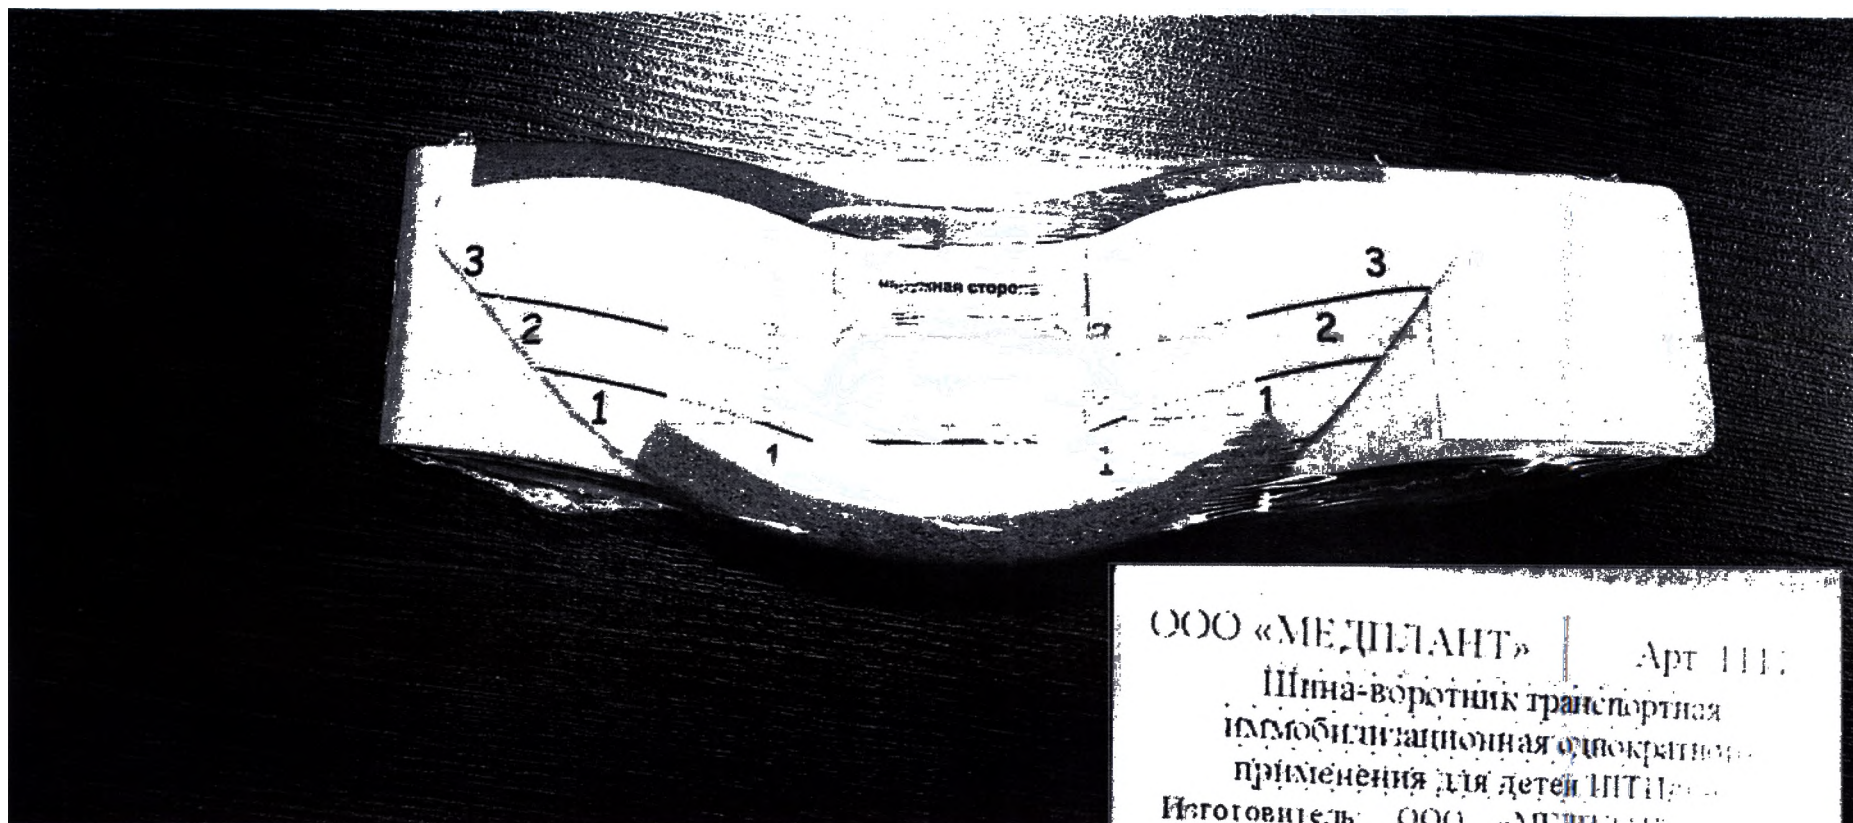

ООО «МЕДИЛАНТ» | Арт. 111
 Шина-воротник транспортная
 иммобилизационная однократного
 применения для детей ИТН
 Изготовитель: ООО «МЕДИЛАНТ»,
 109316, г. Москва, Волгоградский
 корп. 5, телефон: 8 (495) 223-6011
 Рег. уд. №ФСР 2012 13255 от 08.08.2012
 ТУ 9438-001-91531-20-2011
 «Комплект шин транспортных и
 складных
 КШПН-«Медилант»
 Подлежит утилизации как медицинский отход
 класса «Б»
 Срок хранения: 3 года
 Год выпуска: 2018 г.
 ISO 13485
 Усл. хранения: 1

Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для детей

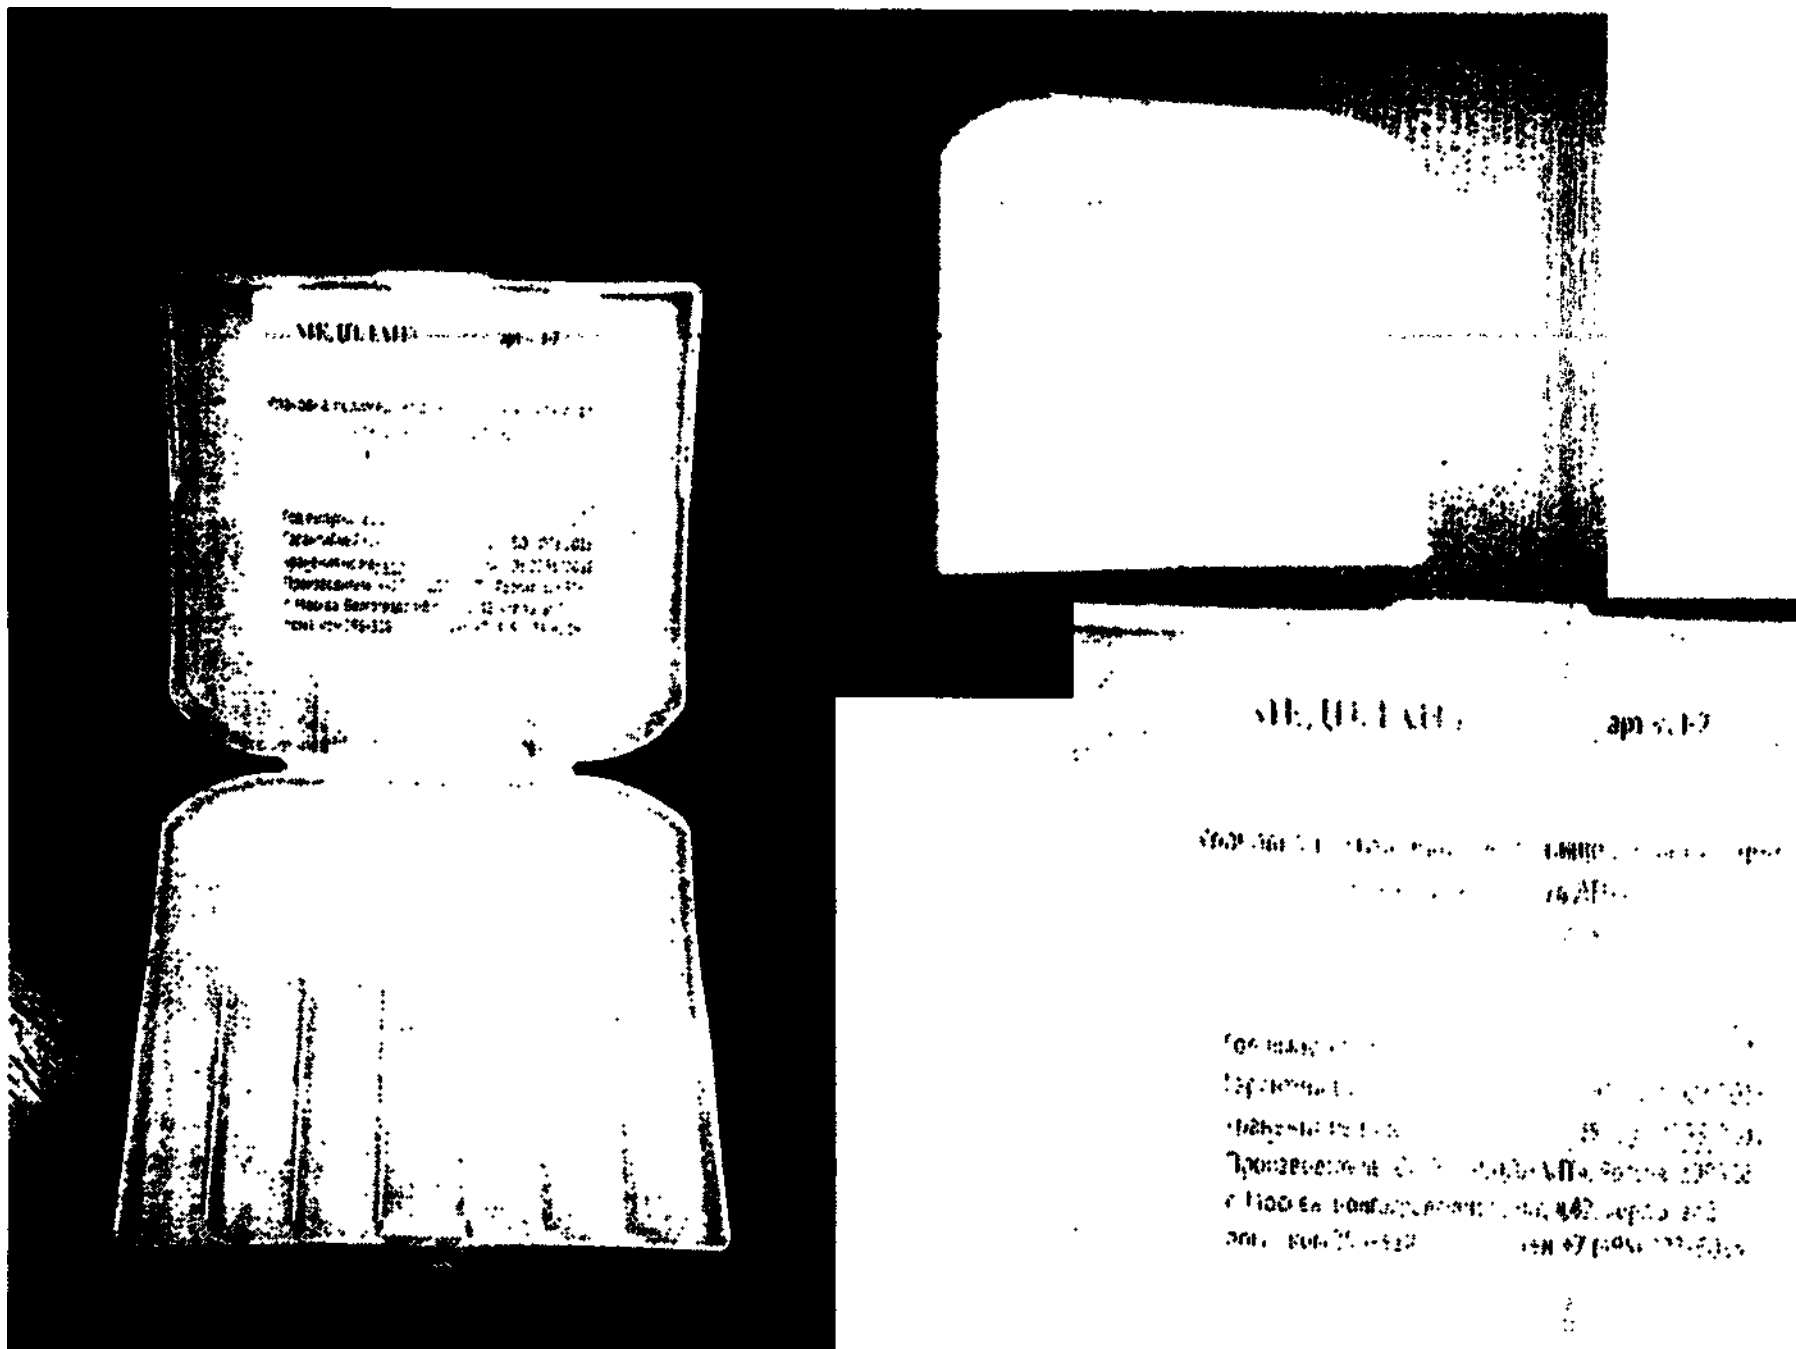

Ампульница пластиковая



Ременное устройство для переноса пострадавших



Ручка шариковая



РЕСУРСНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА
ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



Справочник по *первой* *ПОМОЩИ*

...тепительно можете оказать помощь!

Москва 2018 г.

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью -58-

цифрами

(пятьдесят восемь)

прописью

) листов

Генеральным директором ООО "МЕДПЛАНТ"

Хардина С.М. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

подпись

ХАРДИНА С.М.



Дополнения к Фотографическим изображениям медицинского изделия
Набор первой помощи НПП по ТУ 21.20.24-032-52777873-2019



Бинт эластичный рулонный


ИНТЕКС

ИНТЕКС


Бинт медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС-ЛАЙТ» средней растяжимости

Бинты нестерильные предназначены для проведения компрессионной терапии в различных областях хирургии (сердечно-сосудистой, абдоминальной, торакальной, пластической и др.), травматологии, ортопедии, спортивной медицине и других областях практического здравоохранения. Условия применения – изделия могут быть использованы в клинических, поликлинических, полевых условиях, при оказании первой медицинской помощи и в домашних условиях. 1 класс компрессии.

Состав сырья: хлопок, латекс, полиэфир.

Информацию о правилах использования см. на обороте.

Гарантийный срок службы бинта: 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения: 5 лет.



Сделано
в России

Размер/растягивается до:

10 см x 1.5 м / 3 м

Растяжимость 100%

ТУ 9393-012-46838010-2011
РД № ФСР 2007/01084 от 30.09.16
Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛ» корп.
Юр. адрес: Россия, 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, дом. 32 стр. 2 пом IV
Адрес производства: Россия, 143984,
г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5
Тел/факс: 8 (495) 528-51-09 www.intex.ru



Дата изготовления/номер партии: 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



4 605086 100385 1



Производитель: Чанчжоу Хуалянь Хеалф Дрессинг Ко., Лтд. / Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhongu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

По заказу: ООО Сана, 302008, Орел, ул. Высоковольтная, д. 2Г,

тел: +7 (4862) 44-02-92, e-mail: sanaorel@mail.ru.

Дата изготовления / Mfg date:

Срок годности / Use before:

Партия № / LOT:

01.06.2018

01.06.2023

01062018

Рег. Уд. № ФСЗ 2011/09593 от 20.04.2011

МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ

Предназначен для фиксации защитных повязок, тампонов, компрессов, зондов и катетеров.

Изготовлен из хлопчатобумажной ткани с применением каучука.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Хранить в сухом месте, при комнатной температуре.

Не токсично, однократного применения, не применять в случае нарушения целостности упаковки.



Лейкопластырь 2x500 см

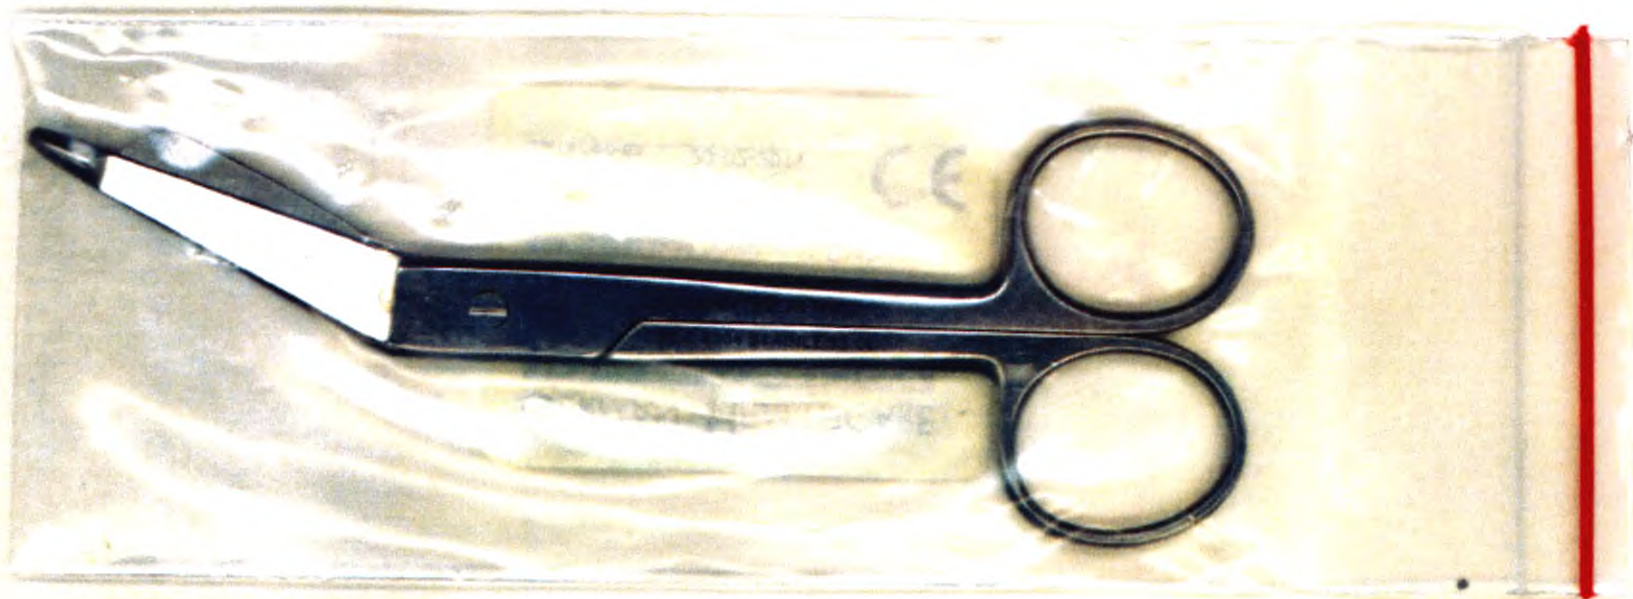

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

Текст маркировки:

ООО «ПКЦ СпецТехСбыт»

117574, г.Москва, Новоясеневский проспект, д.6, корп. 1,2

Телефон/факс: (495)660-15-47

ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ

Медицинский индивидуальный

СТЕРИЛЬНЫЙ

Дата изготовления: II кв. 2017г.


Срок годности

ГОСТ 1179-93 РУ №ФСР 2007/01319 ОТ 03.12.2007



Пакет перевязочный стерильный в герметичной упаковке



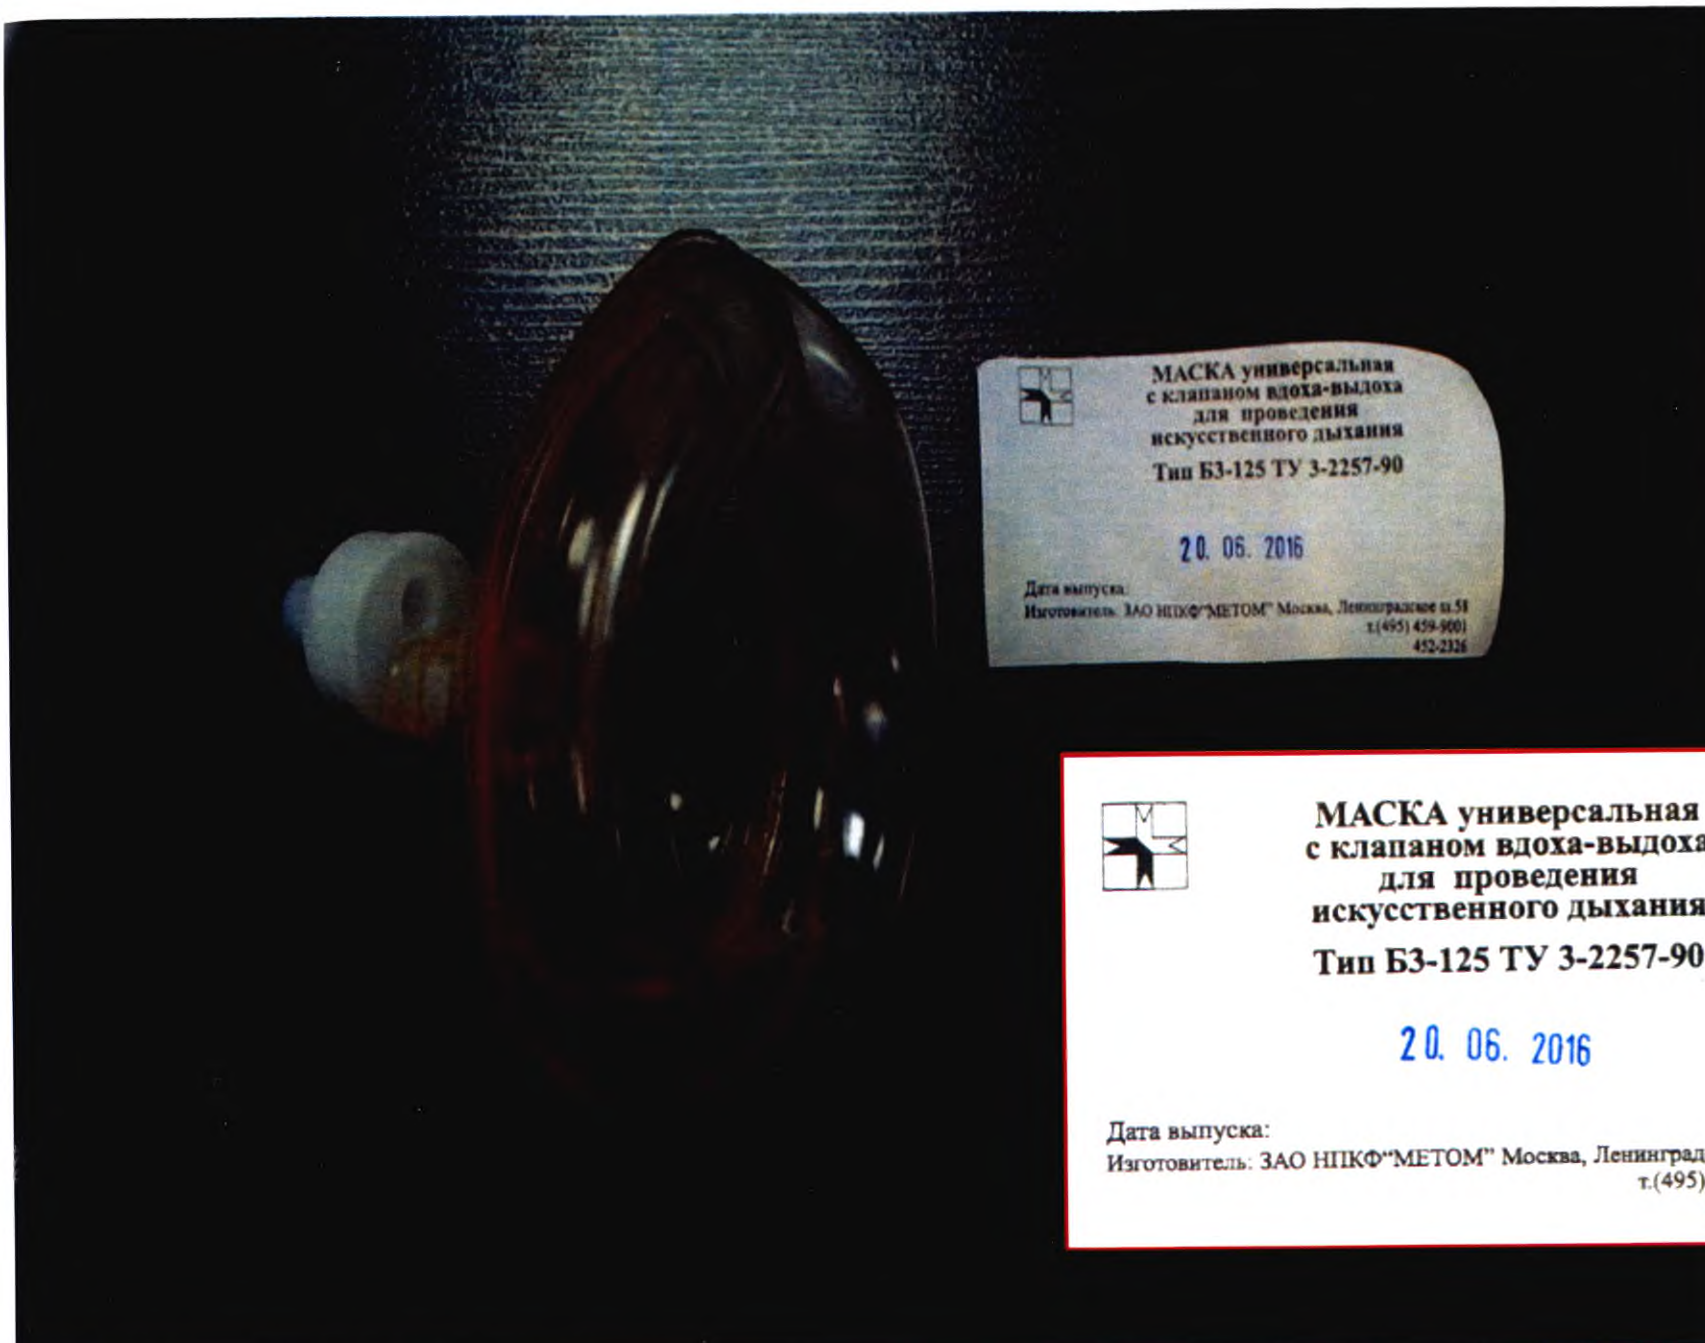


**МАСКА универсальная
с клапаном вдоха-выдоха
для проведения
искусственного дыхания
Тип БЗ-125 ТУ 3-2257-90**

20. 06. 2016

Дата выпуска:
Изготовитель: ЗАО НПКФ "МЕТОМ" Москва, Ленинградское ш.58
т.(495) 459-9001
452-2326




**МАСКА универсальная
с клапаном вдоха-выдоха
для проведения
искусственного дыхания
Тип БЗ-125 ТУ 3-2257-90**

20. 06. 2016

Дата выпуска:
Изготовитель: ЗАО НПКФ "МЕТОМ" Москва, Ленинградское ш.58
т.(495) 459-9001
452-2326

Устройство для проведения искусственного дыхания

Бинт медицинский 5м x 10см стерильный

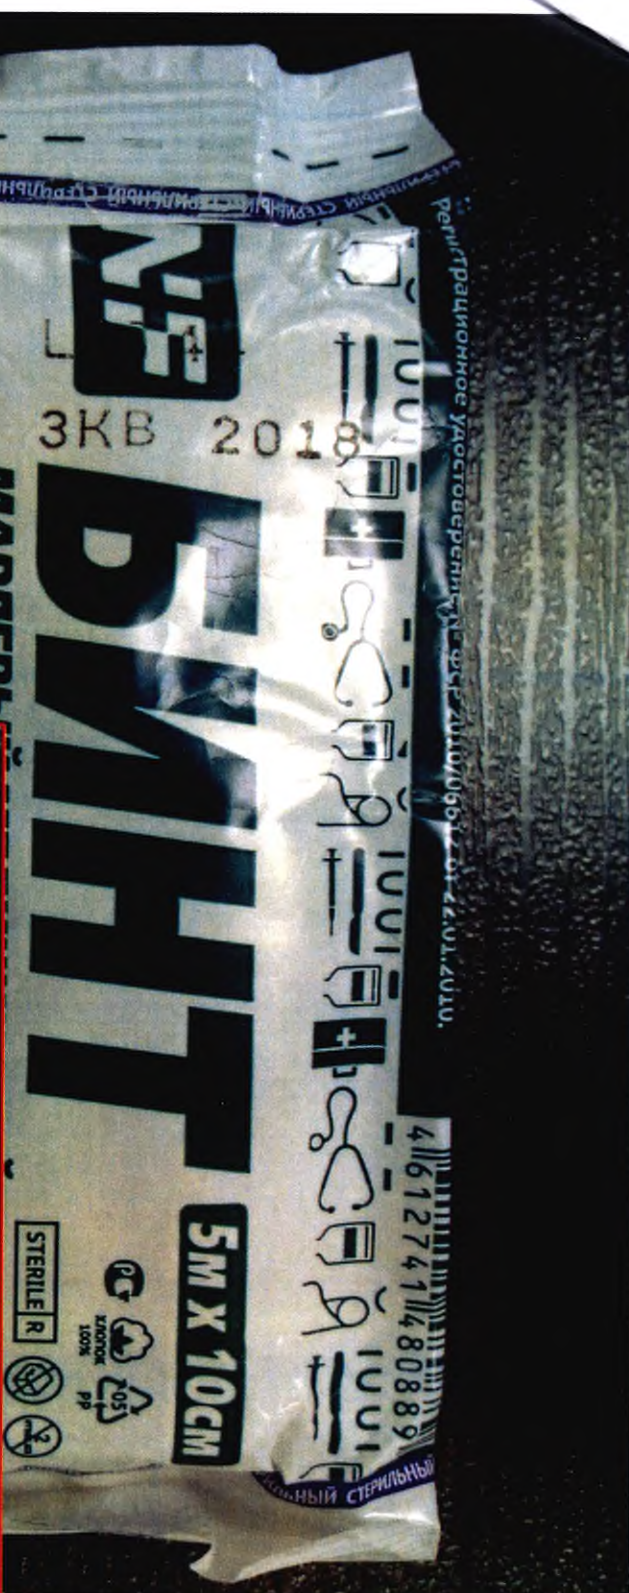



Покрывало спасательное





Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое

СТЕРИЛЬНО

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГИДРОГЕЛЕВОЕ, ПРОТИВООЖГОВОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ «ЛЮКСАЗИН-СП»
Обладает охлаждающим, обезболивающим, бактериостатическим действием.

Состав:

Биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксиэтанолом и лидокаином, нанесенный на салфетку из нетканого полотна, в индивидуальной упаковке.

Назначение:

Для оказания первой помощи при ожогах (I-II), в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых.

Порядок применения:

При ожогах I-II степени, в том числе радиационных сразу после возникновения - обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации.

При укусах насекомых: обработать место укуса.

Противопоказания: Гиперчувствительность к компонентам изделия.

Побочные действия: Аллергические реакции.

ТУ 21.20.24-002-18152288-2015

РУ № ФСР 2010/08888

Условия хранения:

Хранить при температуре от -5 °C до +40 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Утилизация:

Образующиеся отходы и отработанные изделия (салфетка) складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Г и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.



Сведения о производителе:

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России

141402, Московская область,
г. Химки, Вашутинское шоссе, 11

тел./факс: +7 (495) 789-6555

info@atompharm.ru


WWW.LIOXAZIN.RU



STERILE R



Номер партии, дата изготовления и дата окончания срока годности:
указаны на шве упаковки.
Для однократного применения

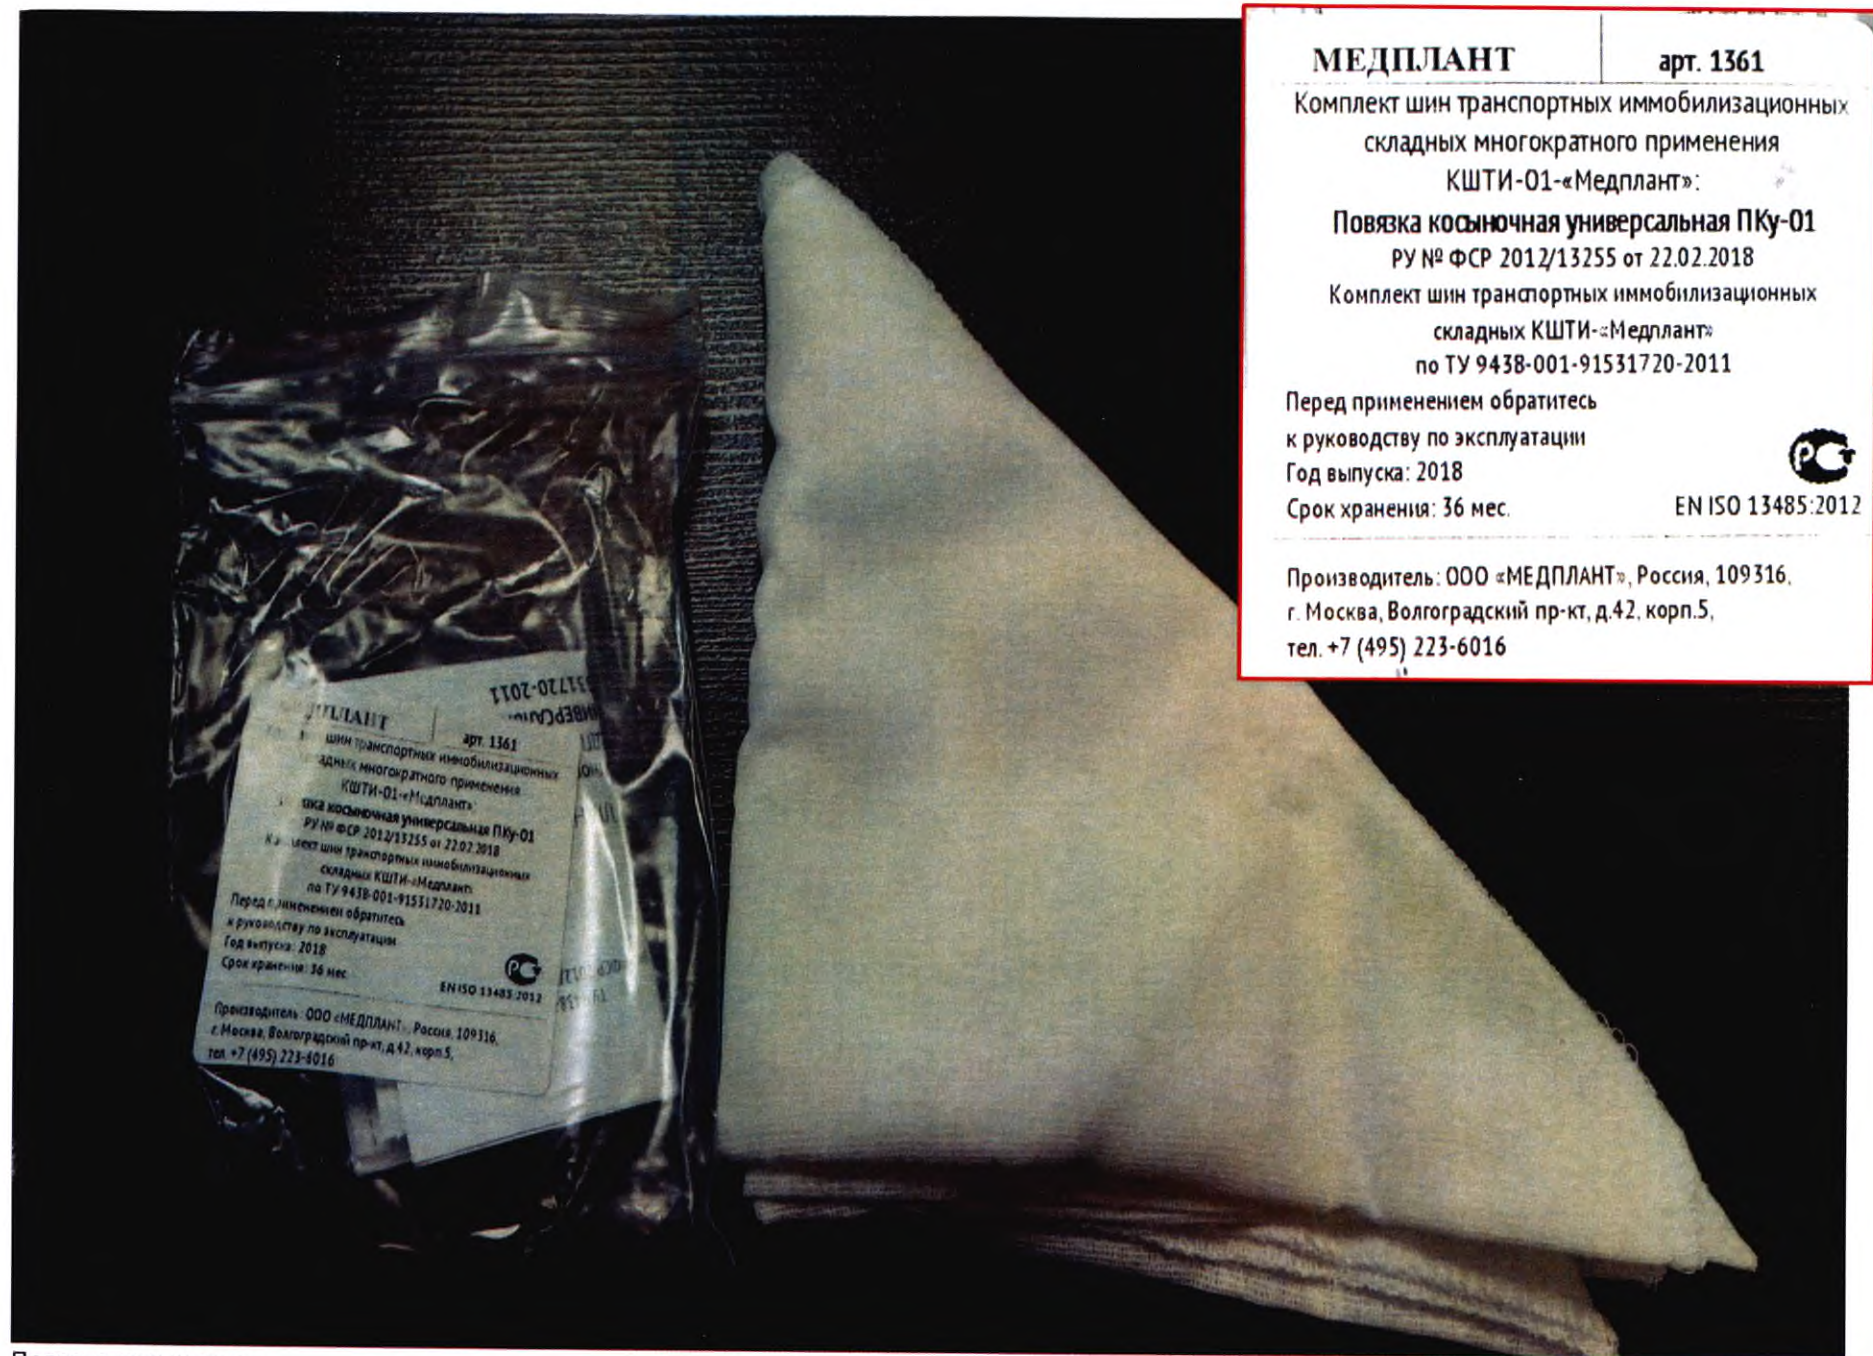

Повязка косыночная

МЕДПЛАНТ

арт. 1361

Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных многократного применения
КШТИ-01-«Медплант»:

Повязка косыночная универсальная ПКУ-01

ПУ № ФСР 2012/13255 от 22.02.2018

Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных КШТИ-«Медплант»
по ТУ 9438-001-91531720-2011

Перед применением обратитесь

к руководству по эксплуатации

Год выпуска: 2018

Срок хранения: 36 мес.



EN ISO 13485:2012

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,
тел. +7 (495) 223-6016

МЕДПЛАНТ
арт. 1361
шин транспортных иммобилизационных
складных многократного применения
КШТИ-01-«Медплант»
повязка косыночная универсальная ПКУ-01
ПУ № ФСР 2012/13255 от 22.02.2018
Комплект шин транспортных иммобилизационных
складных КШТИ-«Медплант»
по ТУ 9438-001-91531720-2011
Перед применением обратитесь
к руководству по эксплуатации
Год выпуска: 2018
Срок хранения: 36 мес.
EN ISO 13485:2012
Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5,
тел. +7 (495) 223-6016

МЕДПЛАНТ

арт.1307

Ампульница пластиковая АП-2

РУ № РЗН 2019/8866 от 05.09.2019

Ампульницы тканевые АМ и пластиковые АП
по ТУ 32.50.13-026-52777873-2018

Дата выпуска: III кв.2019г.

Гарантийный срок хранения: не менее 3-х лет

EN ISO 13485: 2016


Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом
I, ком.296-318. тел. +7 (495) 223-6016





Ременное устройство для переноса пострадавших

Средство для каменения пострадавших из-под завалов
ТТТ - «МЕДЛАНТ»
РП № РЭН 2016/3882 от 01.04.2016
Носители «Волокныш»
по ТУ 9451-020-5277873-2015
Перед применением обратитесь к инструкции по эксплуатации
Гарантийный срок службы: 6 мес.
EN ISO 13485: 2016

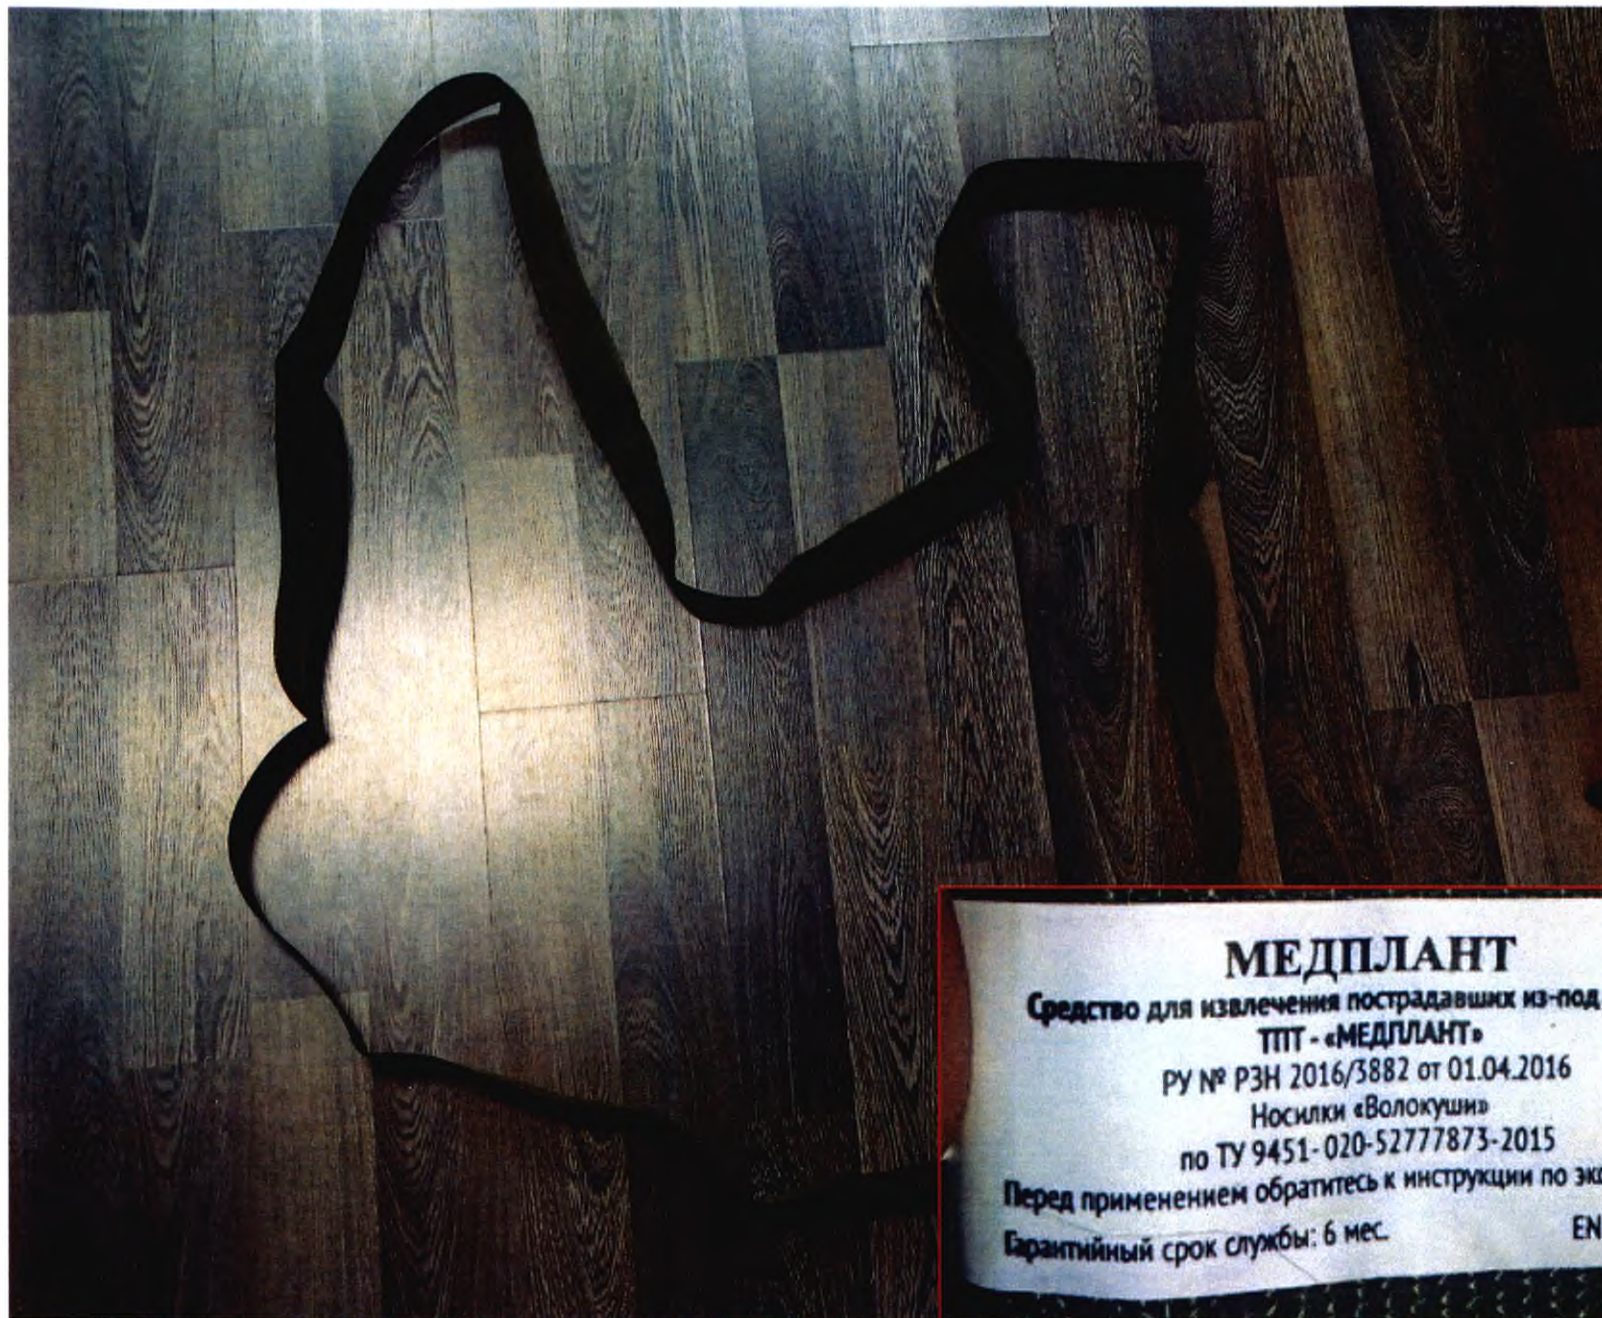

Средство для извлечения пострадавших из-под завалов

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью _____

- 13 -

цифрами

(*т. Хардина*) _____

подписью

_____) листов

Генеральный директор ООО "МЕДИАЛАНТ"

Хардина С.М.

подпись

