

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дрегер»,

Харитонов А.А.

М.П.



« 02 » Октября 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Светодиодная лампа для фототерапии BiliLux с принадлежностями

ООО «Дрегер»

Юридический адрес:
107061 г. Москва, Площадь
Преображенская, дом 8, эт.
12, пом. LIII

Тел.: +7 495 775-15-20(22)
Факс: +7 495 775-15-21
www.draeger.ru

Фактический адрес:

Преображенская площадь, д.8,
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж
Москва, Россия, 107061

Сервисный центр:
Электрозаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
Почтовый адрес:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com


Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com



Лампа для фототерапии BiliLux (вид сверху).

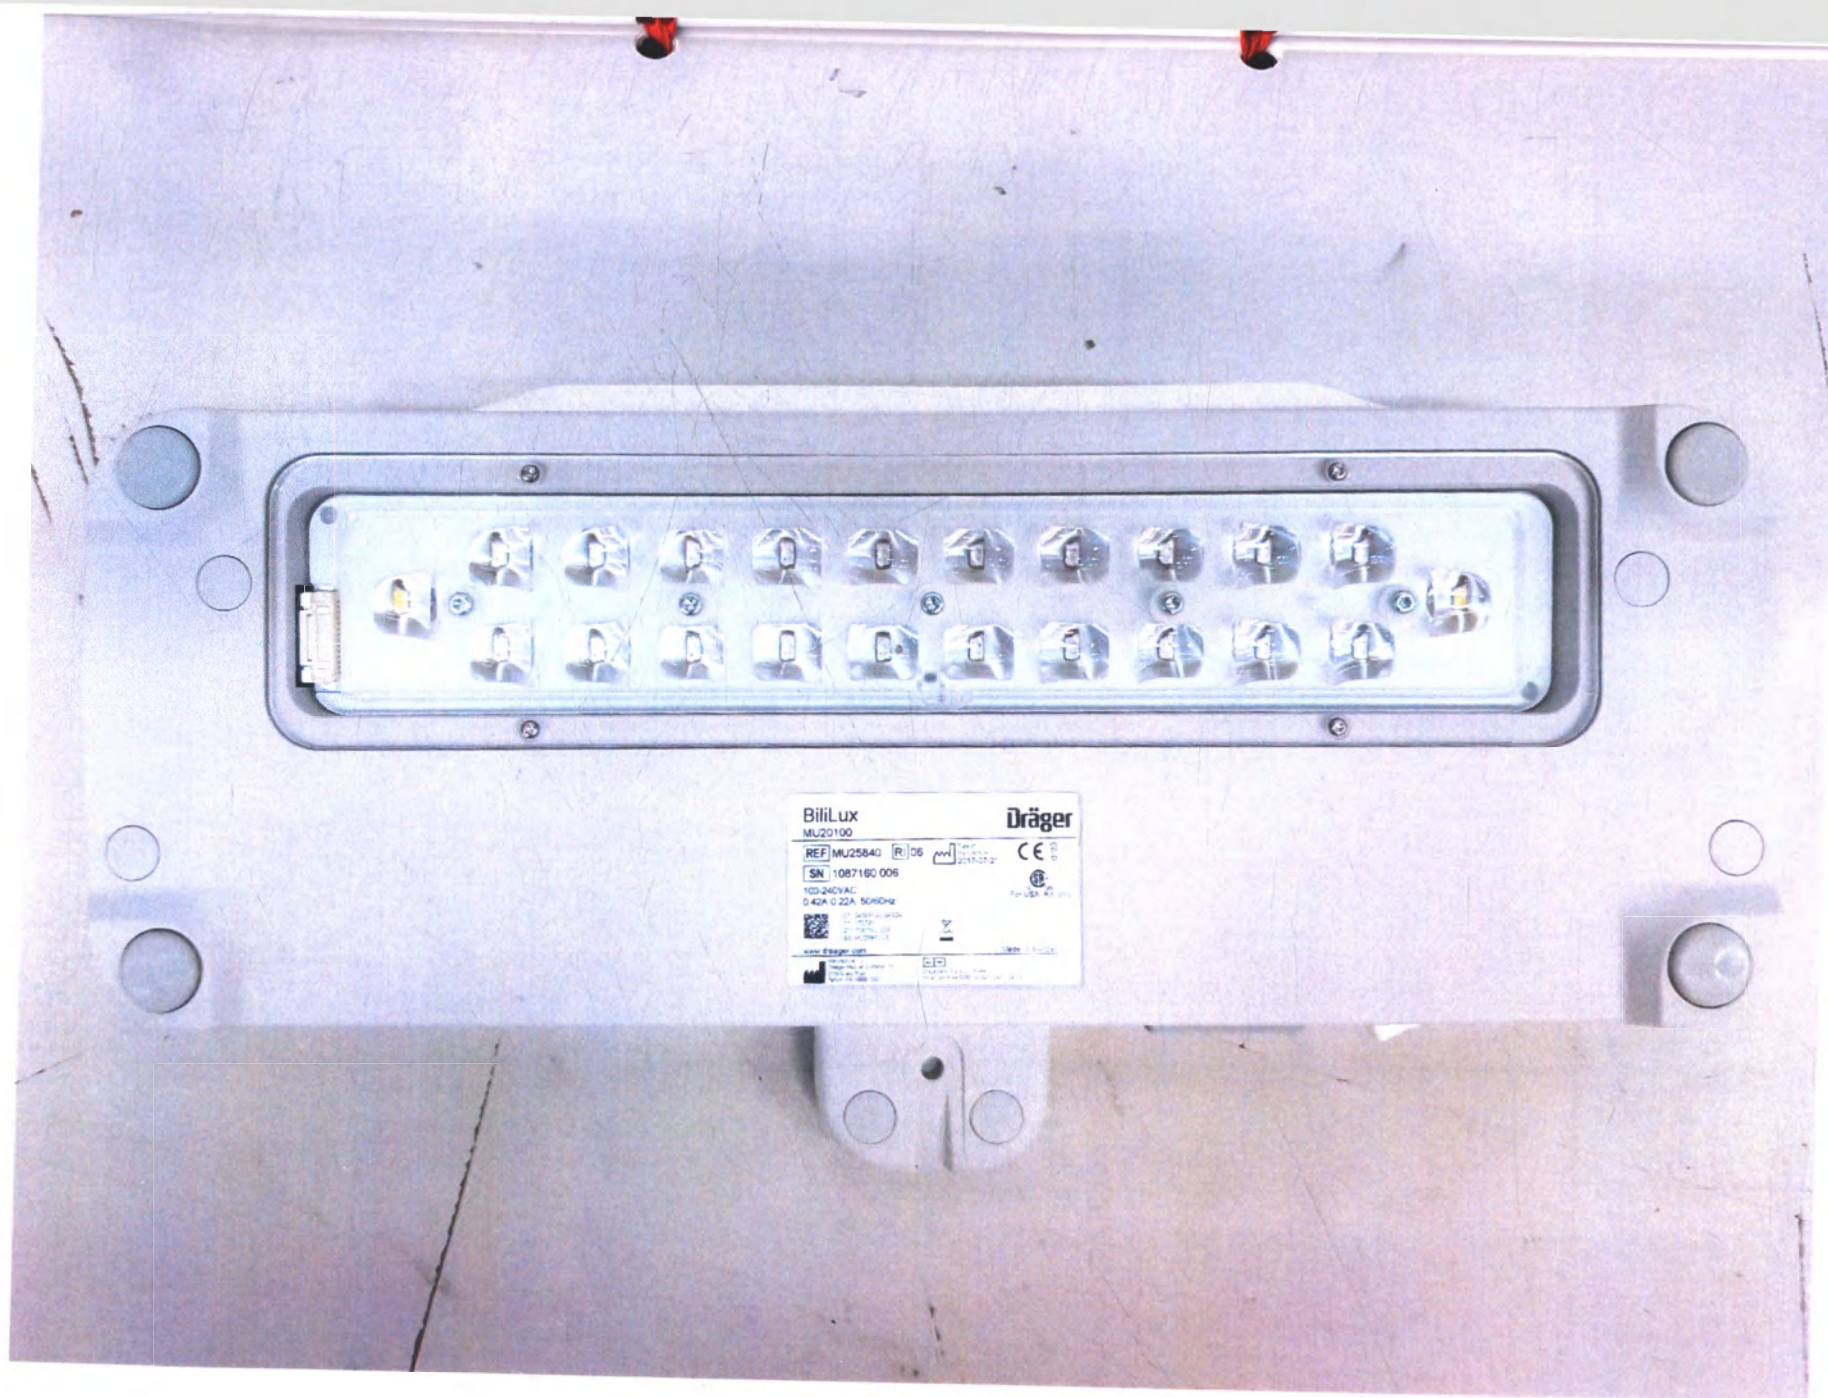


Лампа для фототерапии BiliLux (вид снизу).

BiliLux
MU20100

Dräger

REF MU25840 **RI** 06



Date of
manufacture
2017-07-21

CE 0123

SN 1087160 006

100-240VAC
0.42A-0.22A, 50/60Hz



For USA: RX only



(01) 04049098094924
(11) 170721
(21) 1087160 006
(93) MU25840-06




www.draeger.com

Made in Switzerland



Manufacturer
Dräger Medical Systems, Inc
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969




Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Germany






Лампа для фототерапии BiliLux (упаковка).



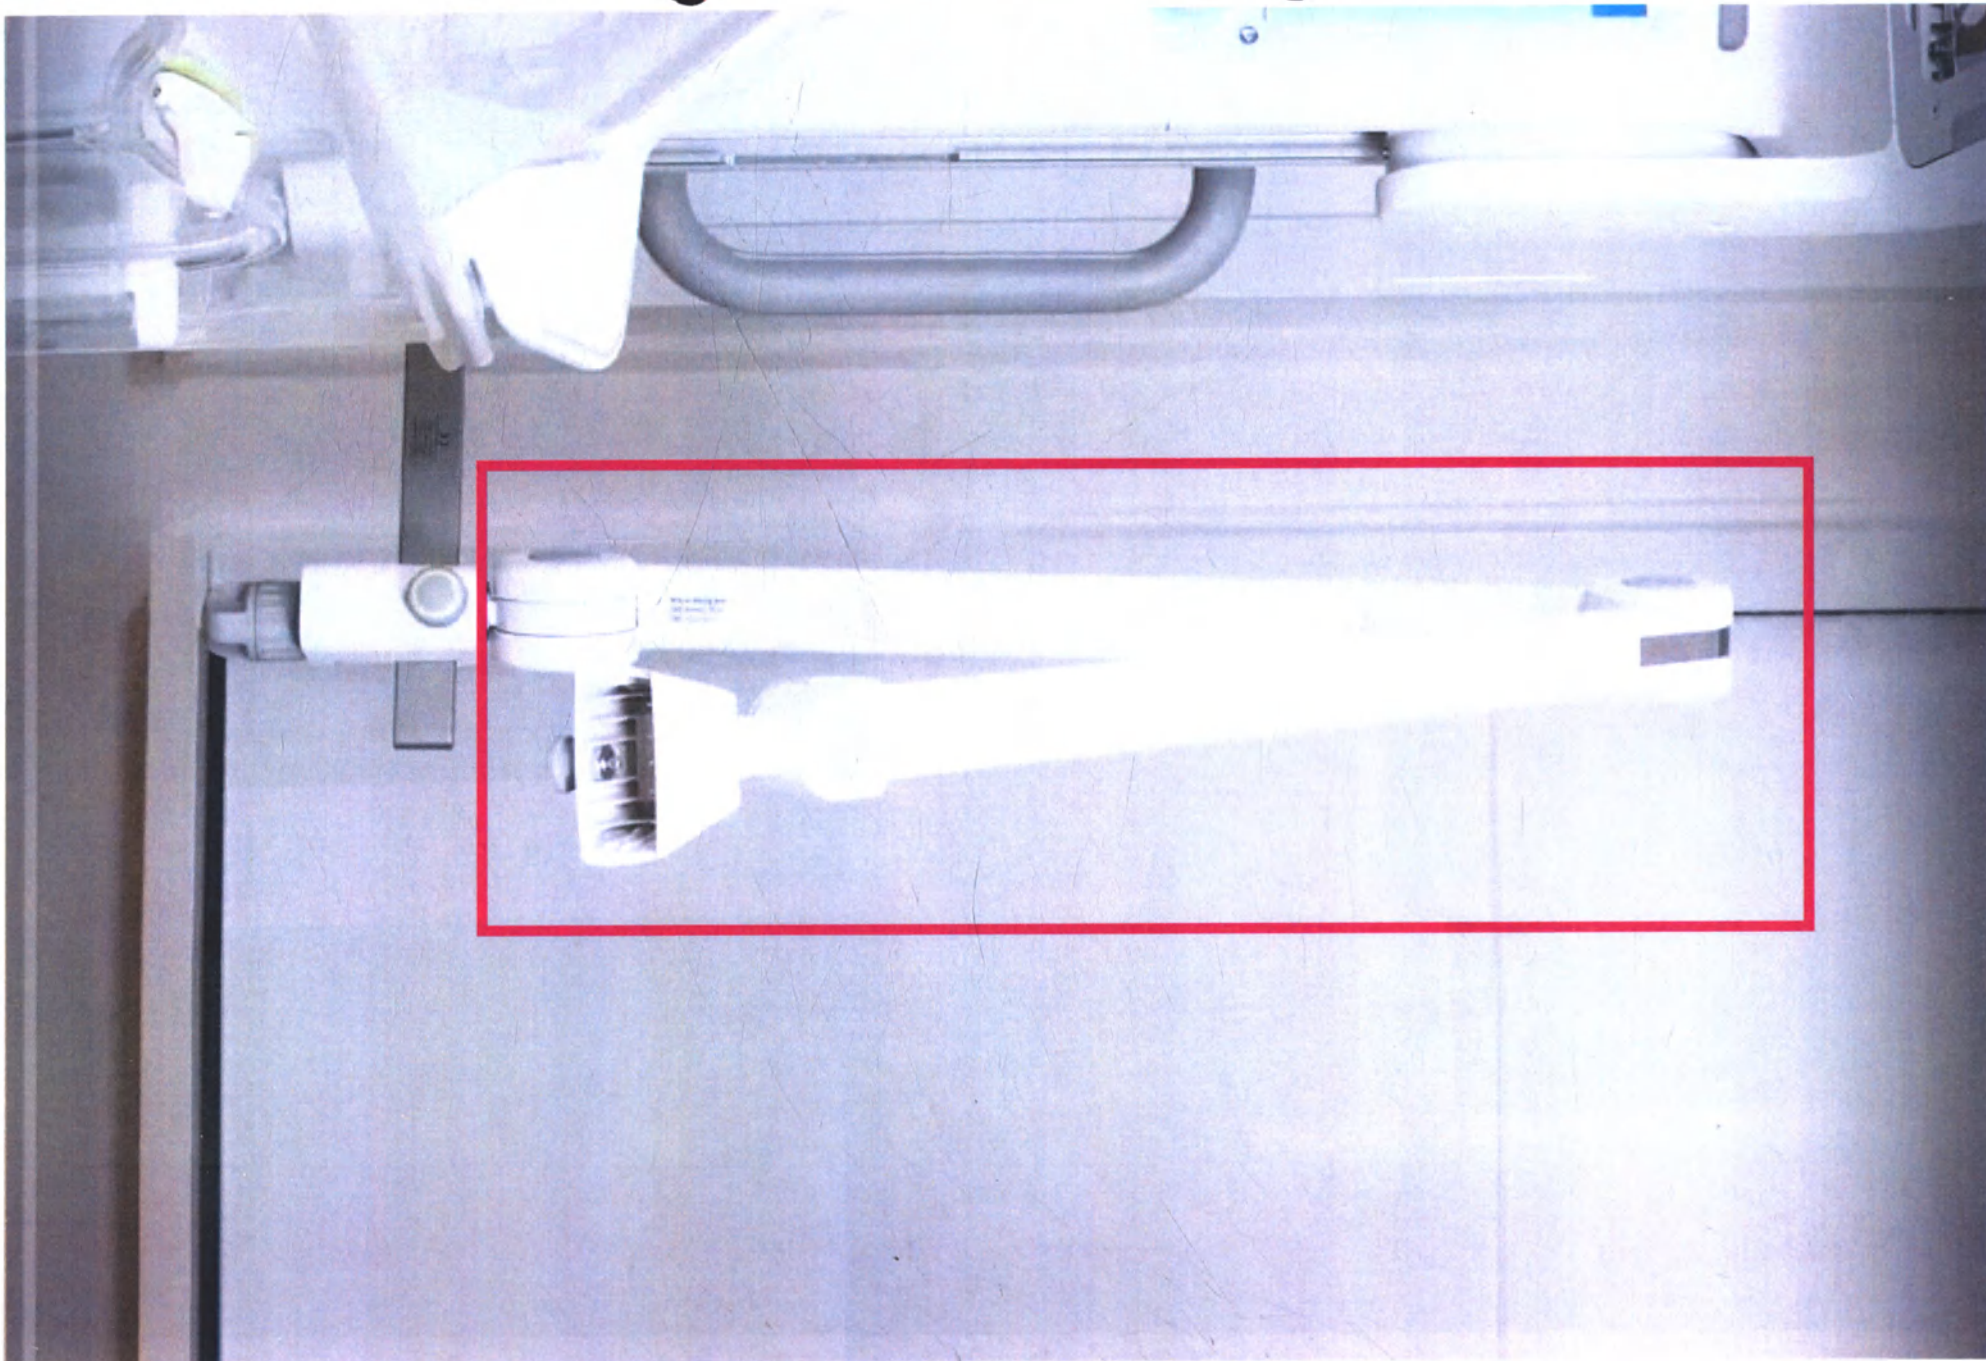

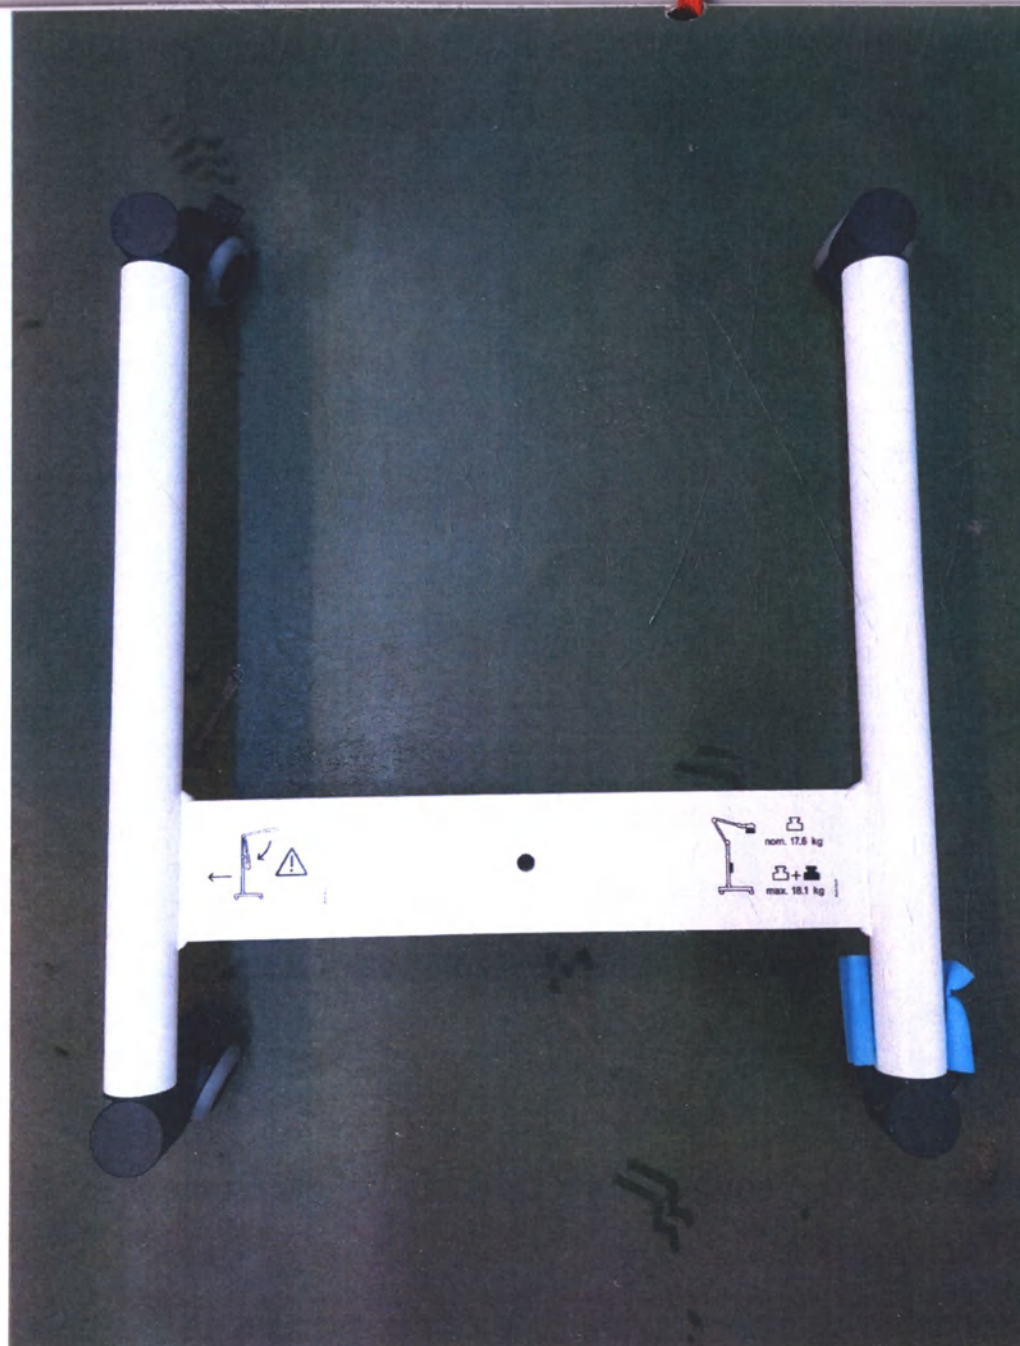

Руководство по эксплуатации **BiliLux**




Руководство по эксплуатации на русском языке.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для надлежащего применения этого медицинского аппарата изучите и соблюдайте данные инструкции по эксплуатации.


**Светодиодная лампа для
фототерапии BiliLux с
принадлежностями**

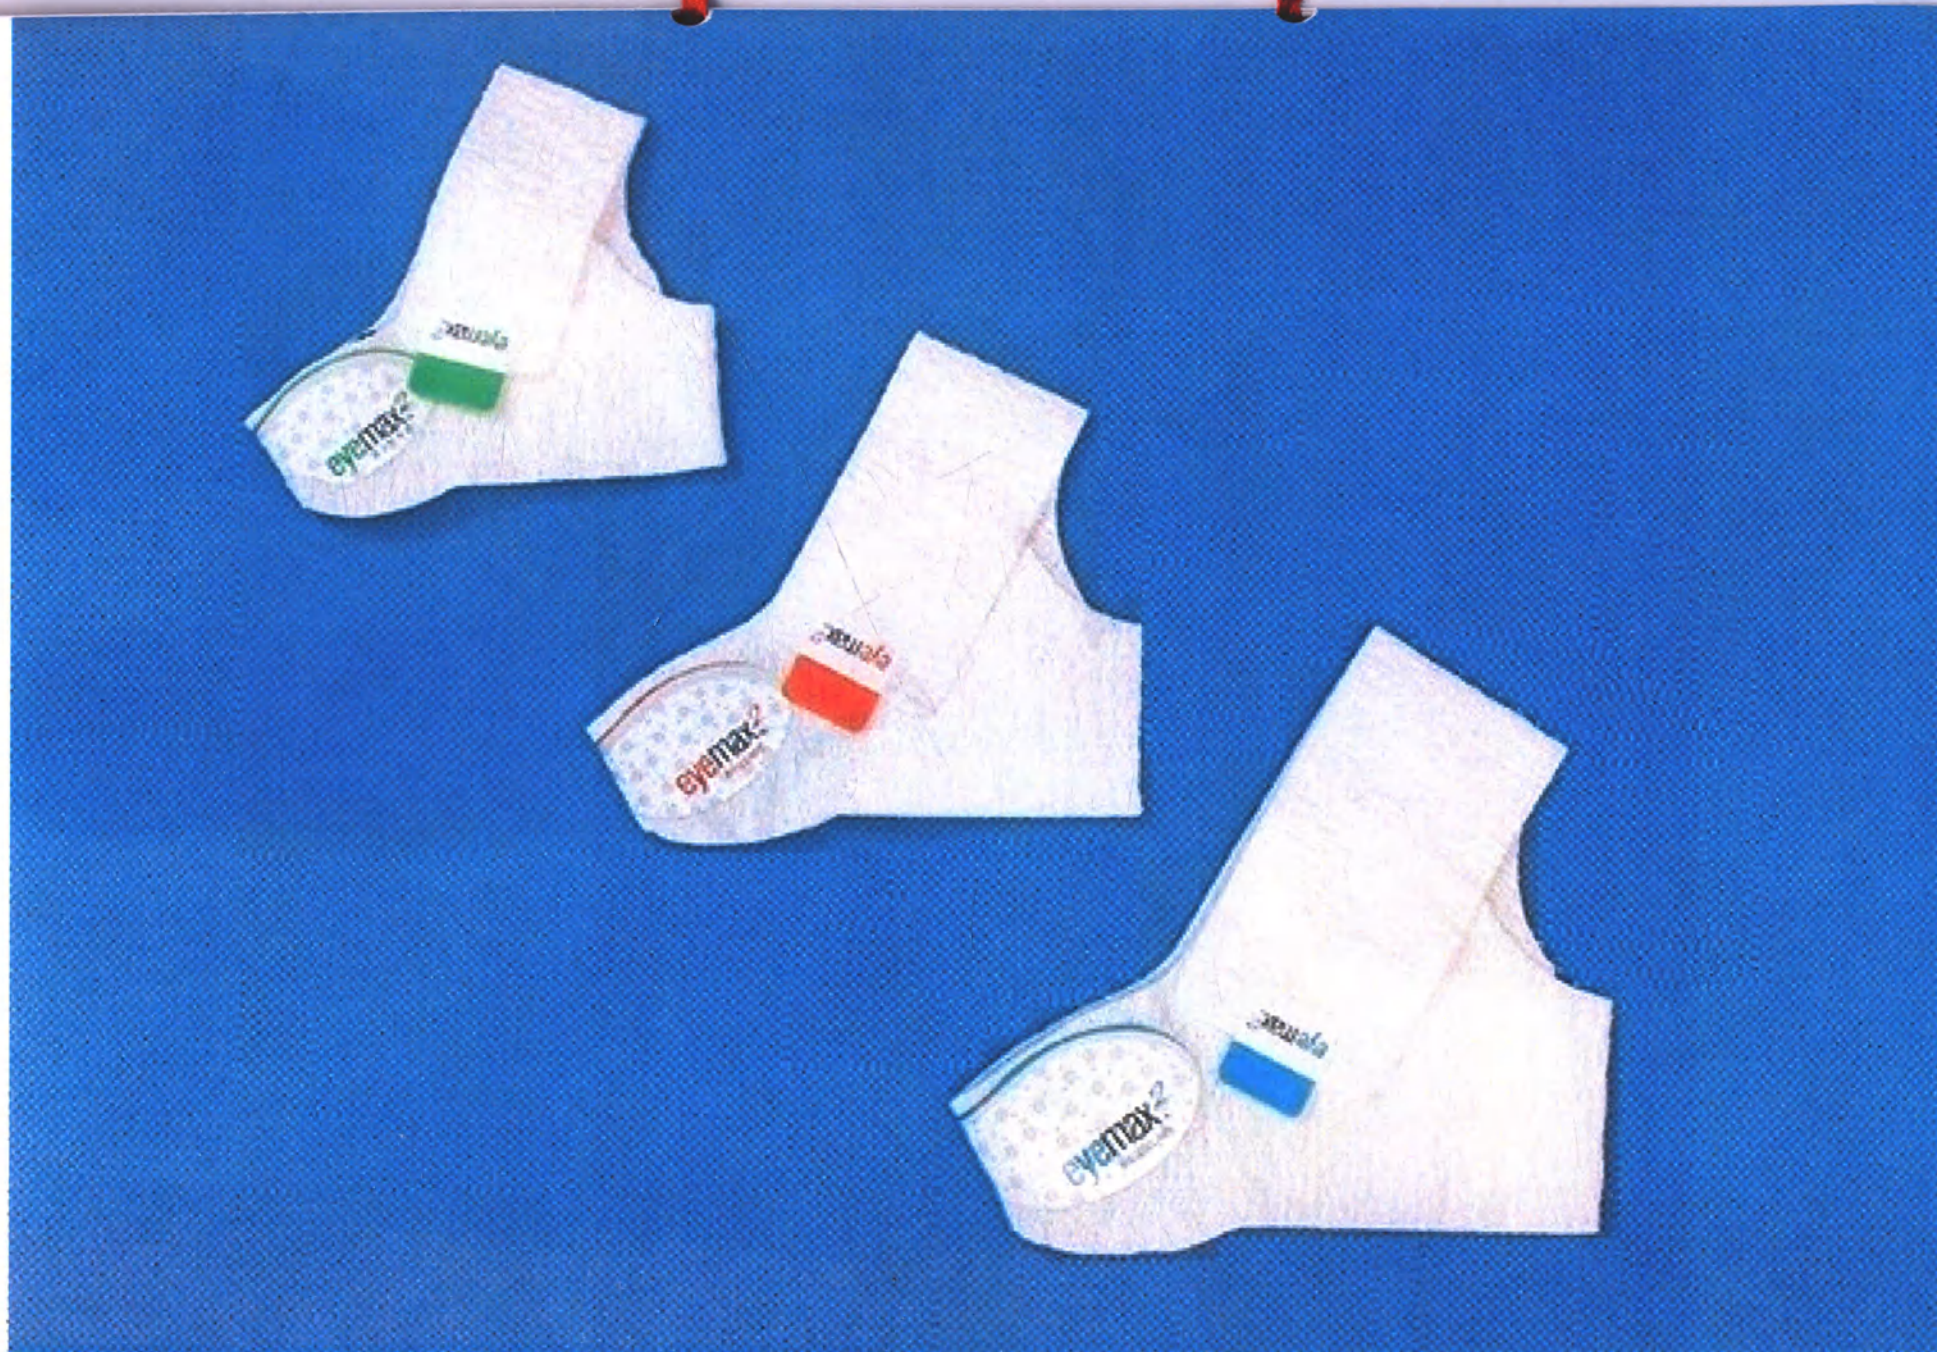



Маски для фототерапии Еуемах 2, одноразовые (размер микро, для недоношенных, стандартная).

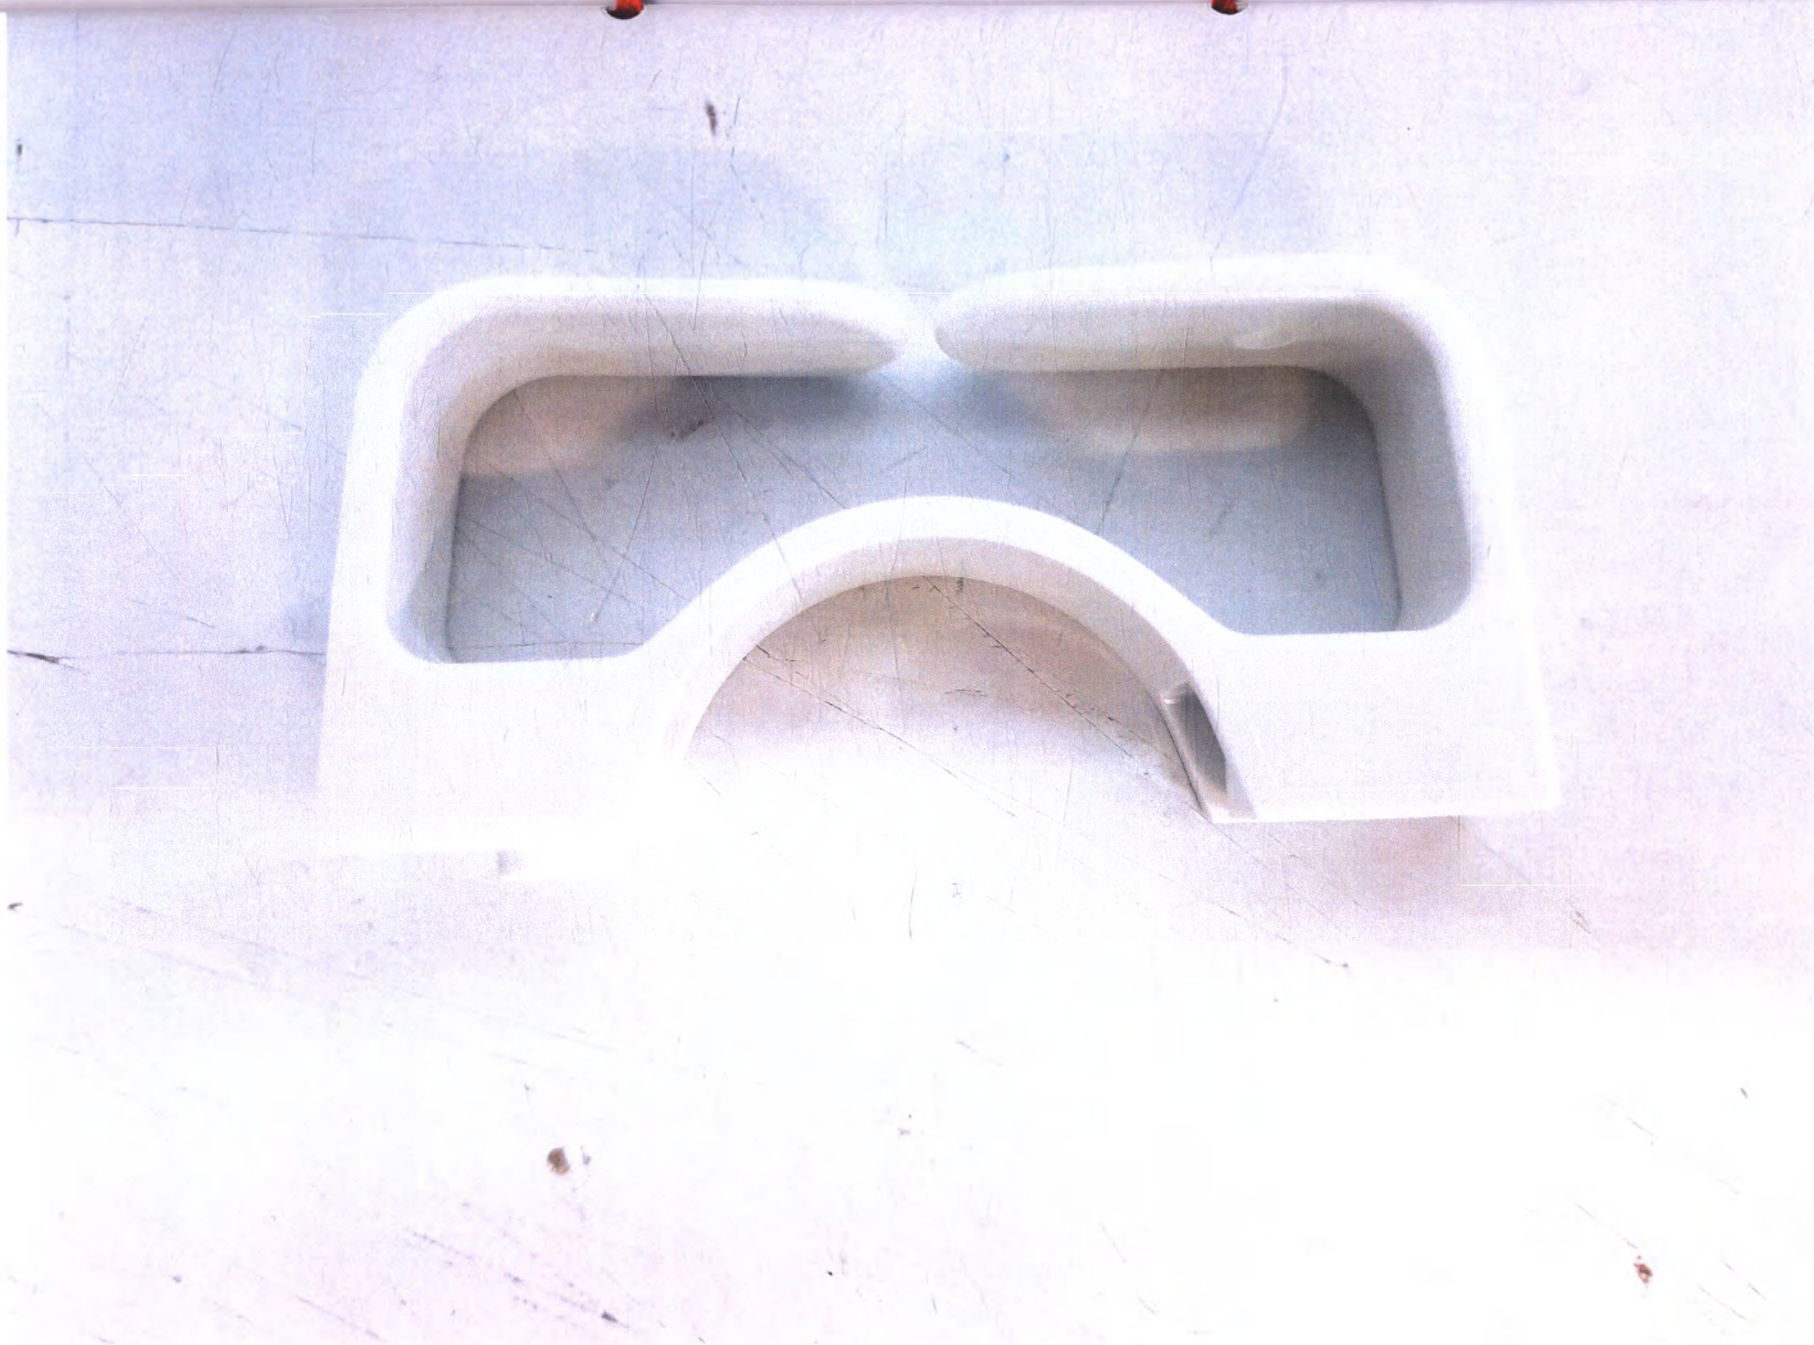


Держатель кабеля для штанги тележки.

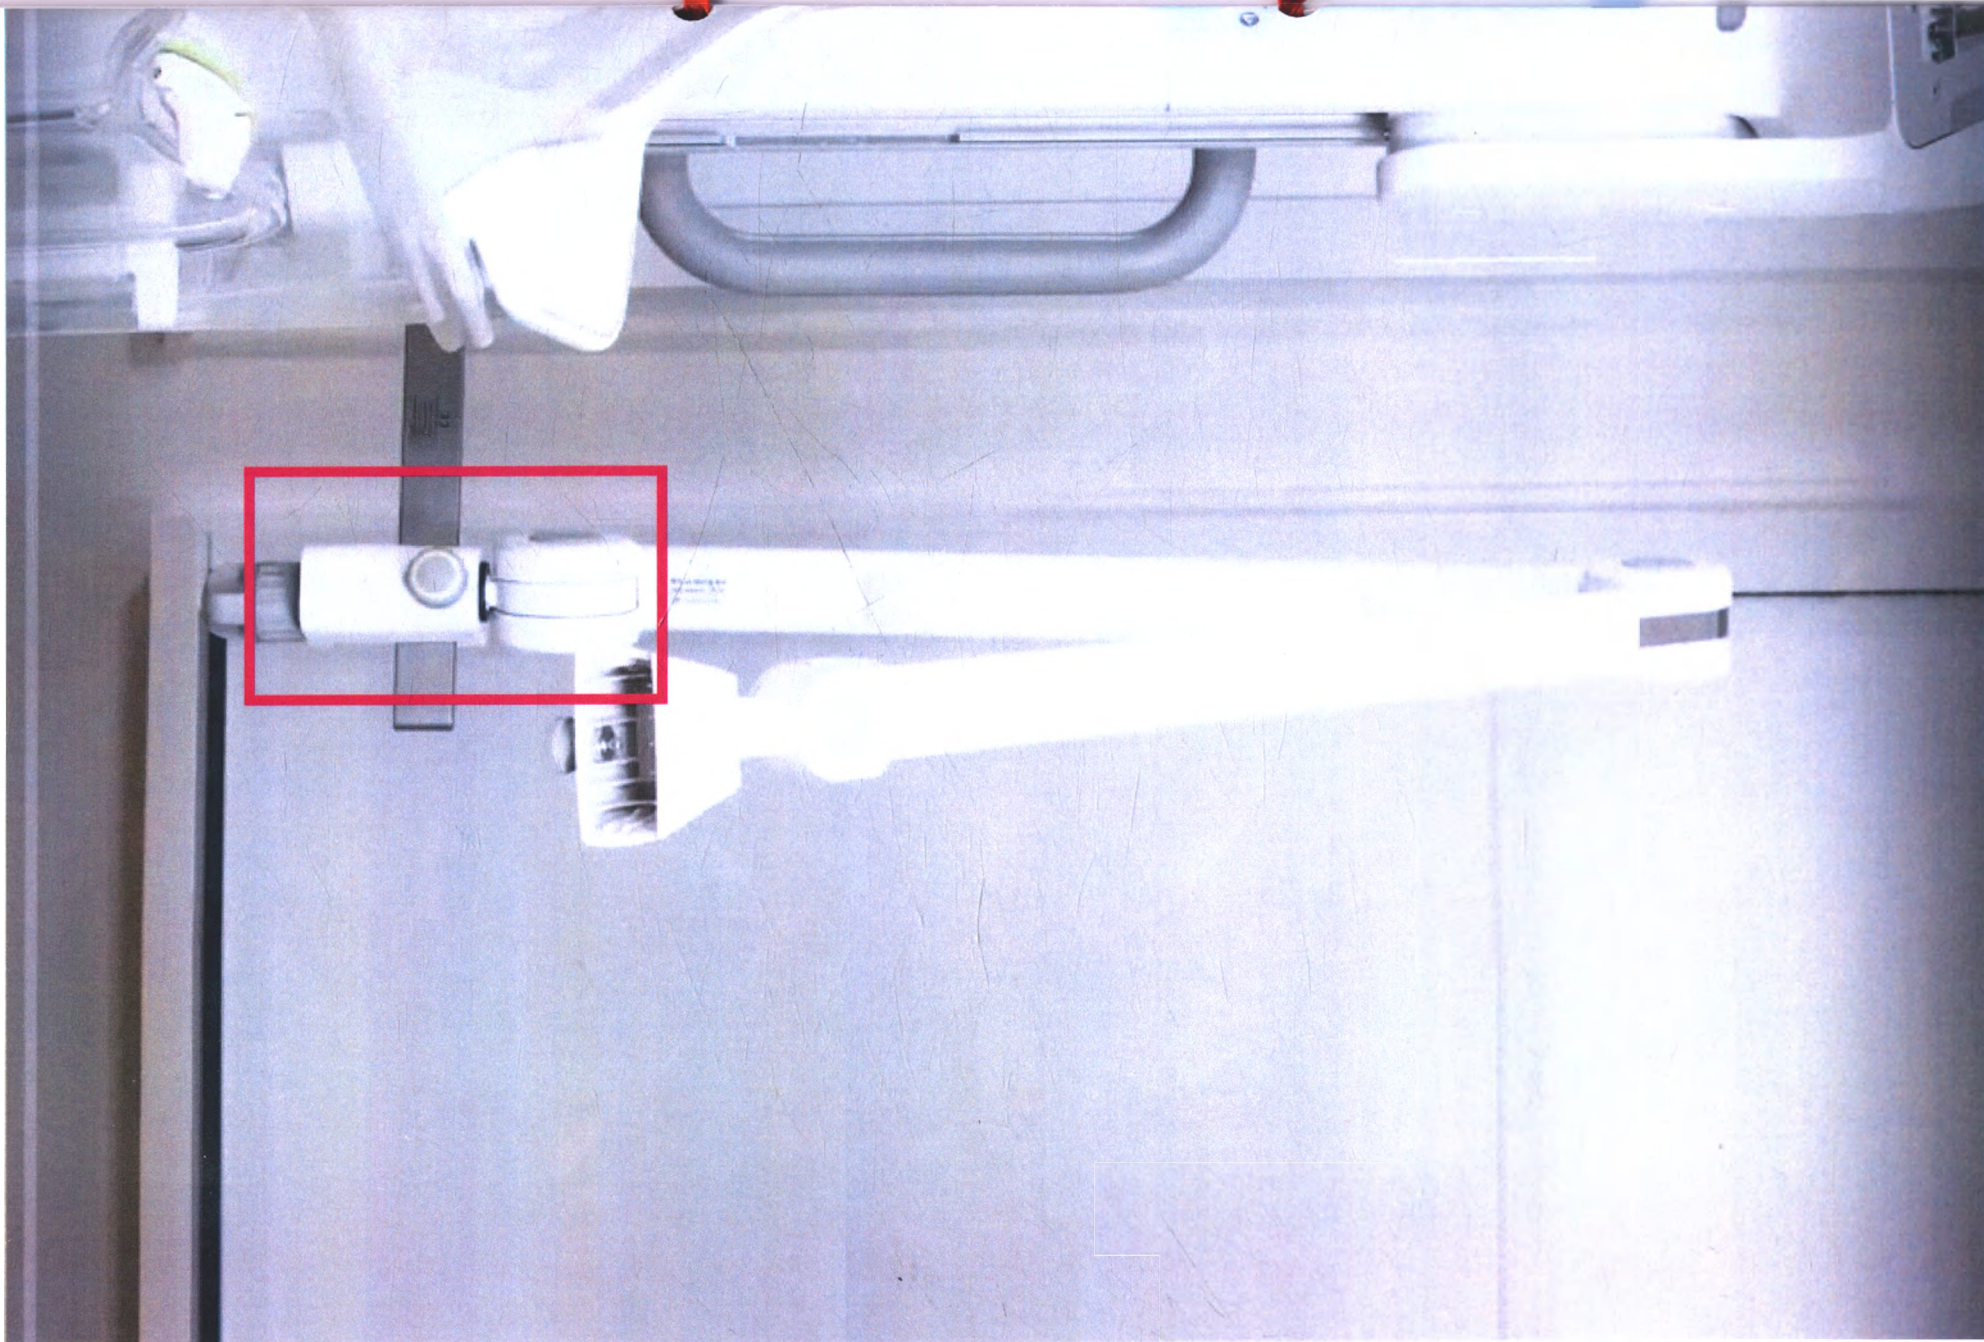

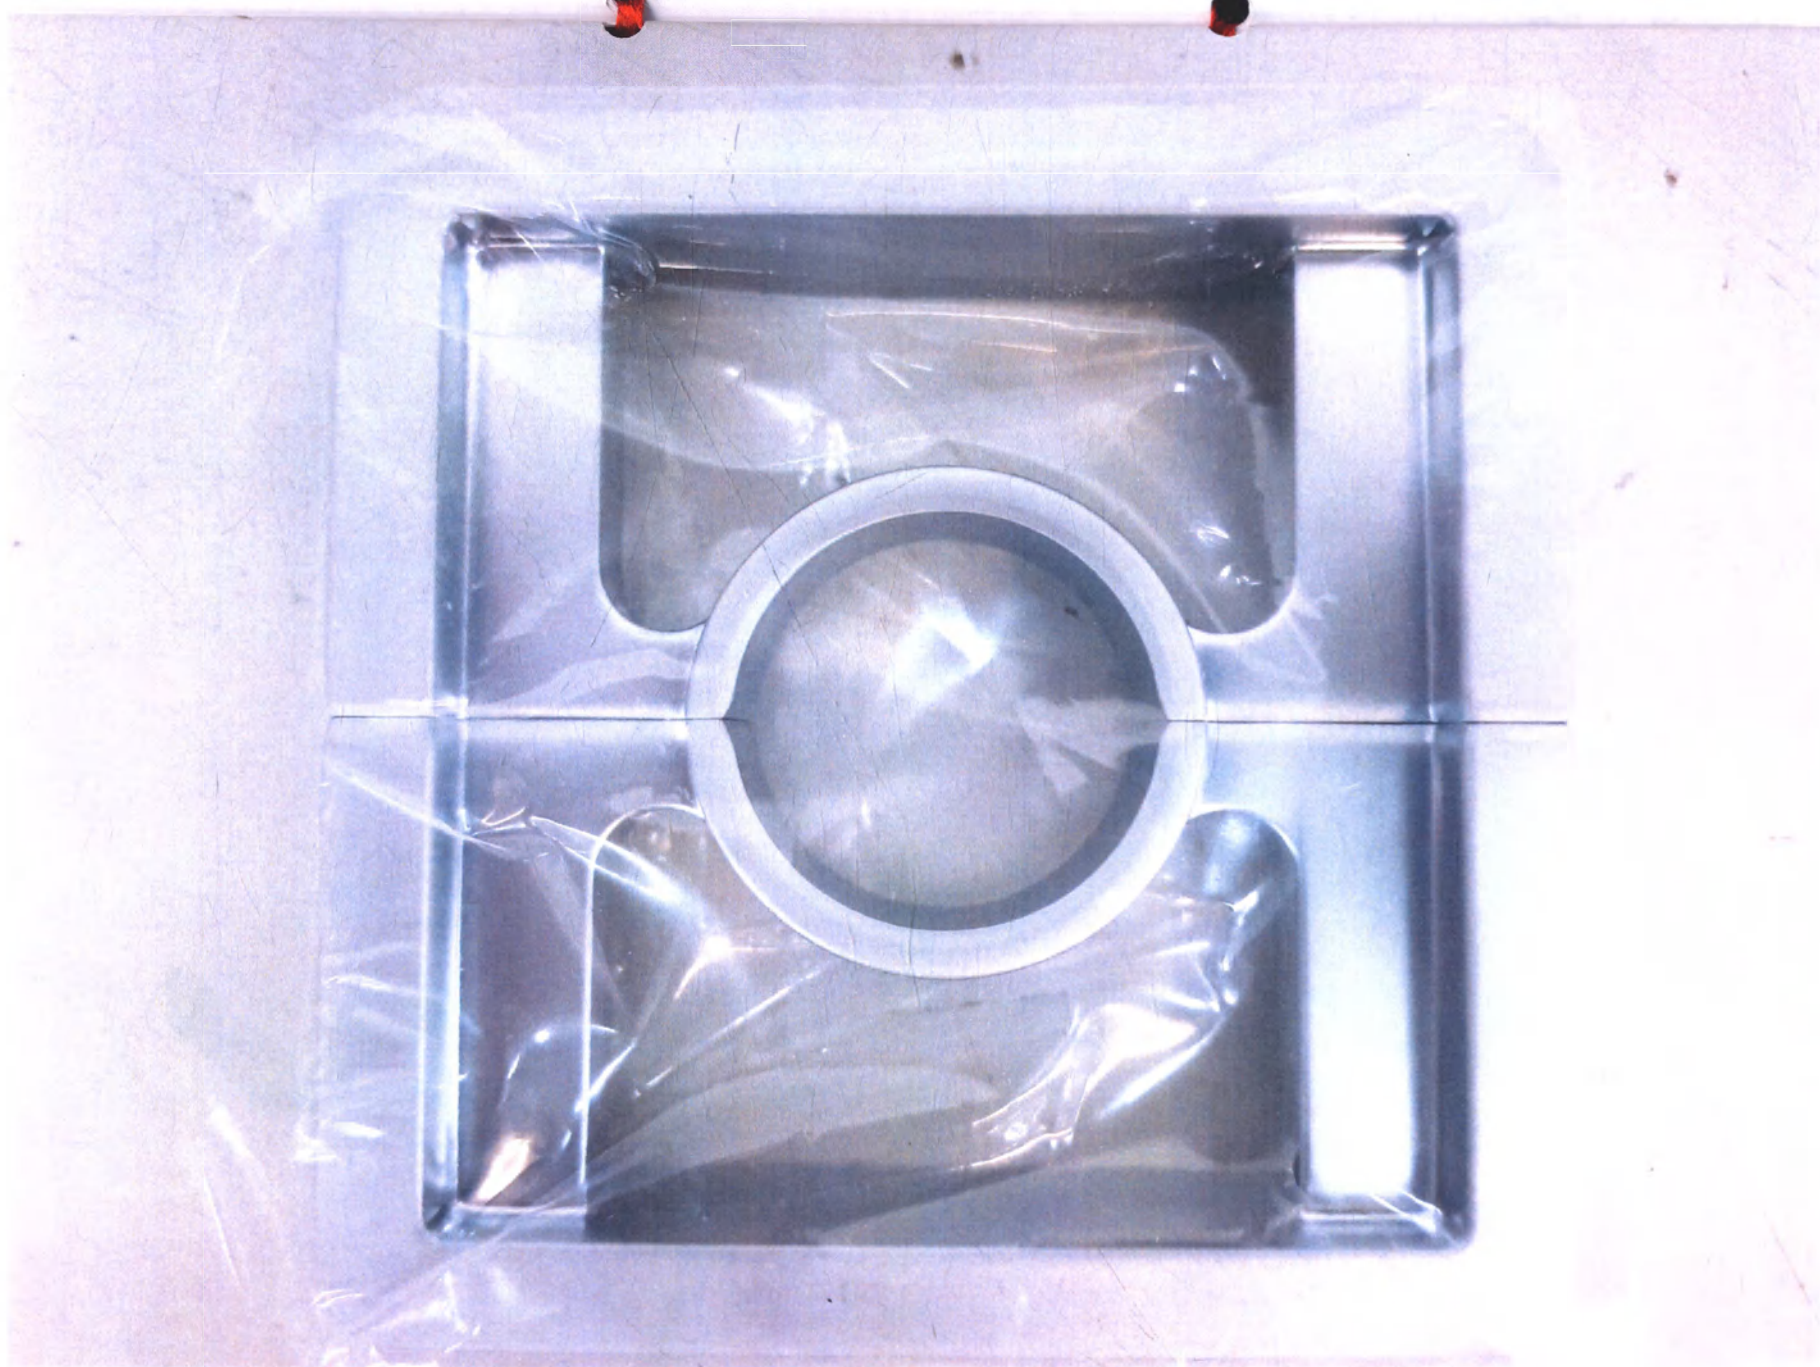


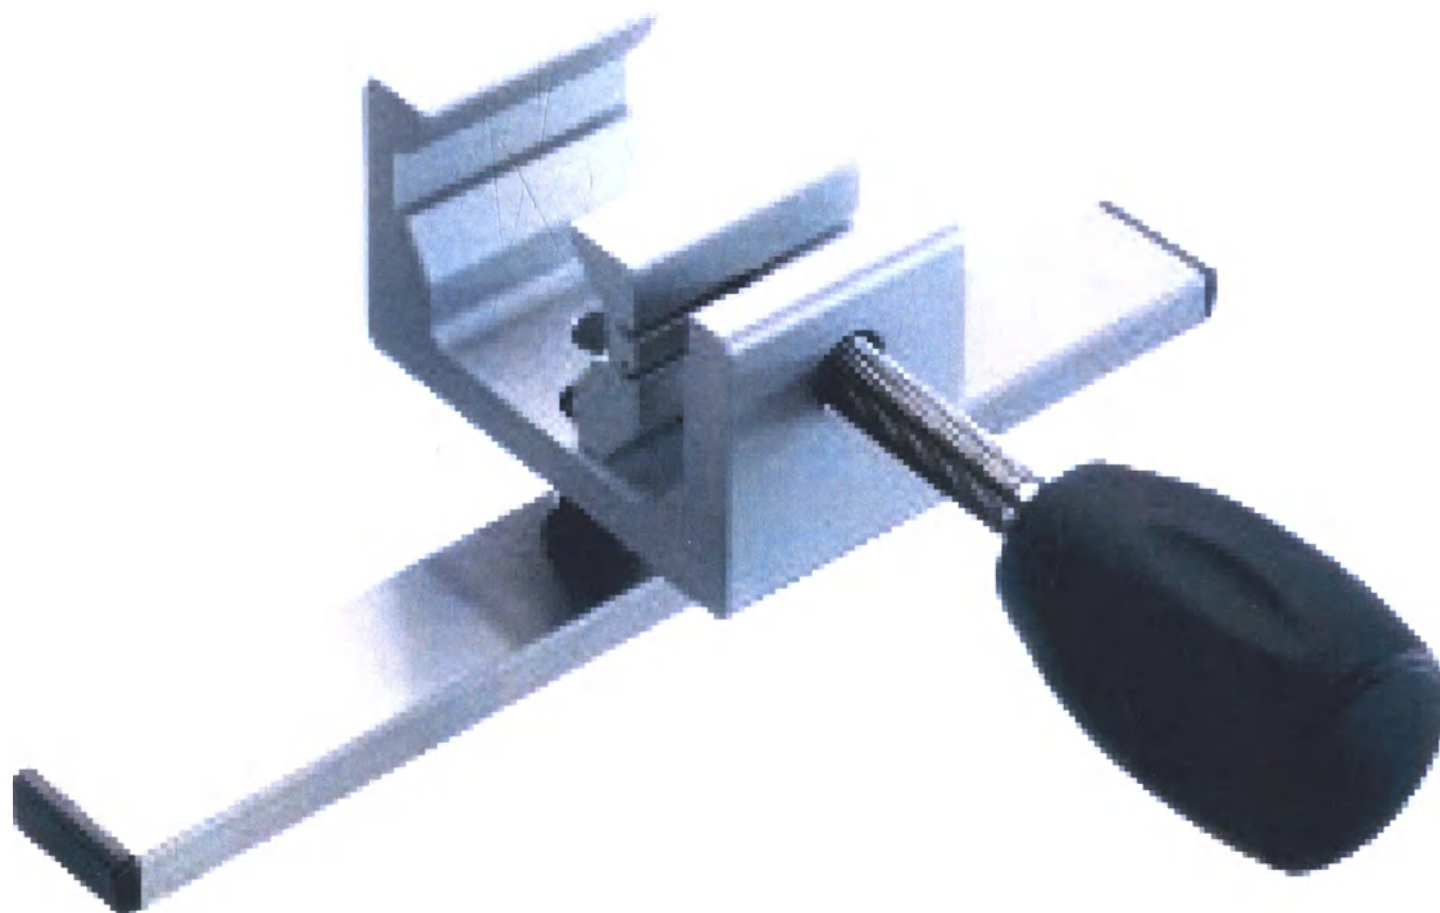

Зажим рельса.

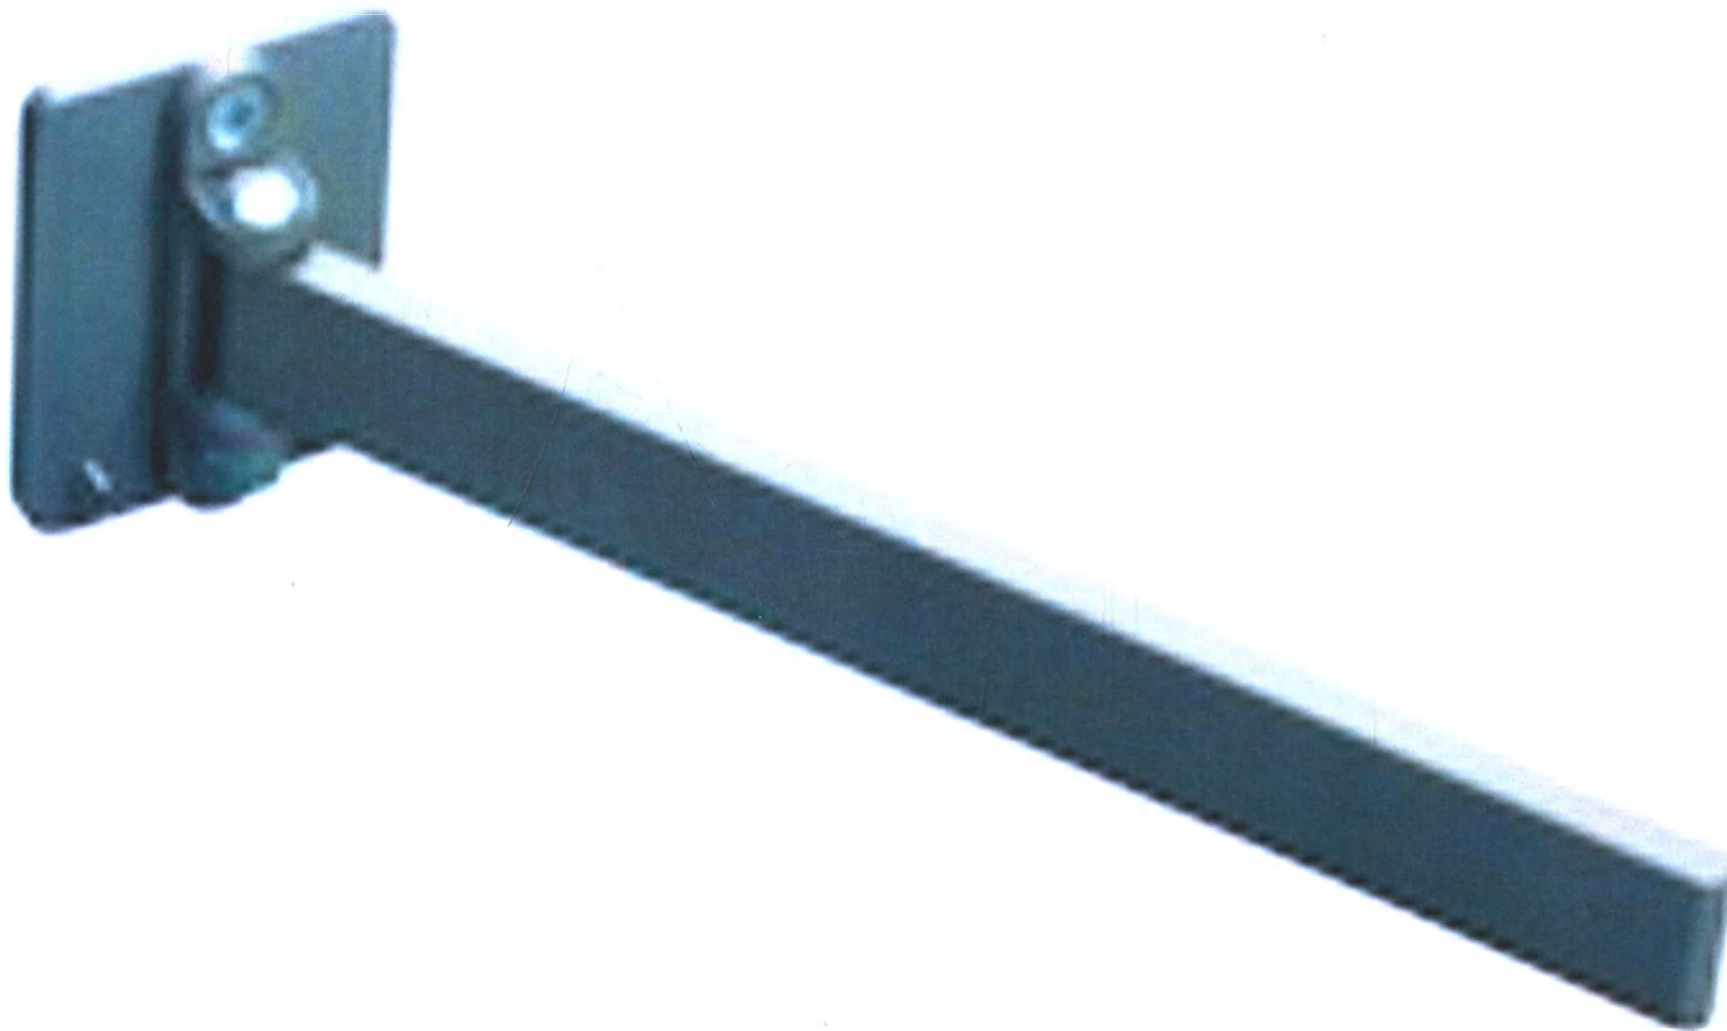

Шарнирный рельс GCX.

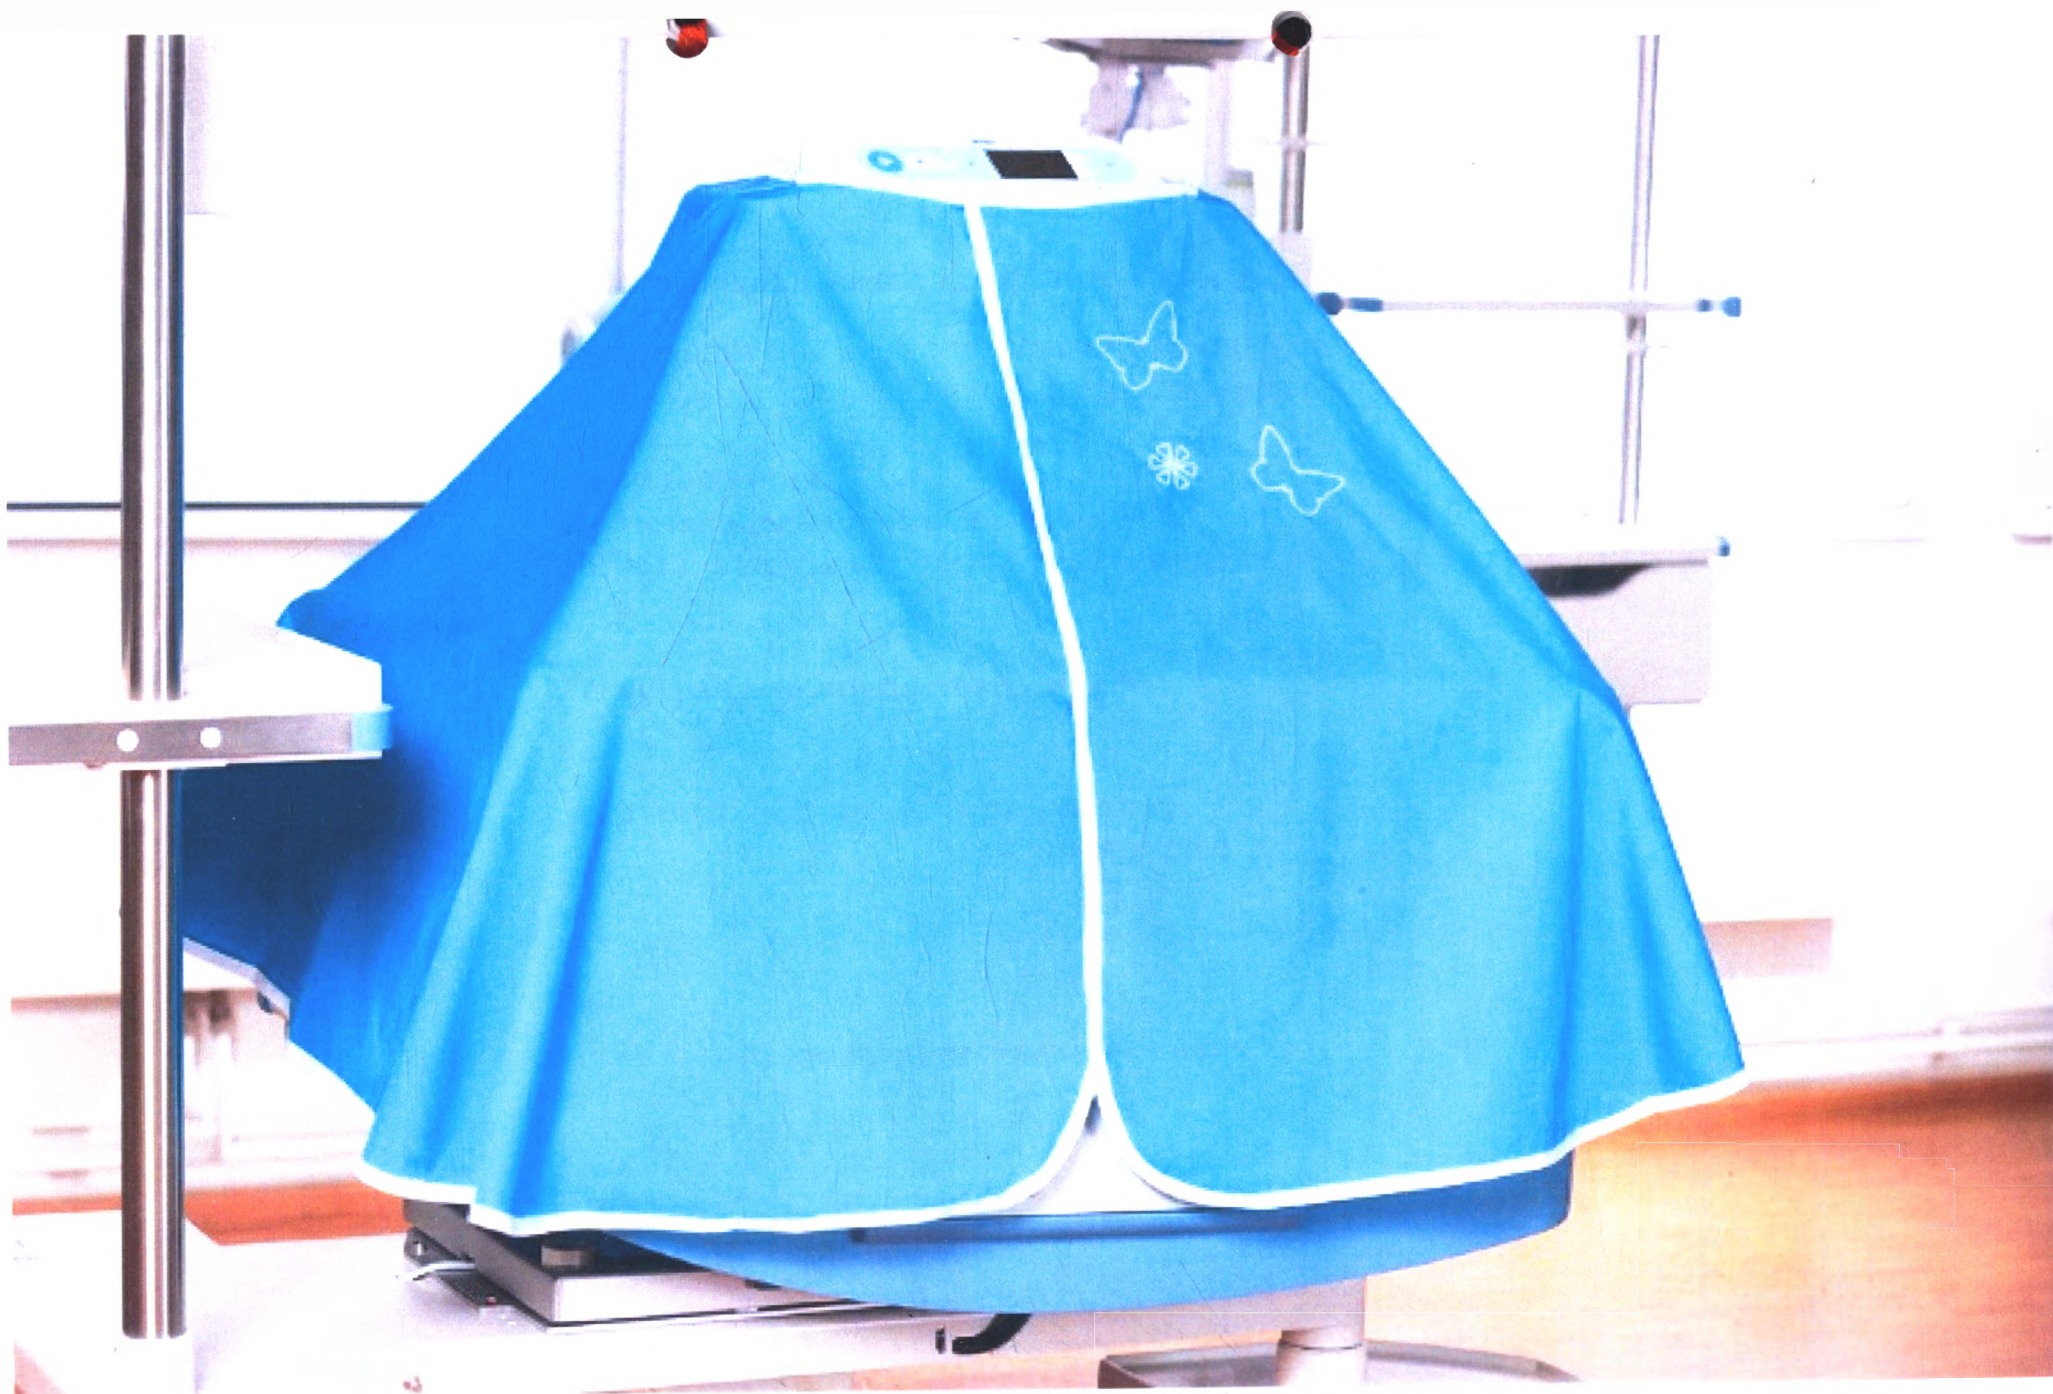

Защитное покрывало для фототерапевтической лампы.



Светодиодная лампа для фототерапии BiliLux

Производитель: Draeger Medical Systems, Inc.
(«Дрегер Медикал Системз, Инк.»)

Страна США


происхождения:

Представитель производителя в РФ: ООО «Дрегер»
107061 г. Москва, Площадь Преображенская, дом 8, эт. 12, пом. LIII

Регистрационное удостоверение № **от**

Дата изгот. / Серия: см. упаковку
см. инструкцию

Проект маркировки на русском языке.

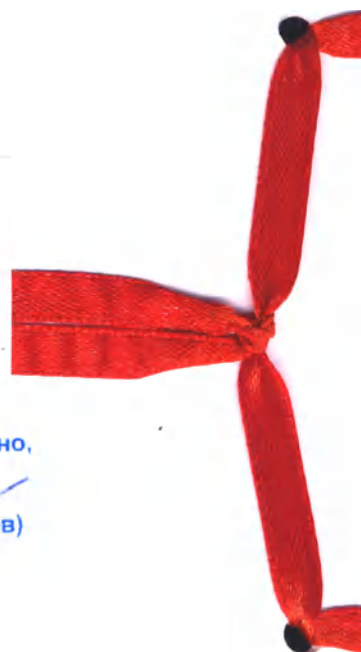

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
_____ листа (ов)