«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СлавМед»

В.Ю. Малышев

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Дрели и пилы электрические для травматологии по ТУ 32.50.50-002-46935138-2017»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СлавМед», 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д.21, лит. А, пом. 30Н

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Электродрель ДЭТ-01. Электропривод с универсальным патроном СВМД.20.01.01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электродрель ДЭТ-02 .Электропривод с быстросъемным патроном СВМД.20.02.01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электродрель ДЭТ-03. Электропривод с быстросъемным патроном СВМД.20.03.01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электродрель ДЭТ-04 .Электропривод с быстросъемным патроном СВМД.20.04.01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электродрель ДЭТ-05 .Электропривод СВМД.20.05.01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

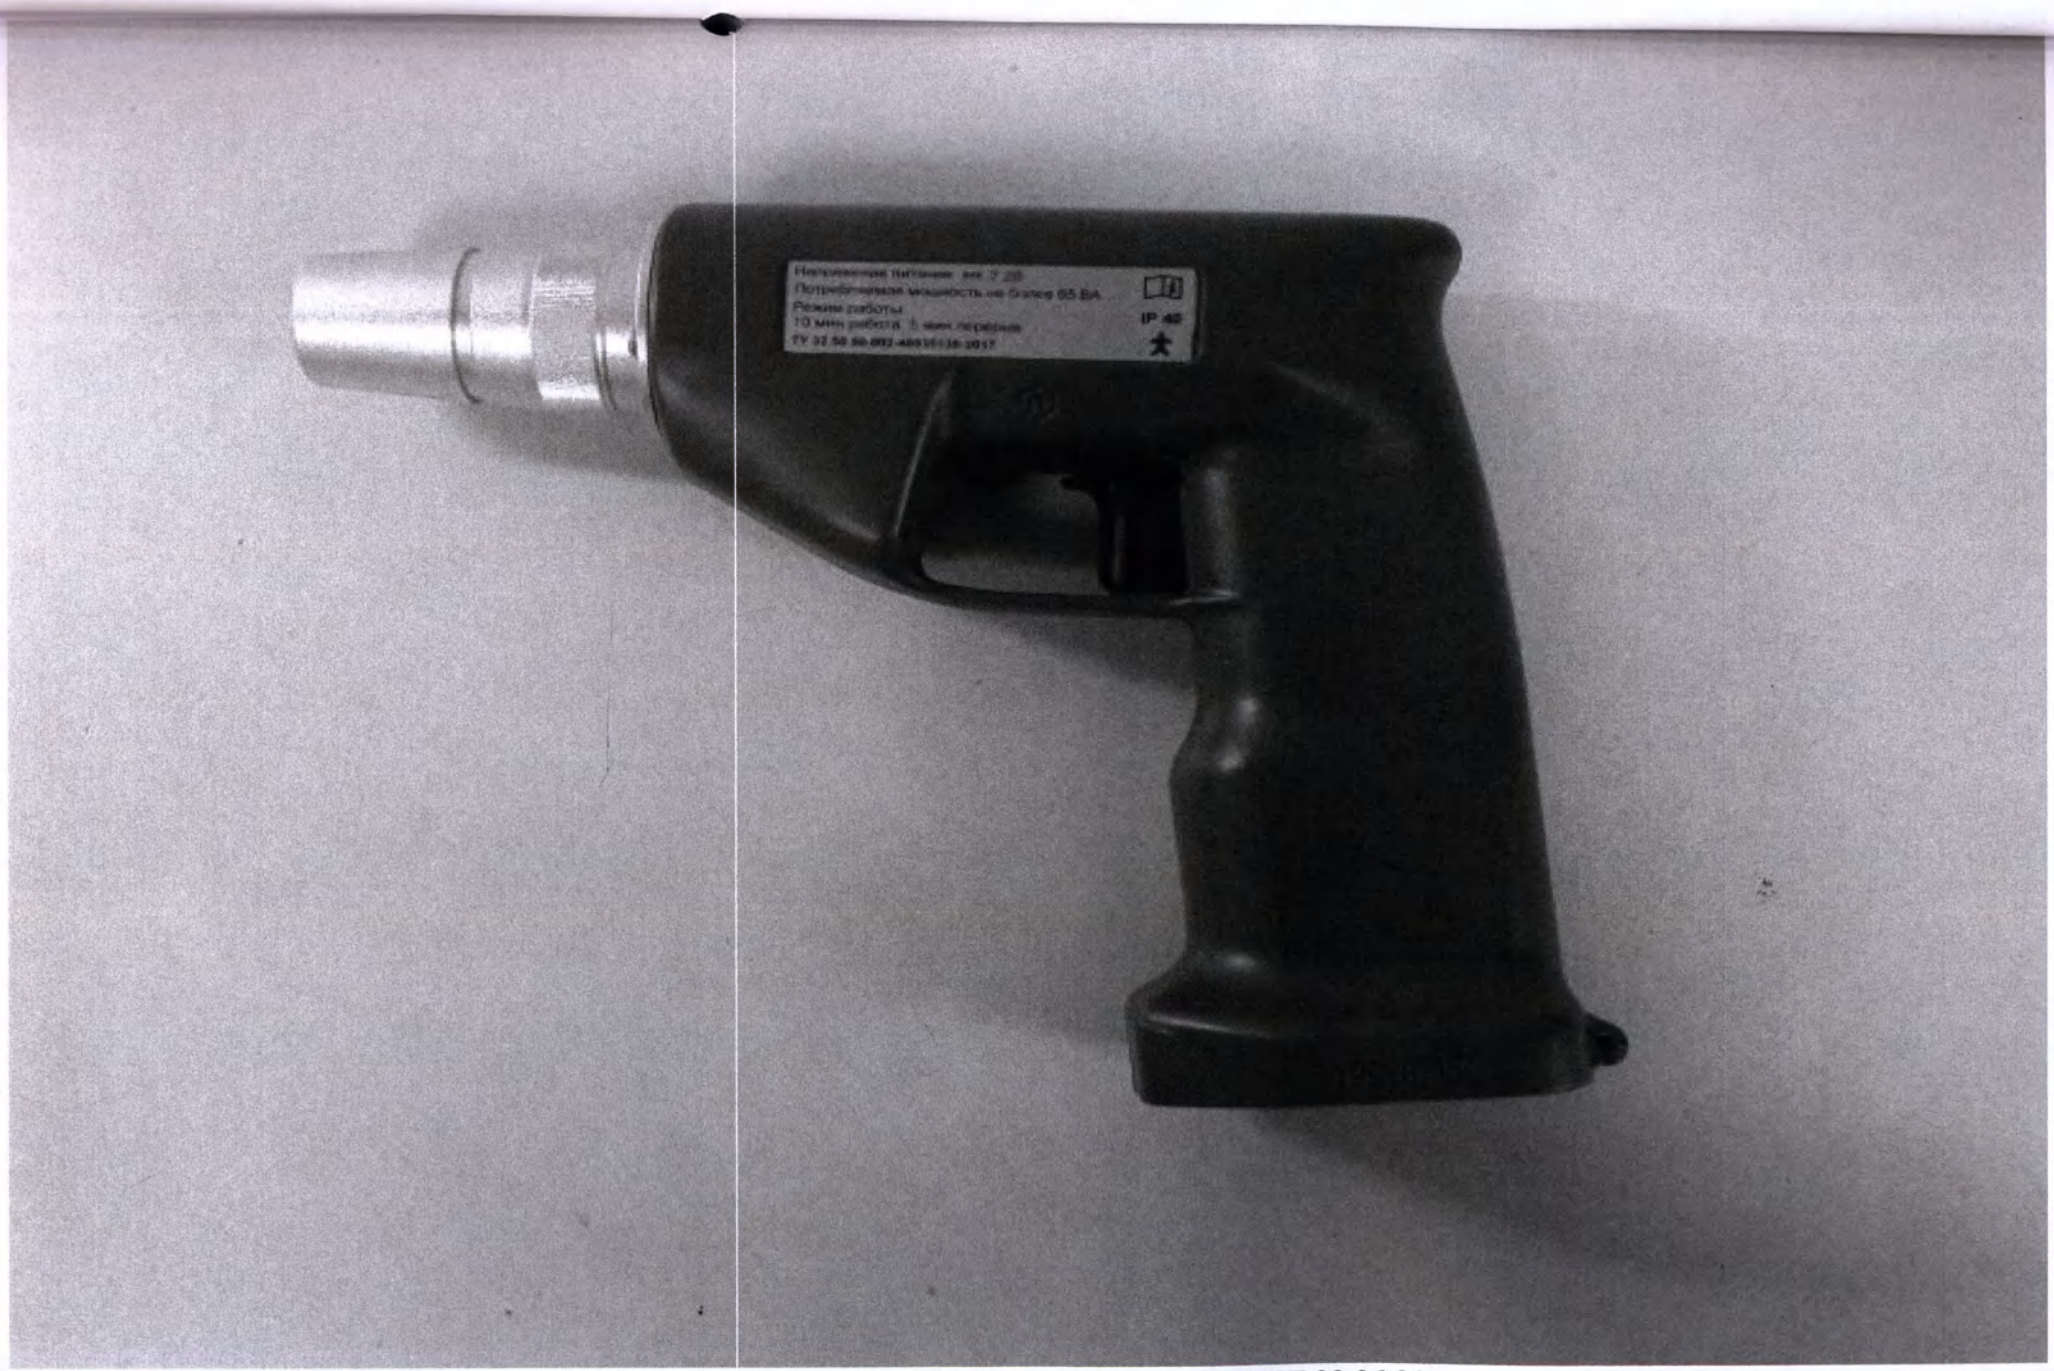

Электродрель ДЭТ-06. Электропривод СВМД.20.06.01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электропила ПЭТ-01. Электропривод с винтовым зажимом СВМД.20.07.01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электродрель ДЭТ-05 Насадка дрель для сверления кости СВМД.20.05.02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

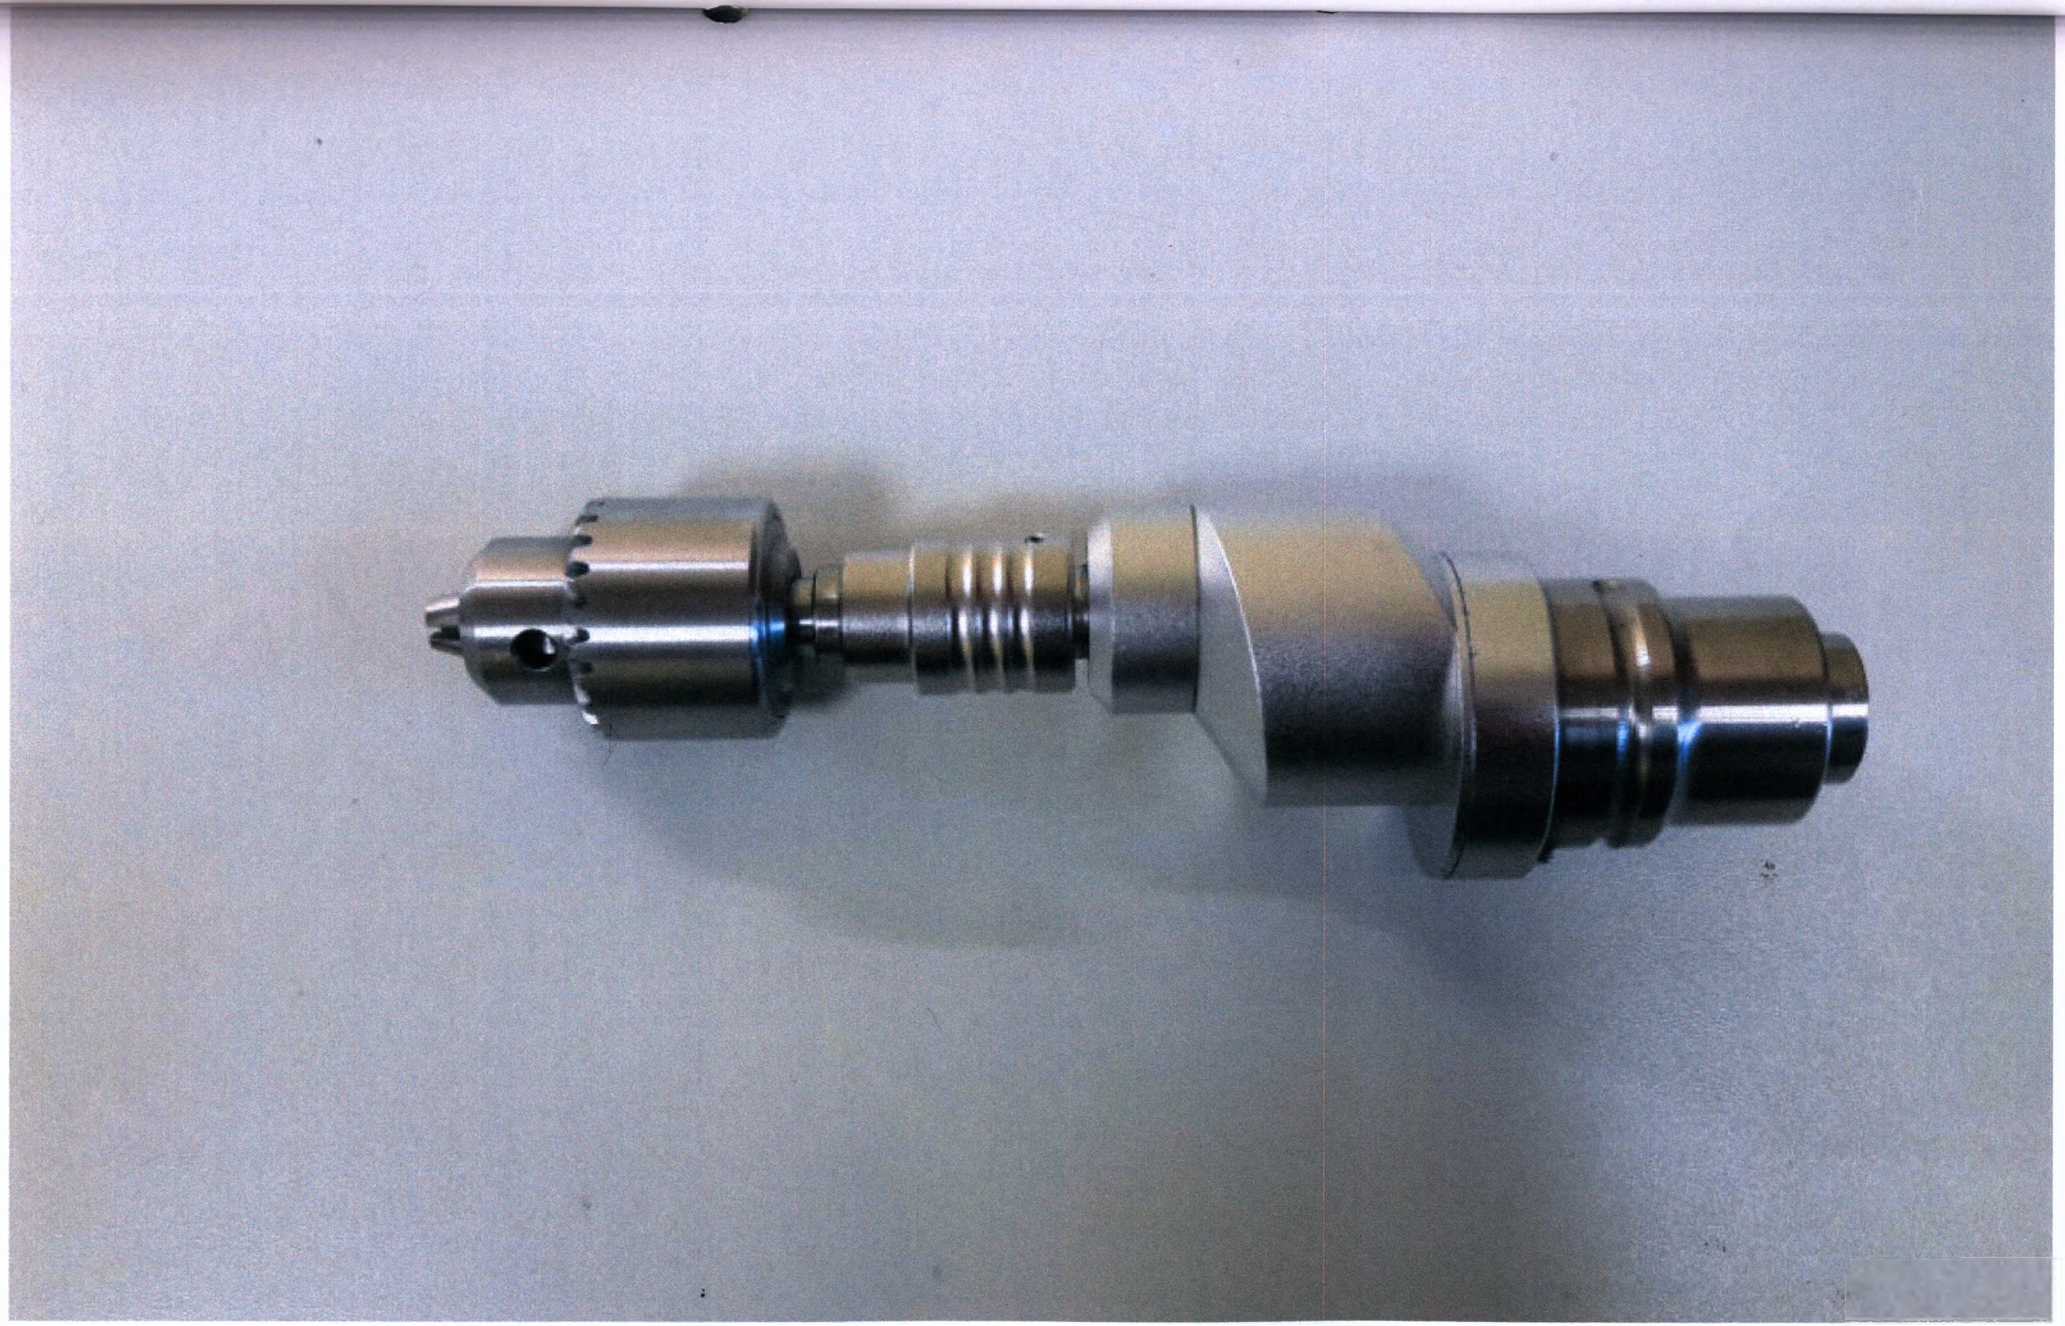

Электродрель ДЭТ-05 Насадка дрель канюлированная СВМД.20.05.03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

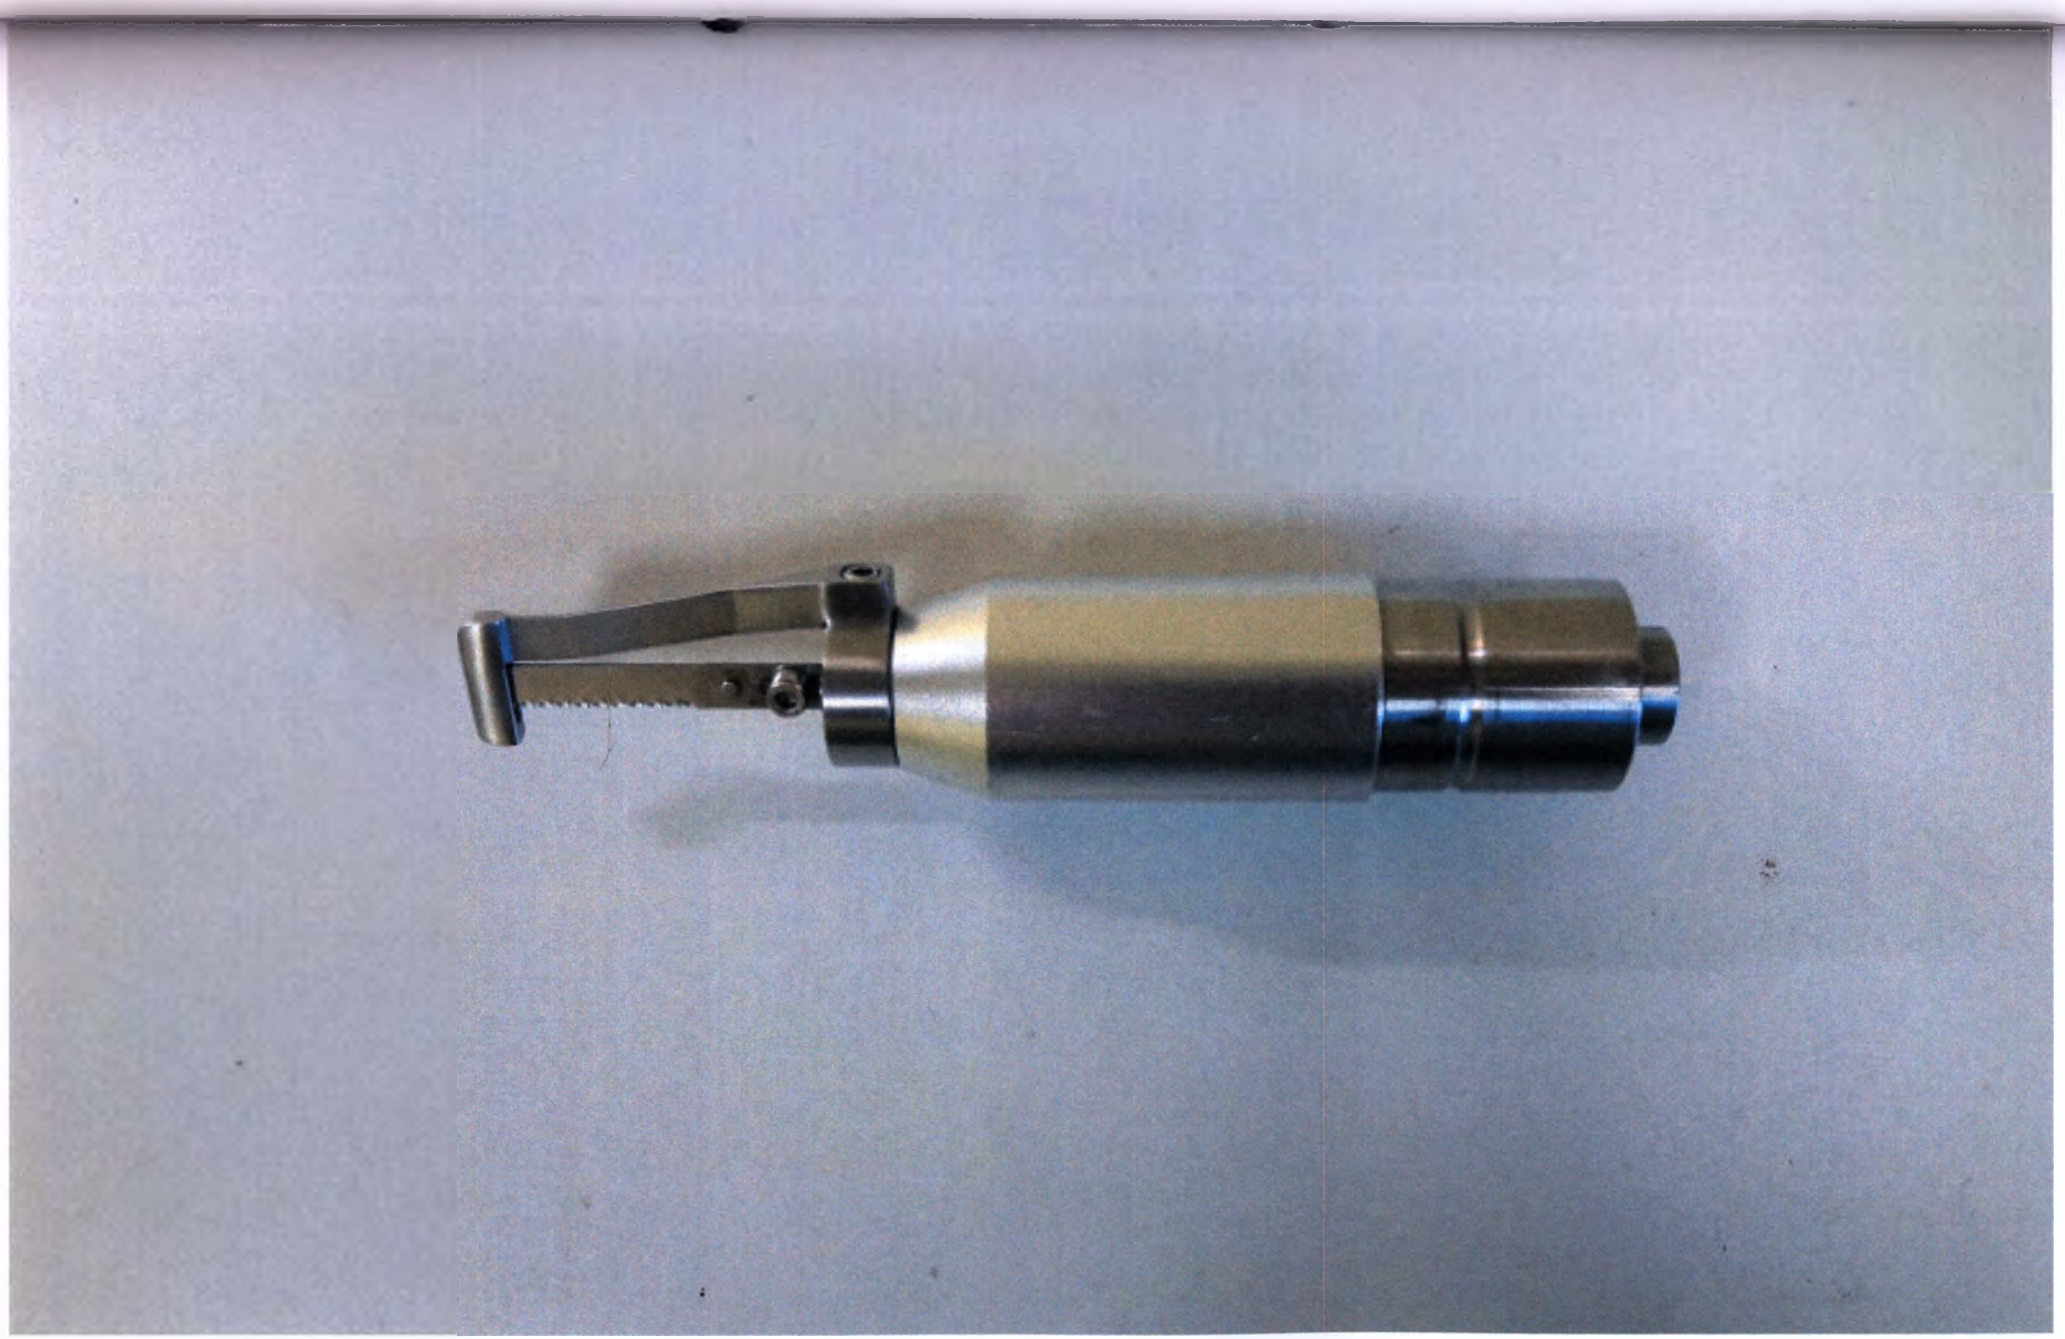

Электродрель ДЭТ-05 Насадка пила реципрокная СВМД.20.05.06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

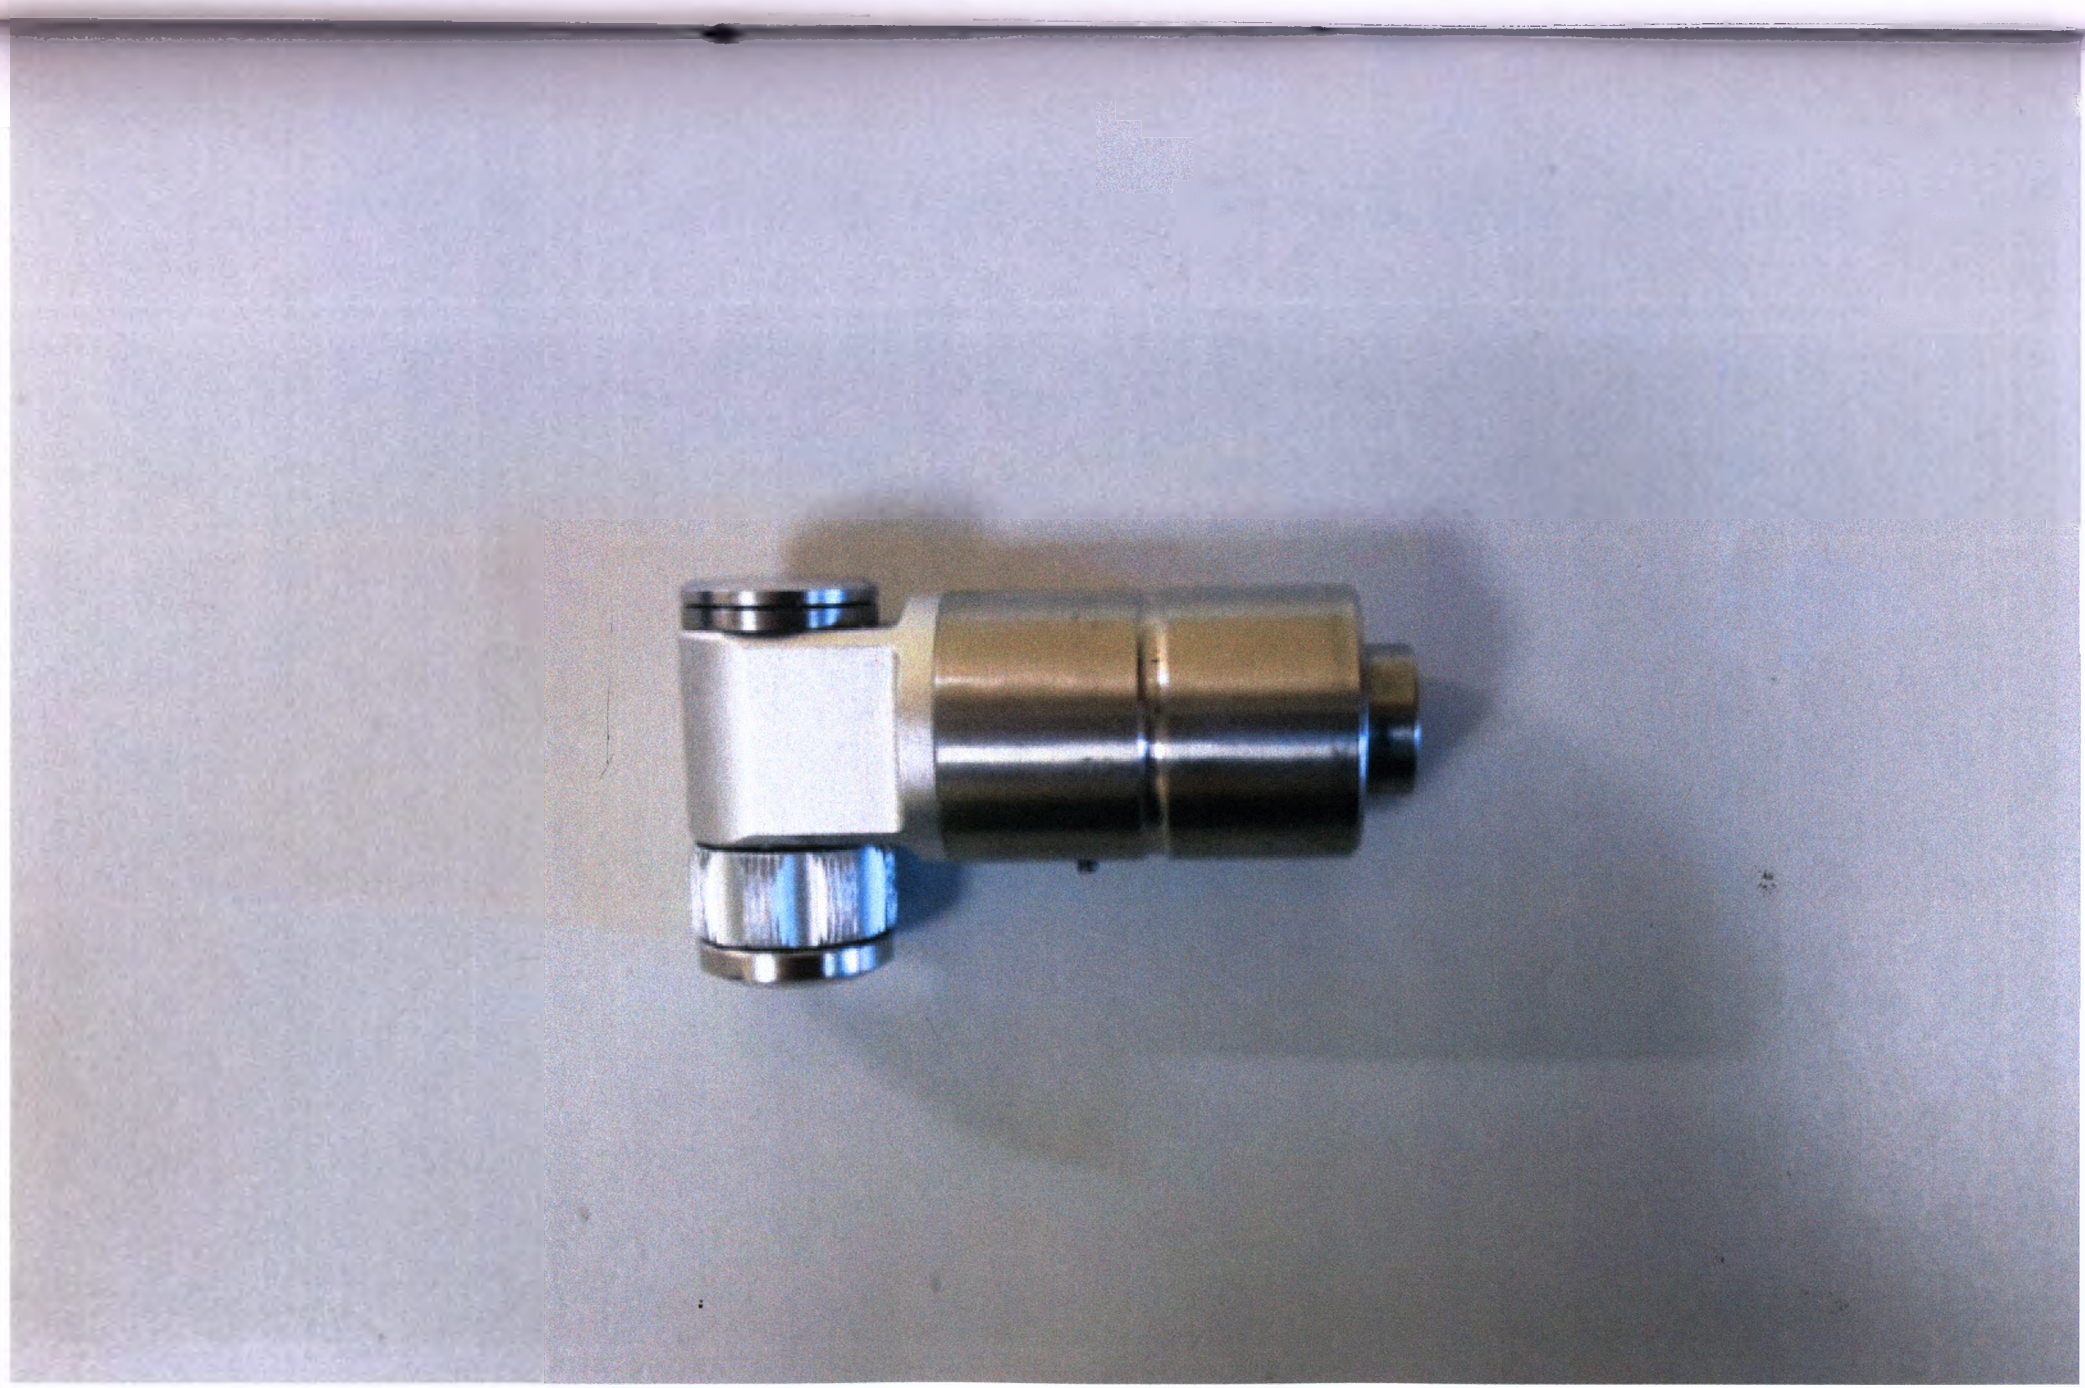

Электродрель ДЭТ-05 Насадка пила осциллирующая СВМД.20.05.05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

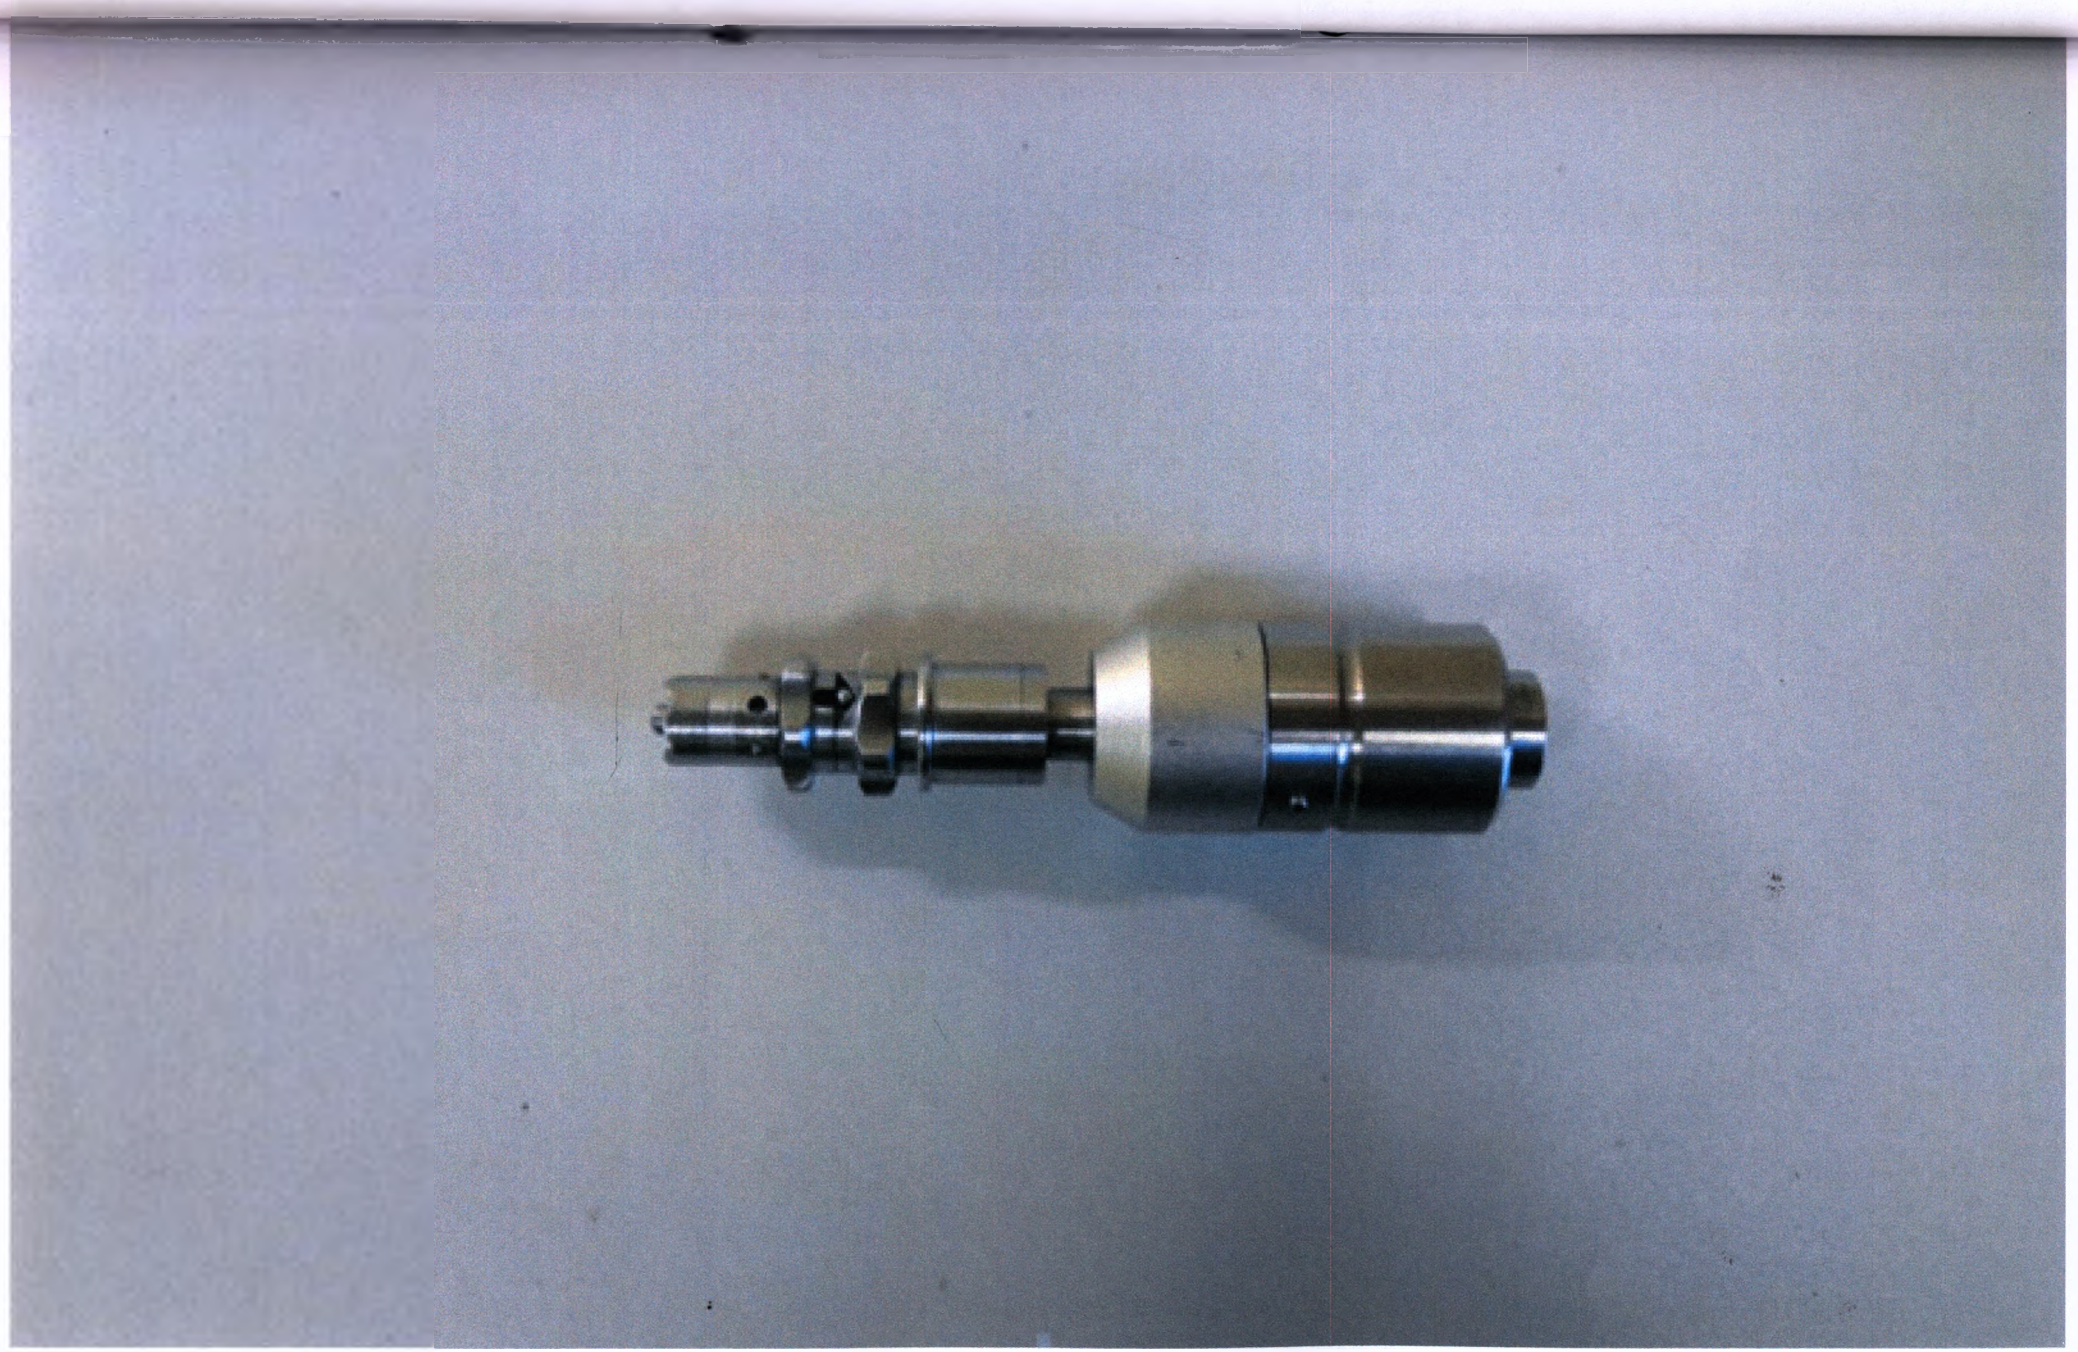

Электродрель ДЭТ-05 Насадка дрель краниальная СВМД.20.05.04

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электродрель ДЭТ-05. Насадка дрель ример СВМД.20.05.07

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

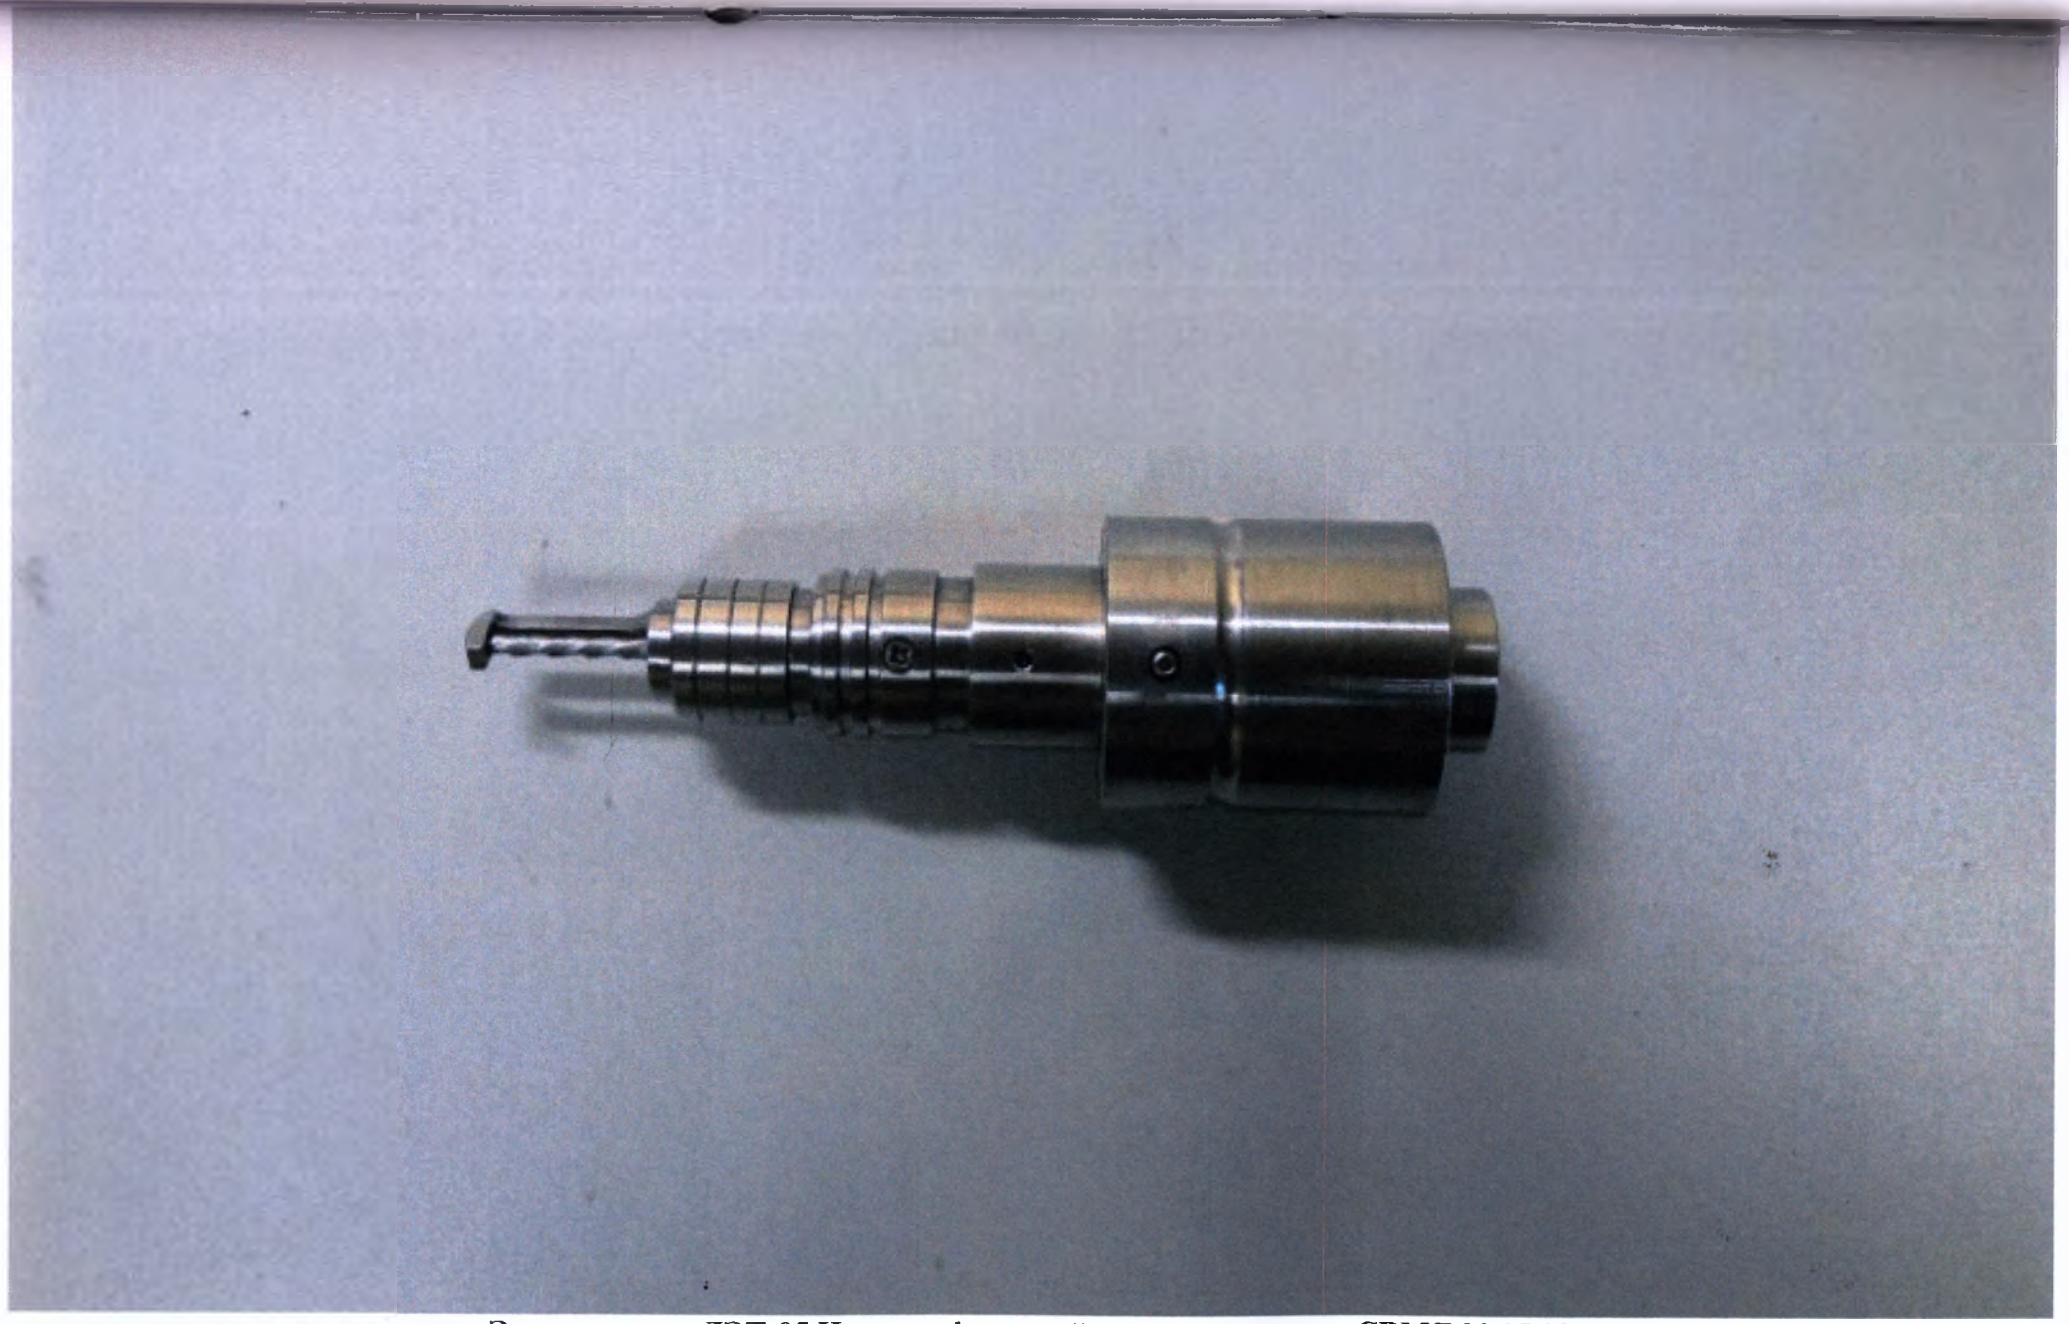

Электродрель ДЭТ-05 Насадка фреза нейрохирургическая СВМД.20.05.08

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

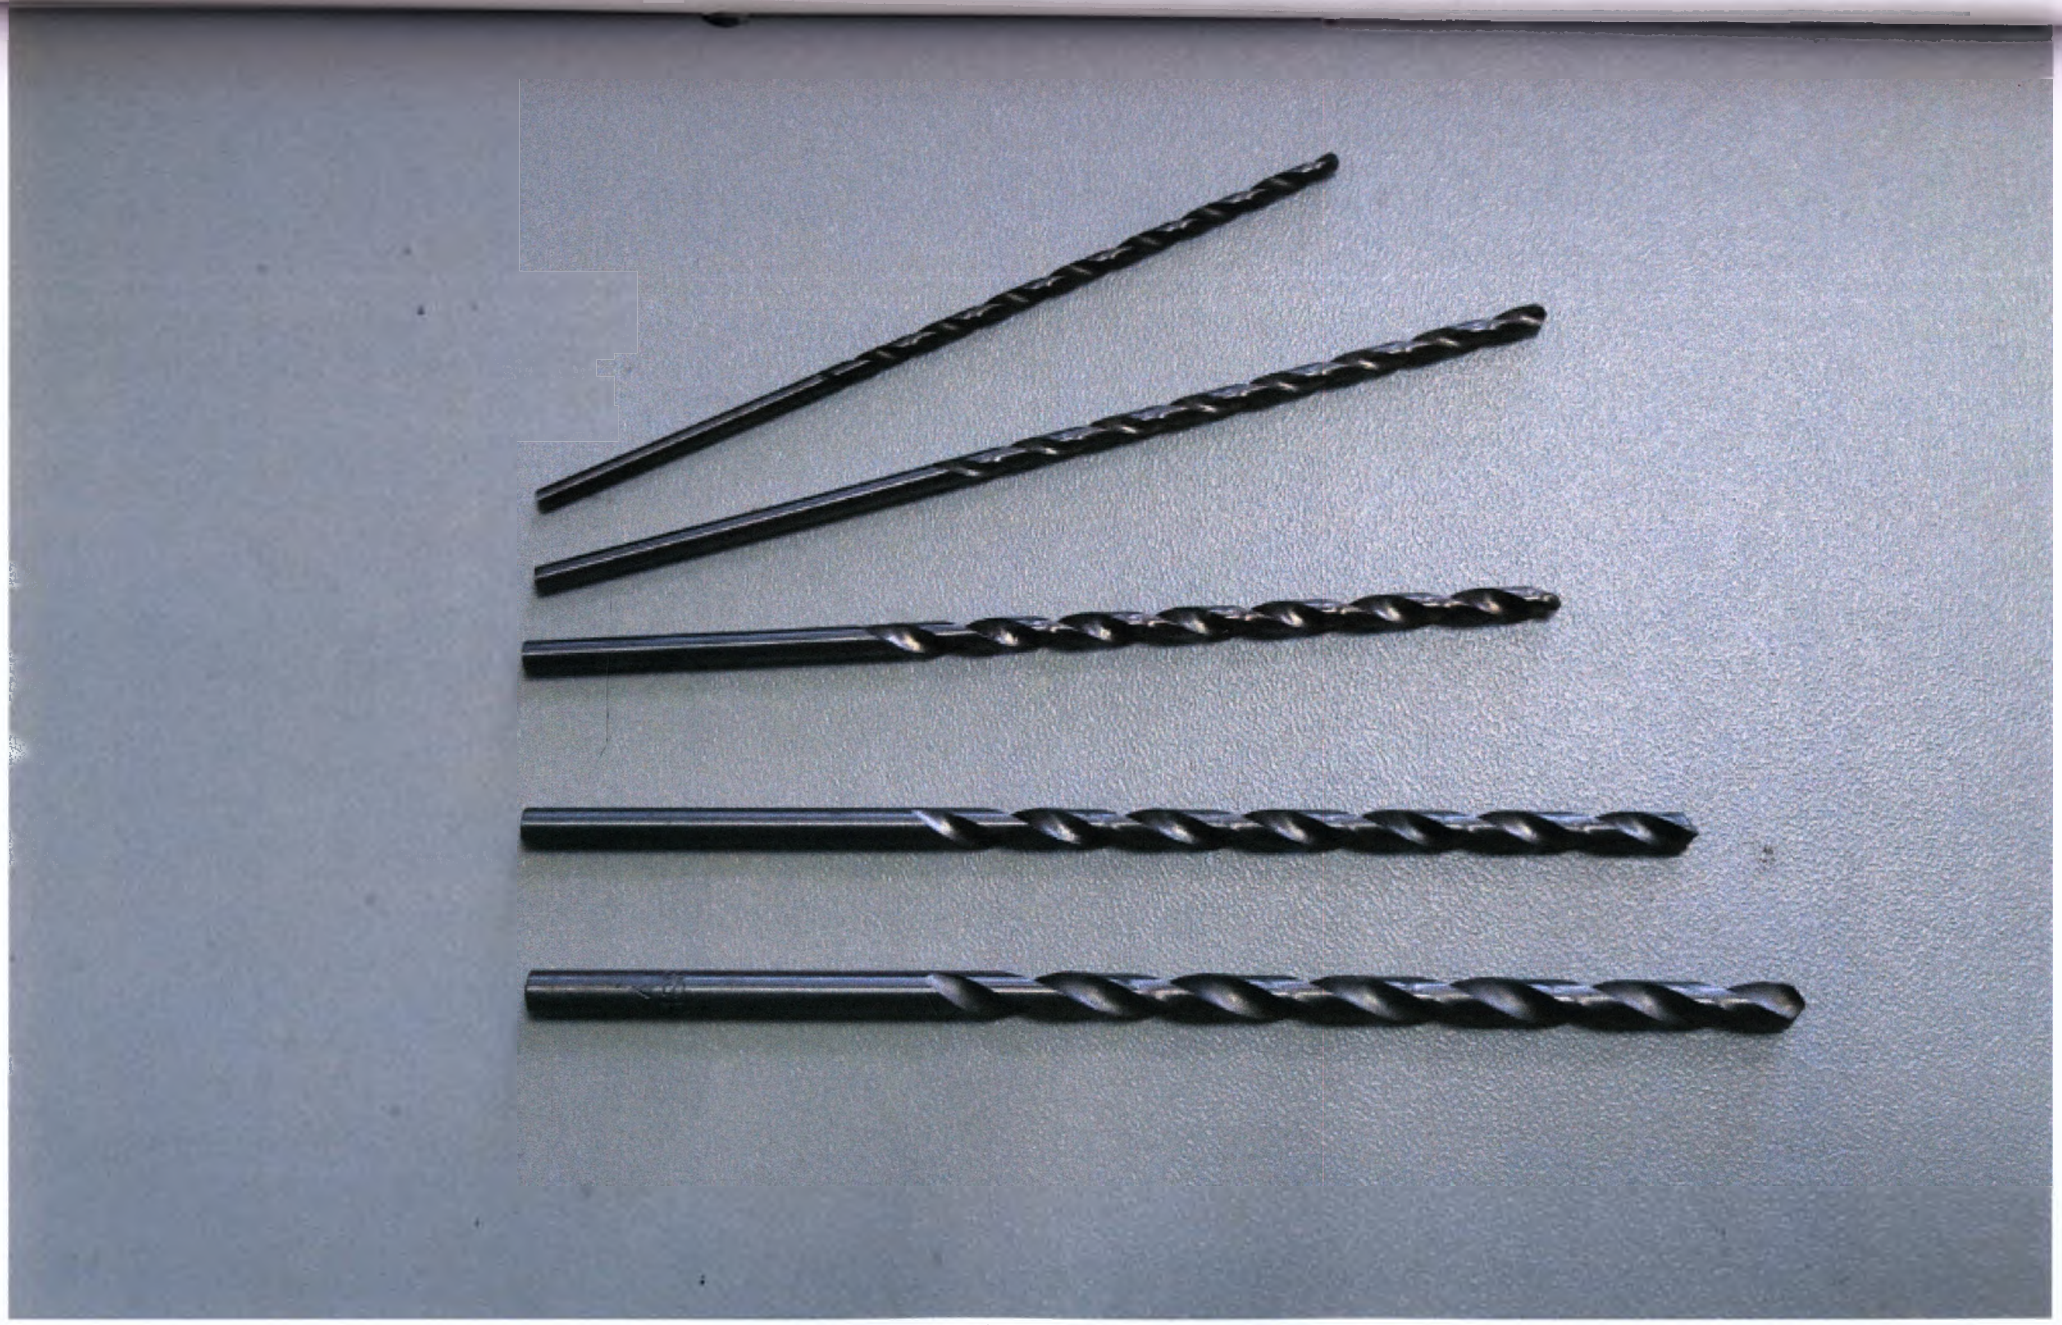

Набор сверл (d=2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

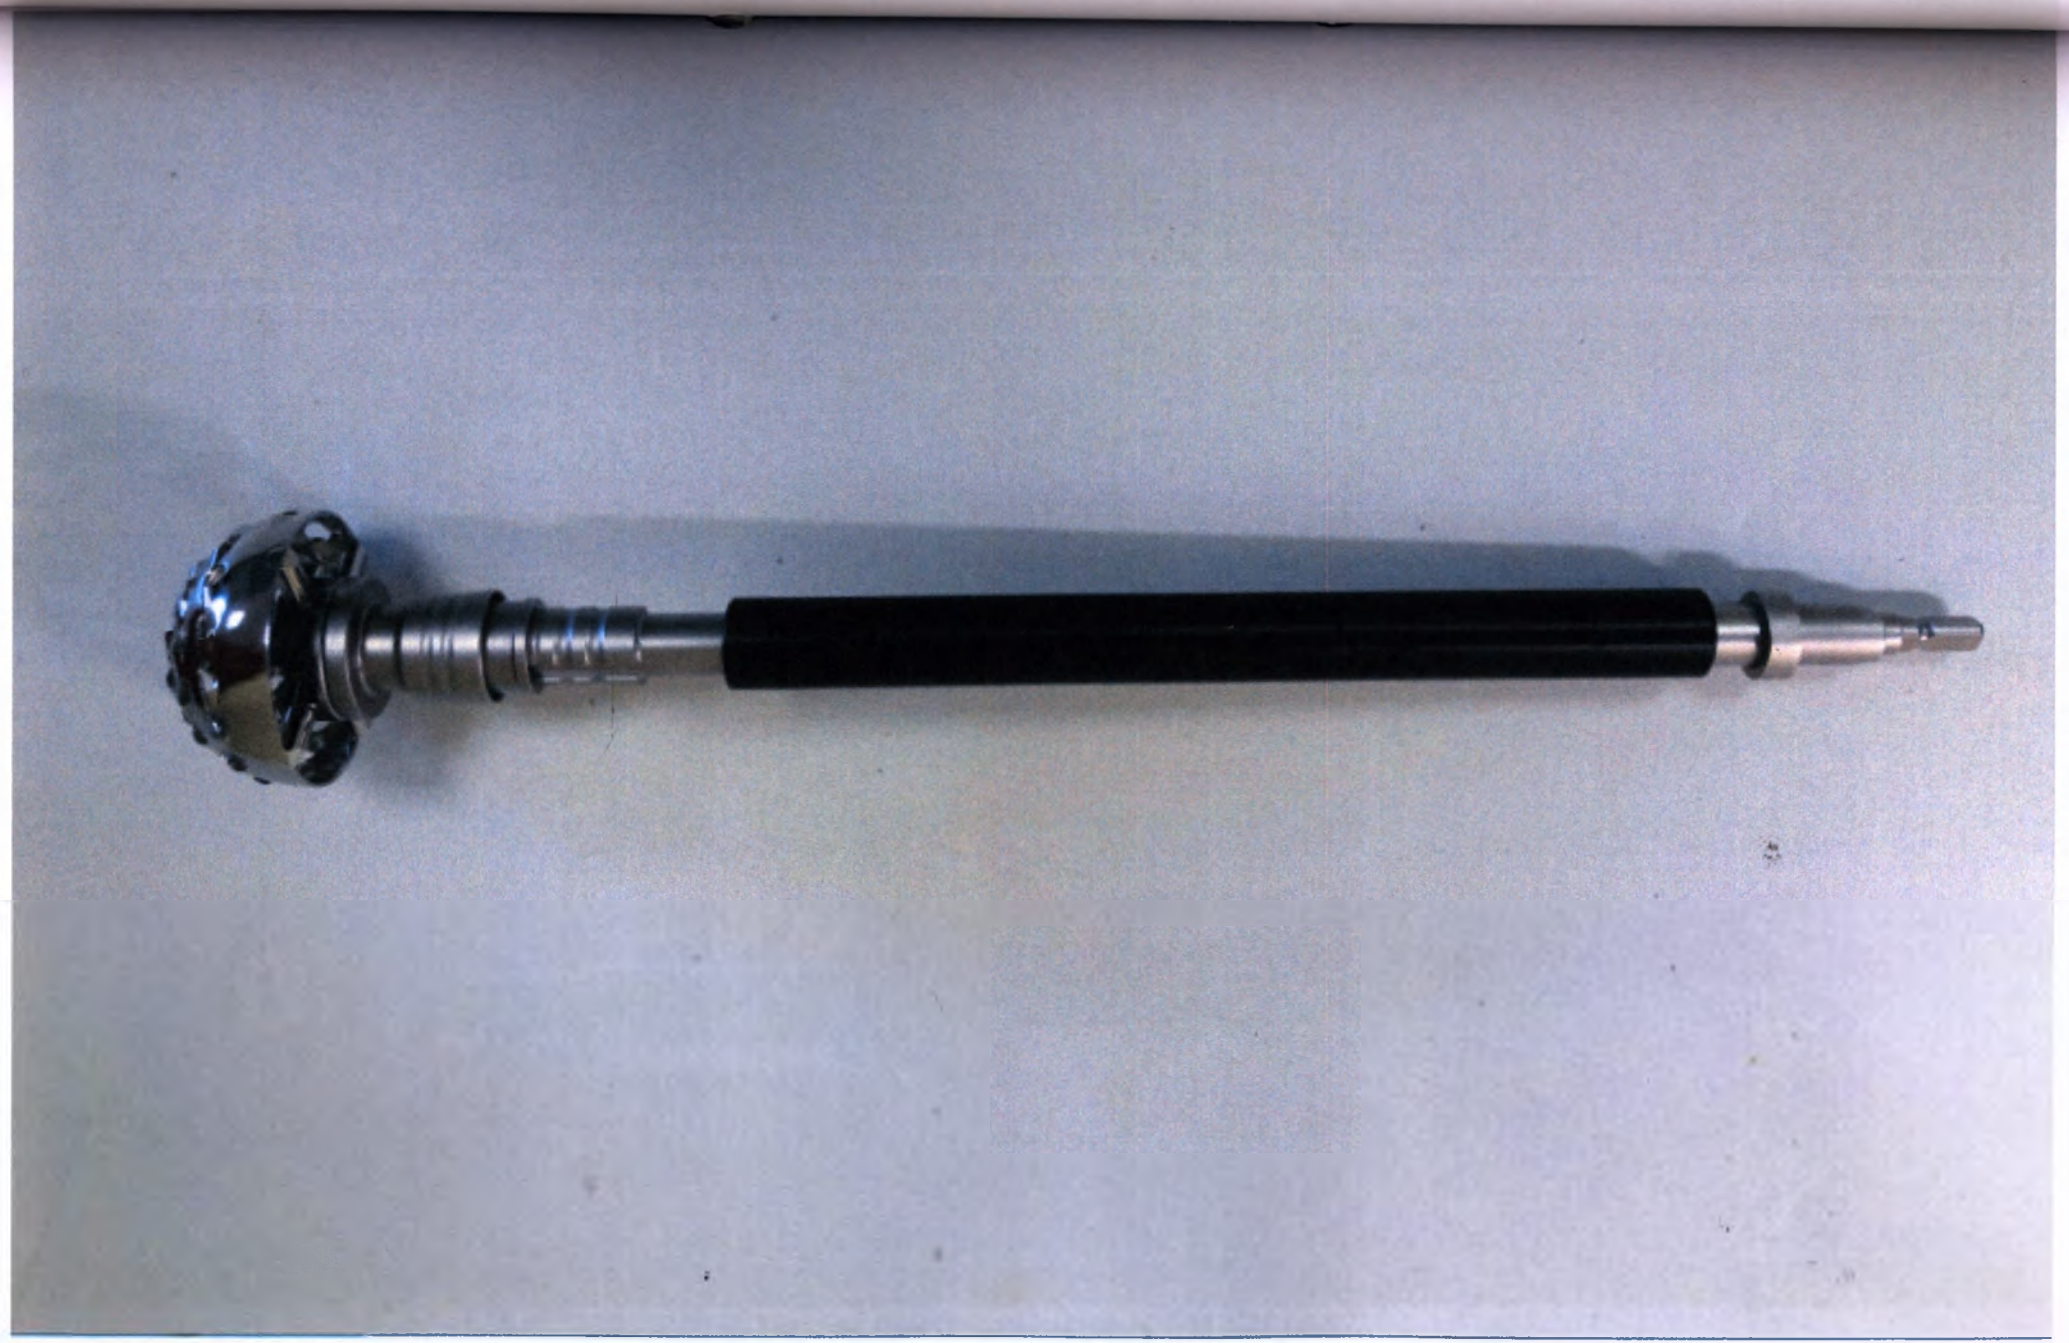

Электродрель ДЭТ-05 Фреза сферическая с адаптером СВМД.20.05.11

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Патрон быстрозажимной СВМД.20.06.07
2. Патрон универсальный СВМД.20.06.05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

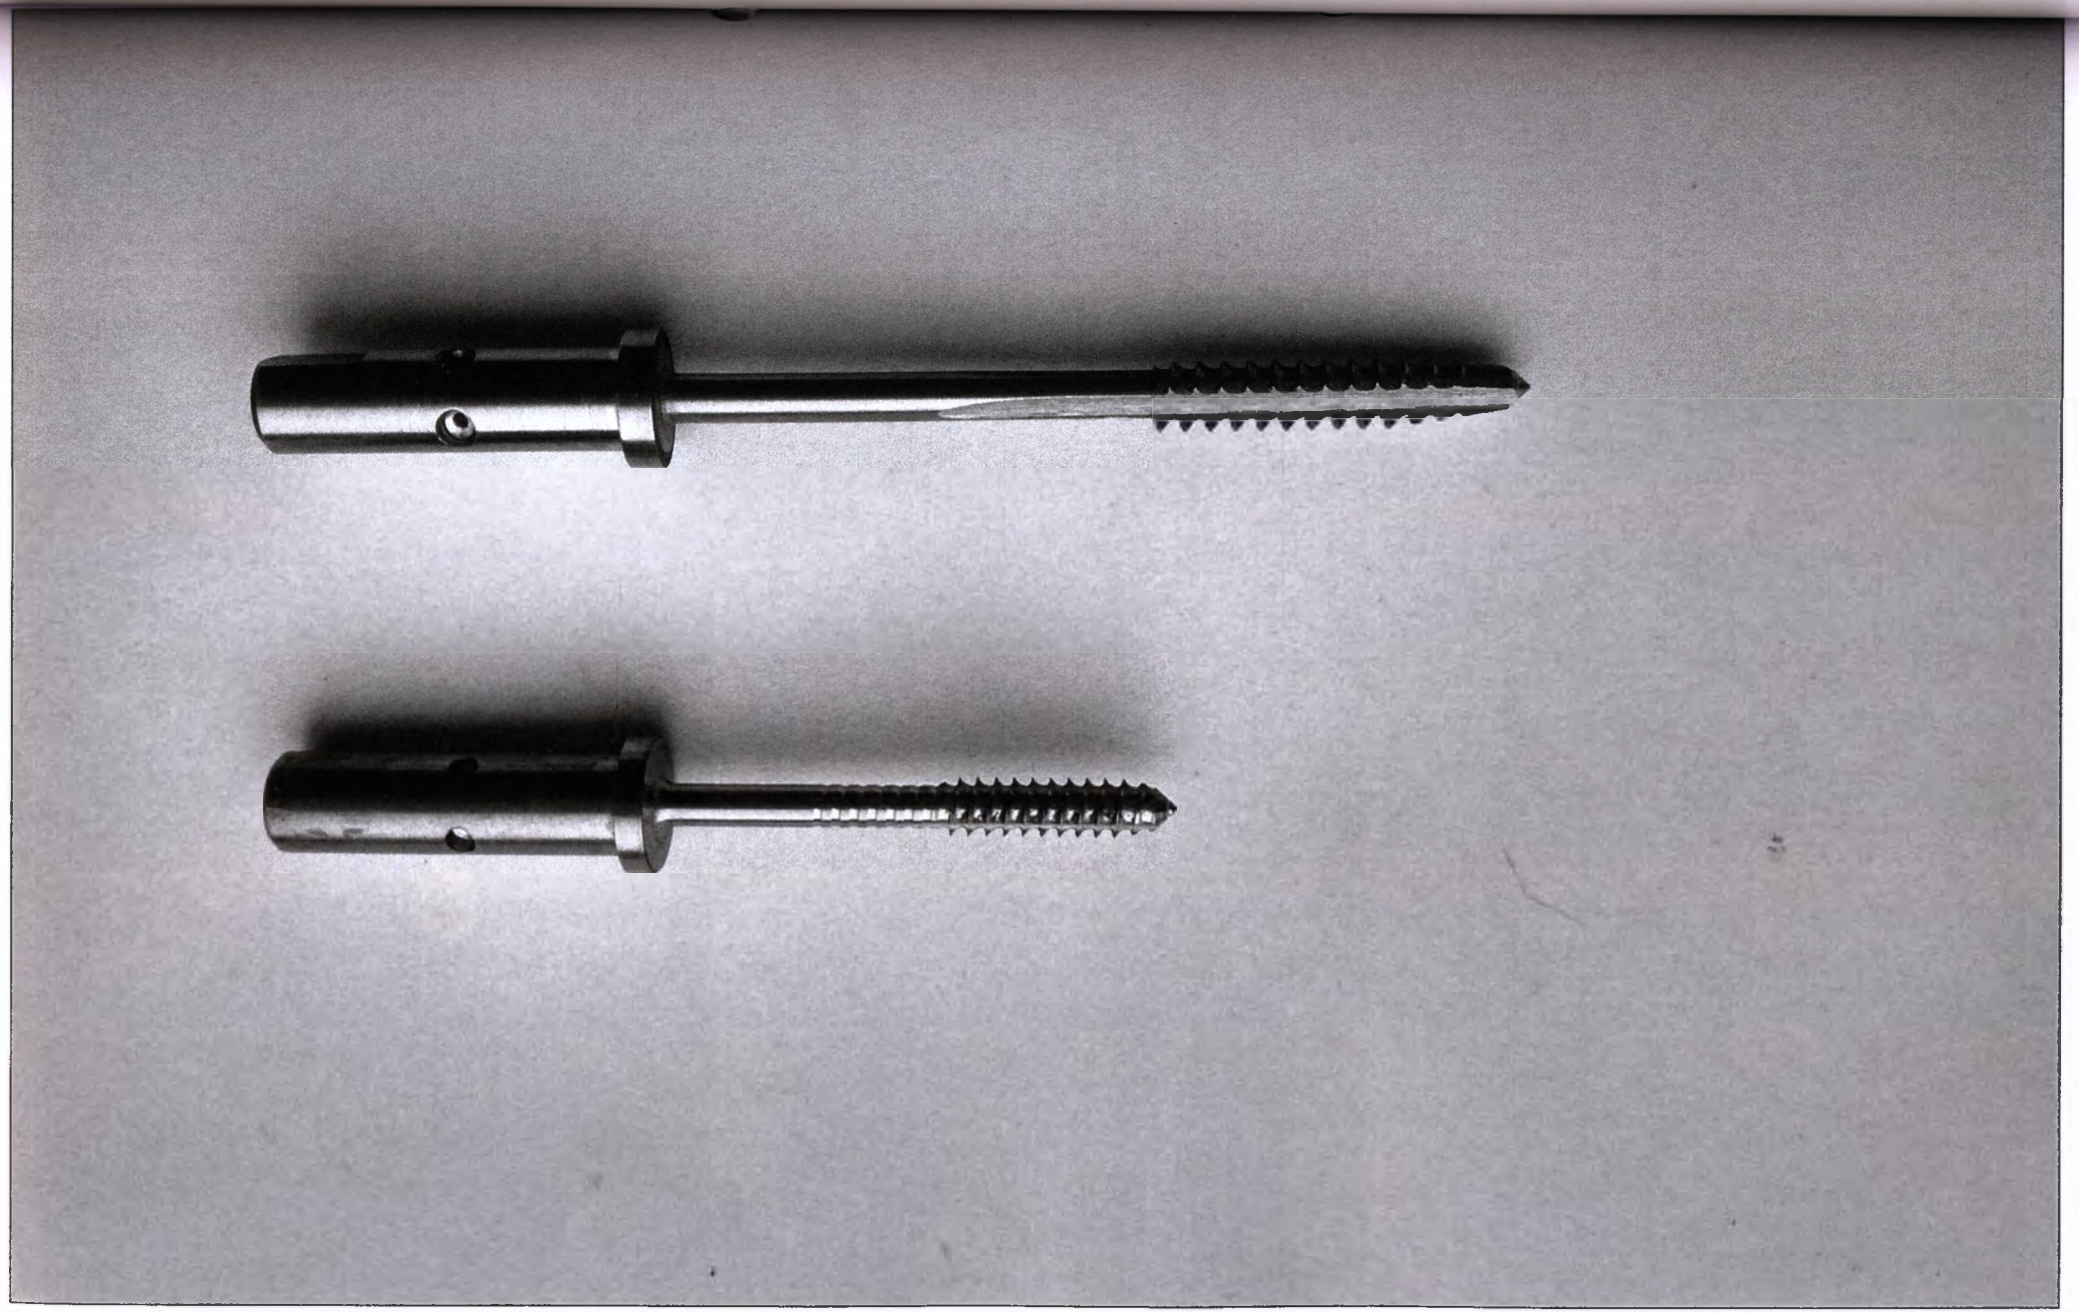

Набор метчиков для кортикальной резьбы (d= 3,5; 4,5мм) СВМД.20.02.11

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

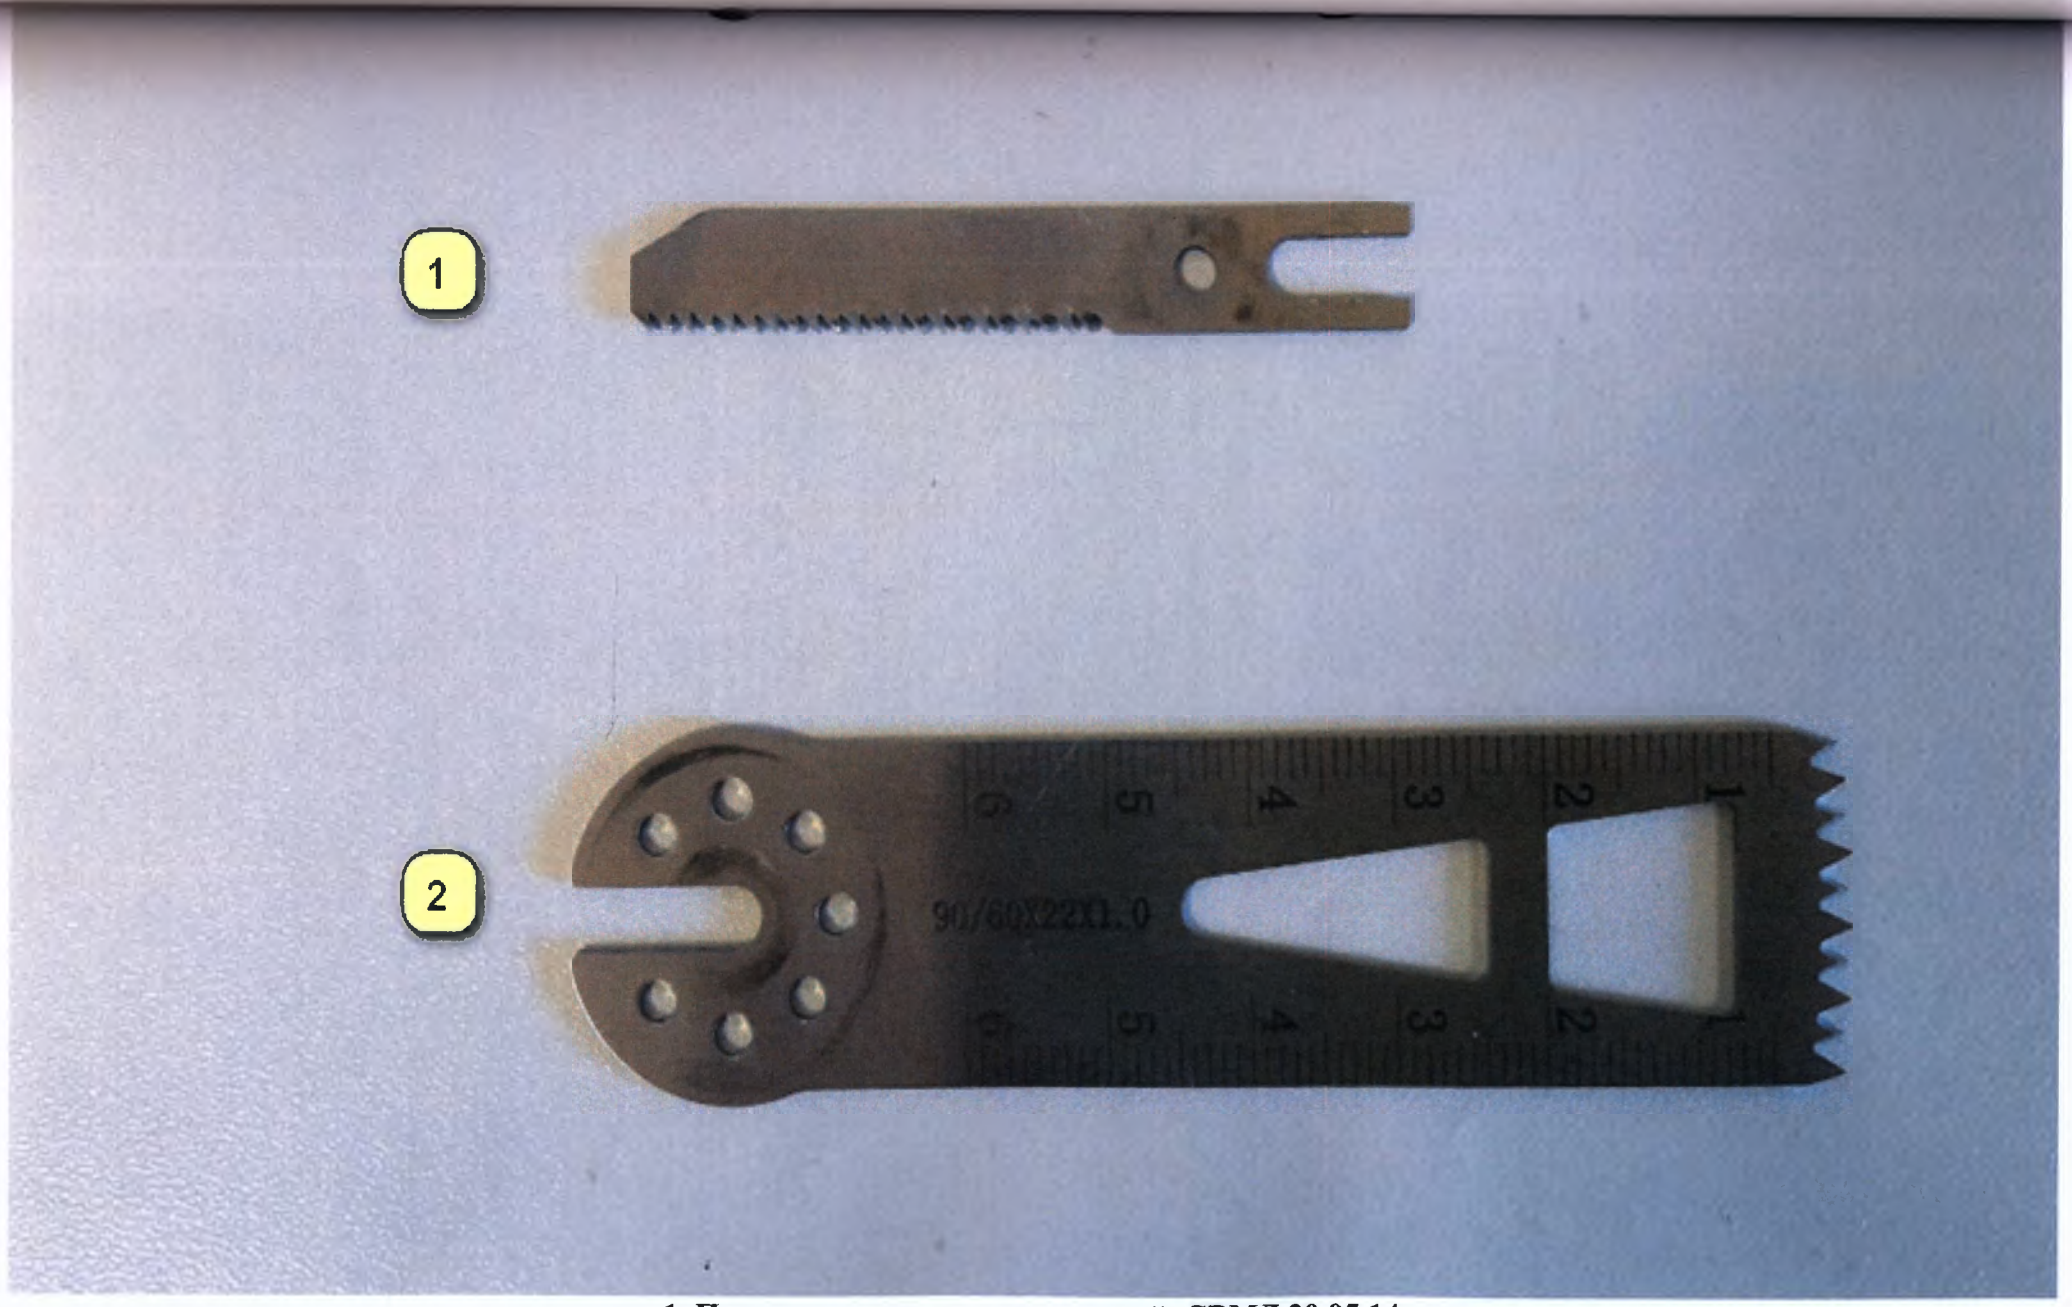

1. Полотно для пилы реципрокной СВМД.20.05.14
2. Полотно секторное СВМД.20.05.13

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

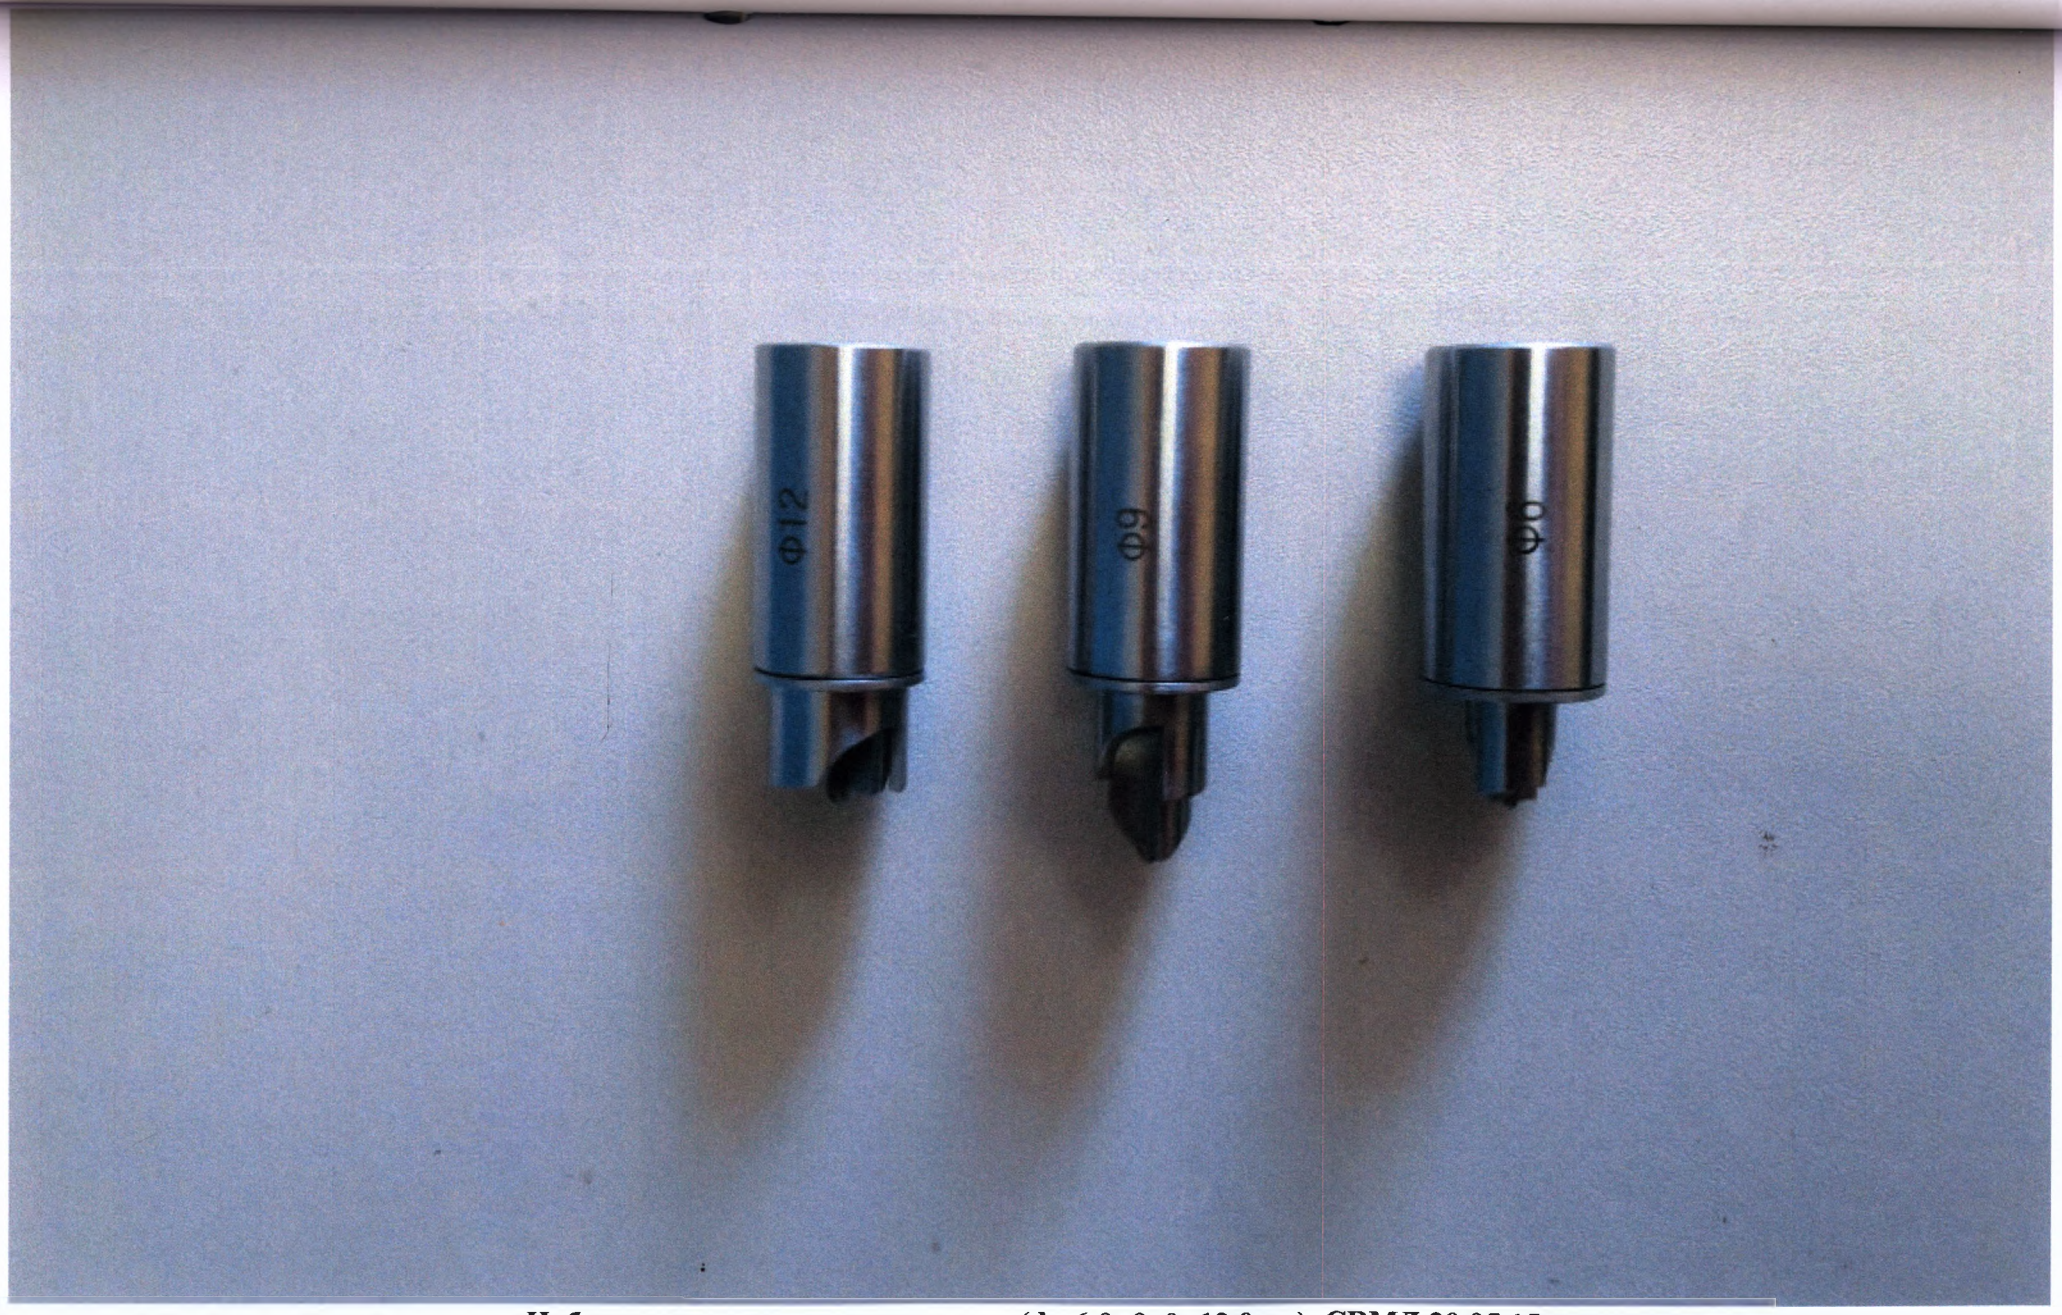

Набор насадок для краниотомии (d= 6,0; 9, 0; 12,0мм) СВМД.20.05.15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

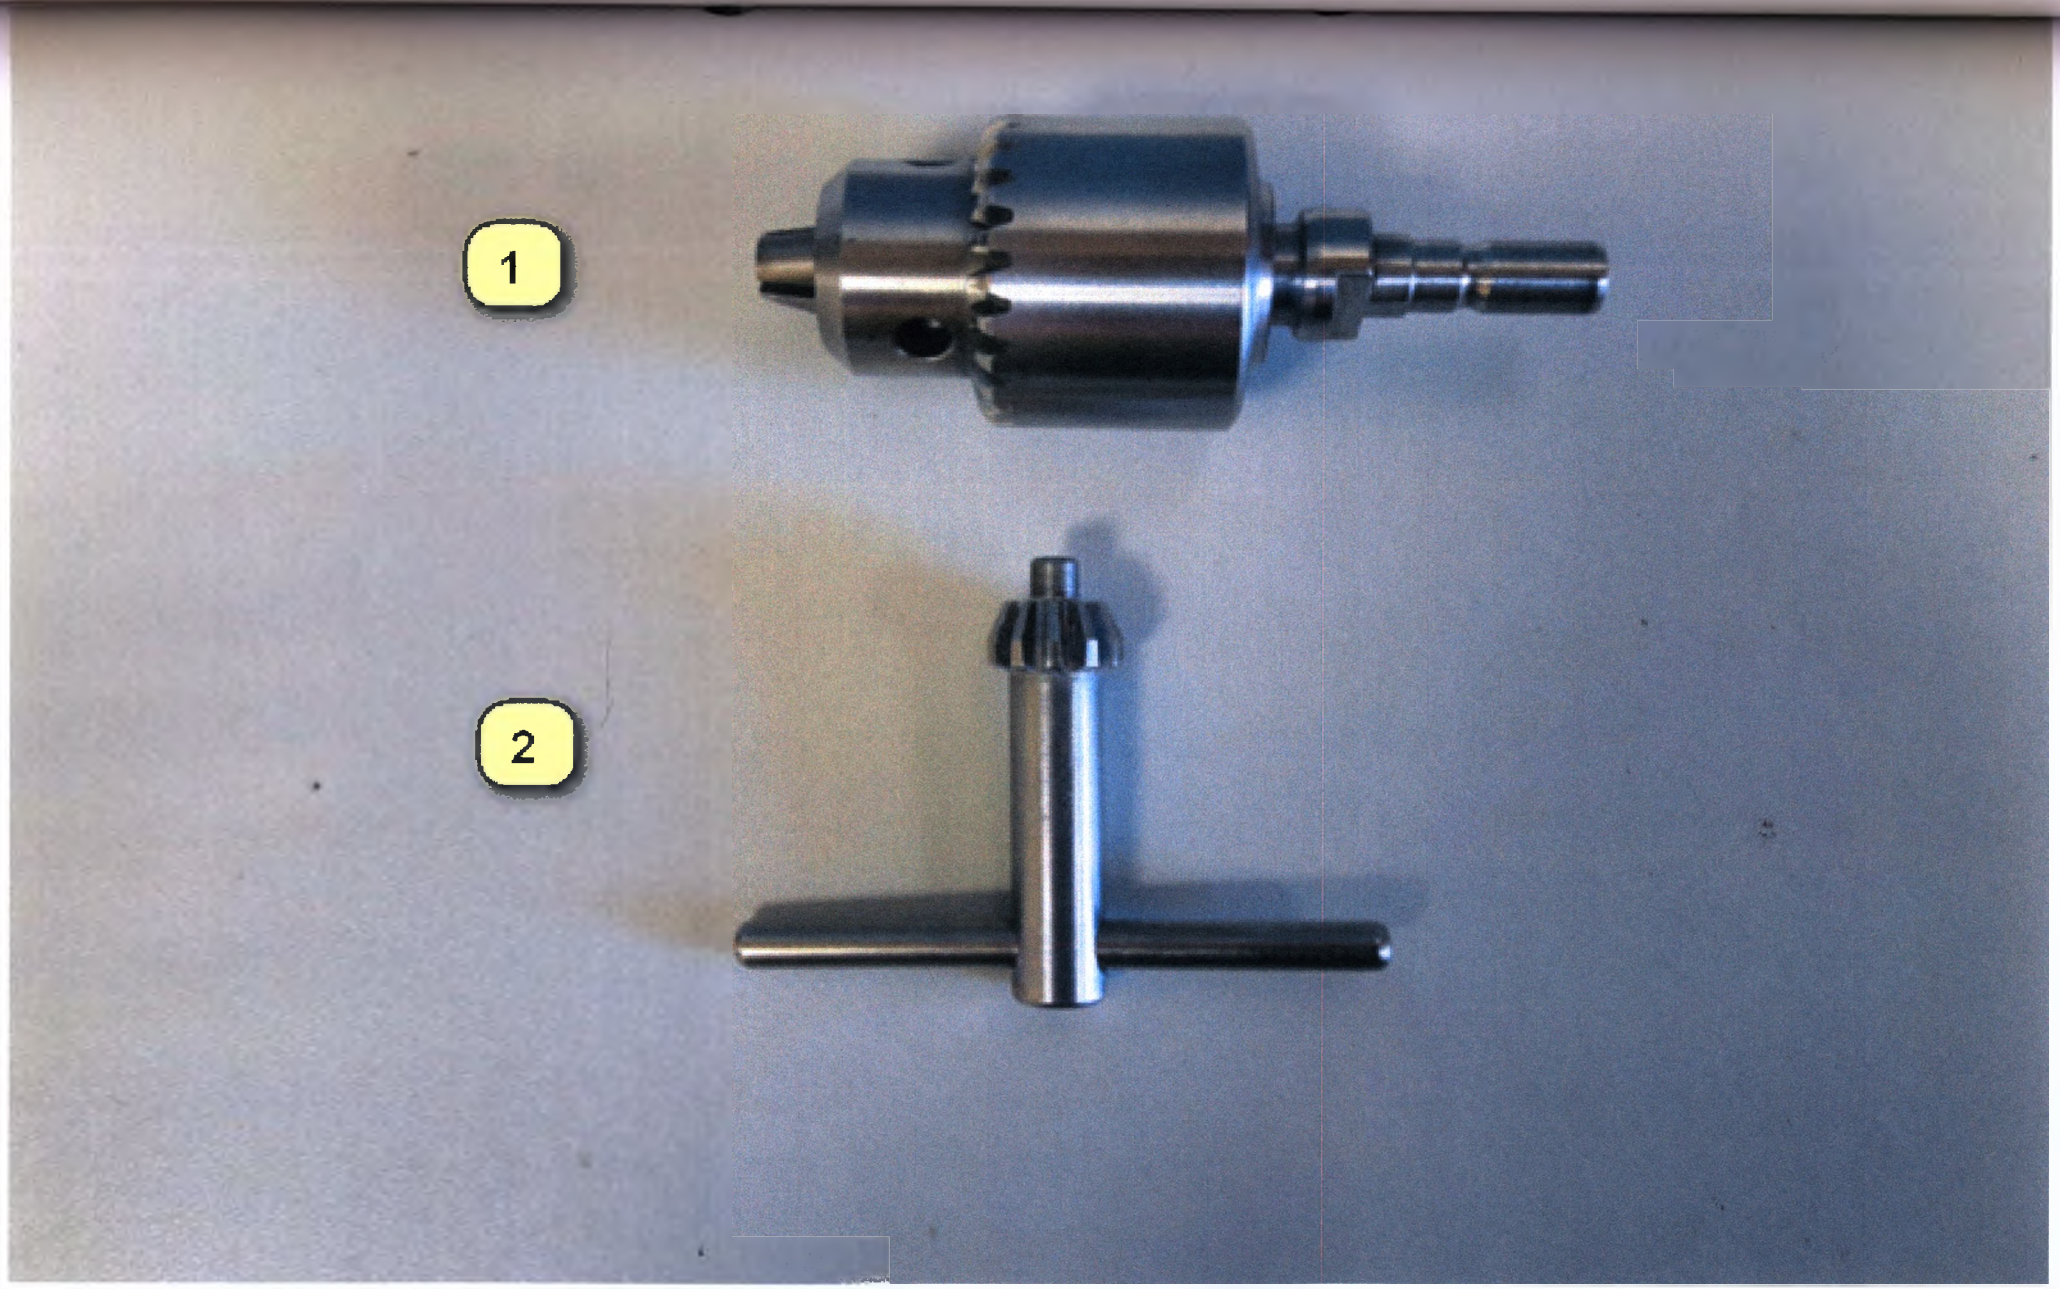

1. Патрон универсальный СВМД.20.02.02
2. Ключ к универсальному патрону СВМД.20.02.03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

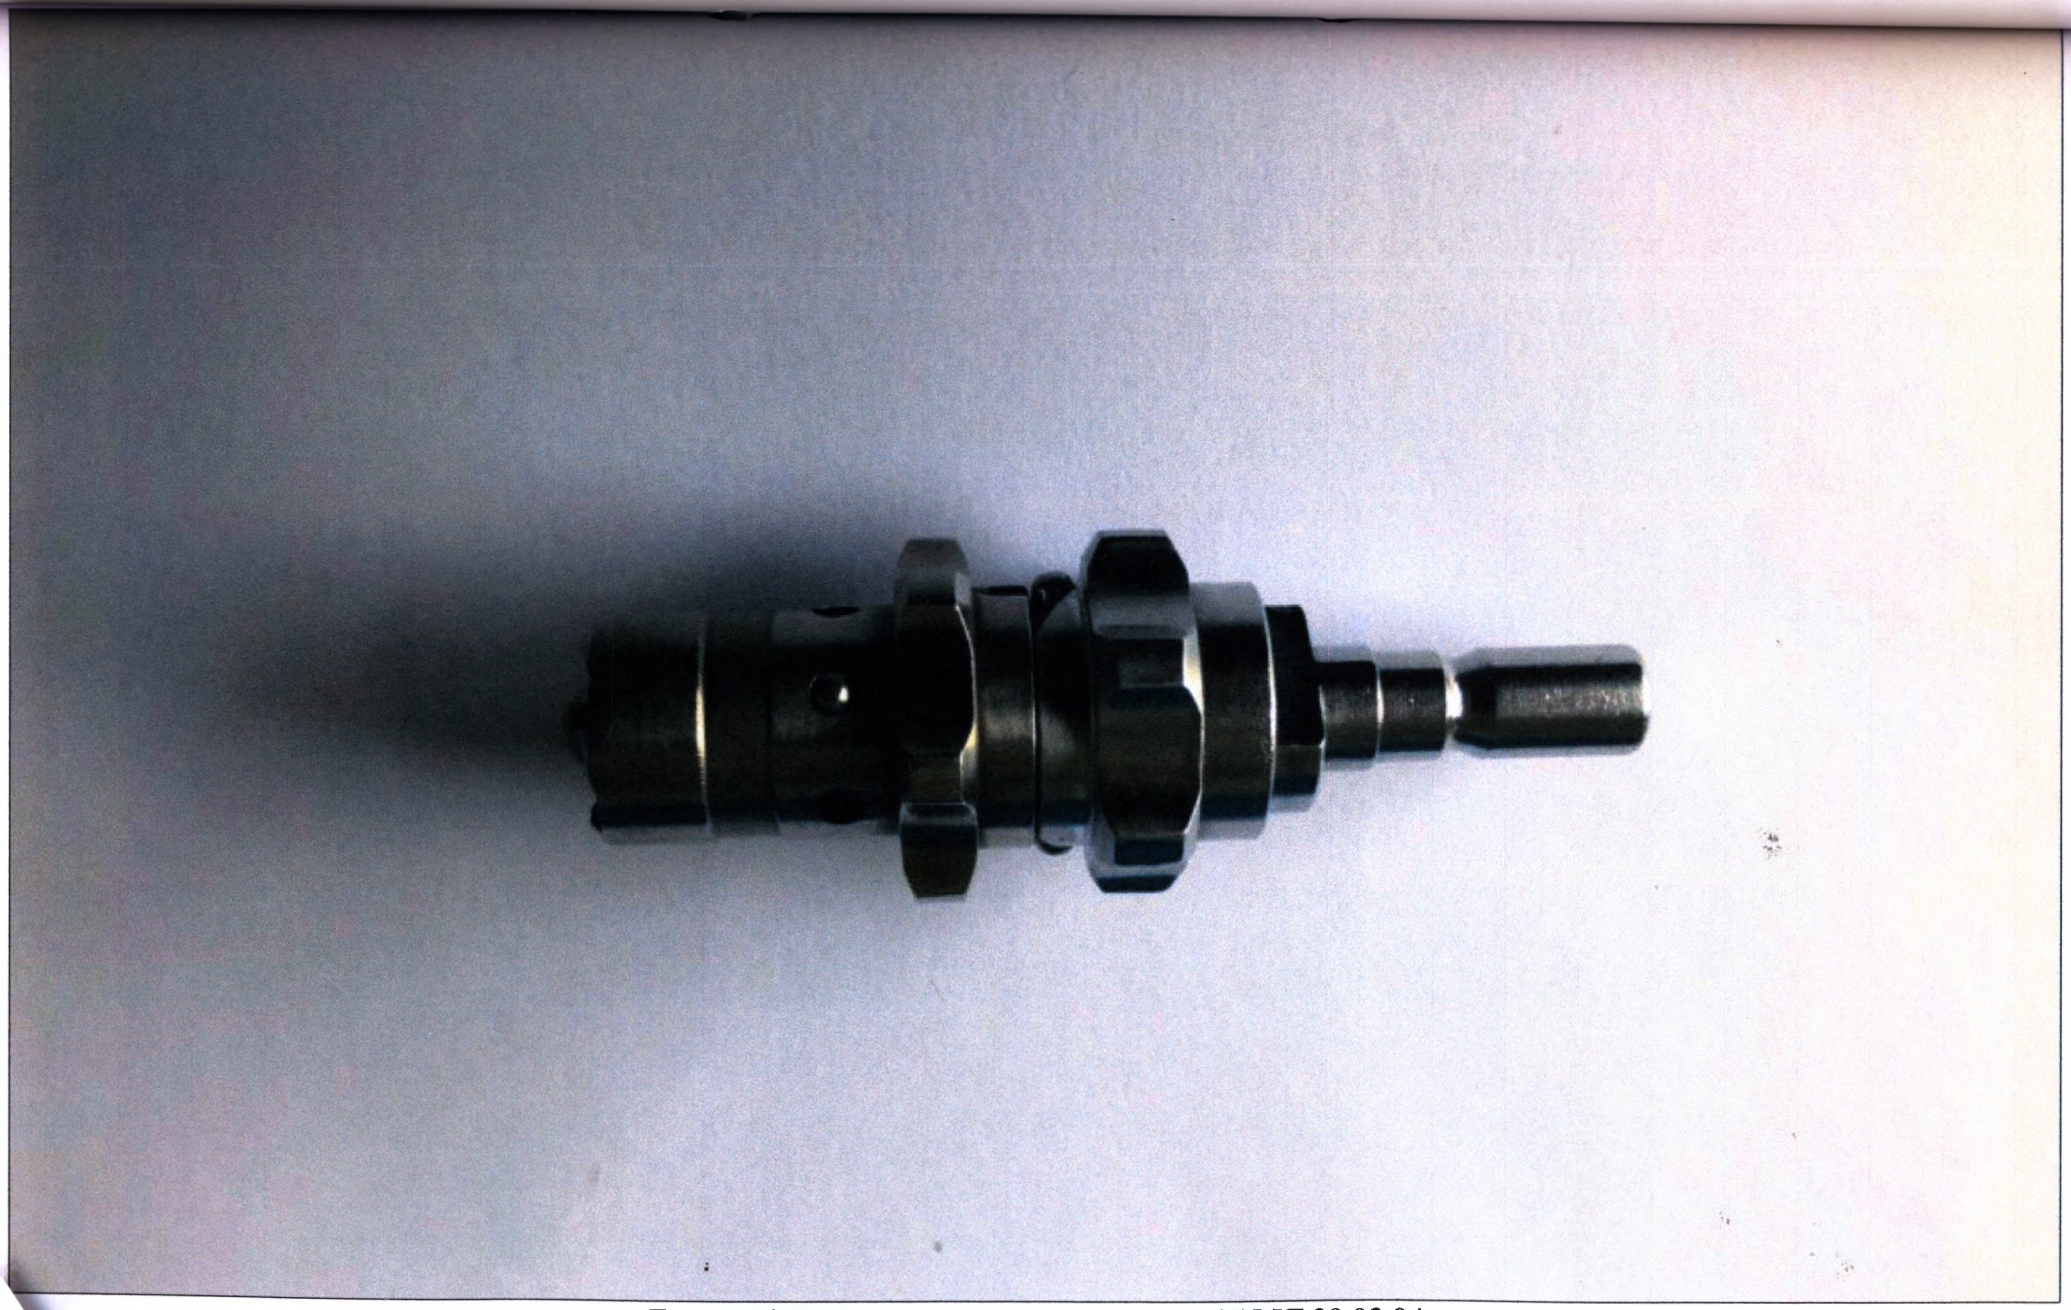

Дрель ДЭТ-03. Адаптер для автостопа СВМД.20.03.04

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зарядное устройство 220/14,4В СВМД.20.01.04

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аккумуляторная батарея 14.4В СВМД. 20.01.02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зарядное устройство 220/7,2 В СВМД. 20.06.03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аккумуляторная батарея 7.2В. СВМД.20.06.02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

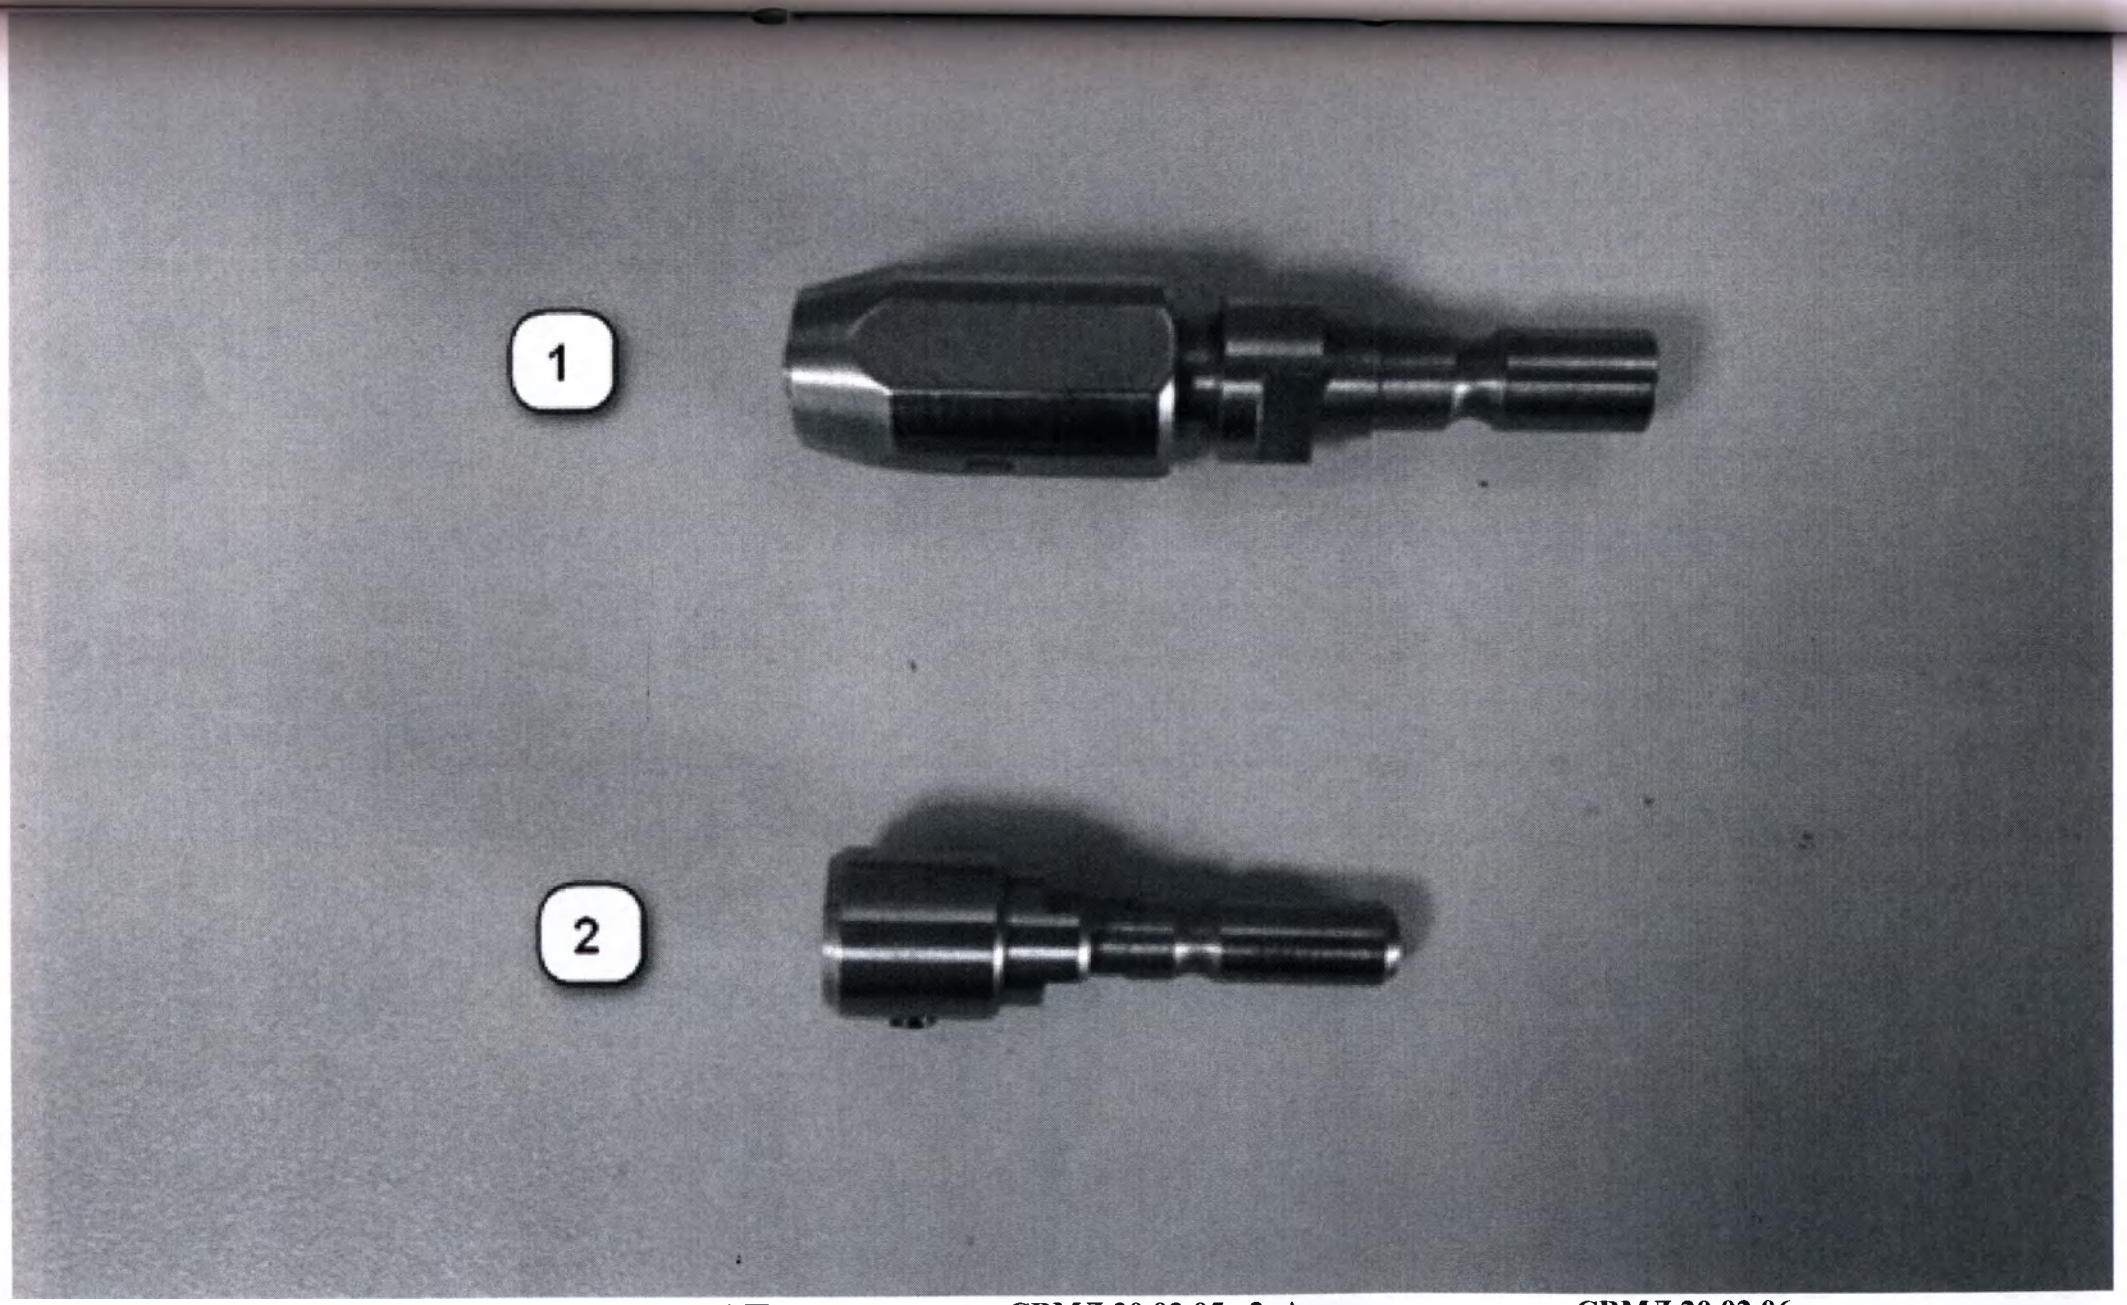

1.Патрон для спиц СВМД.20.02.05 2. Адаптер для сверла СВМД.20.02.06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

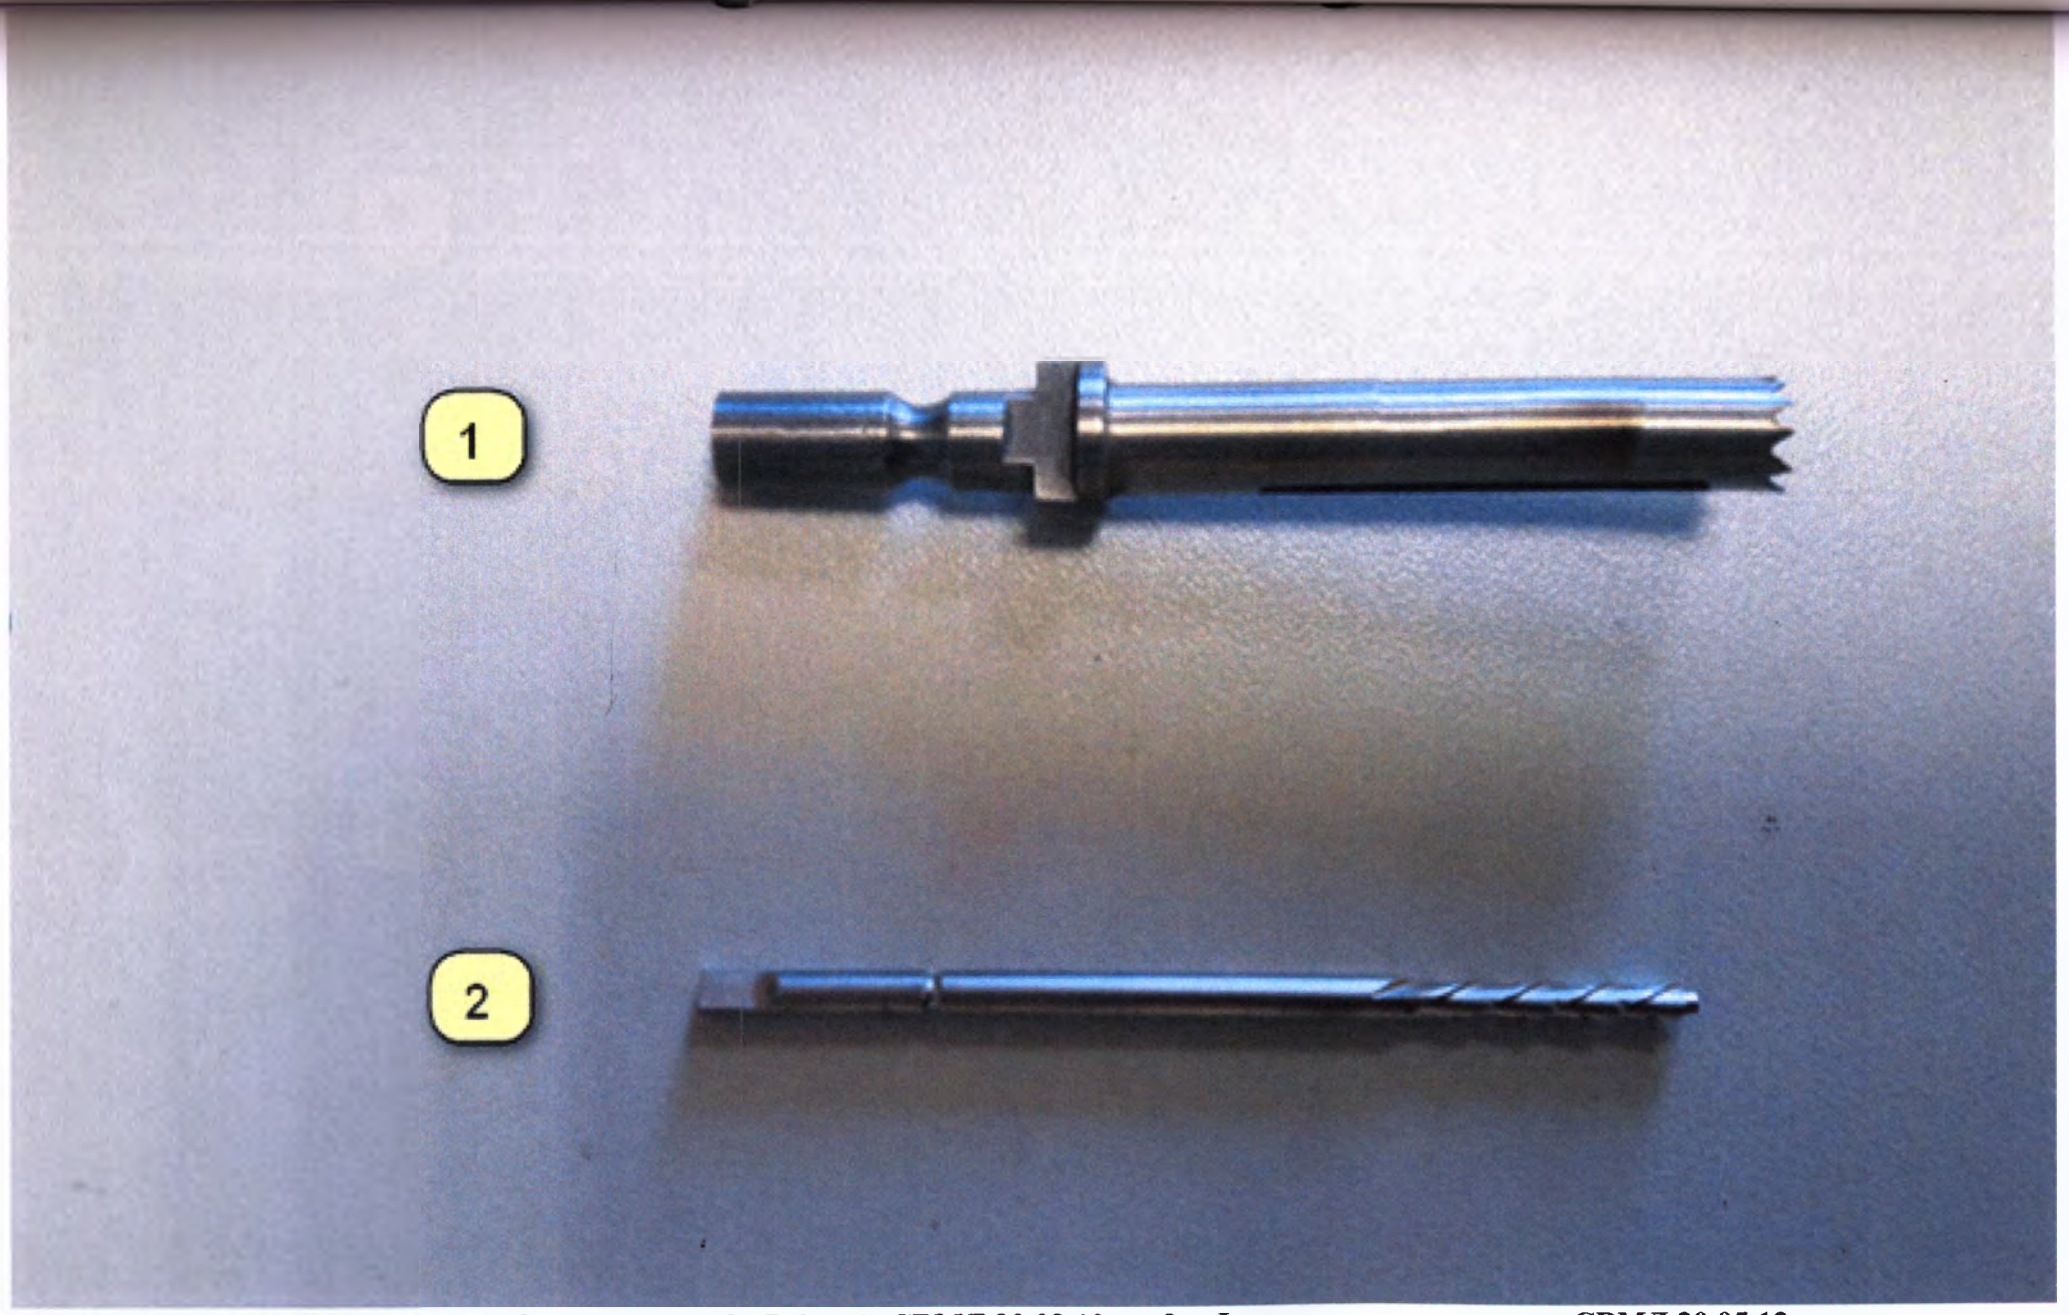

1. Фреза полая (d= 7, 0 мм) СВМД.20.02.10 . 2. Фреза цилиндрическая СВМД.20.05.12

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

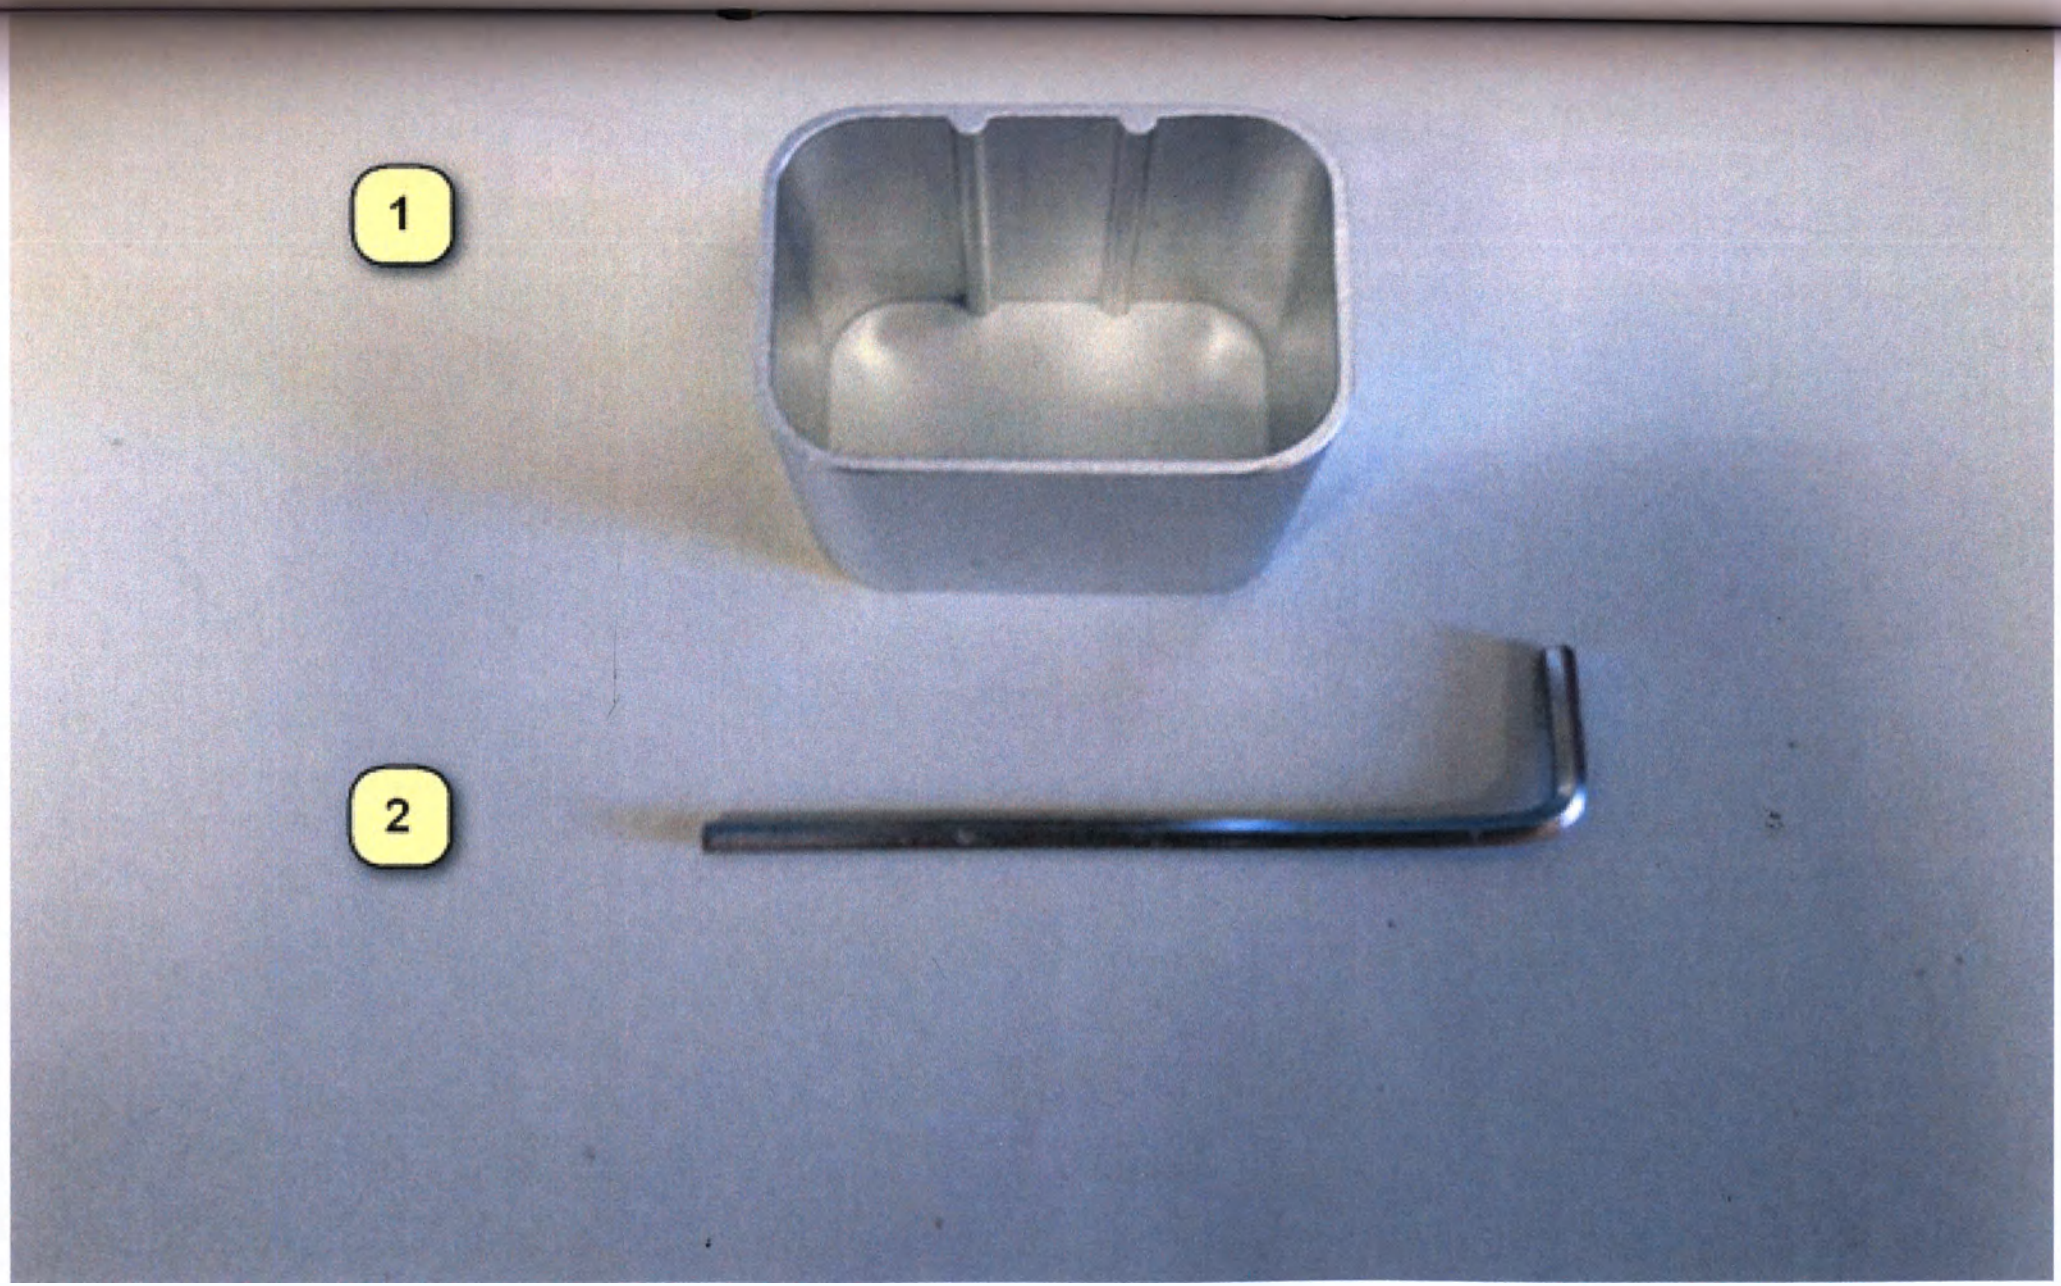

1. Асептический переходник. СВМД.20.01.03. 2. Отвертка технологическая .

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

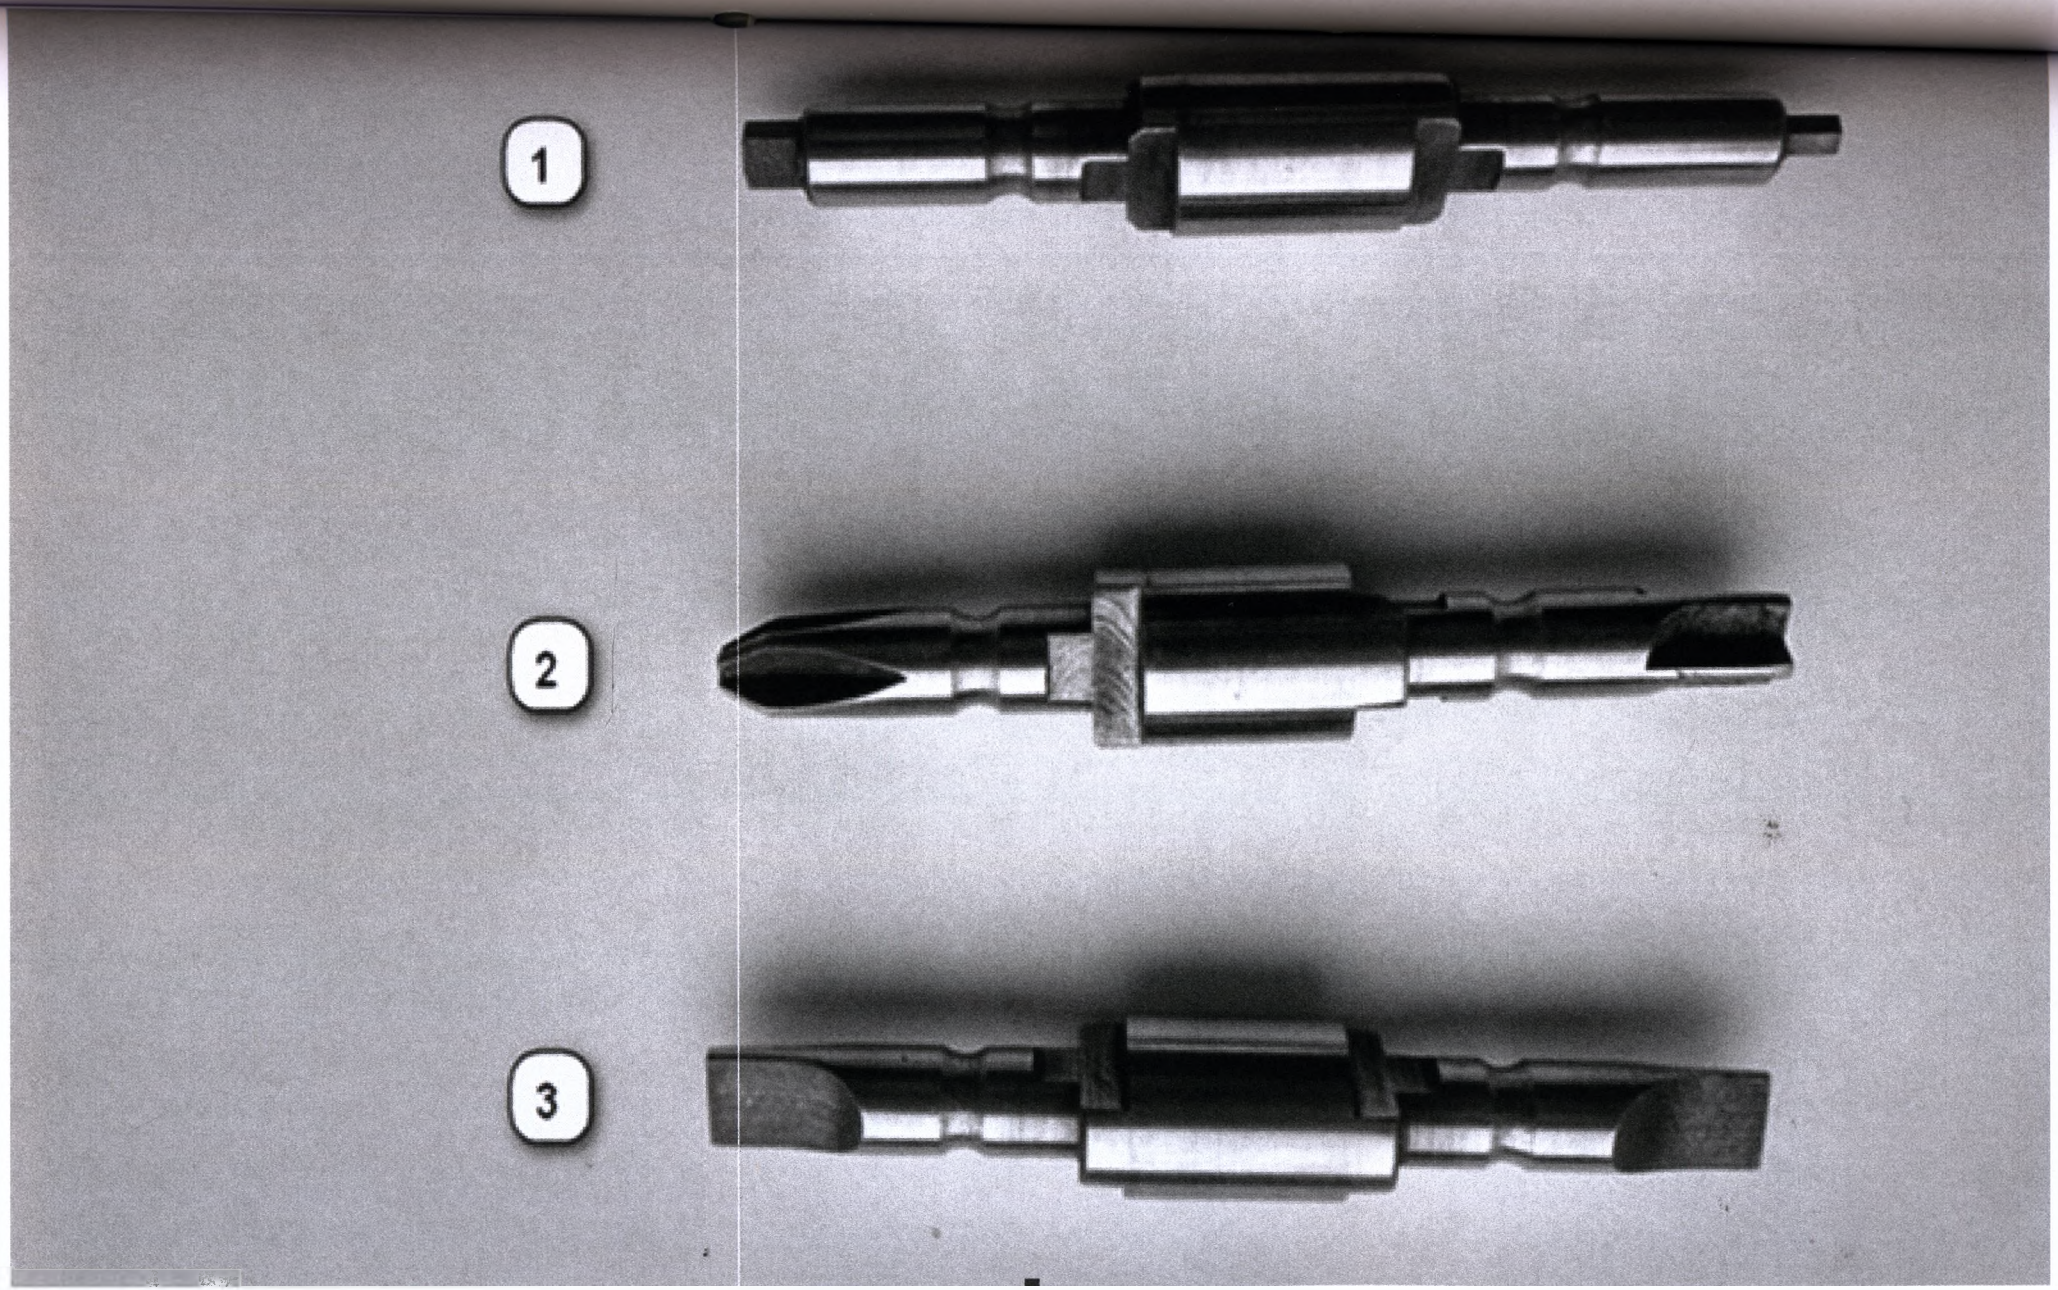

1. Отвертка шестигранная двухсторонняя (S=2,5мм и S=3,5мм) СВМД.20.02.09; 2. Отвертка крестовая двухсторонняя СВМД.20.02.07; 3. Отвертка плоская двухсторонняя СВМД.20.02.08.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

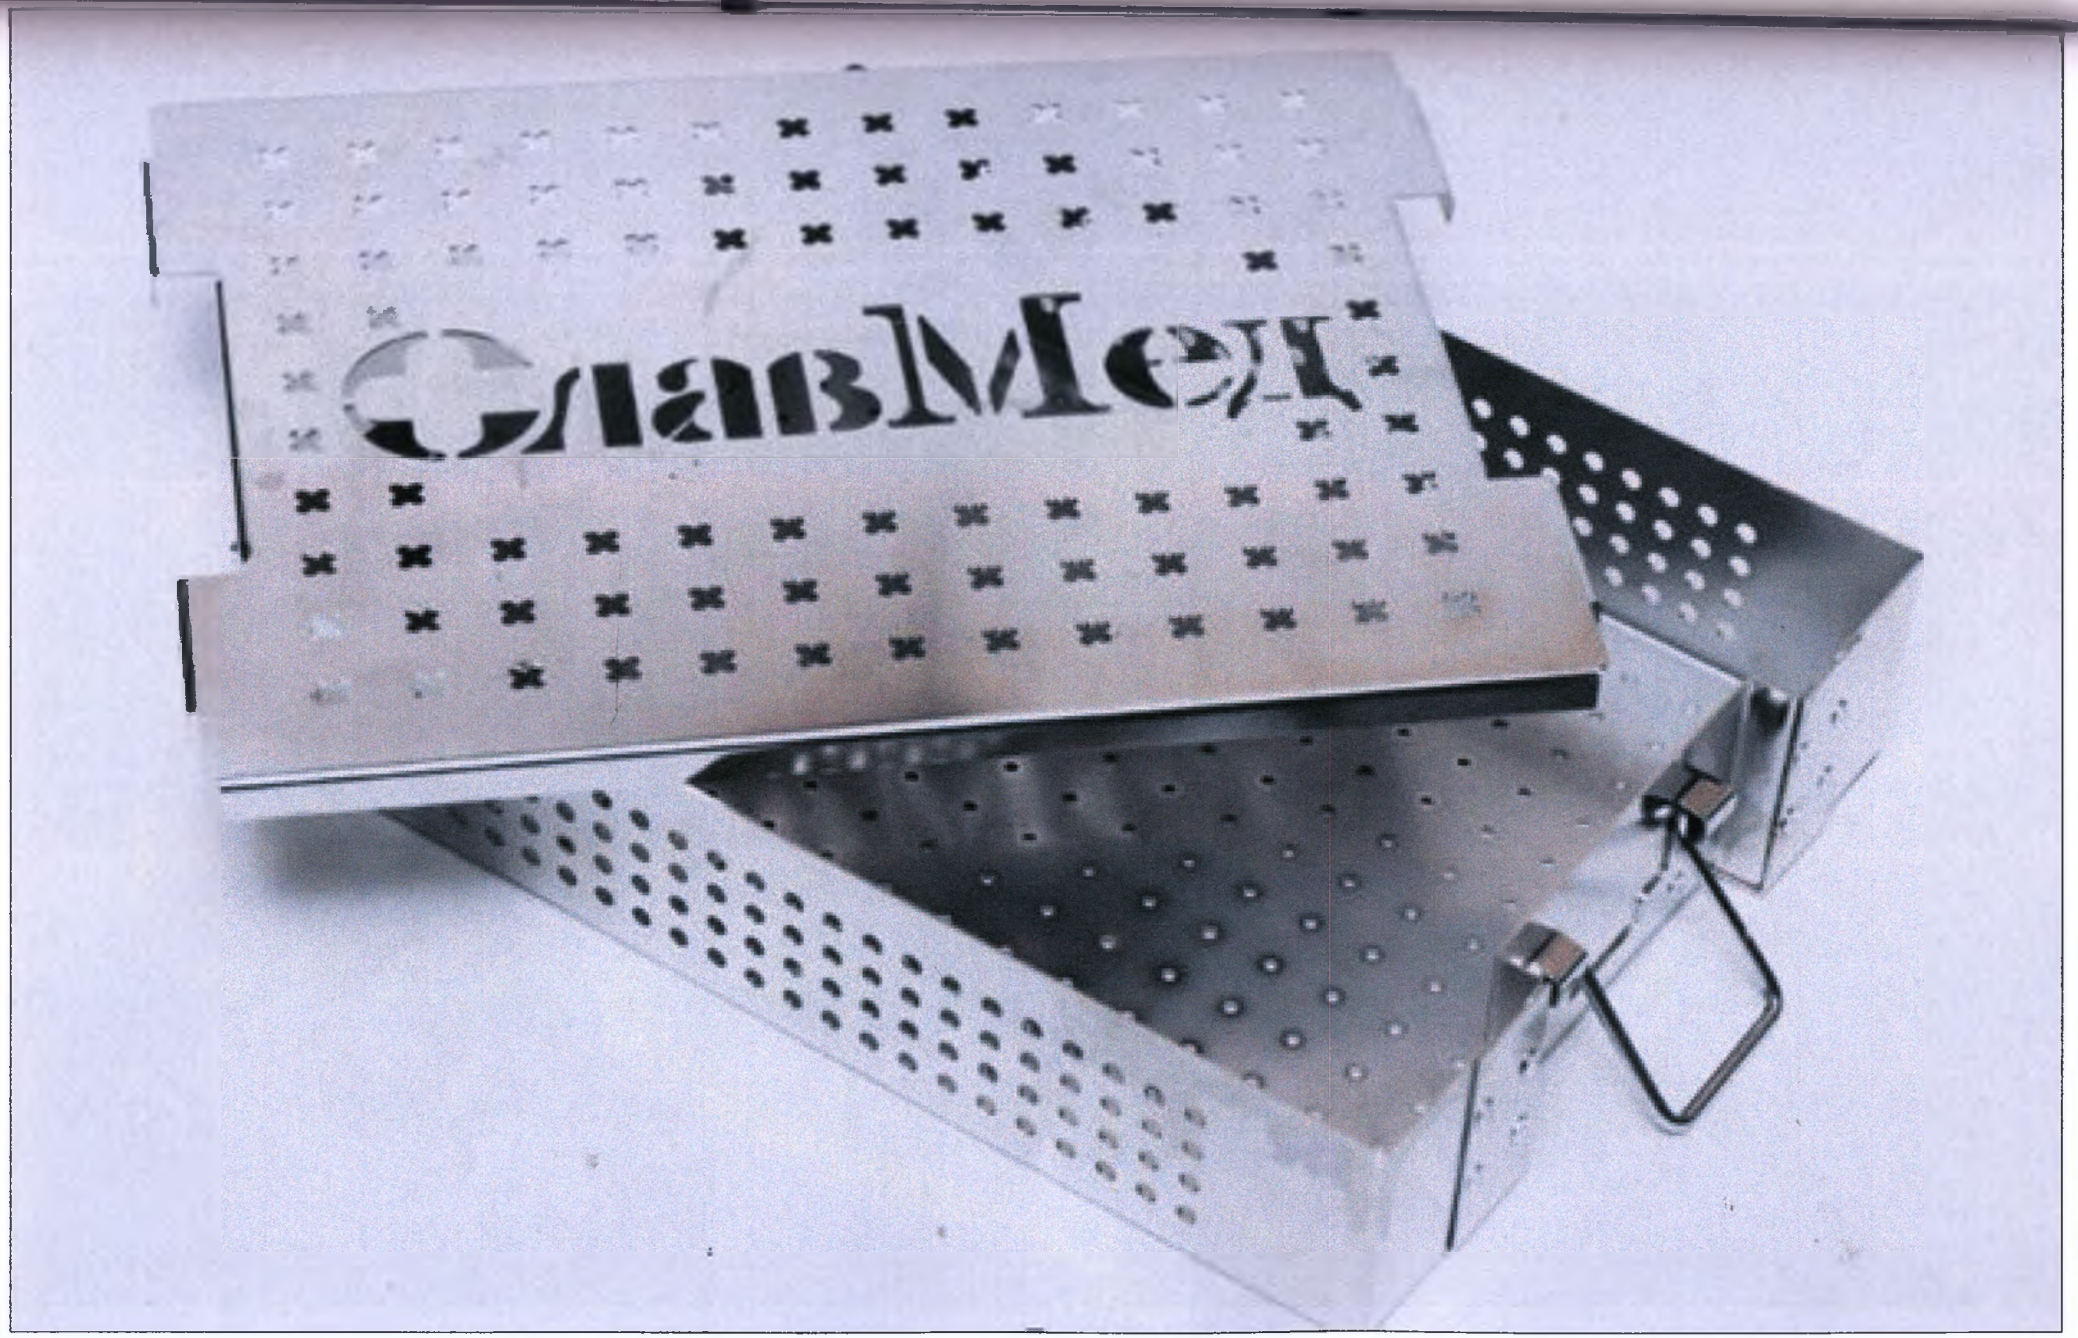

Контейнер для стерилизации. СВМД.20.20.00

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

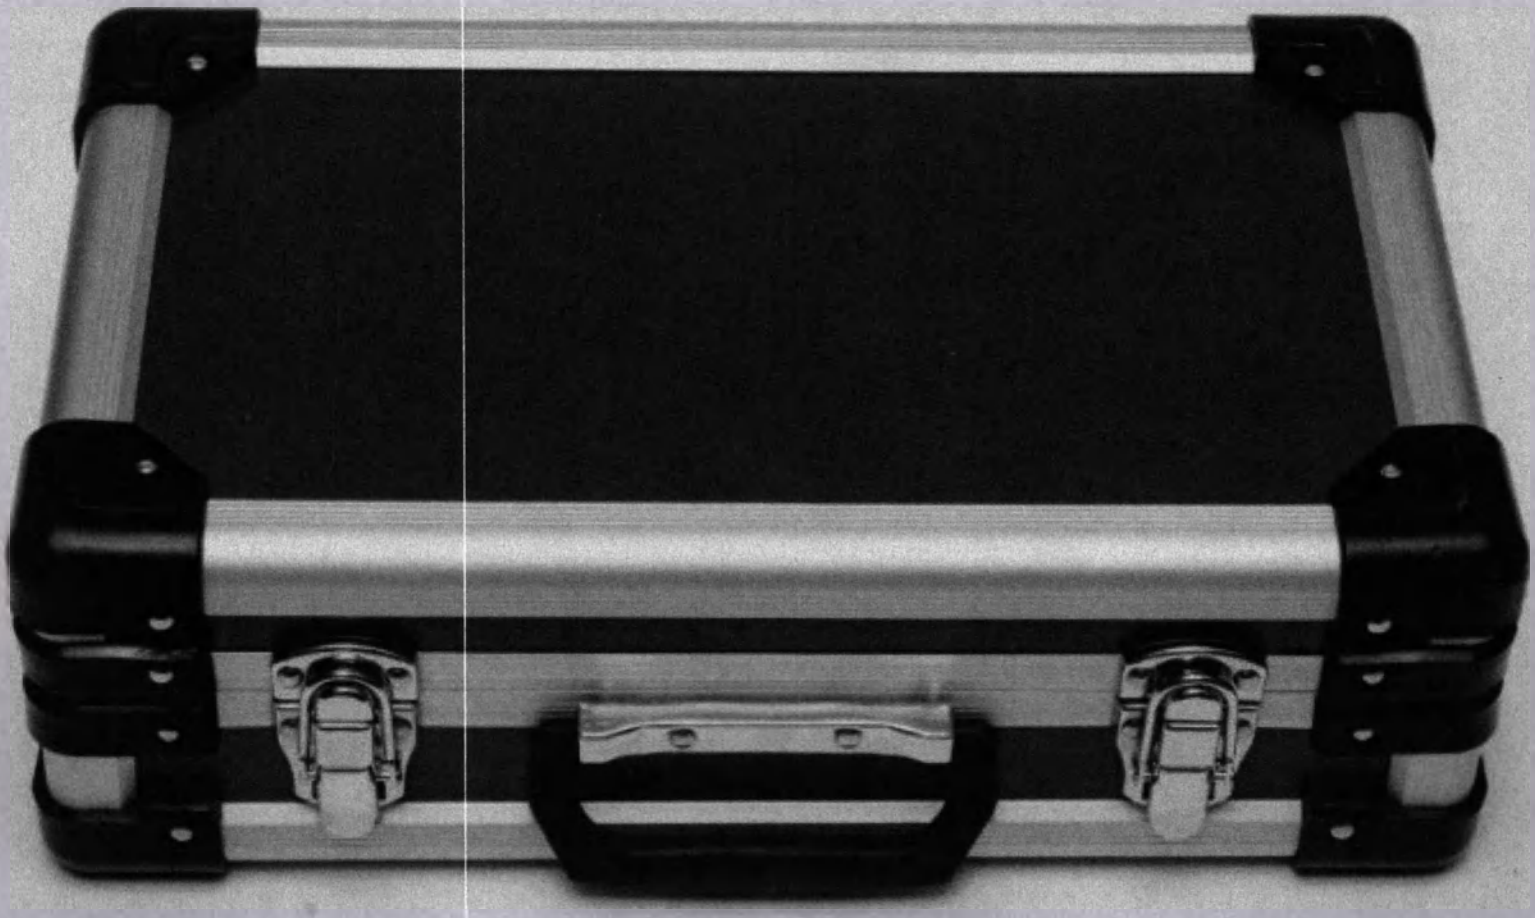

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
20.01.06, СВМД.20.02.05, СВМД.20.03.06, СВМД.20.04.04, СВМД.20.05.16, СВМД.20.06.04, СВМД.20.07.02

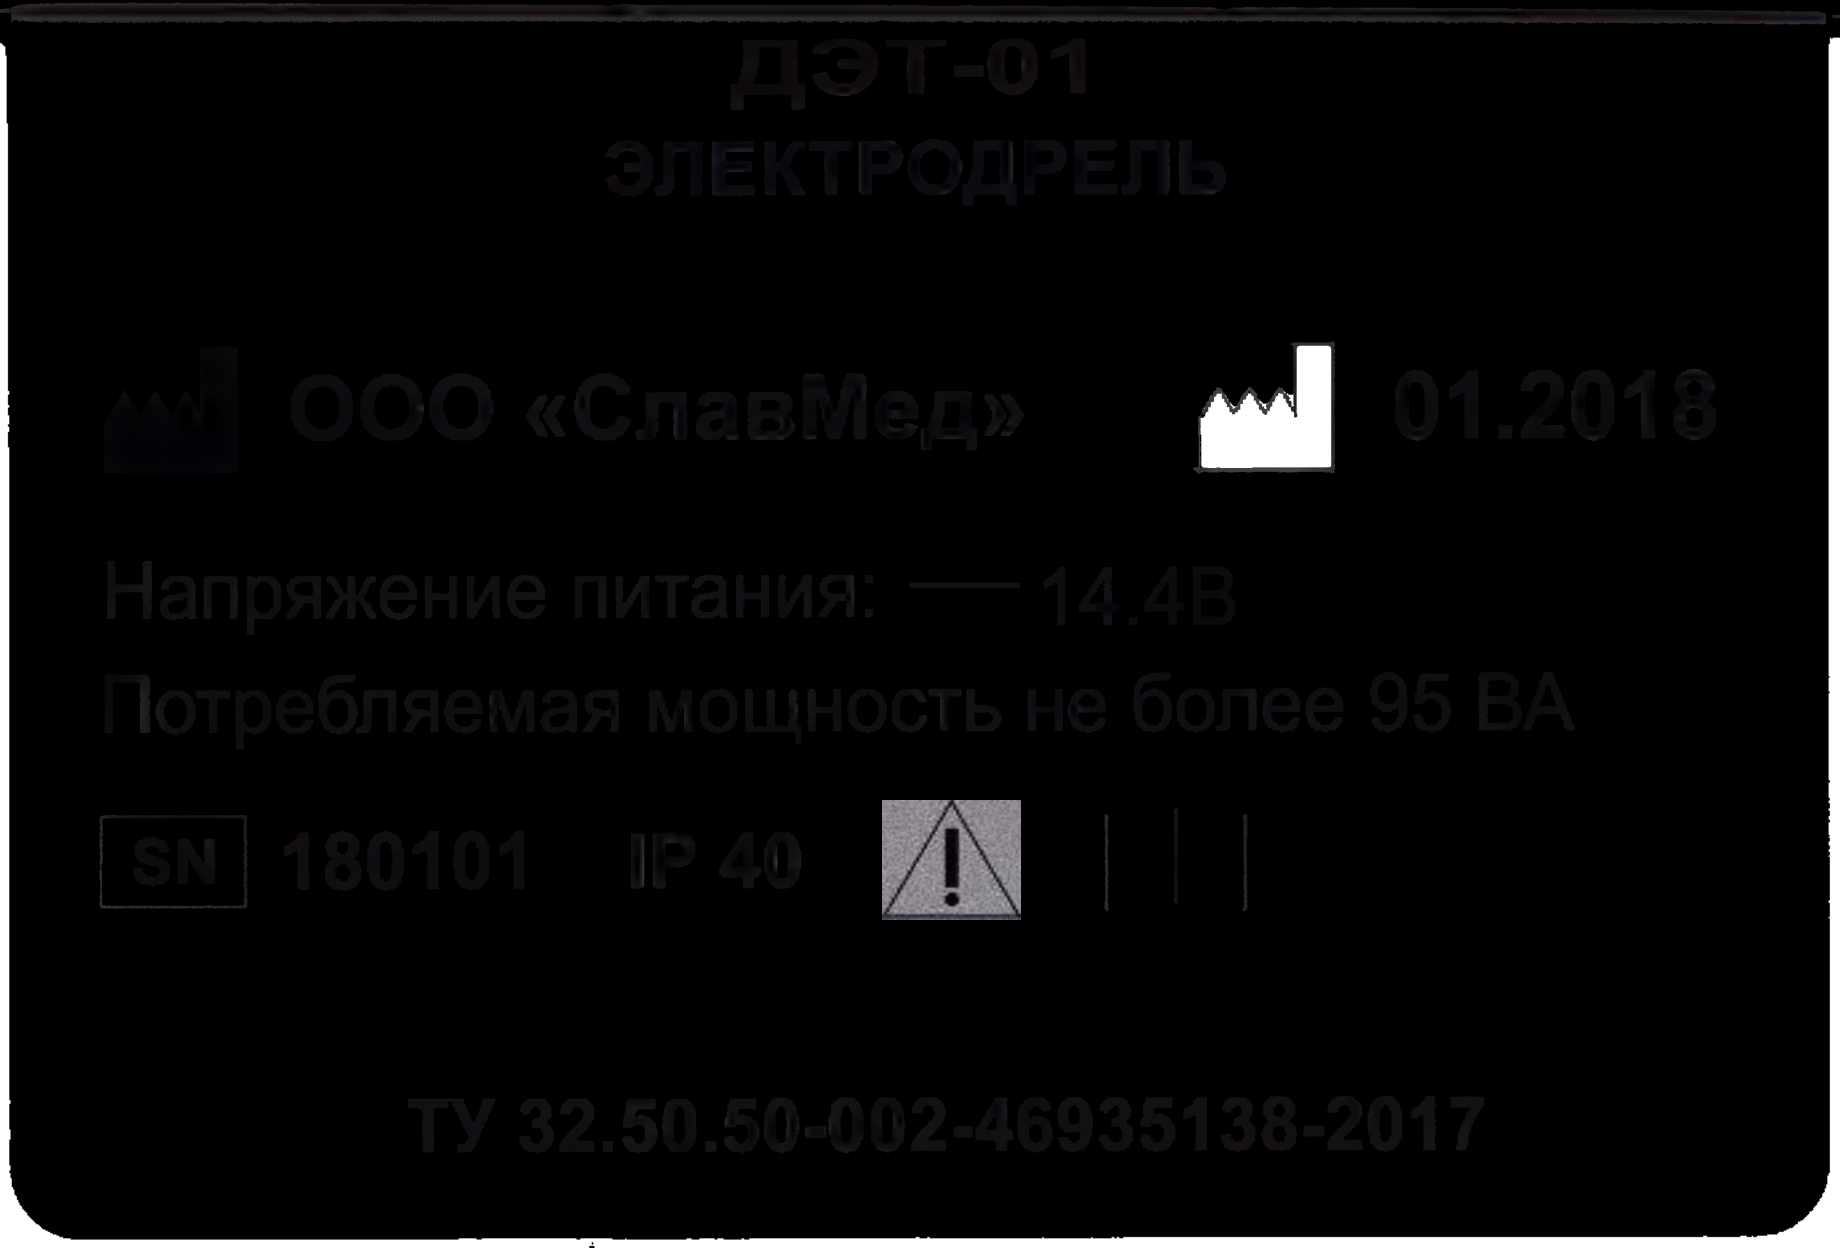

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электродрели ДЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электродрели ДЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

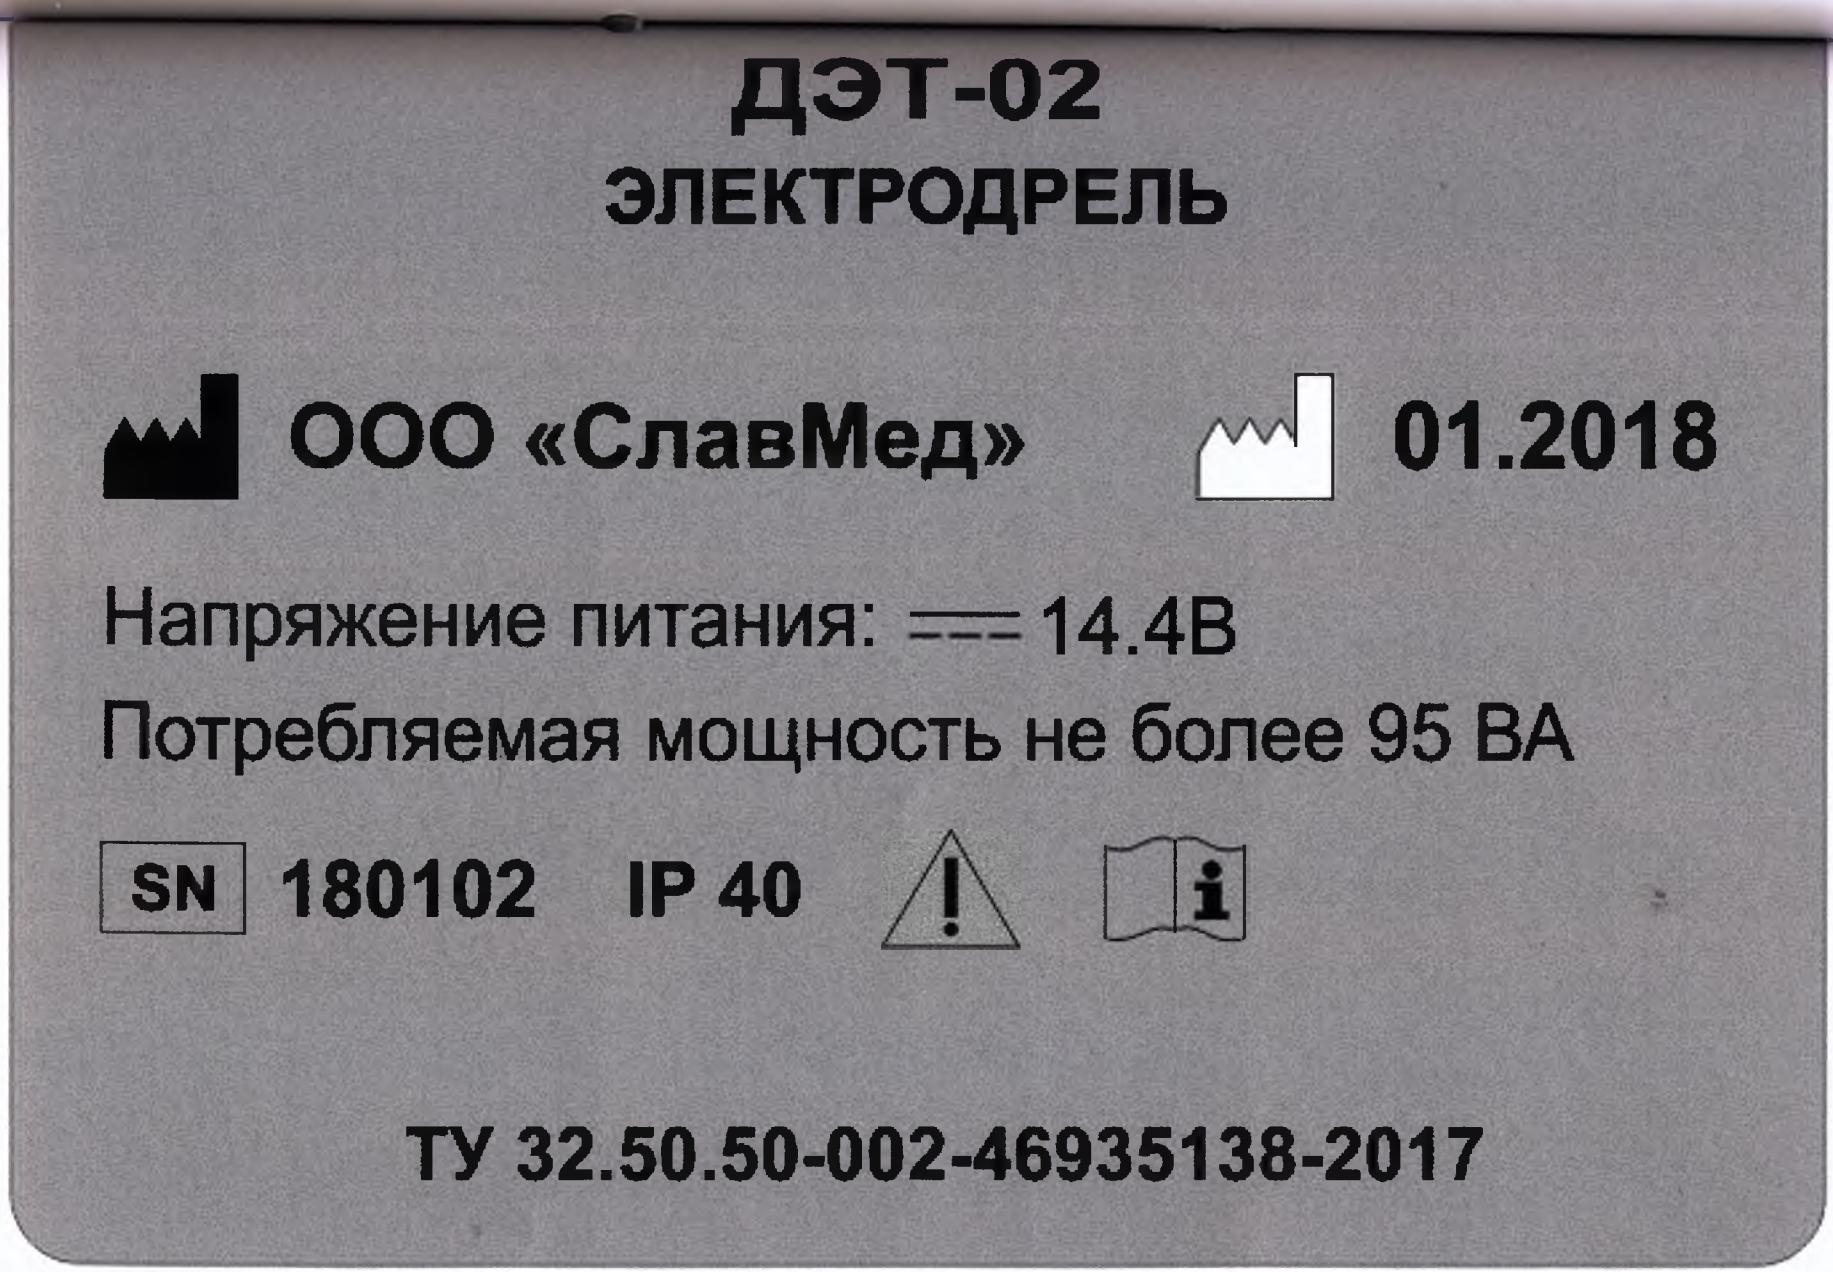

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электродрели ДЭТ-02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

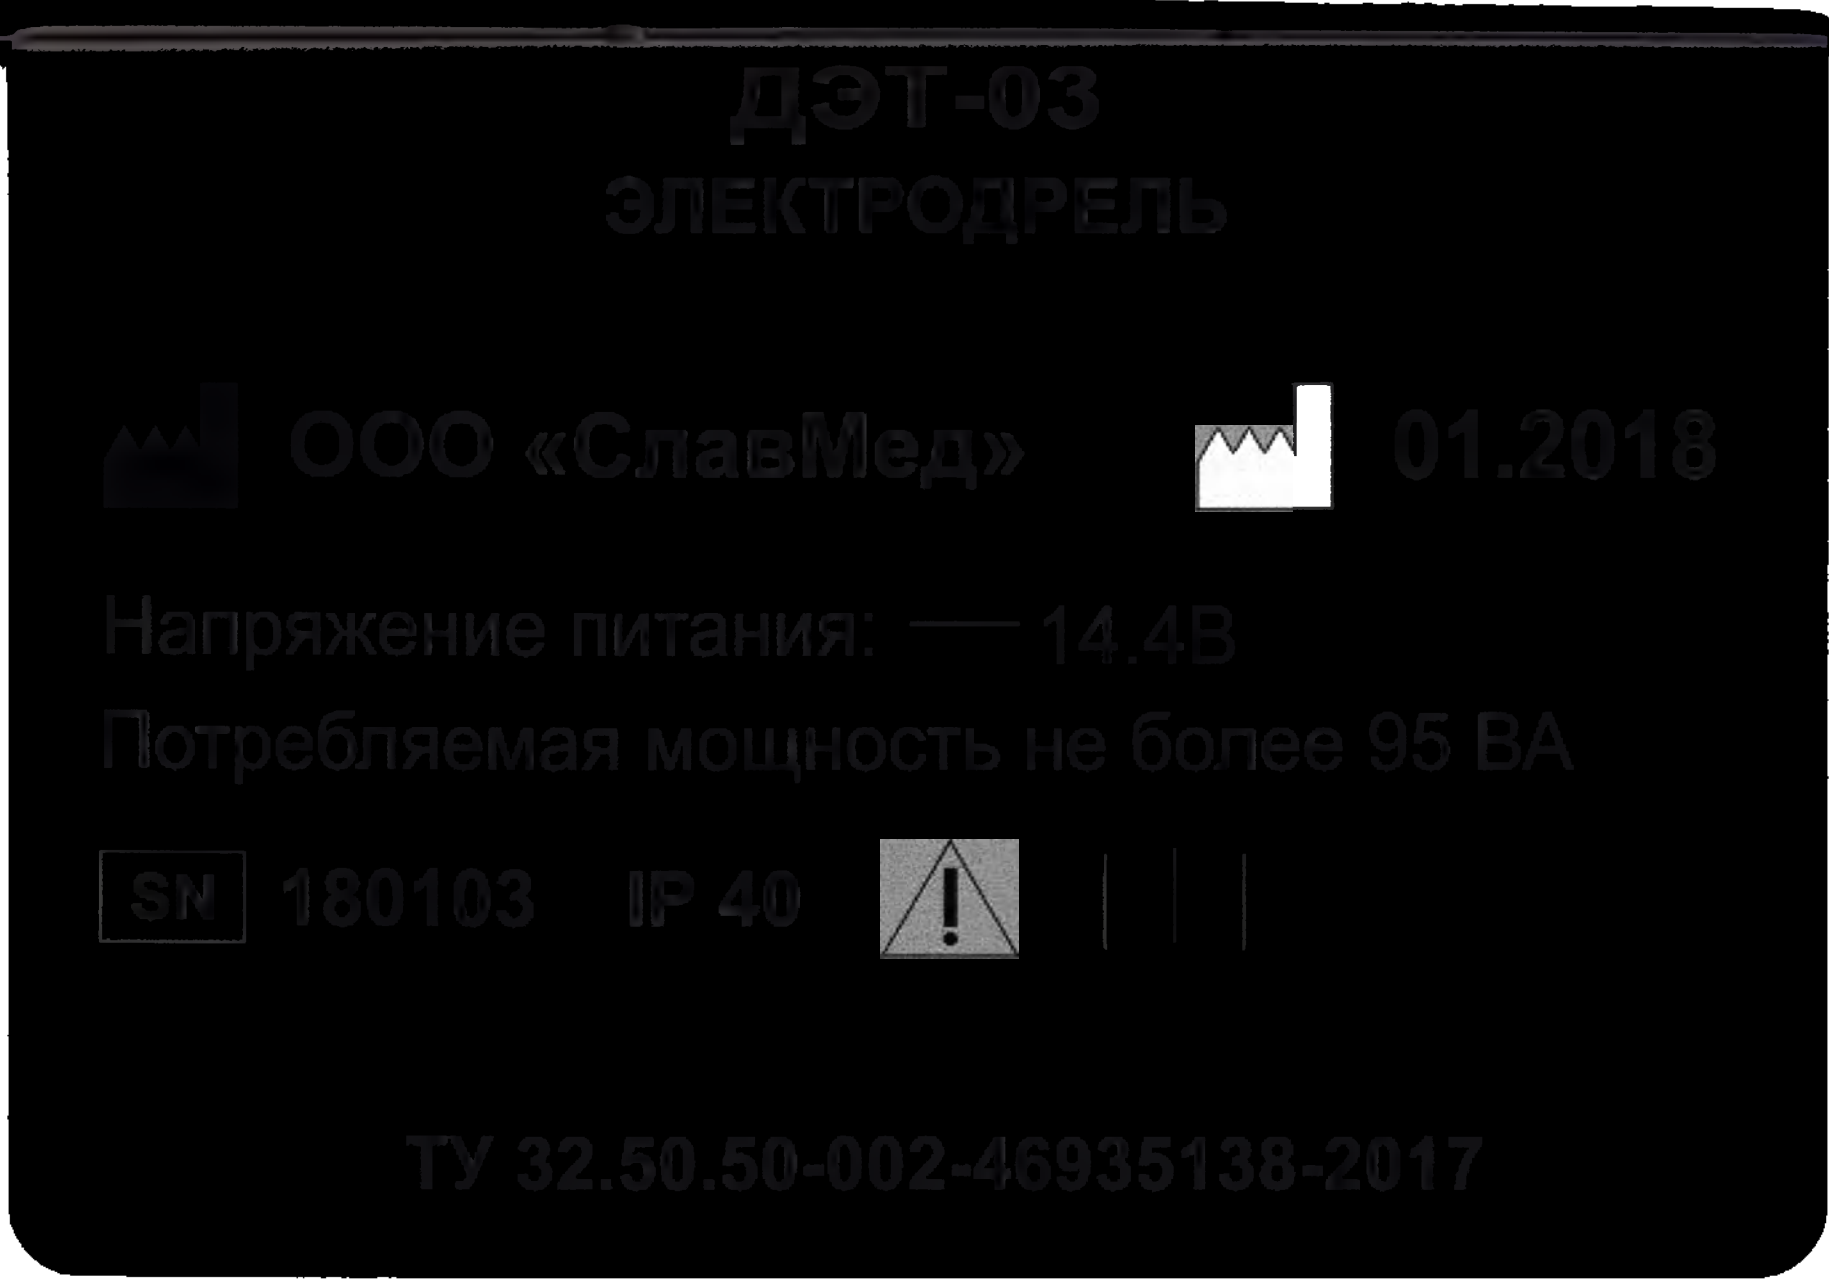

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электродрели ДЭТ-03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электродрели ДЭТ-04

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

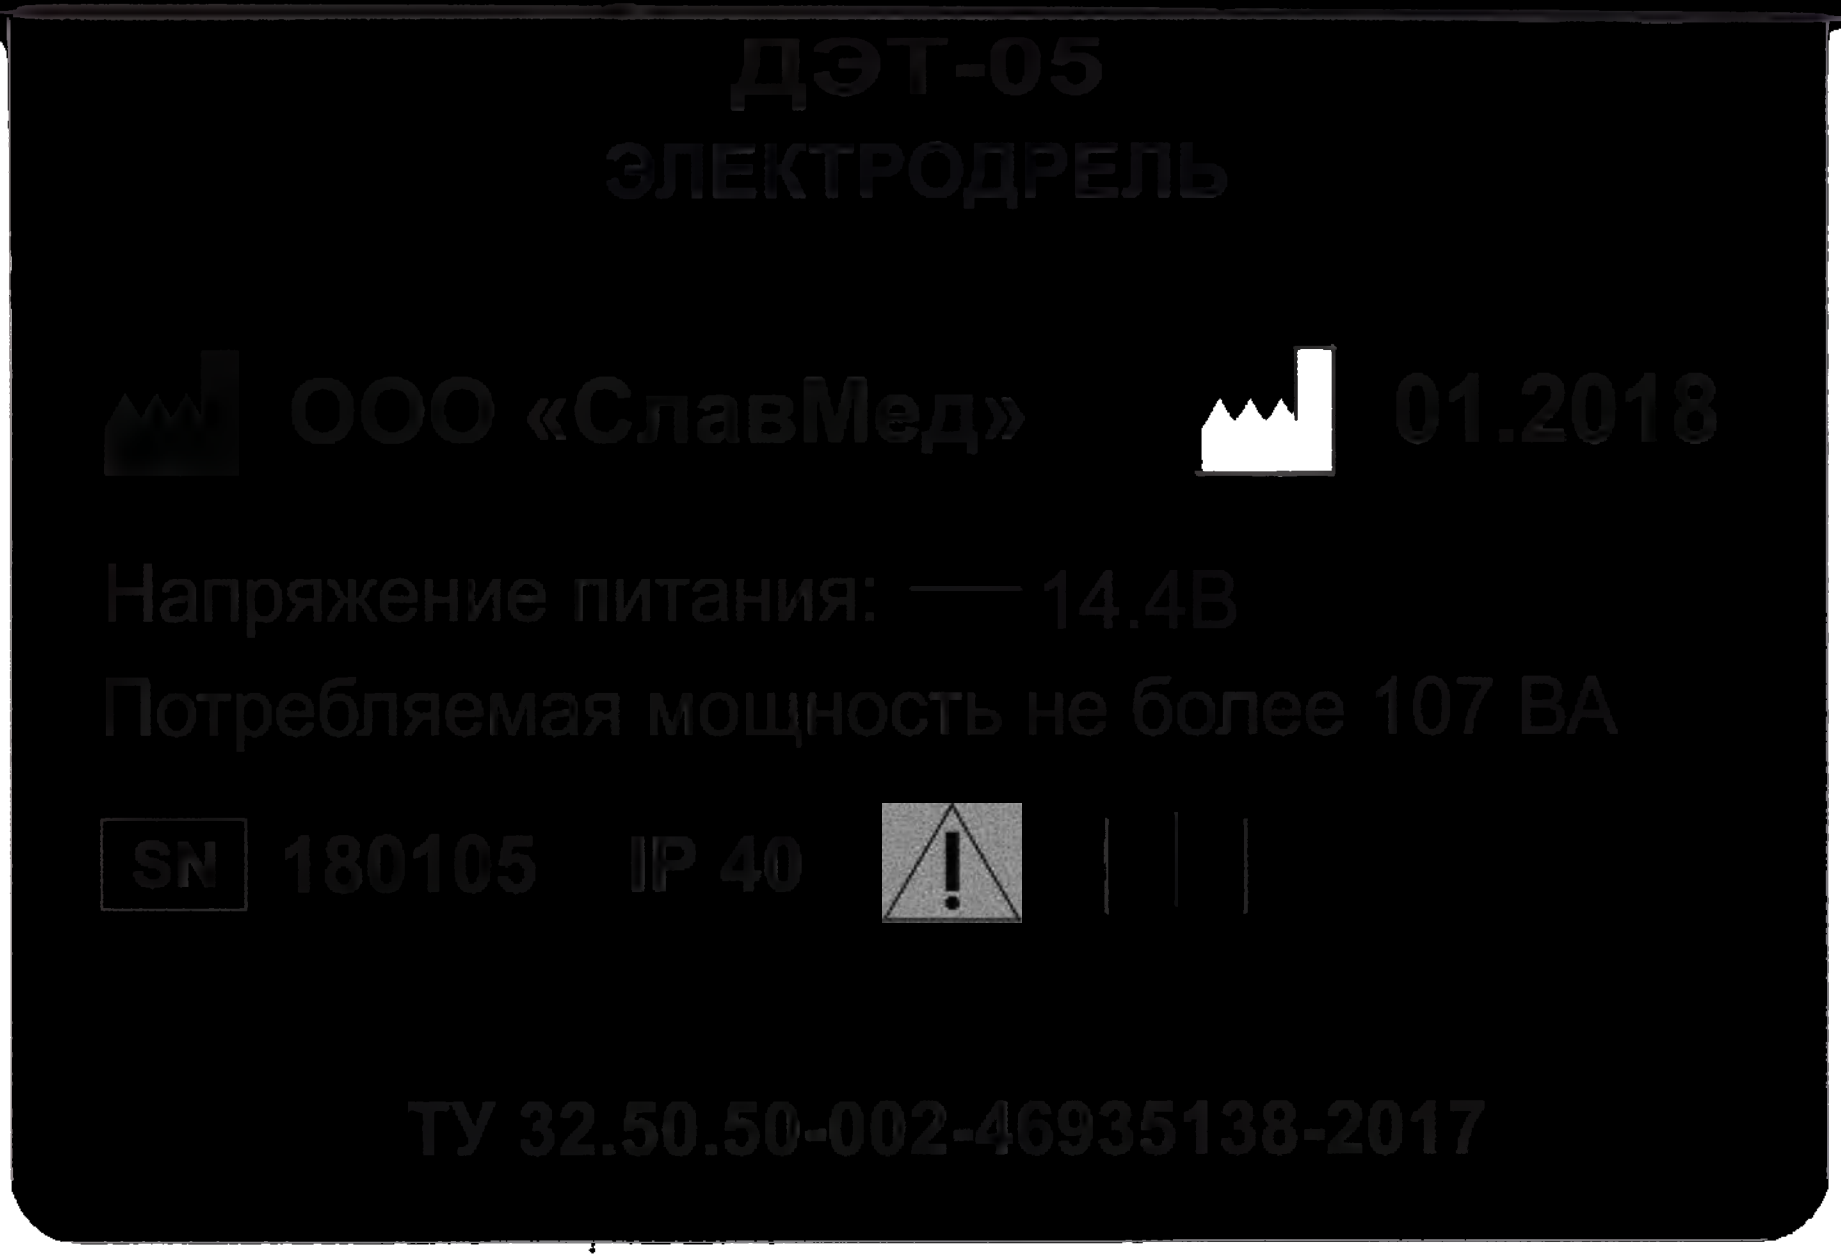

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

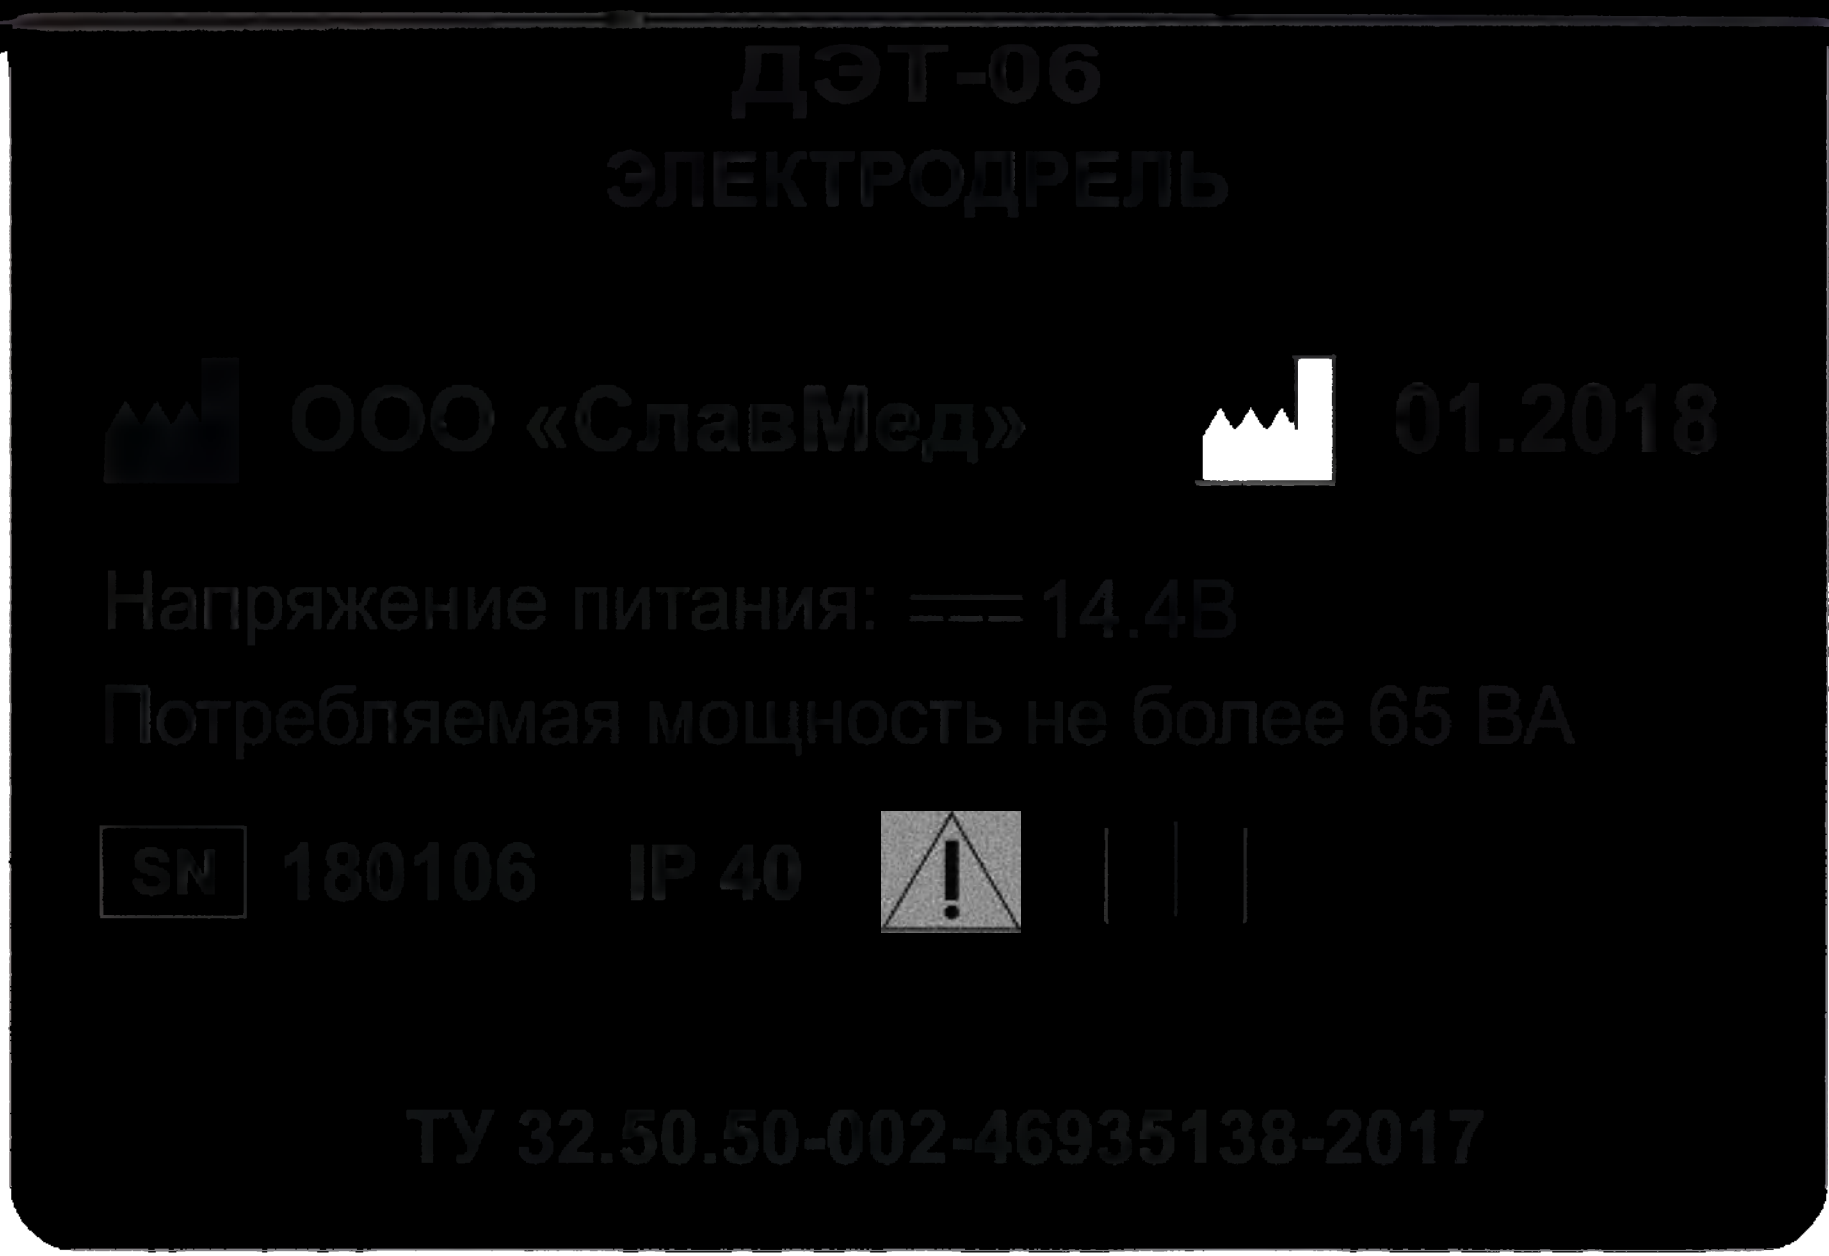

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электродрели ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

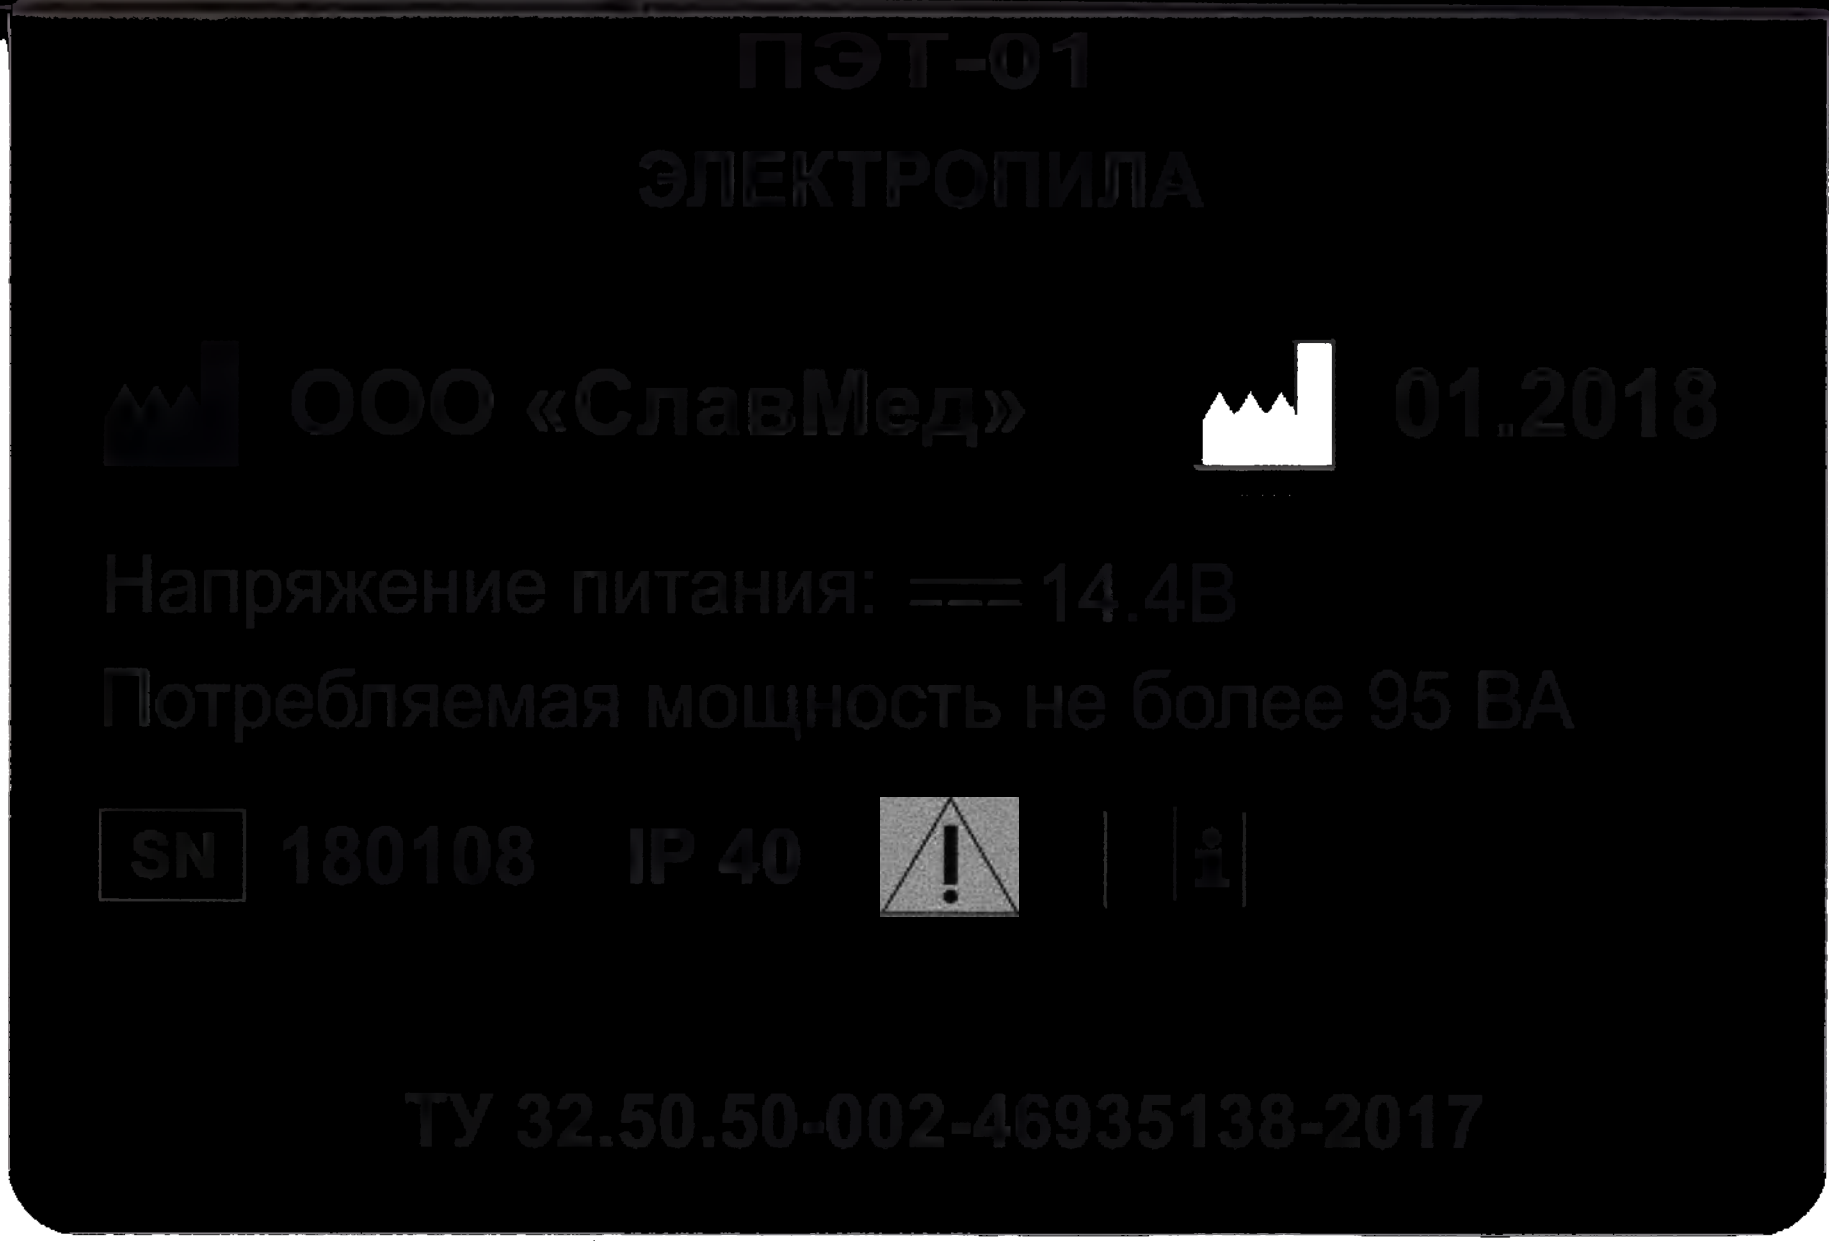

Этикетка на комплект изделий в кейсе для электропилы ПЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зарядное устройство для электродрелей ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, электропилы ПЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

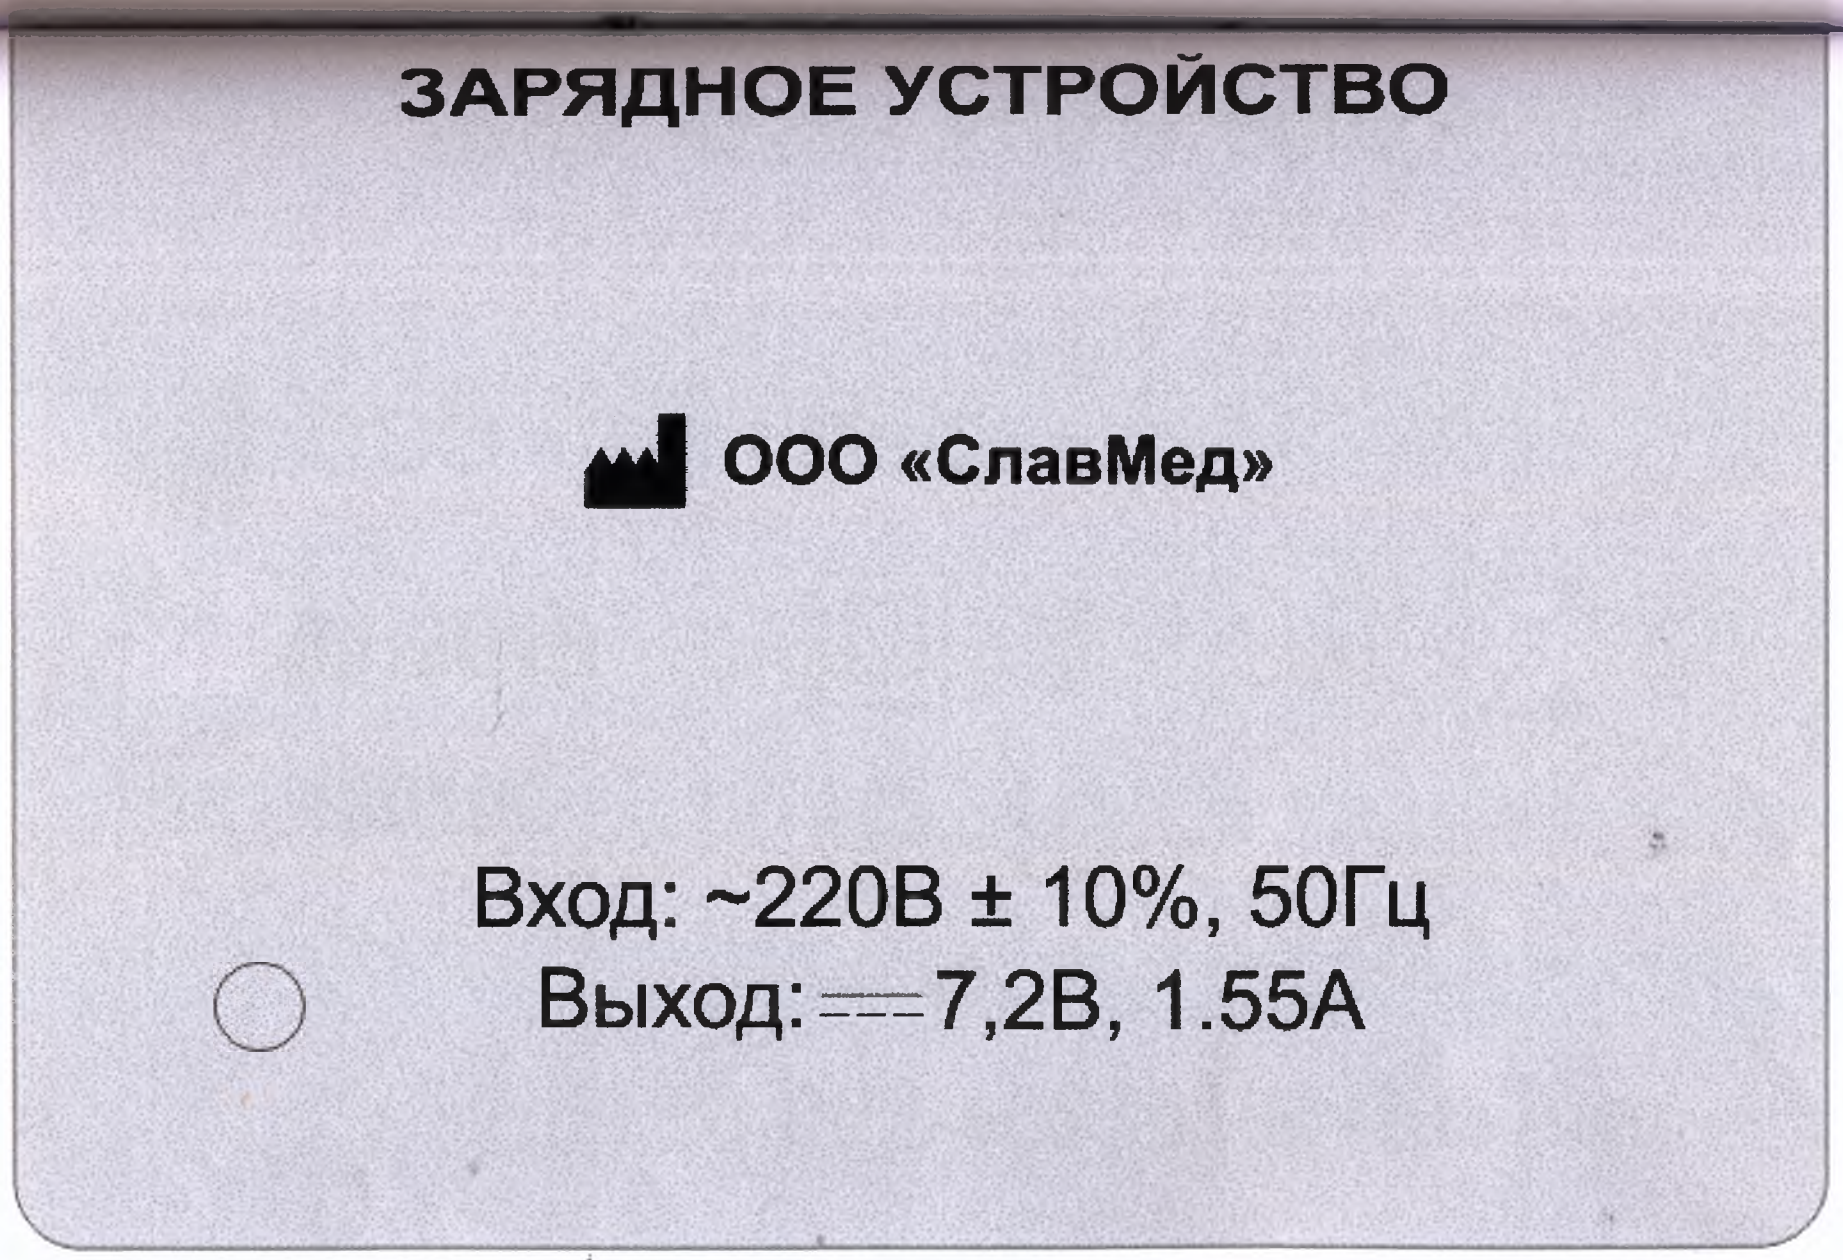

Зарядное устройство для электродрели ДЭТ-06, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

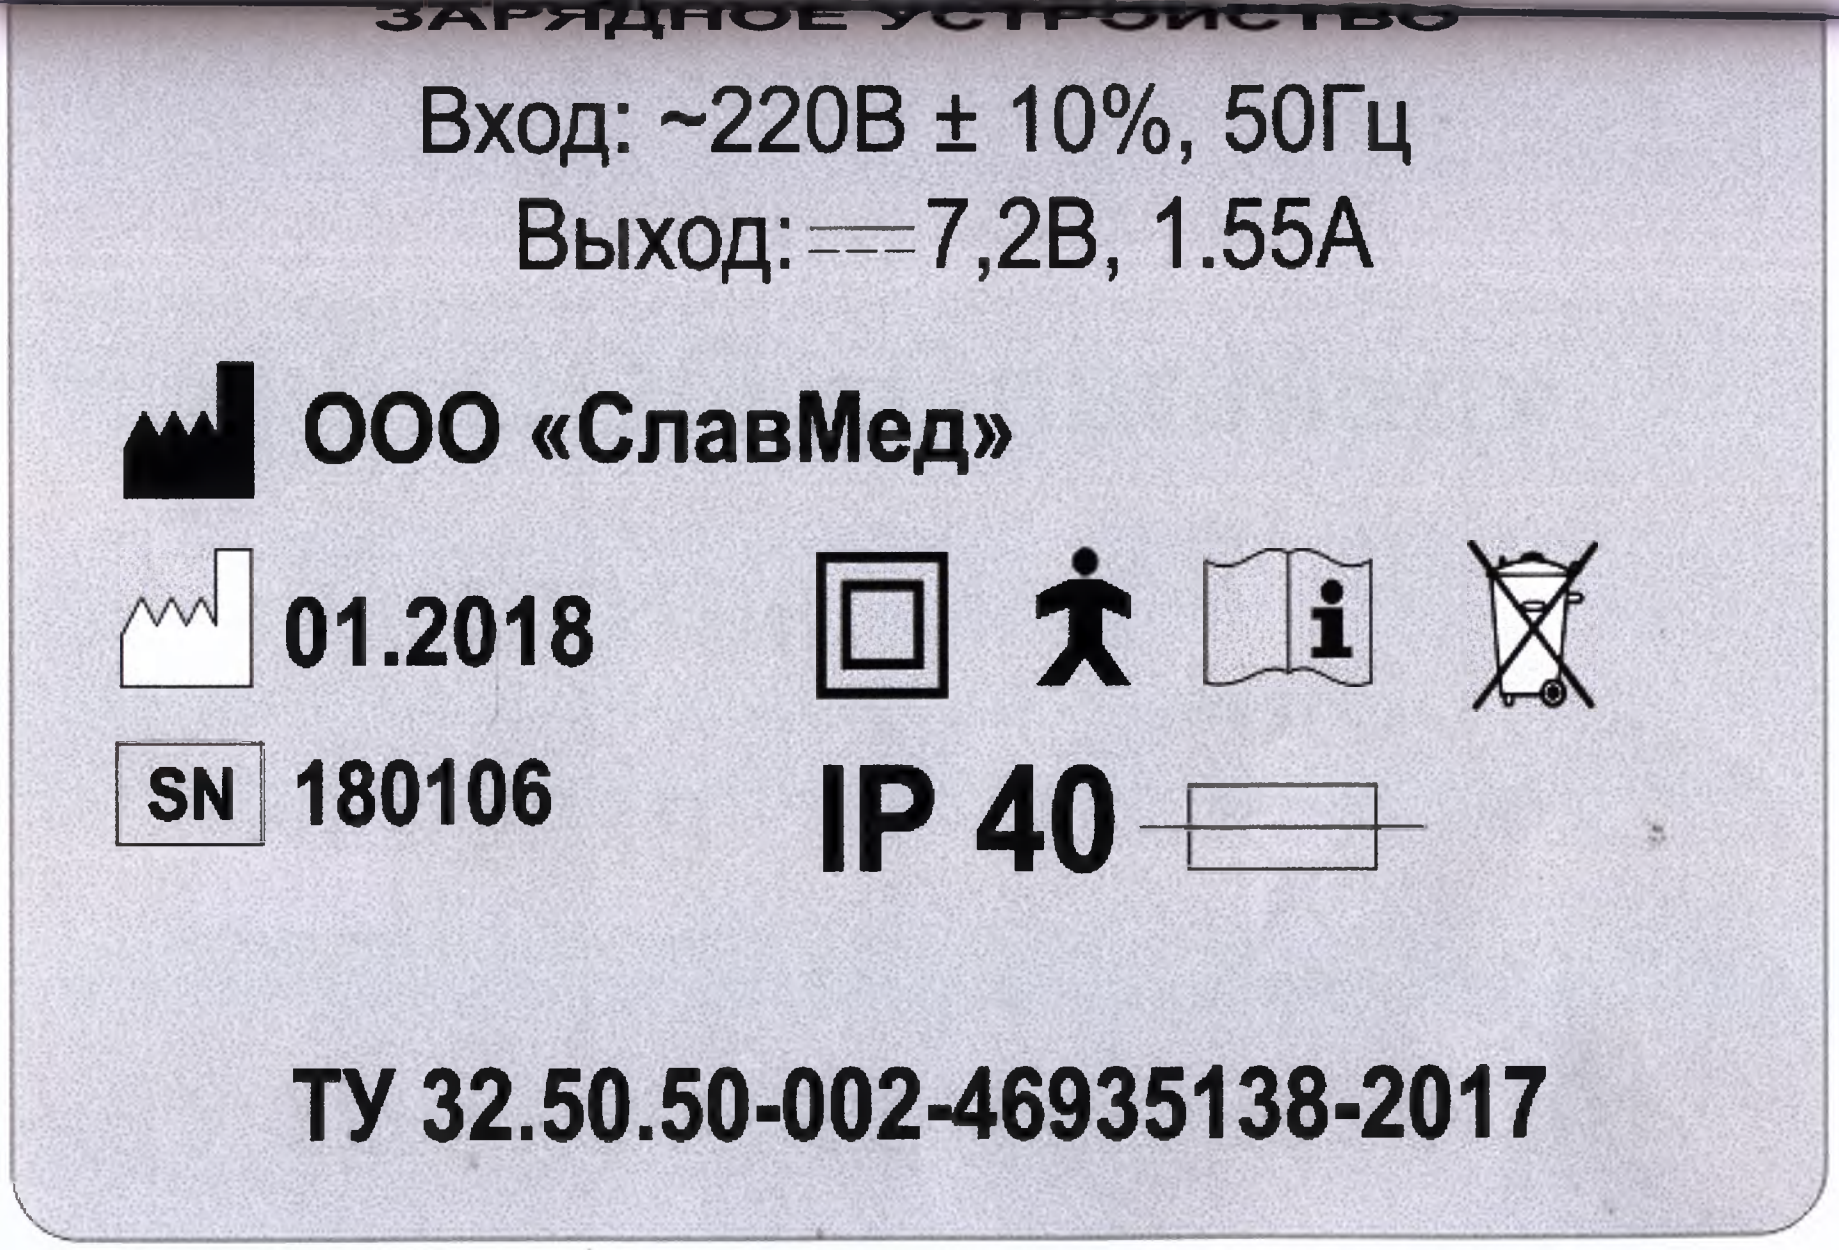

Зарядное устройство для электродрели ДЭТ-06, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

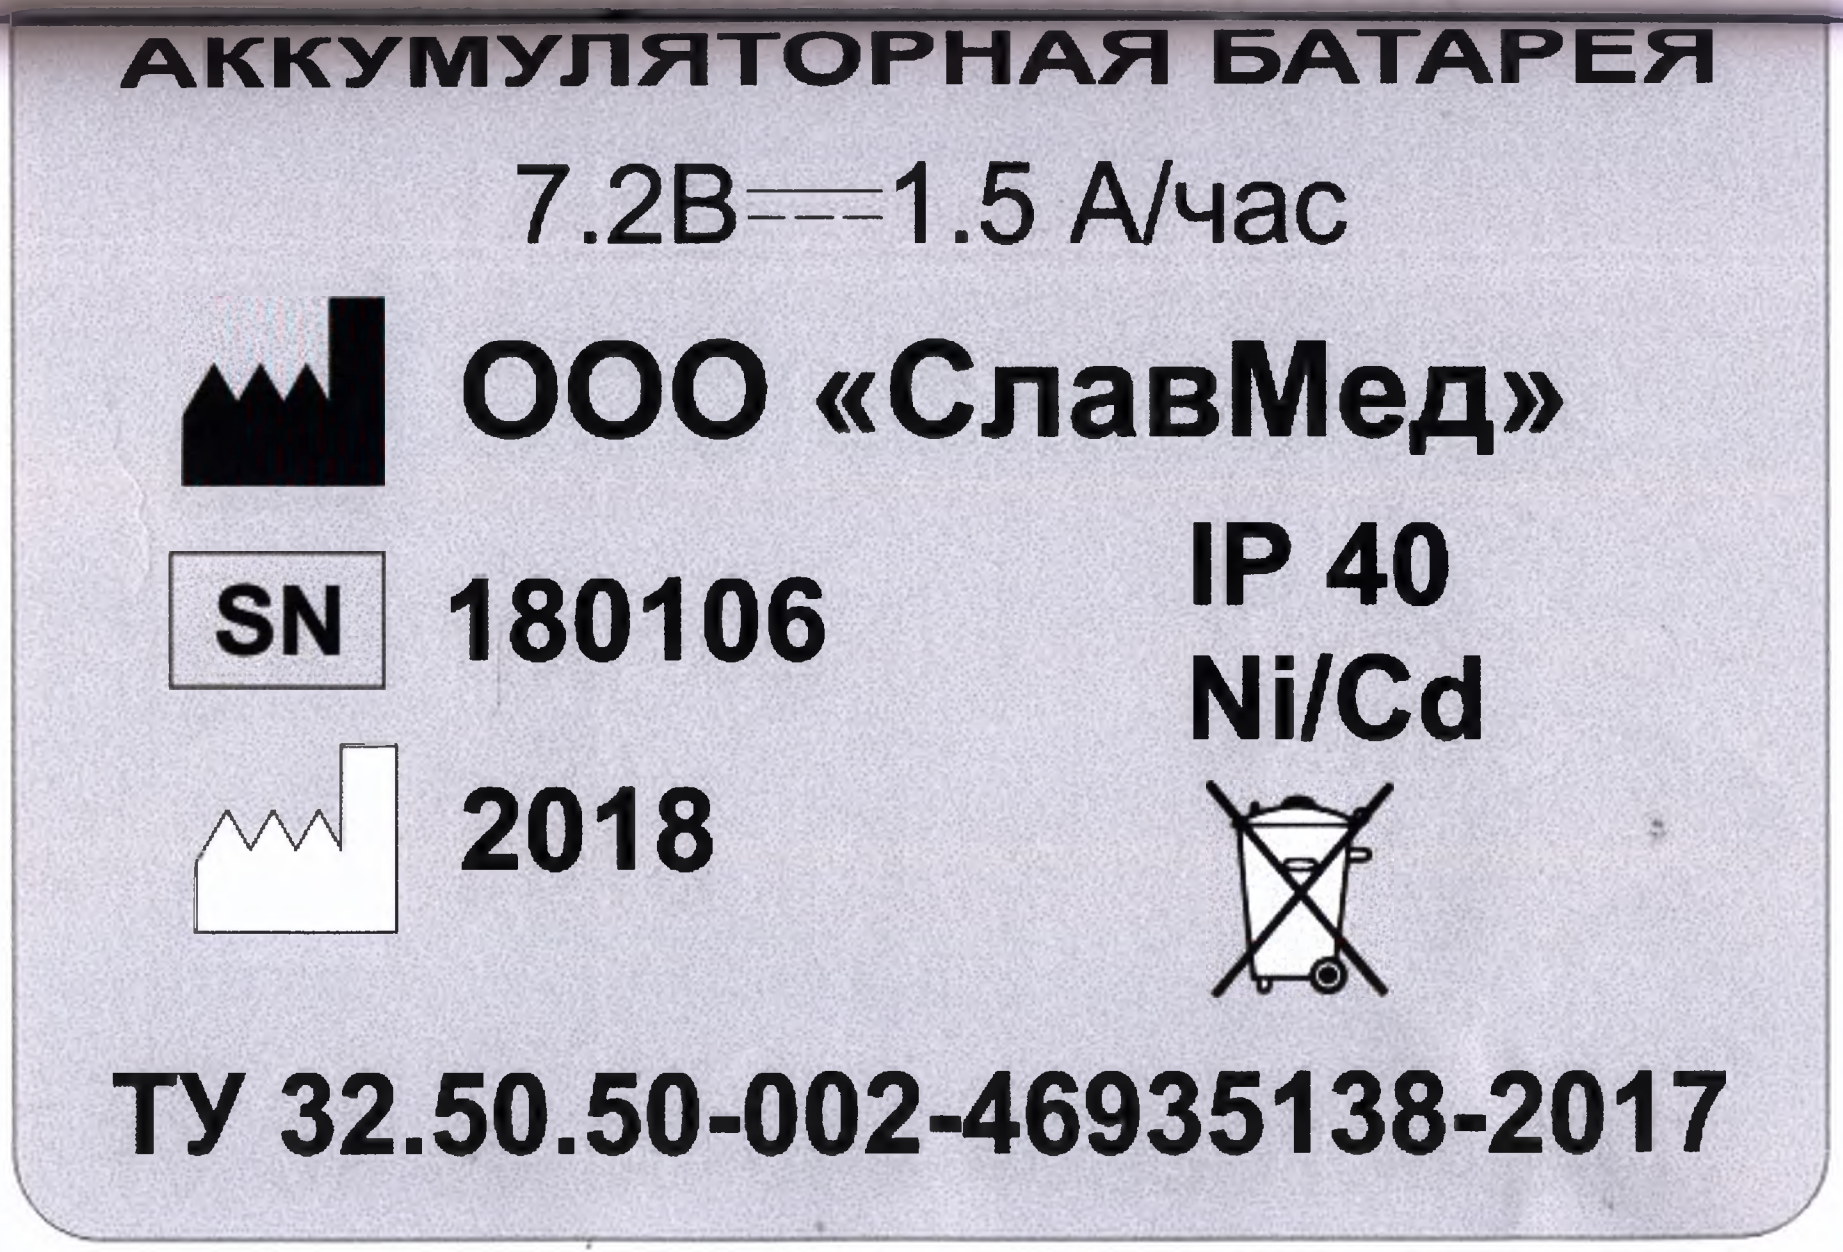

Аккумуляторная батарея для электродрели ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

14.4В ⎓ 1.6 А/час

ООО «СлавМед»

SN 180105

2018

IP 40

Ni/Mh

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Аккумуляторная батарея для электродрелей ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, электропилы ПЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

ПЕРЕХОДНИК АСЕПТИЧЕСКИЙ

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Переходник асептический для электродрелей ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, электропилы ПЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

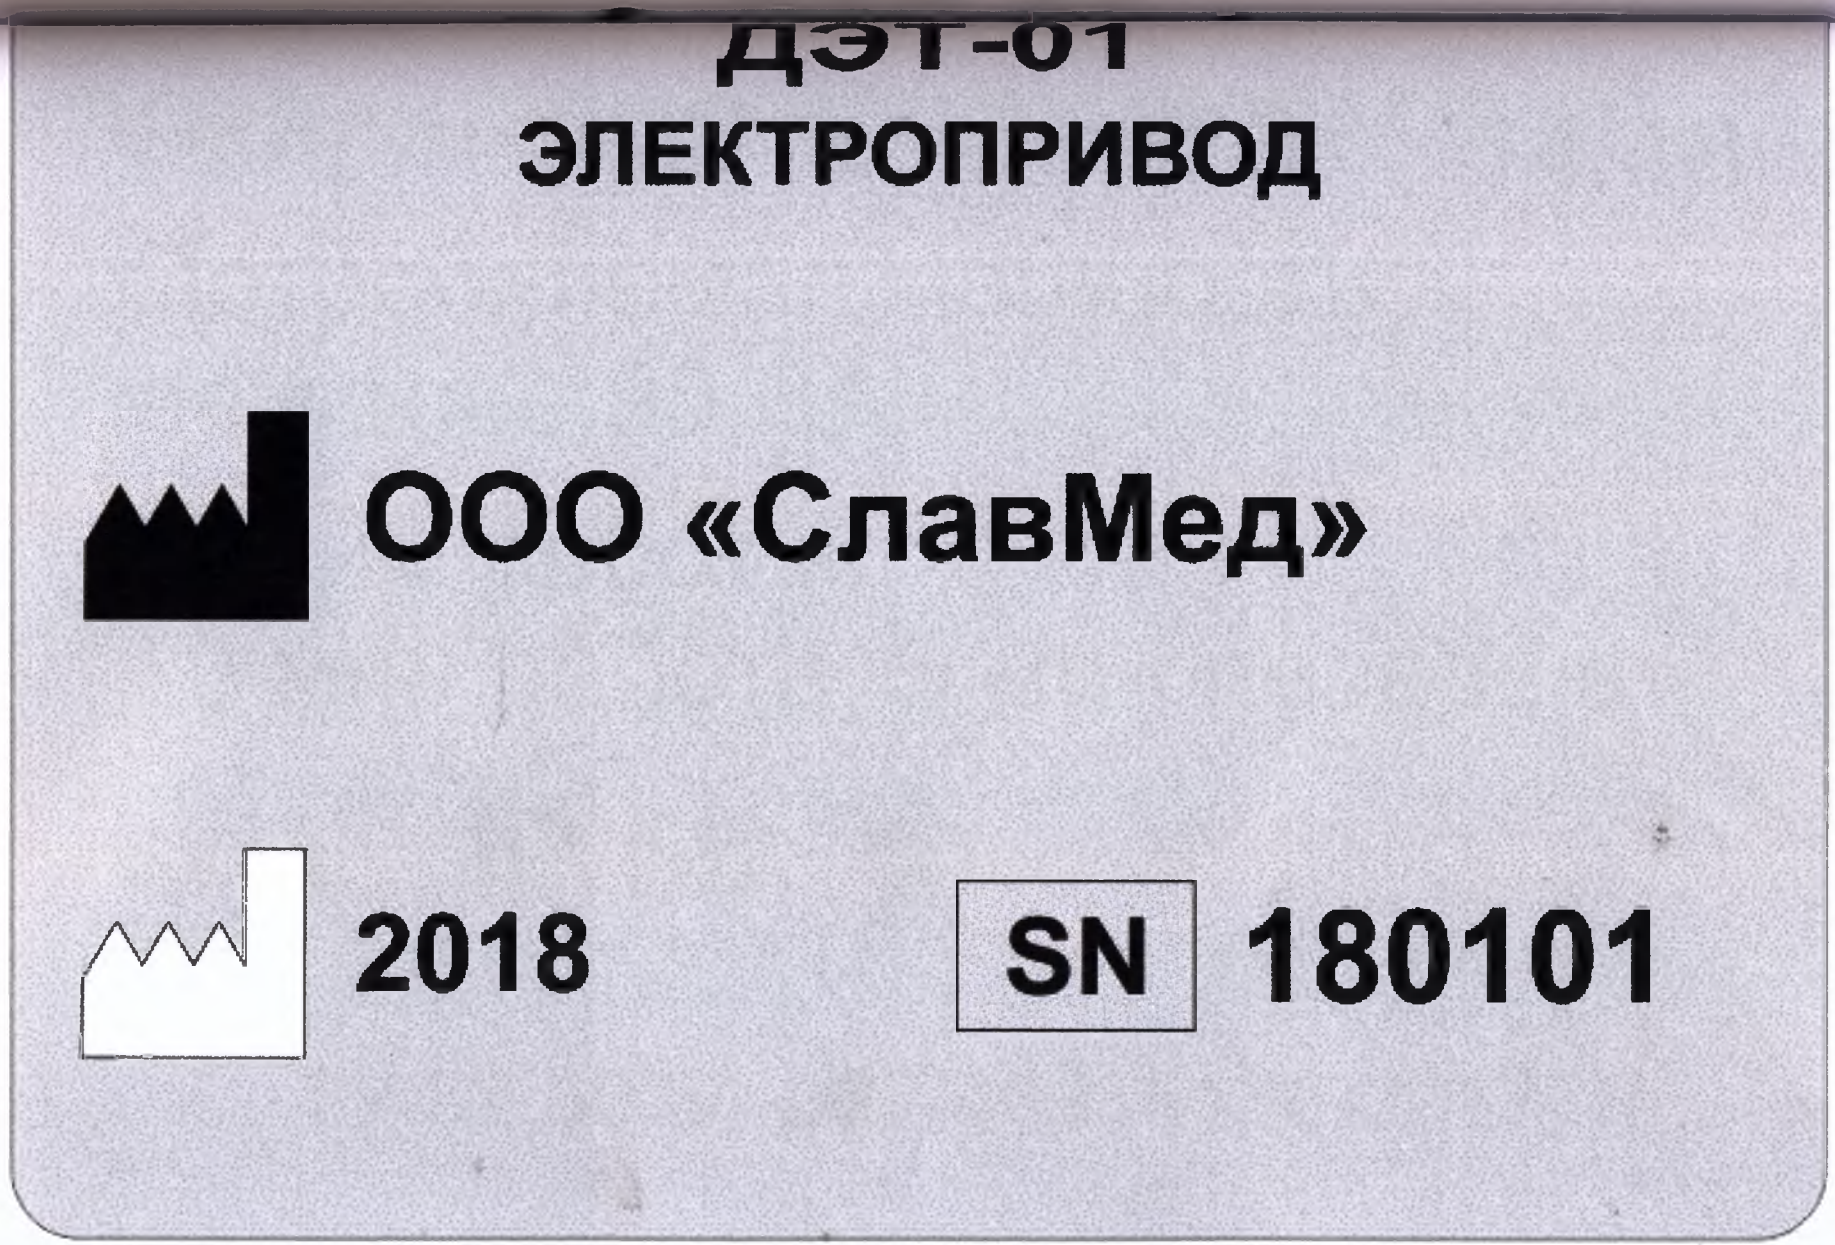

Электропривод электродрели ДЭТ-01, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

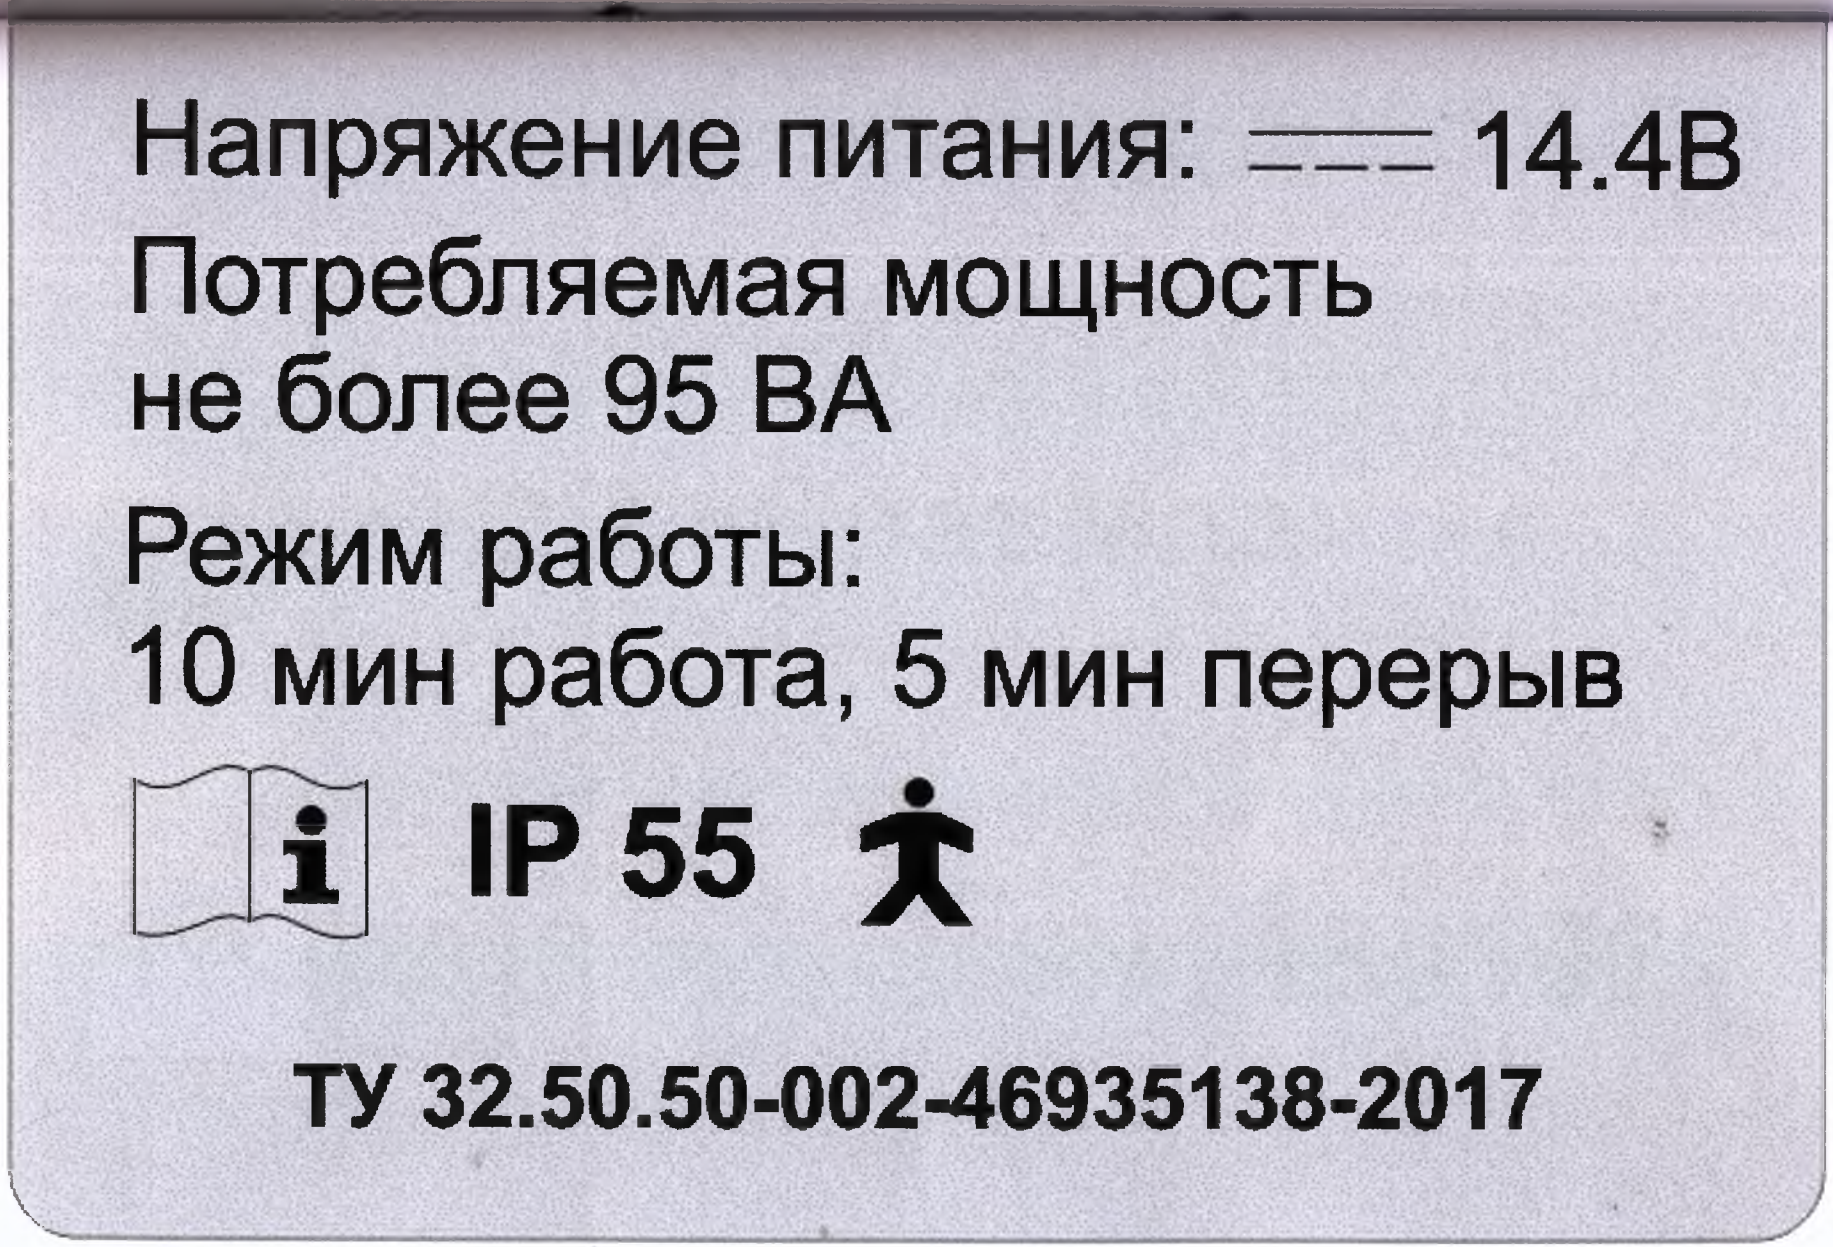

Электропривод электродрели ДЭТ-01, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

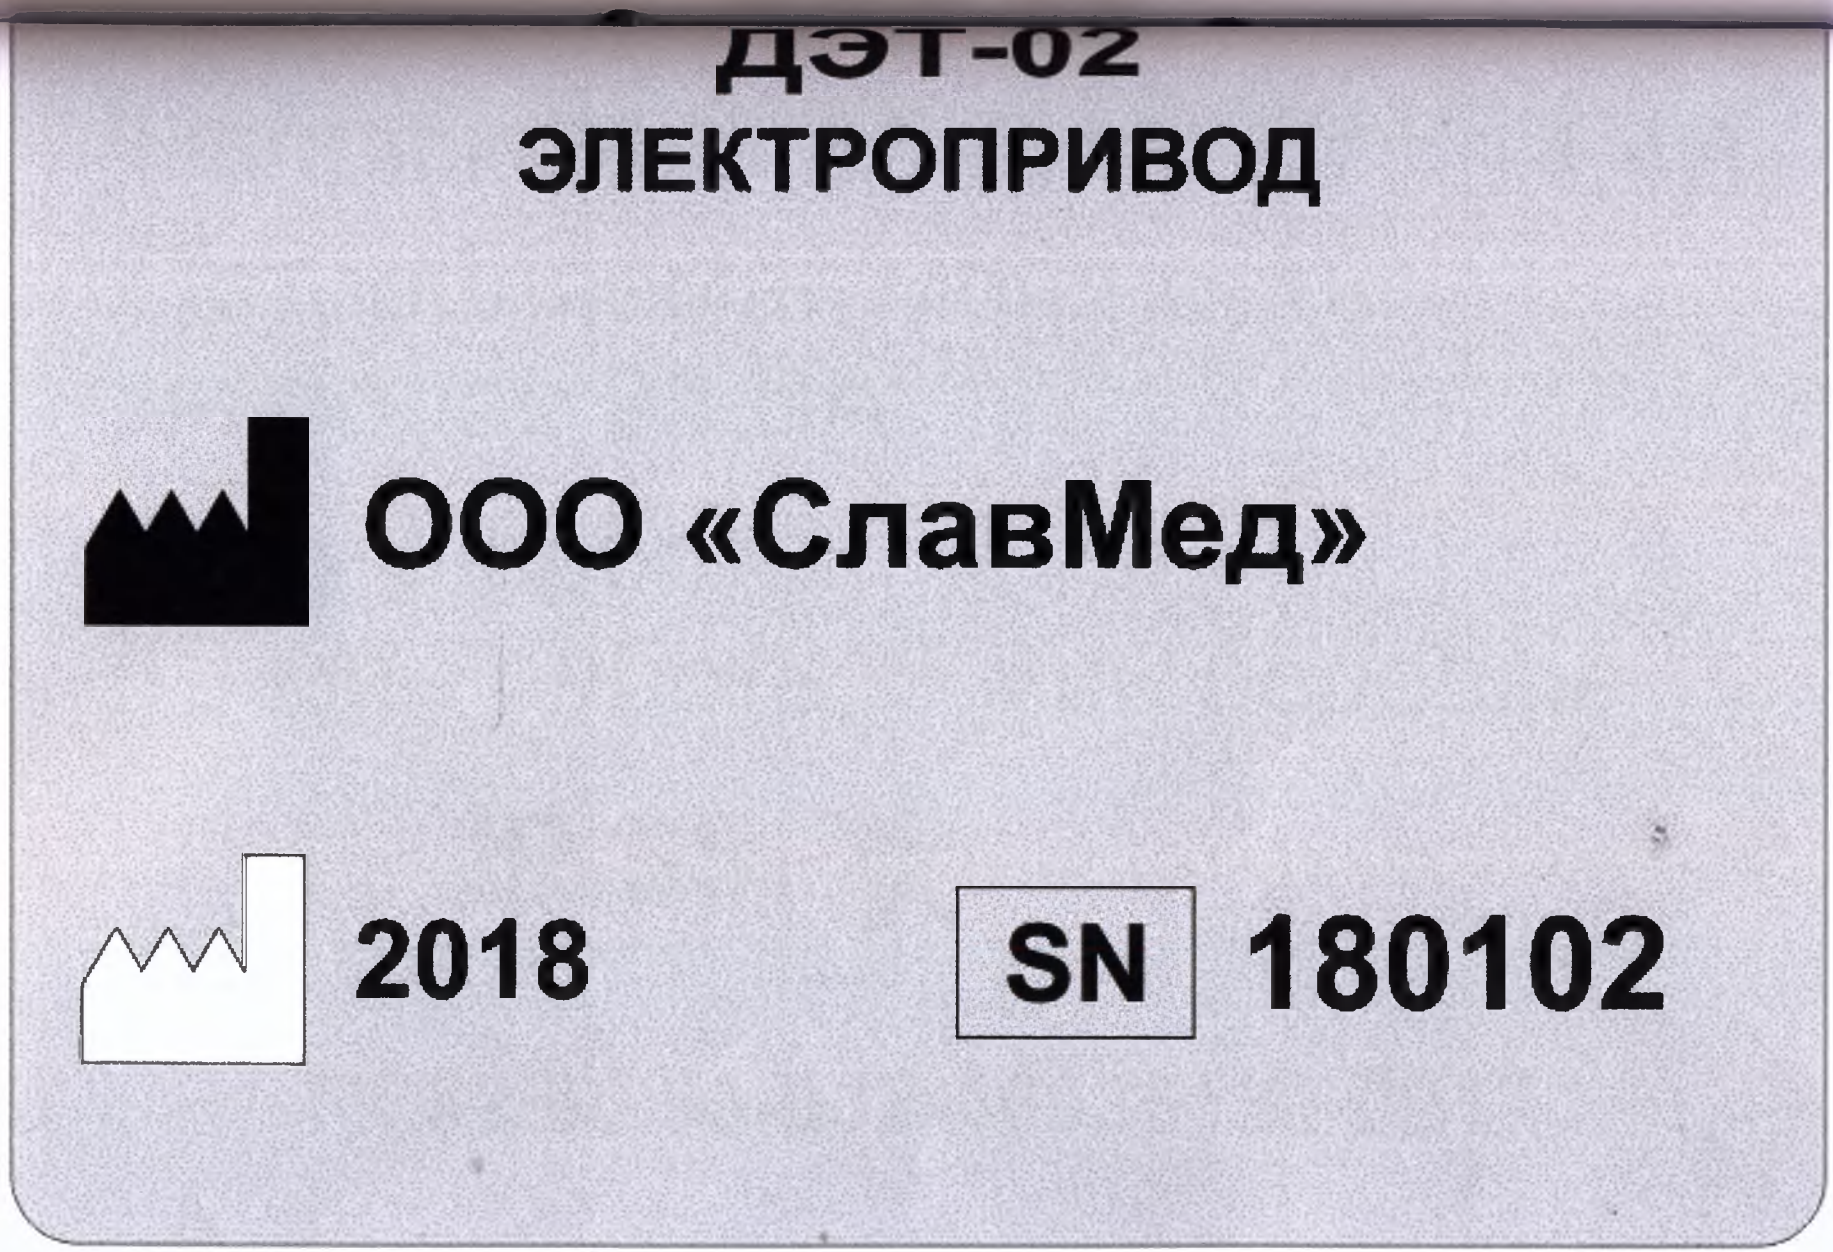

Электропривод электродрели ДЭТ-02, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Напряжение питания: ⎓ 14.4В

Потребляемая мощность
не более 95 ВА

Режим работы:
10 мин работа, 5 мин перерыв



IP 55

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Электропривод электродрели ДЭТ-02, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

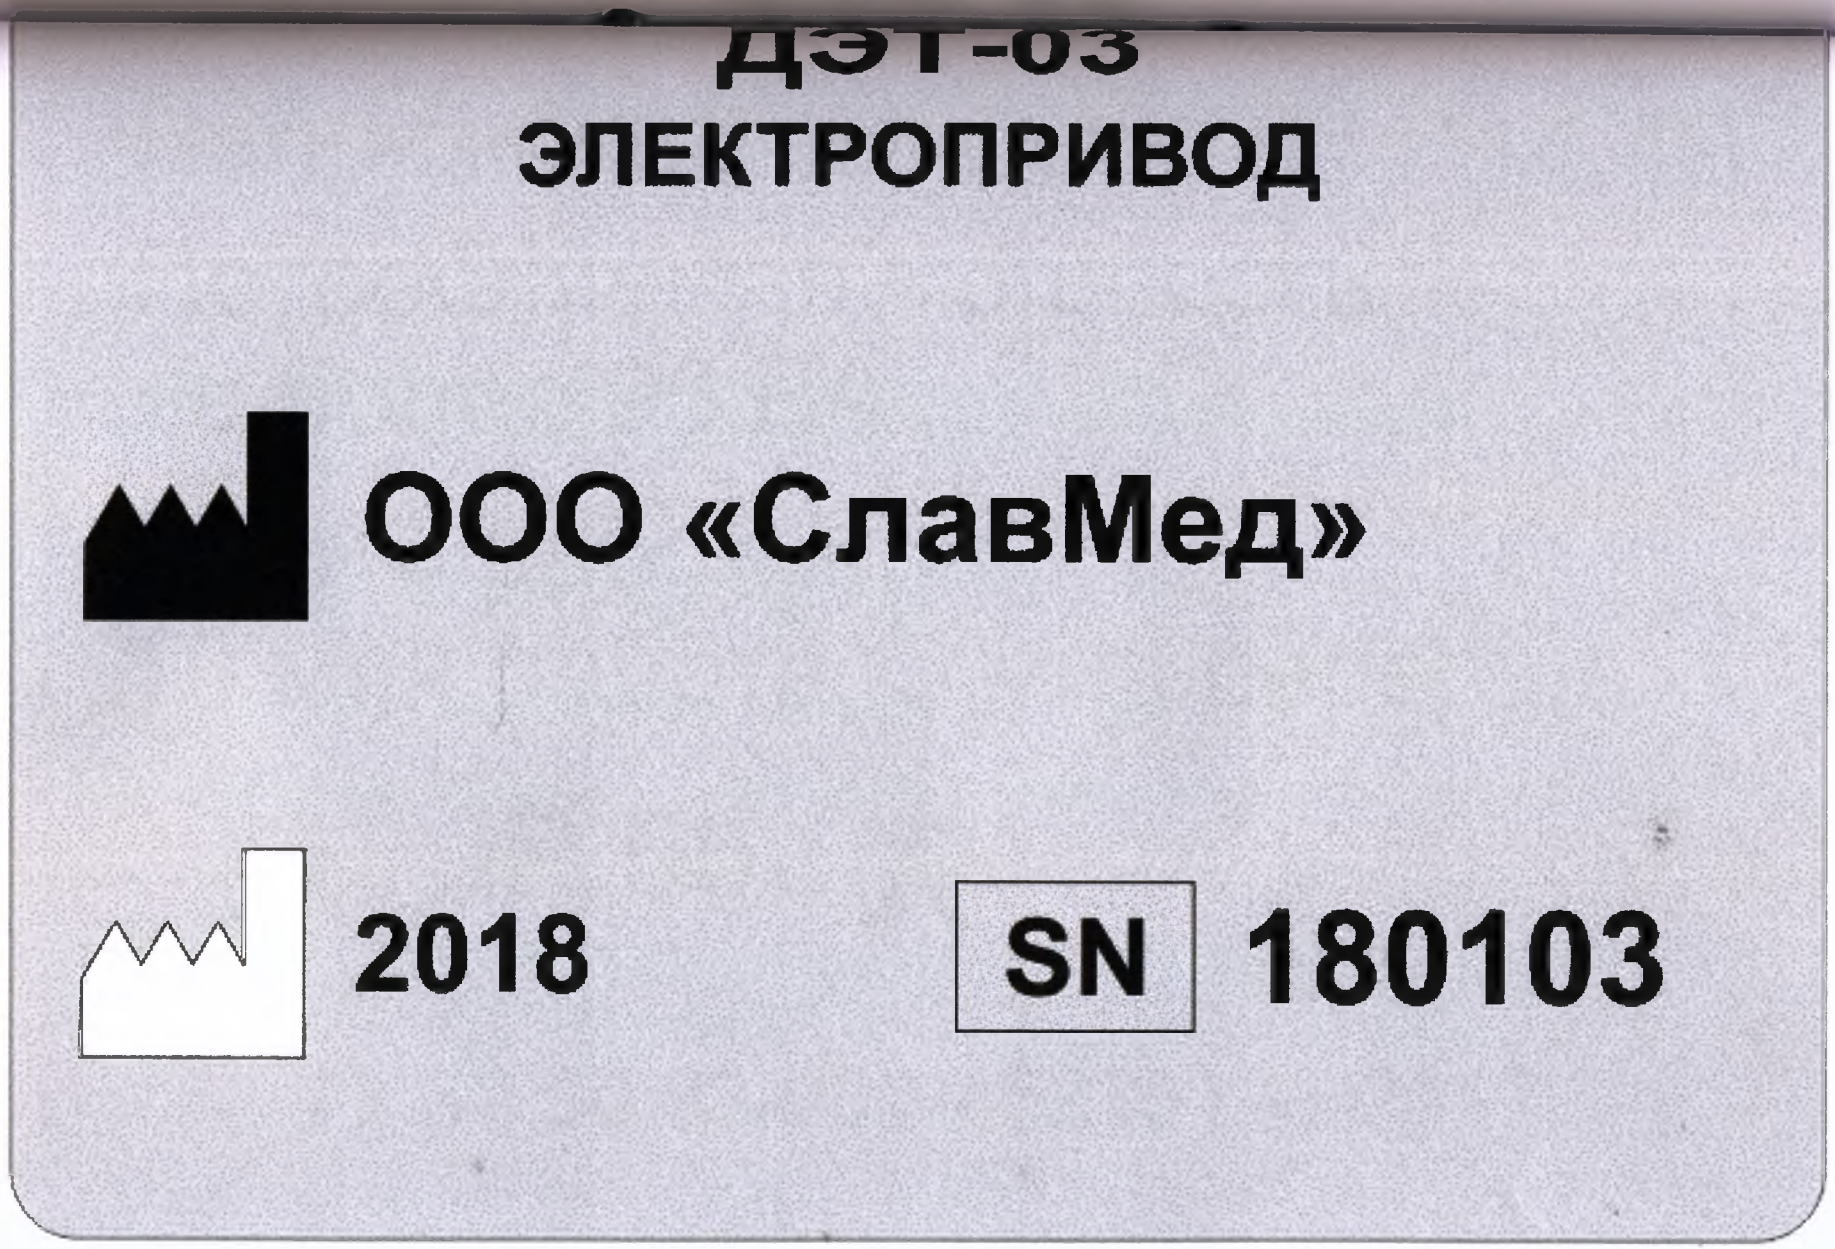

Электропривод электродрели ДЭТ-03, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

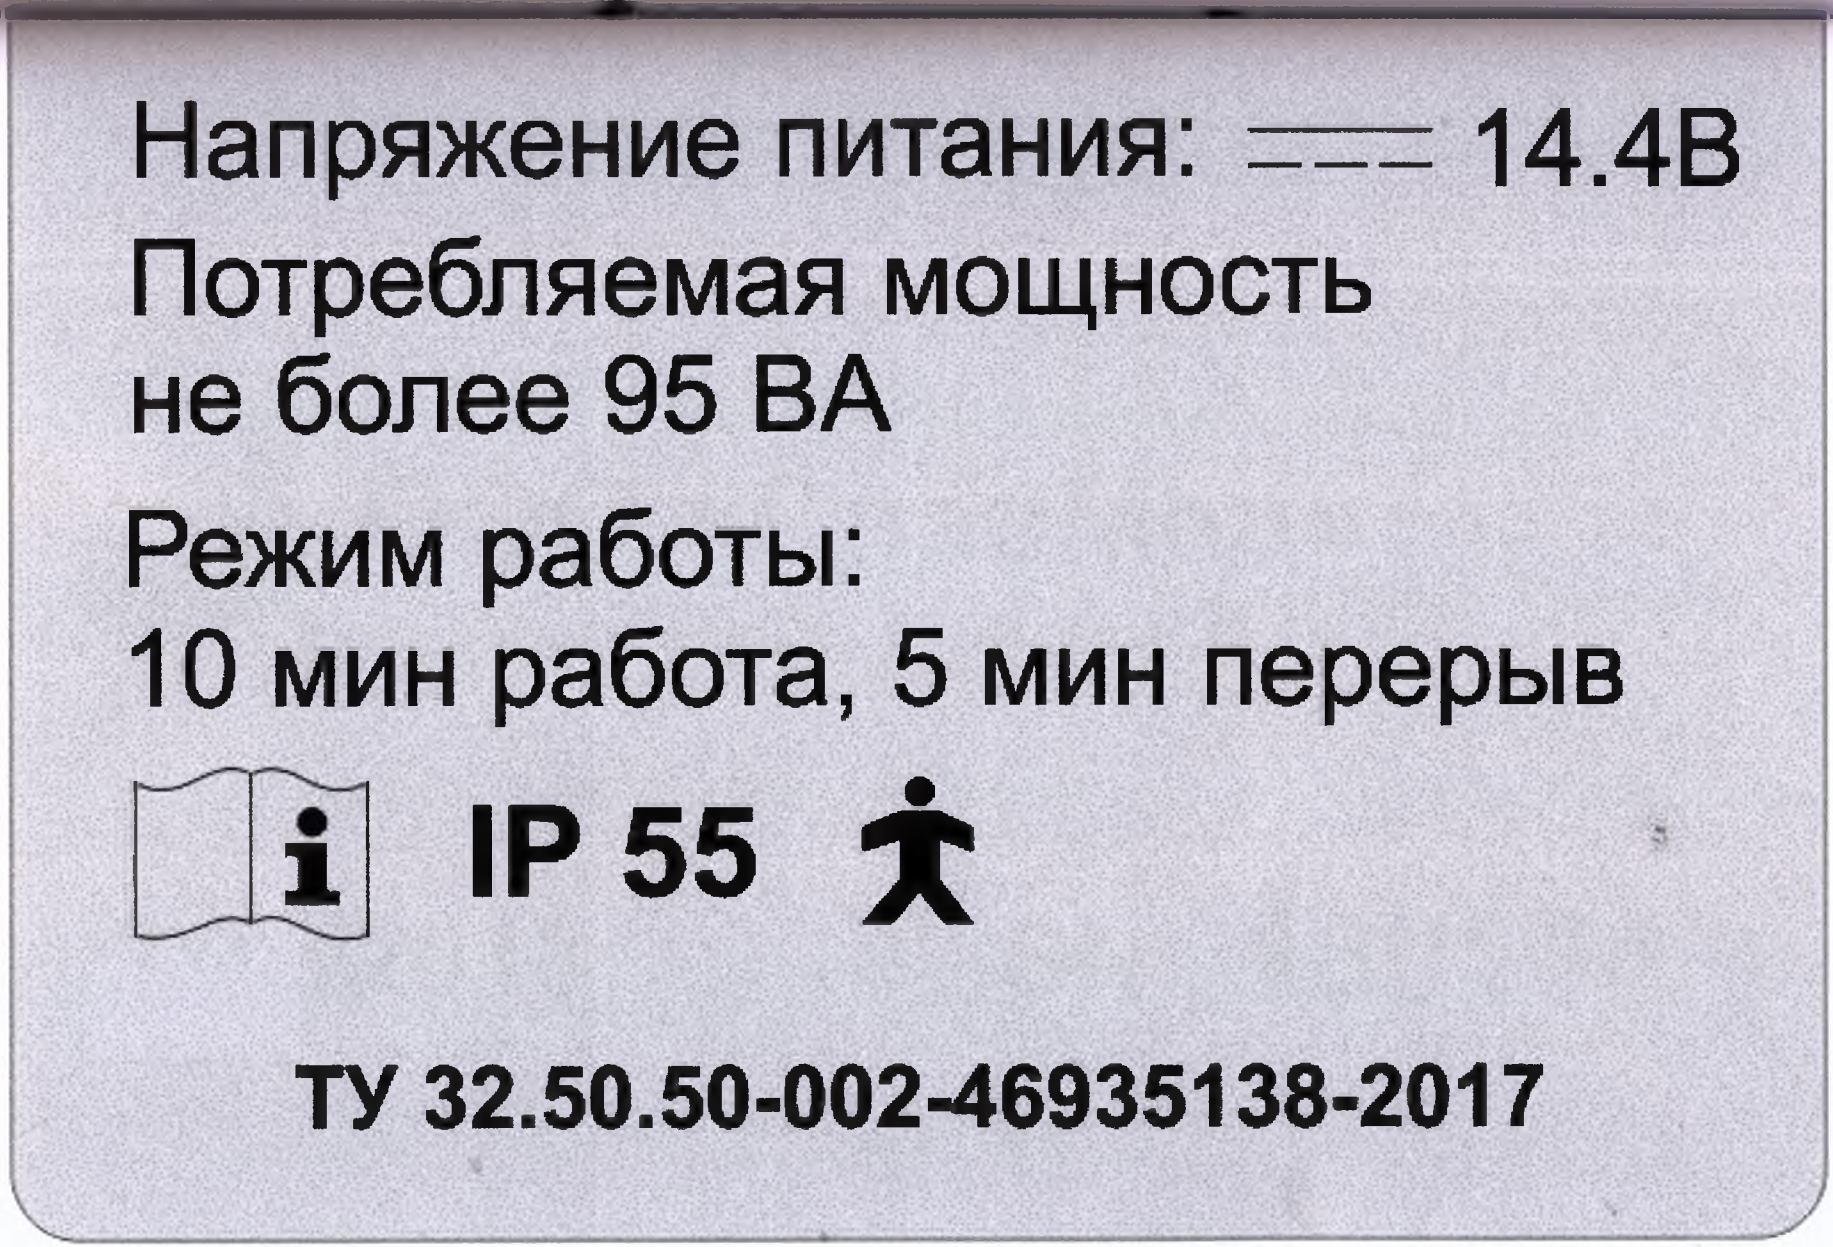

Электропривод электродрели ДЭТ-03, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

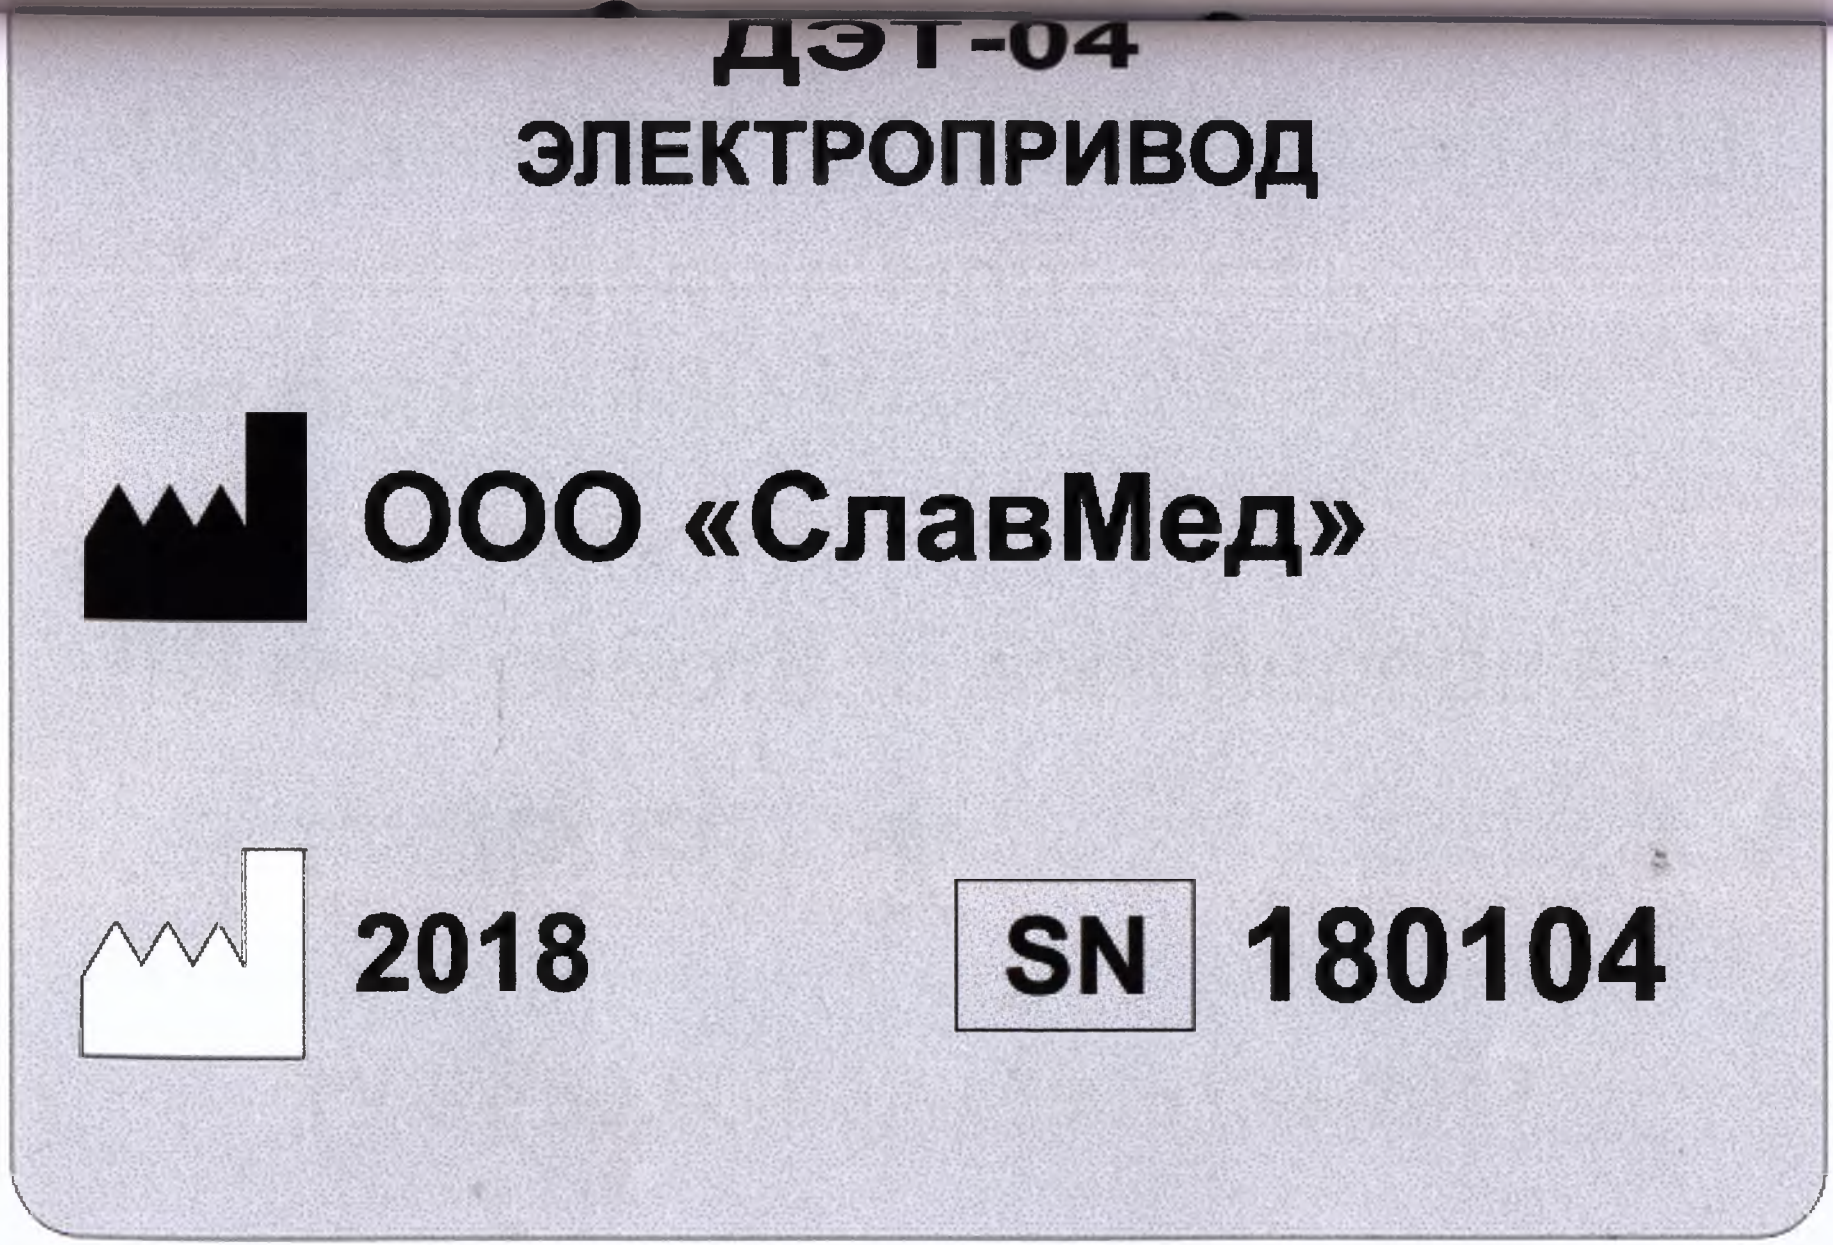

Электропривод электродрели ДЭТ-04, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Напряжение питания: ⎓ 14.4В

Потребляемая мощность
не более 180 ВА

Режим работы:
10 мин работа, 5 мин перерыв



IP 55

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Электропривод электродрели ДЭТ-04, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

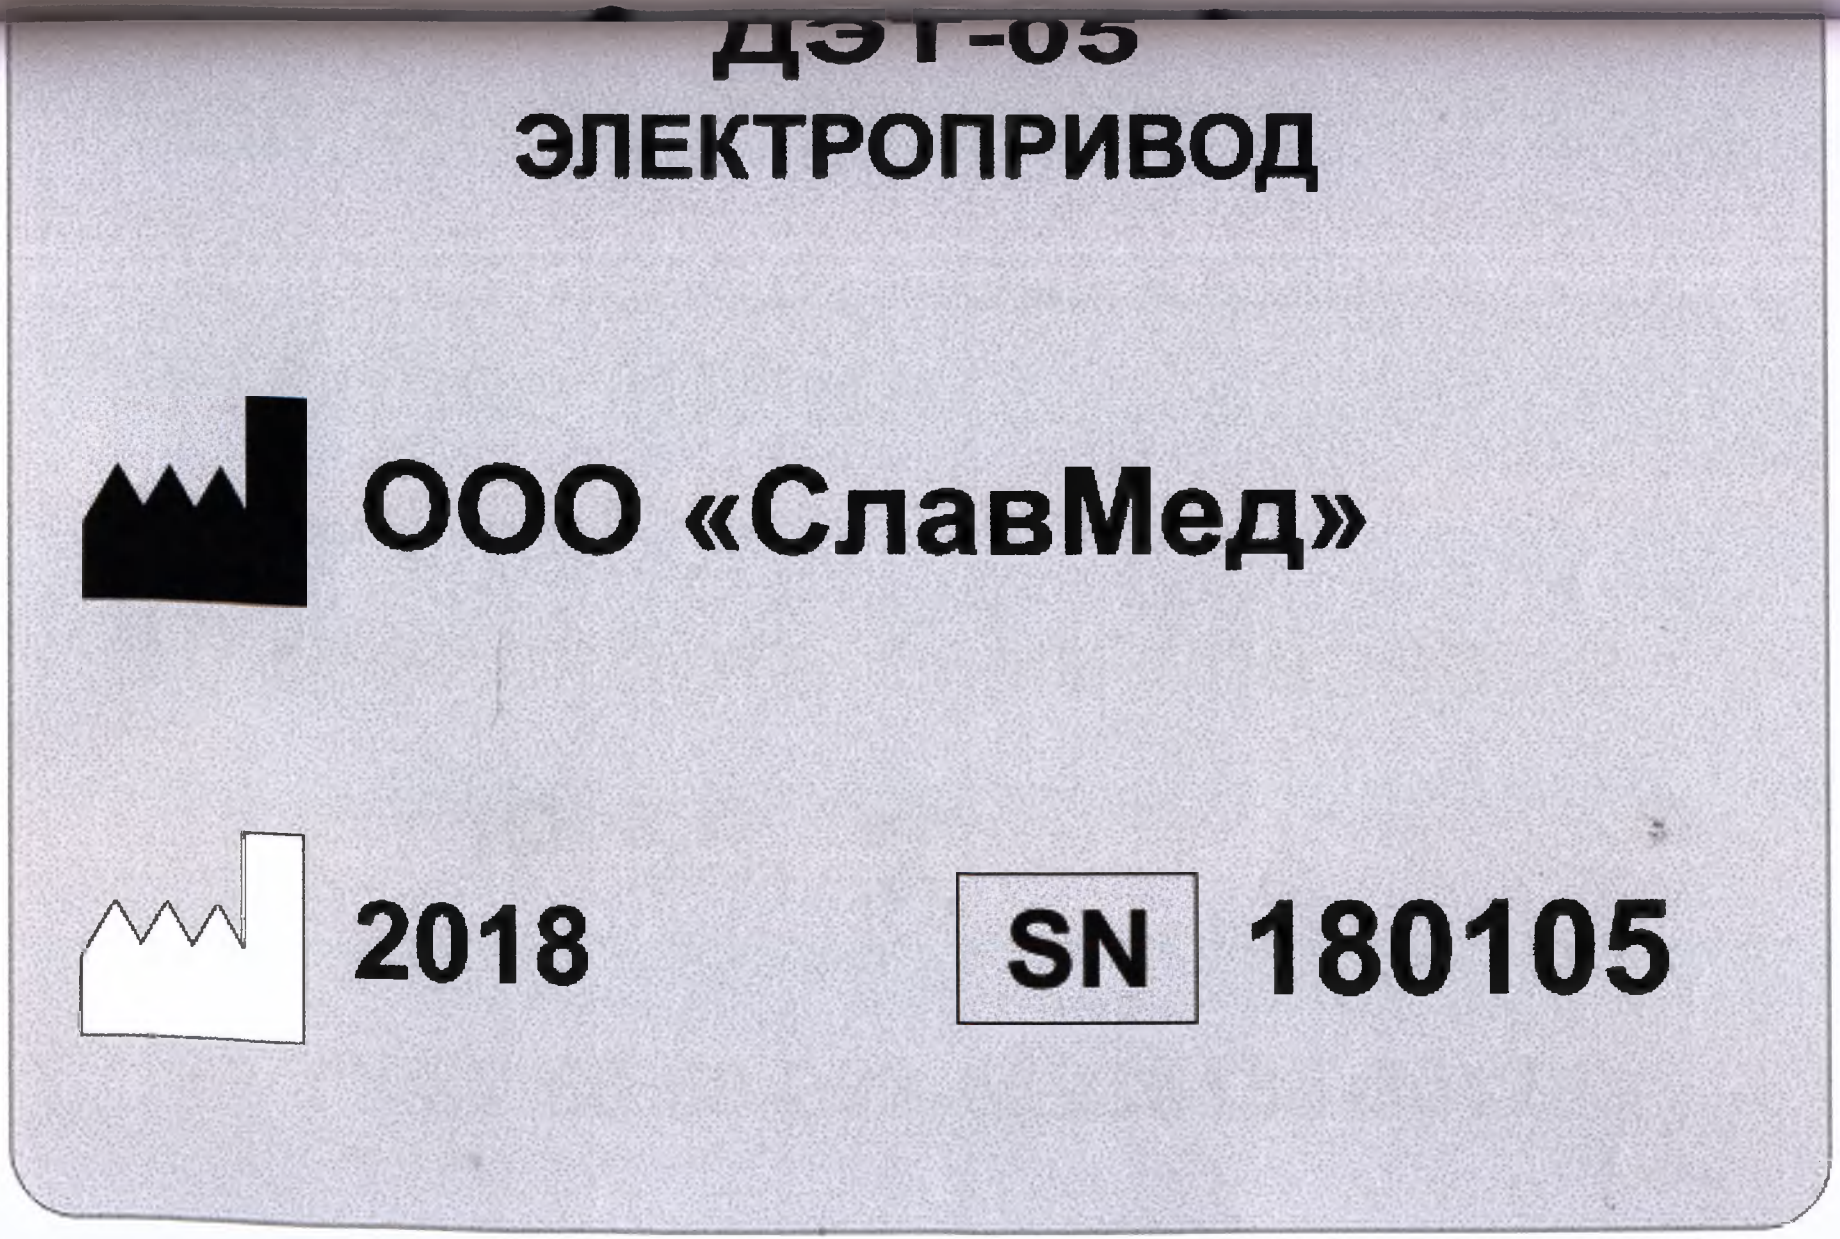

Электропривод электродрели ДЭТ-05, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

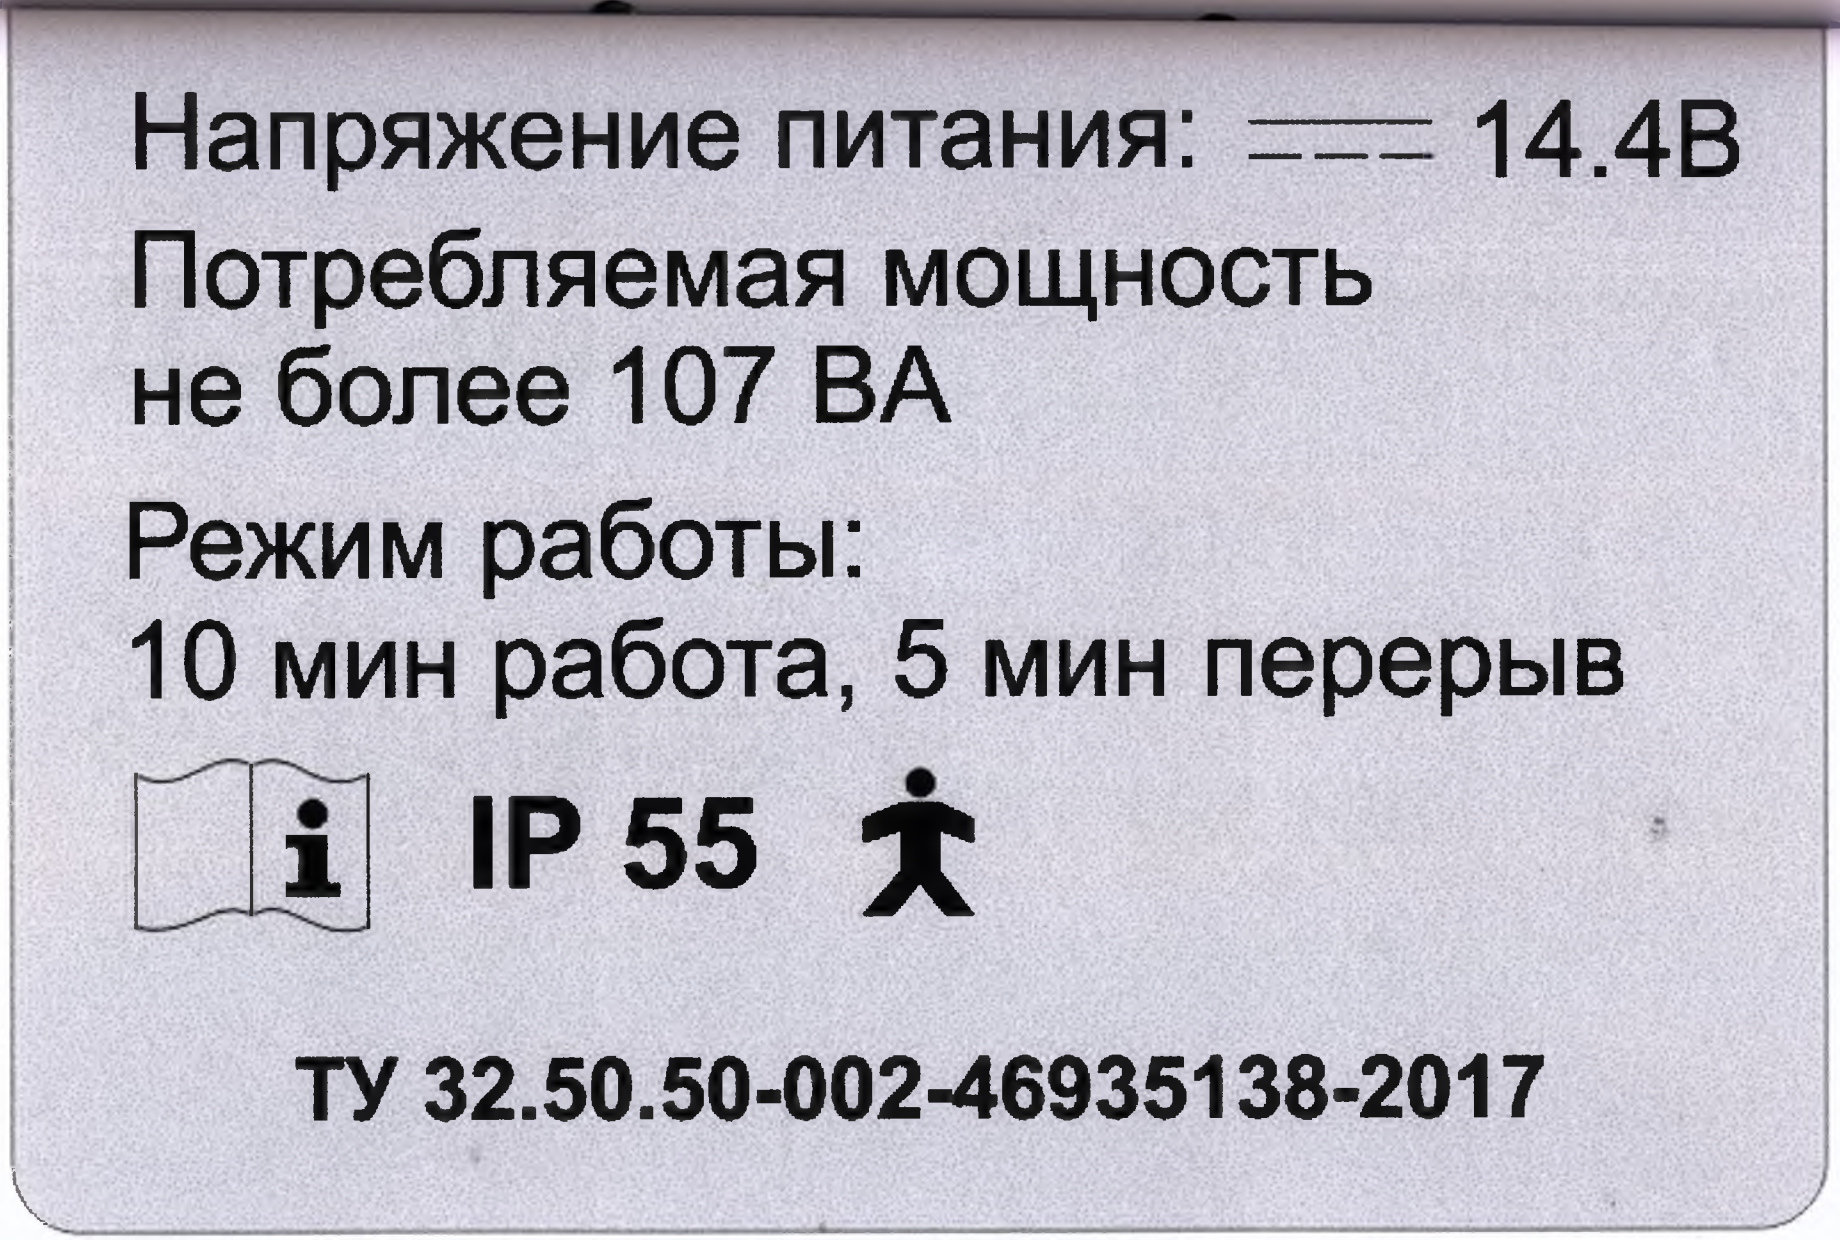

Электропривод электродрели ДЭТ-05, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

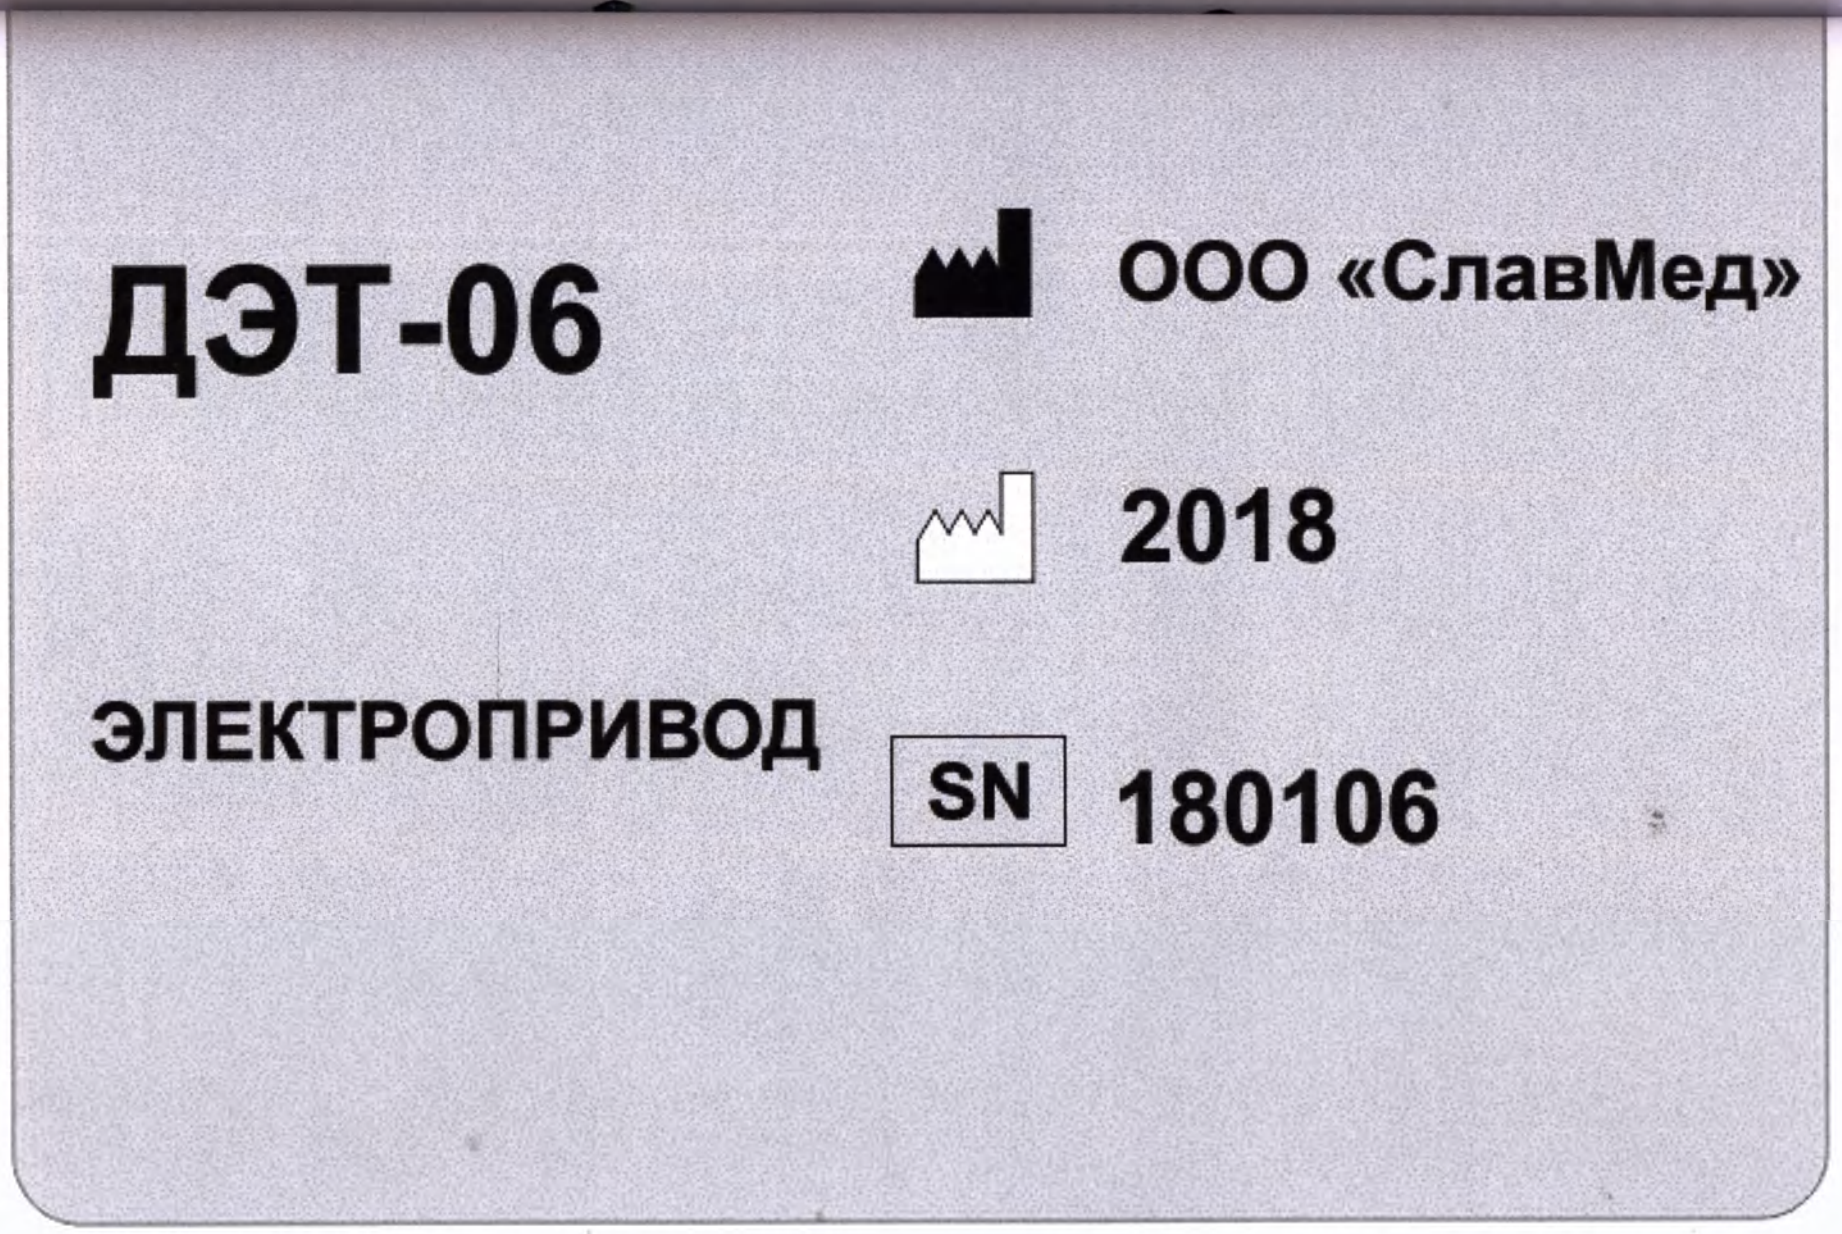

Электропривод электродрели ДЭТ-06, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

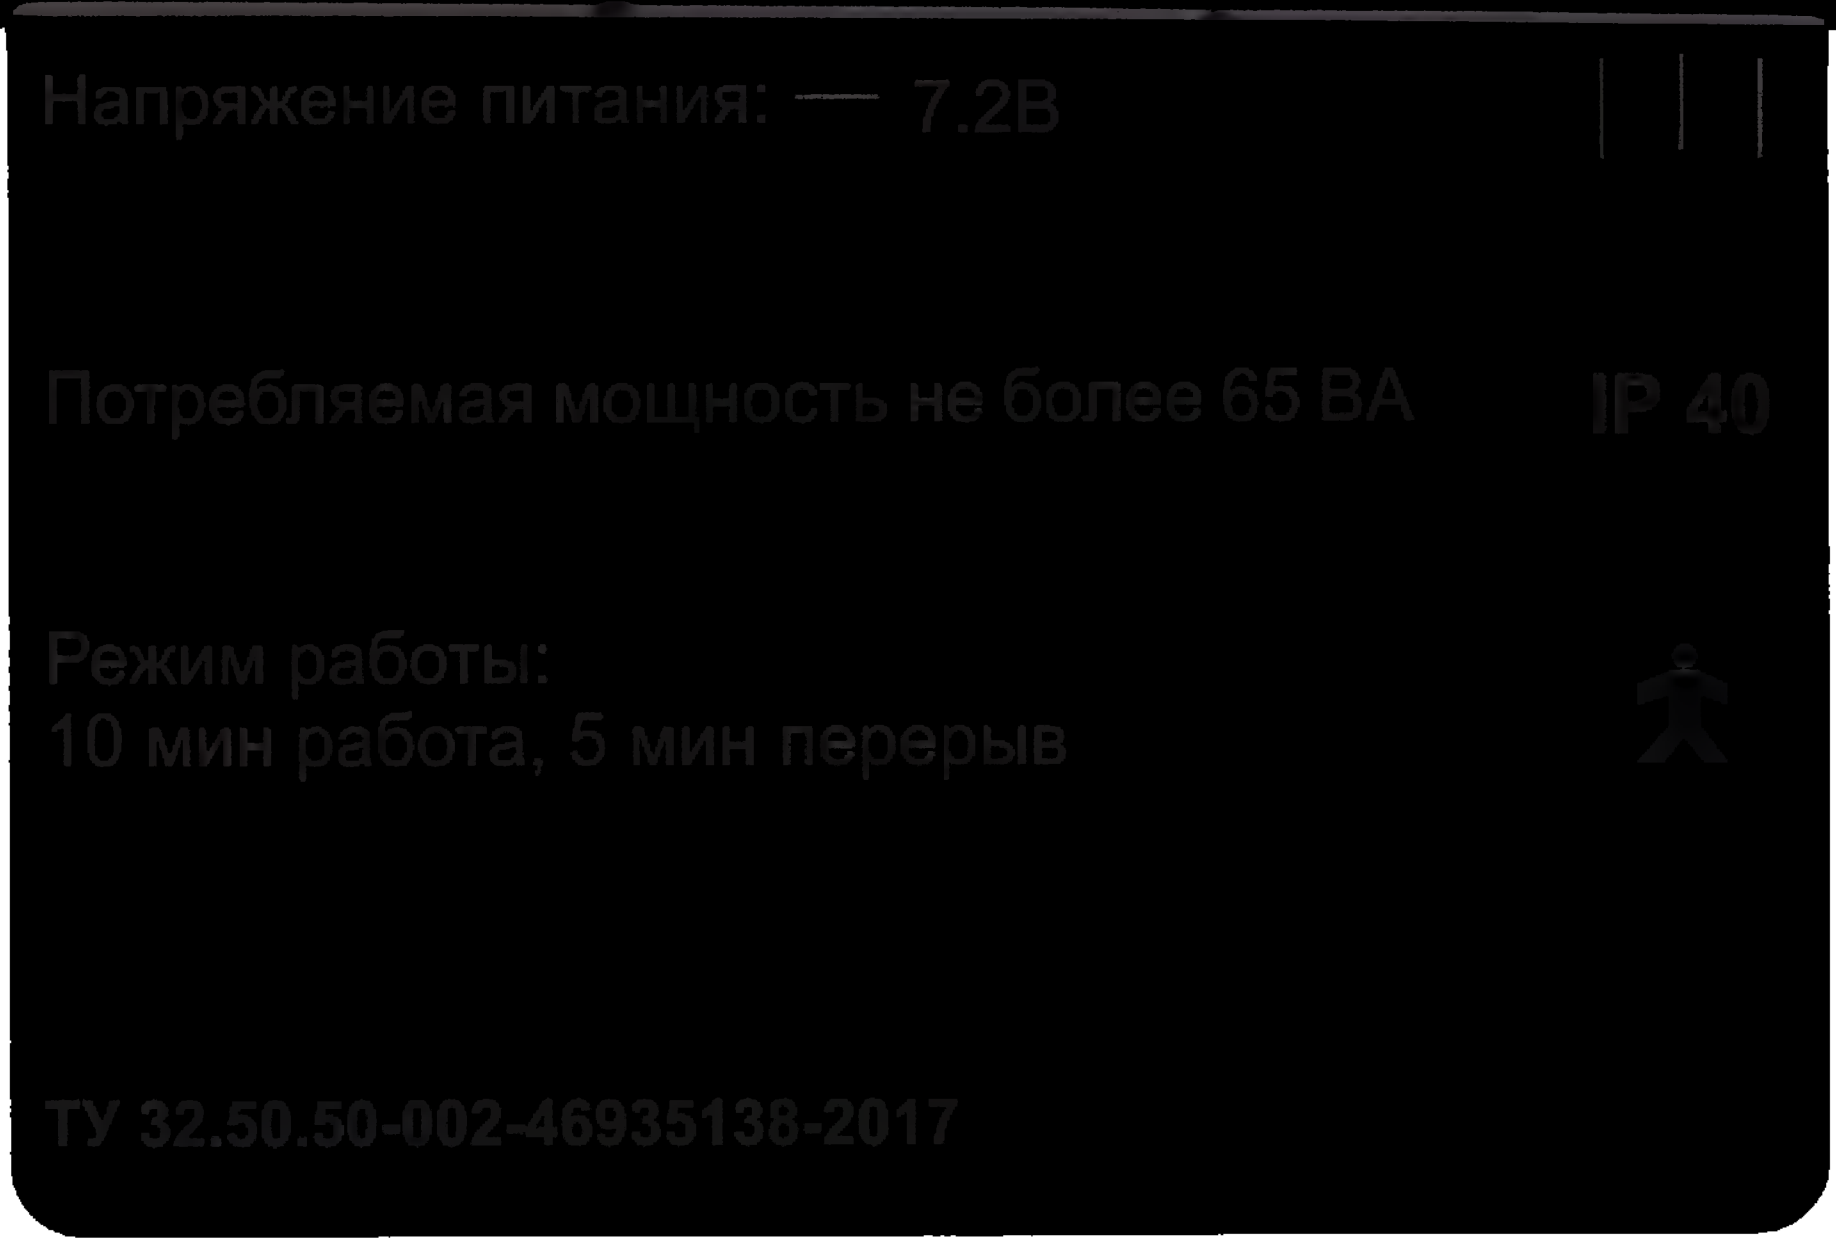

Электропривод электродрели ДЭТ-06, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПЭТ-01

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ООО «СлавМед»

2018

SN 180108

Электропривод электродрели ПЭТ-01, ч. 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

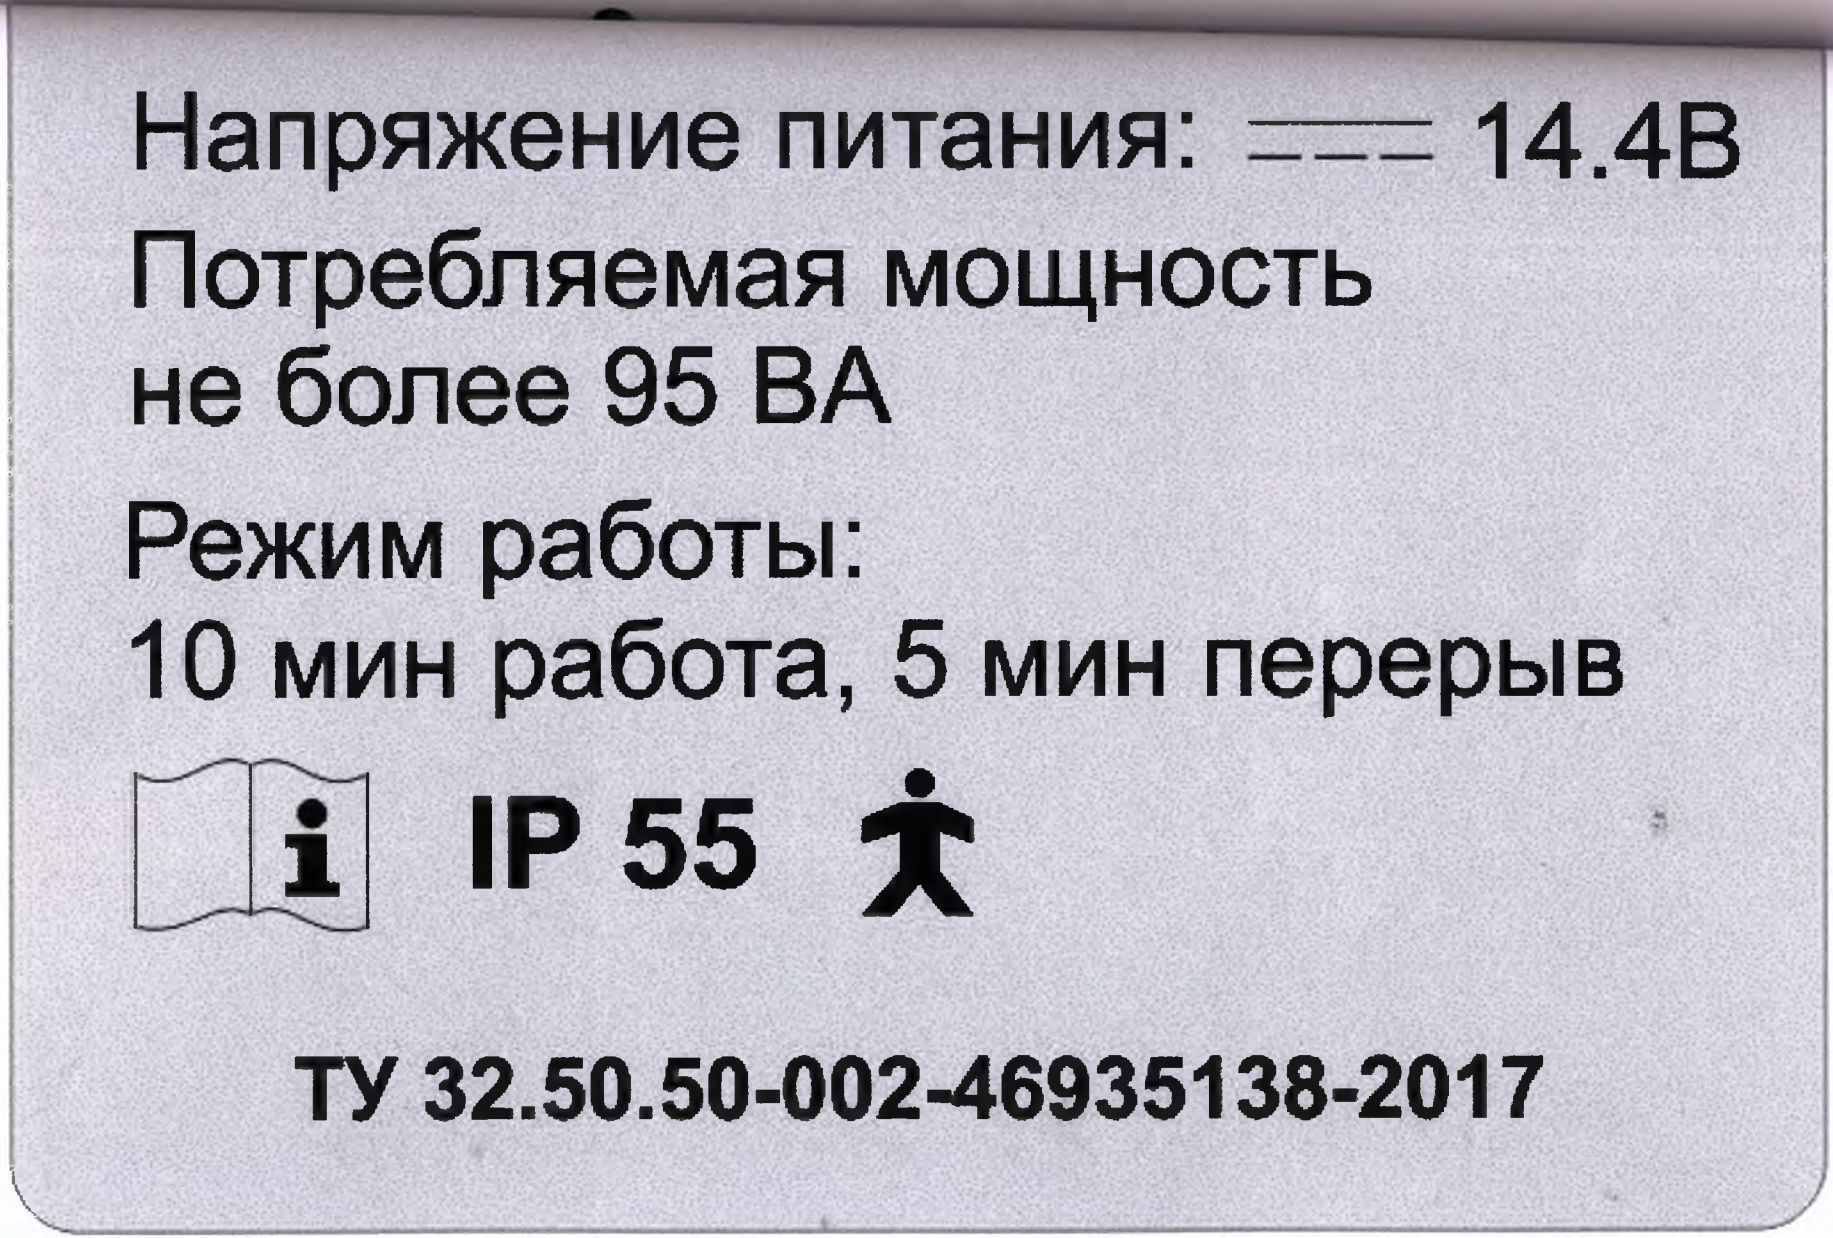

Электропривод электродрели ПЭТ-01, ч. 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

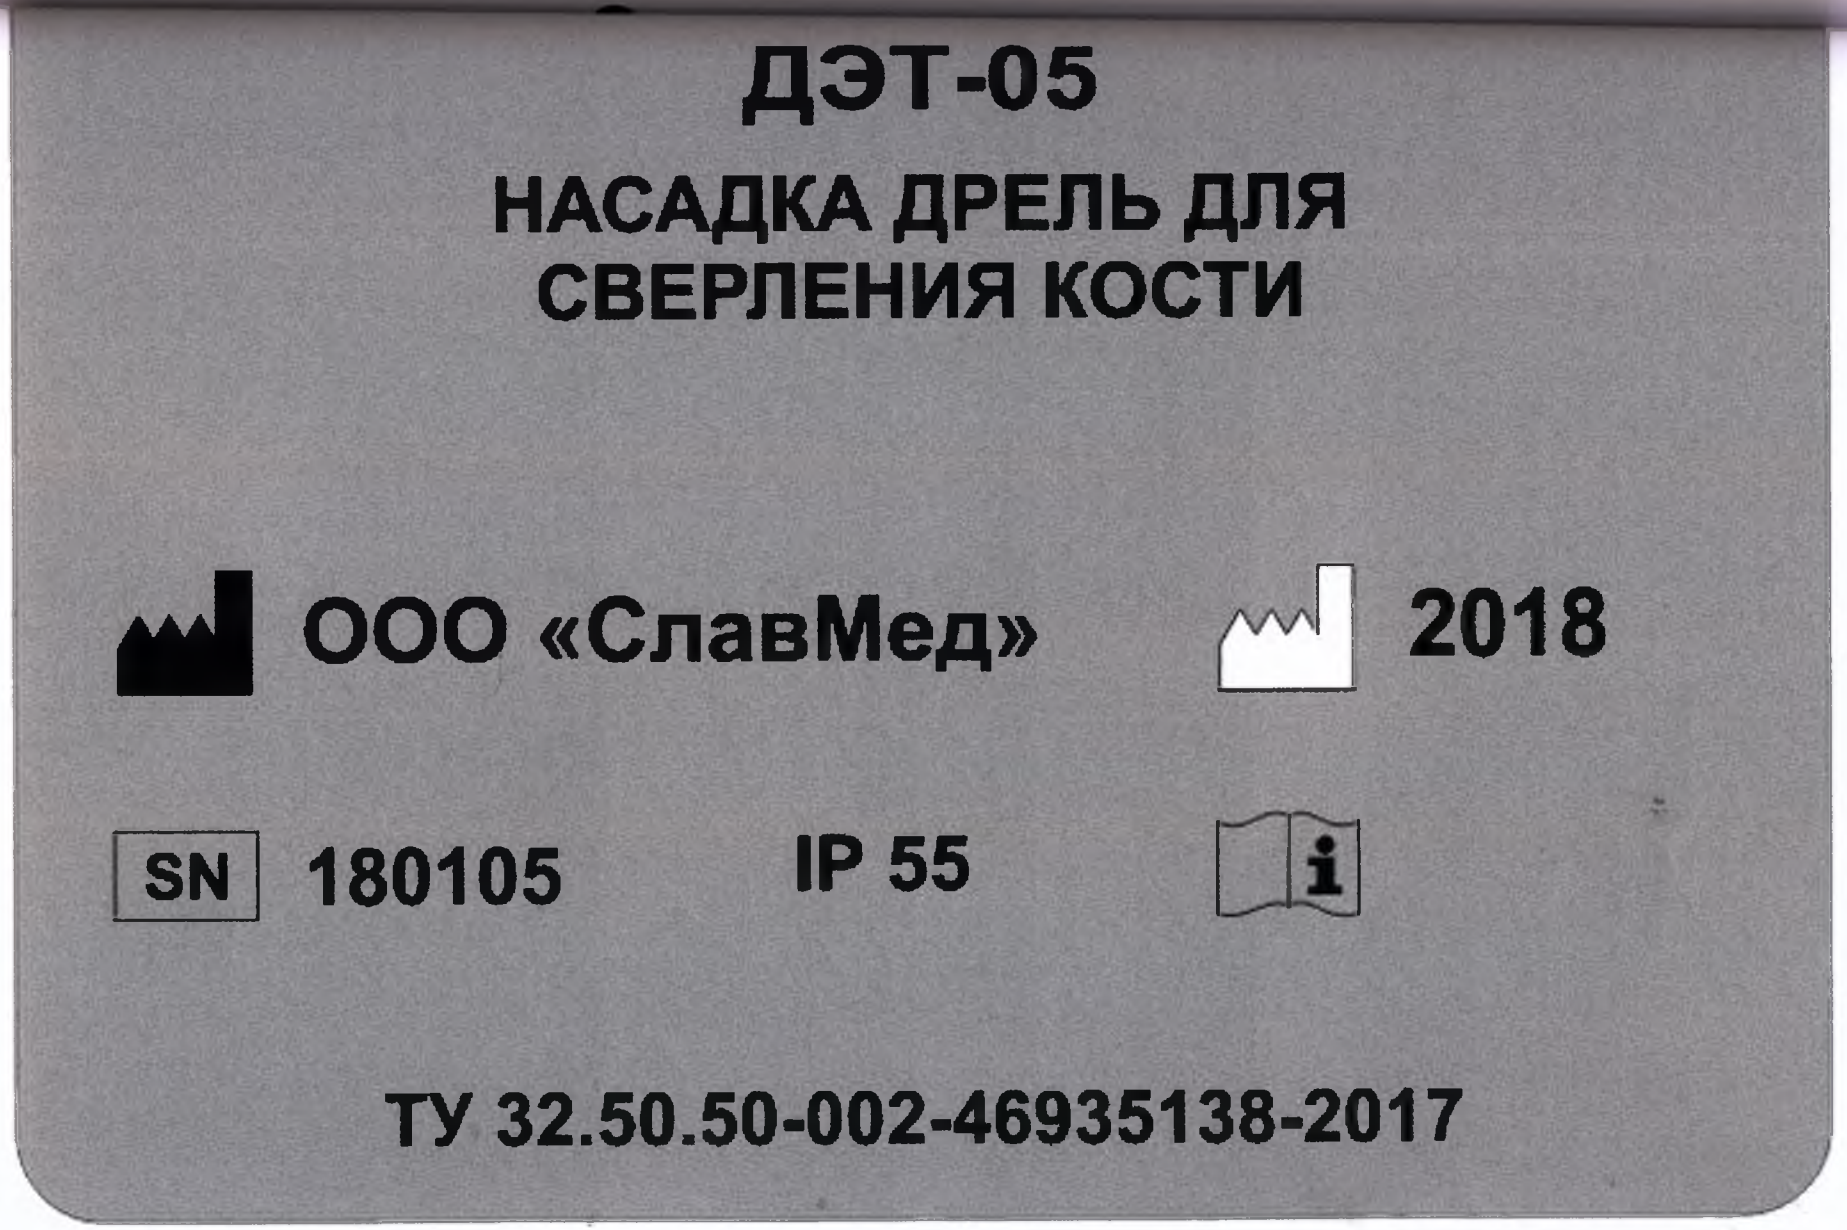

Насадка дрель для сверления кости для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

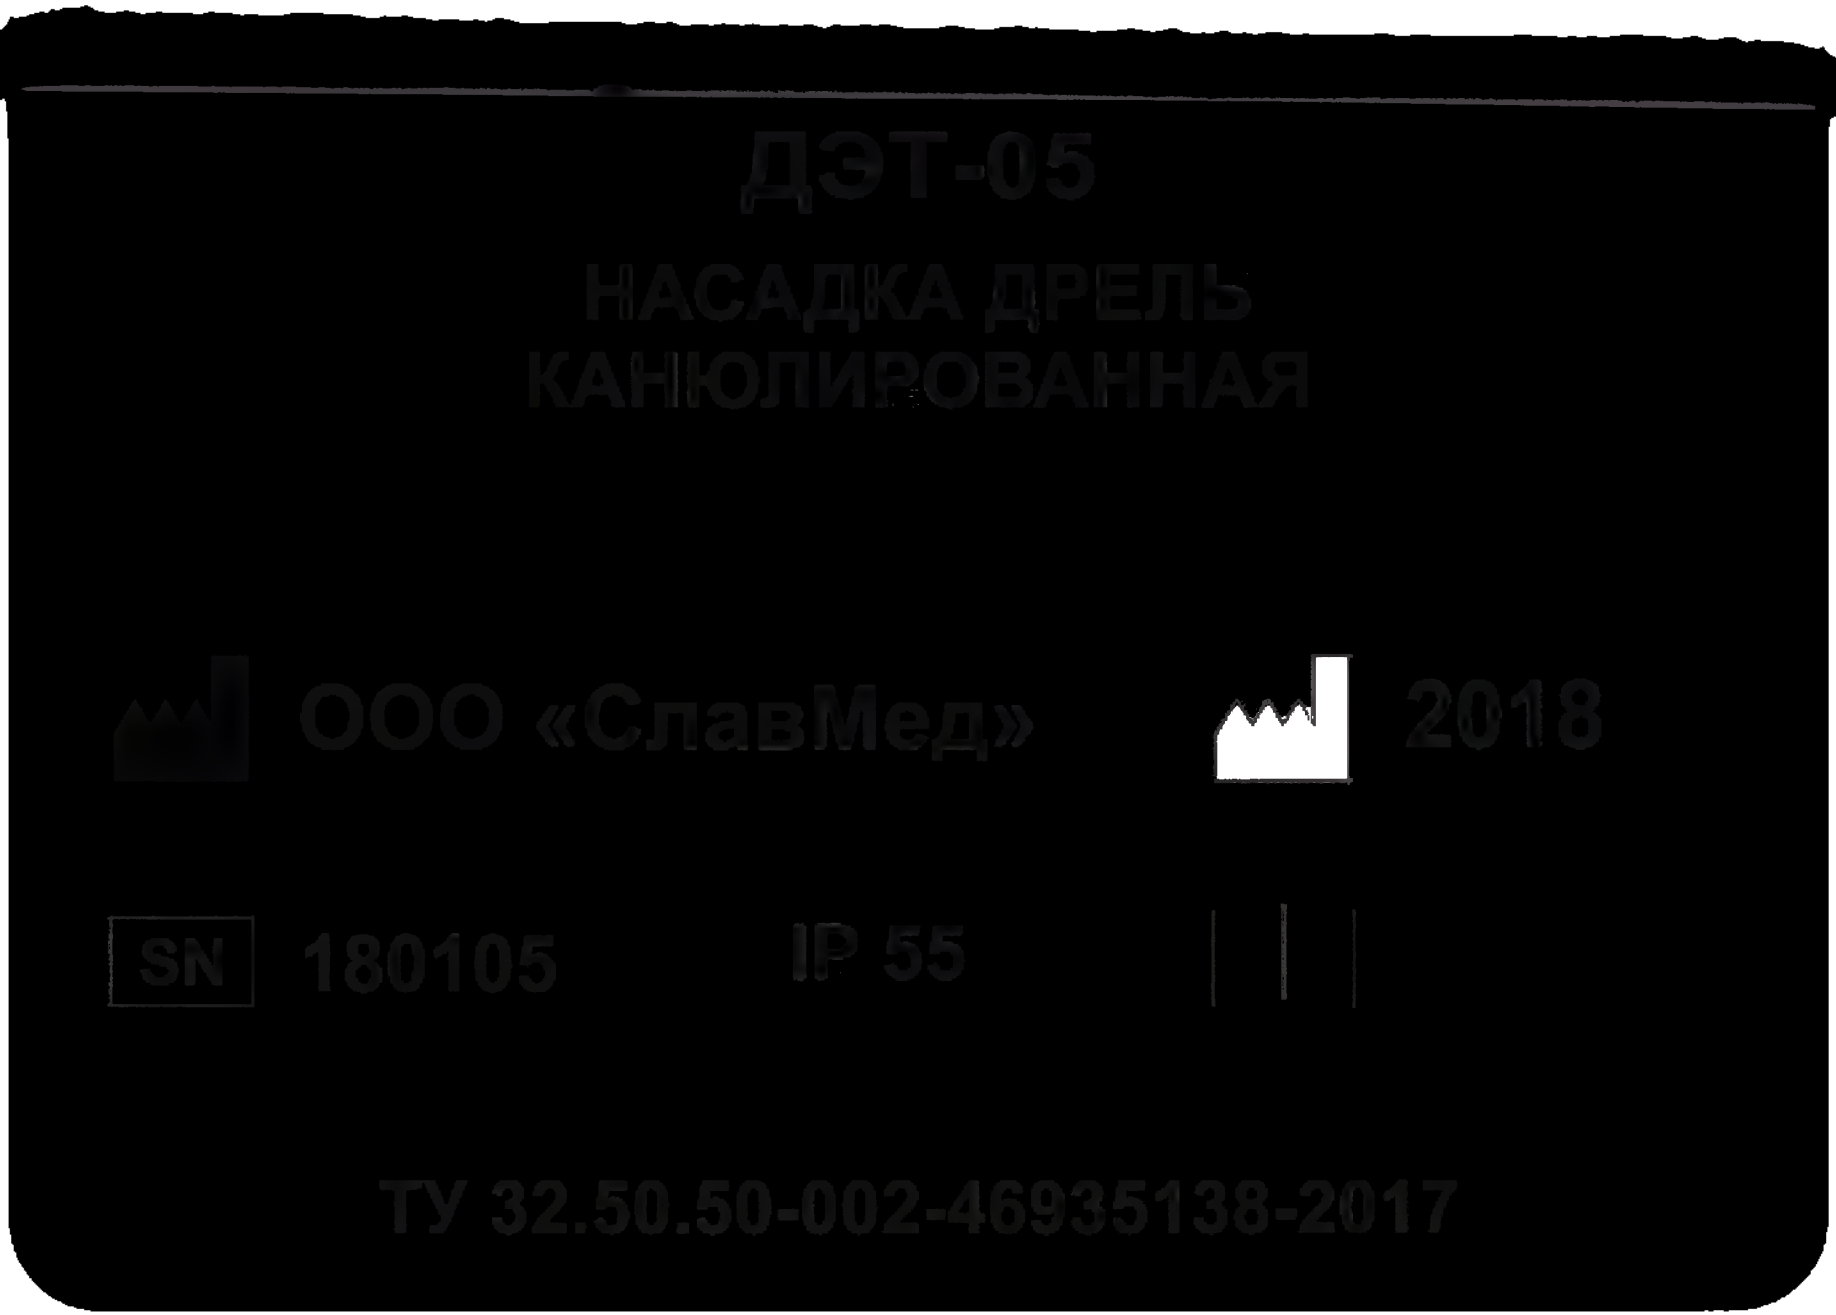

Насадка дрель канюлированная для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

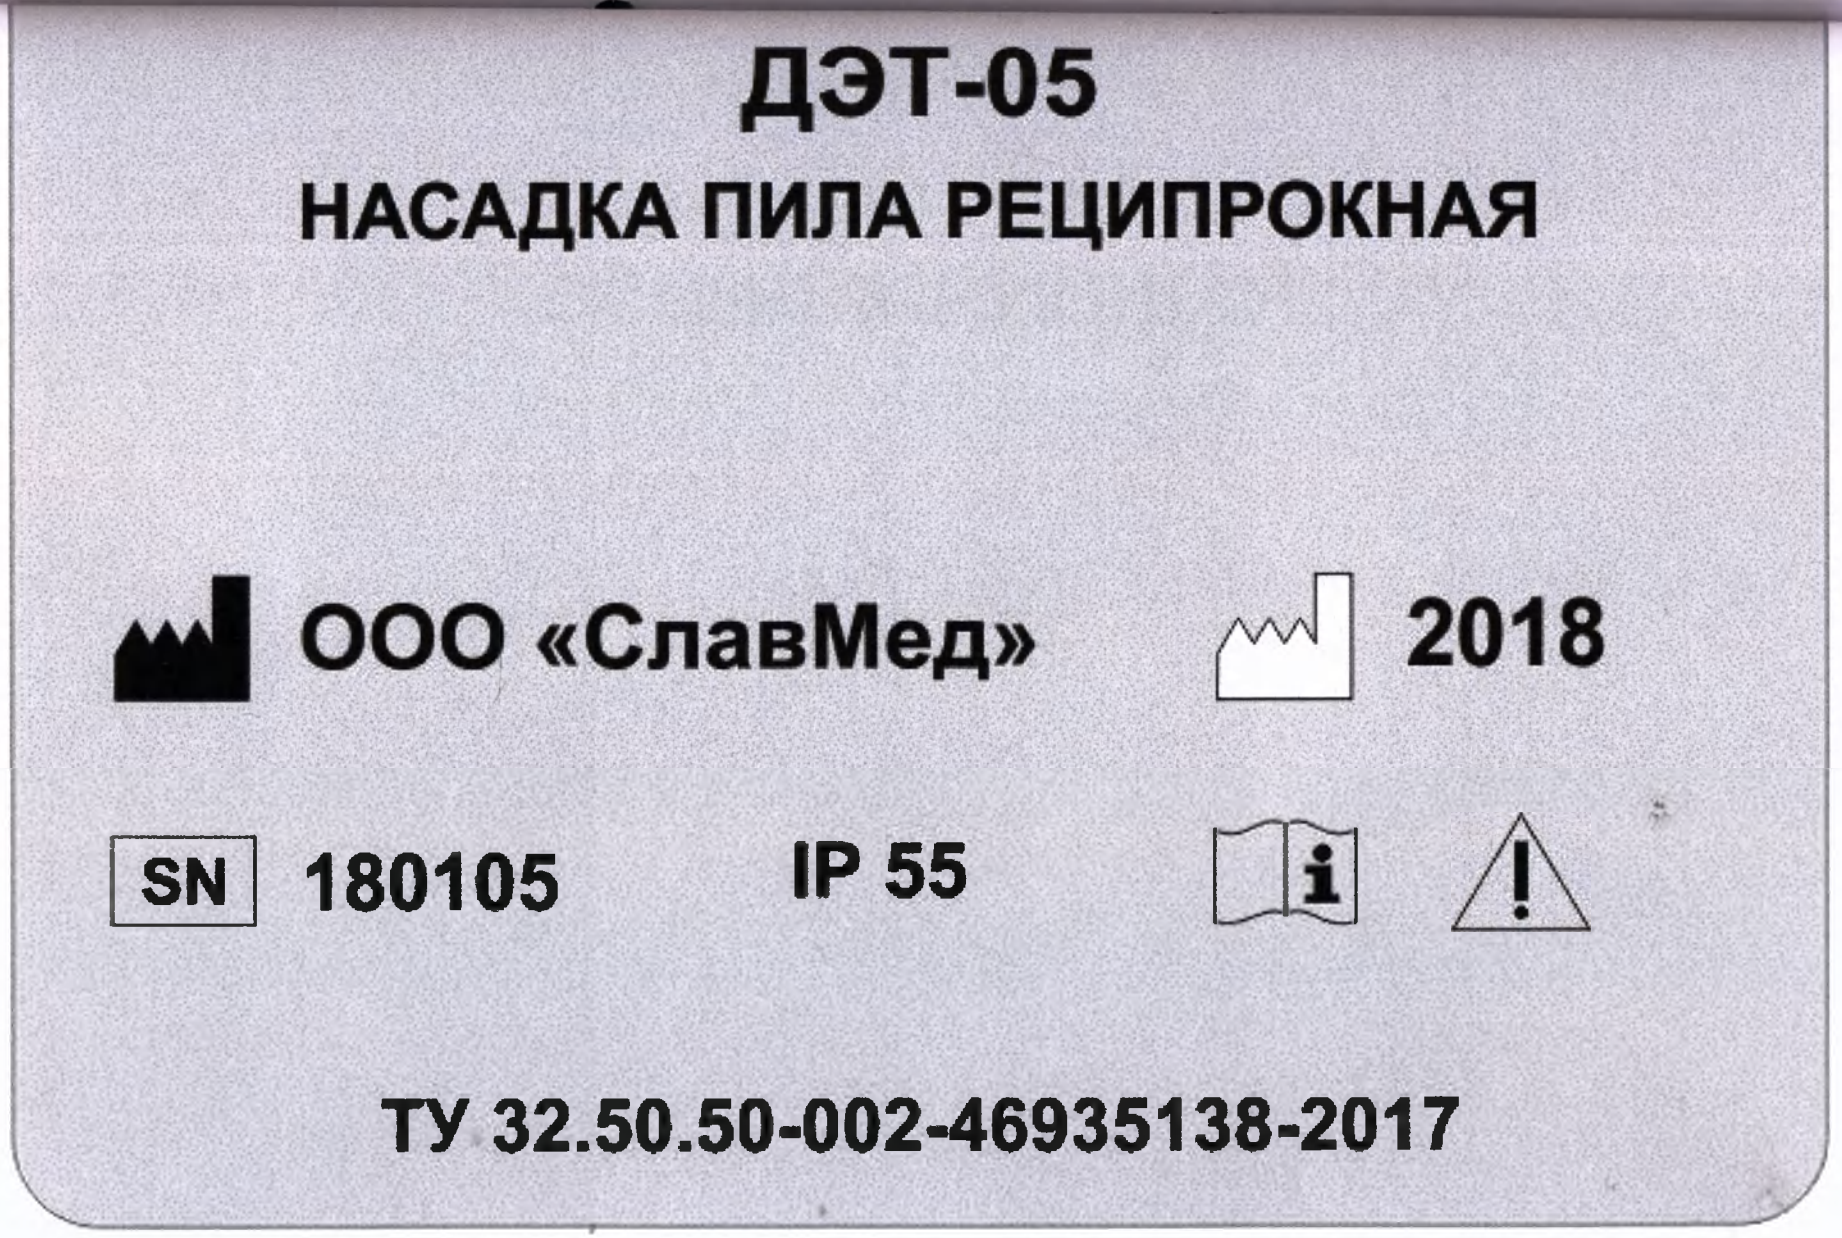

Насадка дрель реципрокная для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

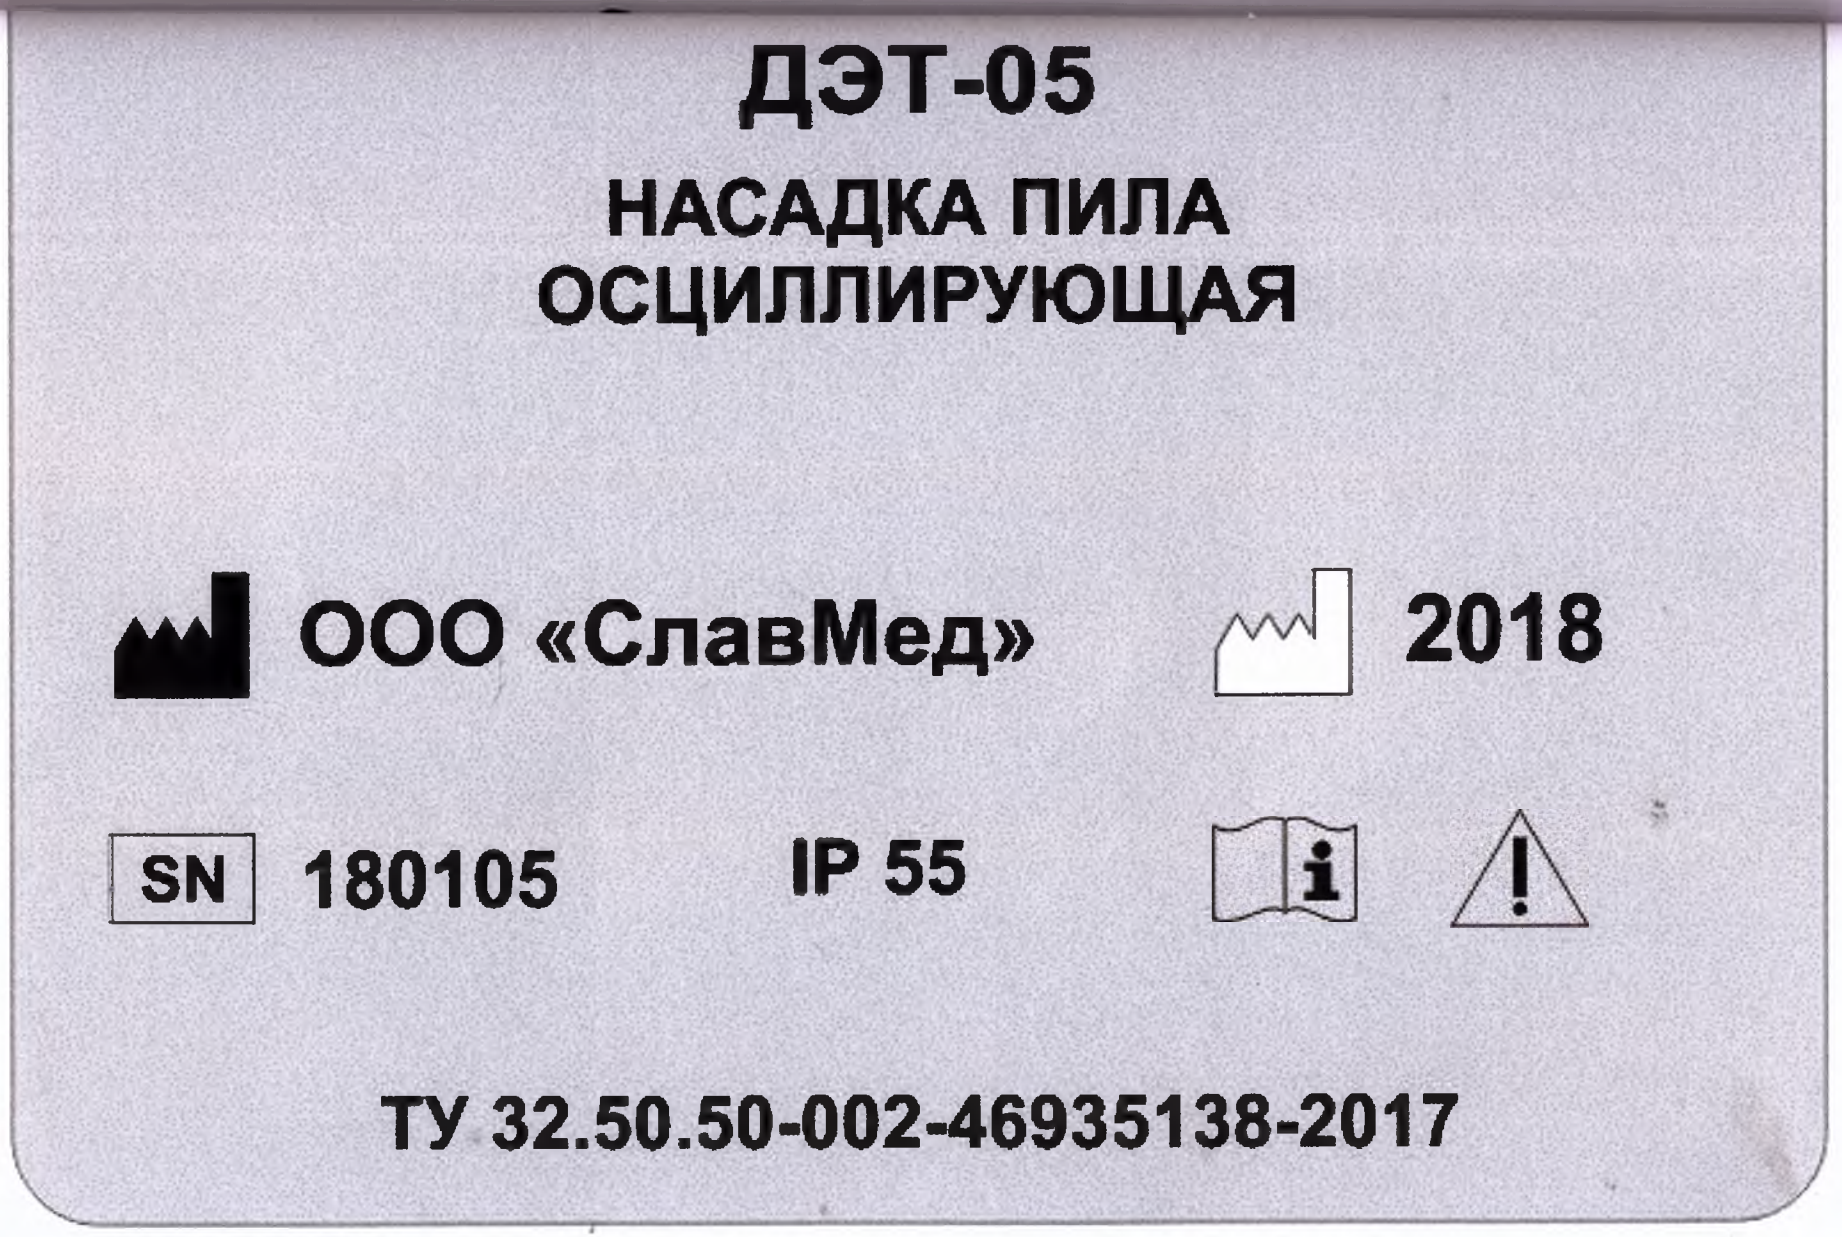

Насадка дрель осциллирующая для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

НАСАДКА ФРЕЗА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105 IP 55

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Насадка дрель нейрохирургическая для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

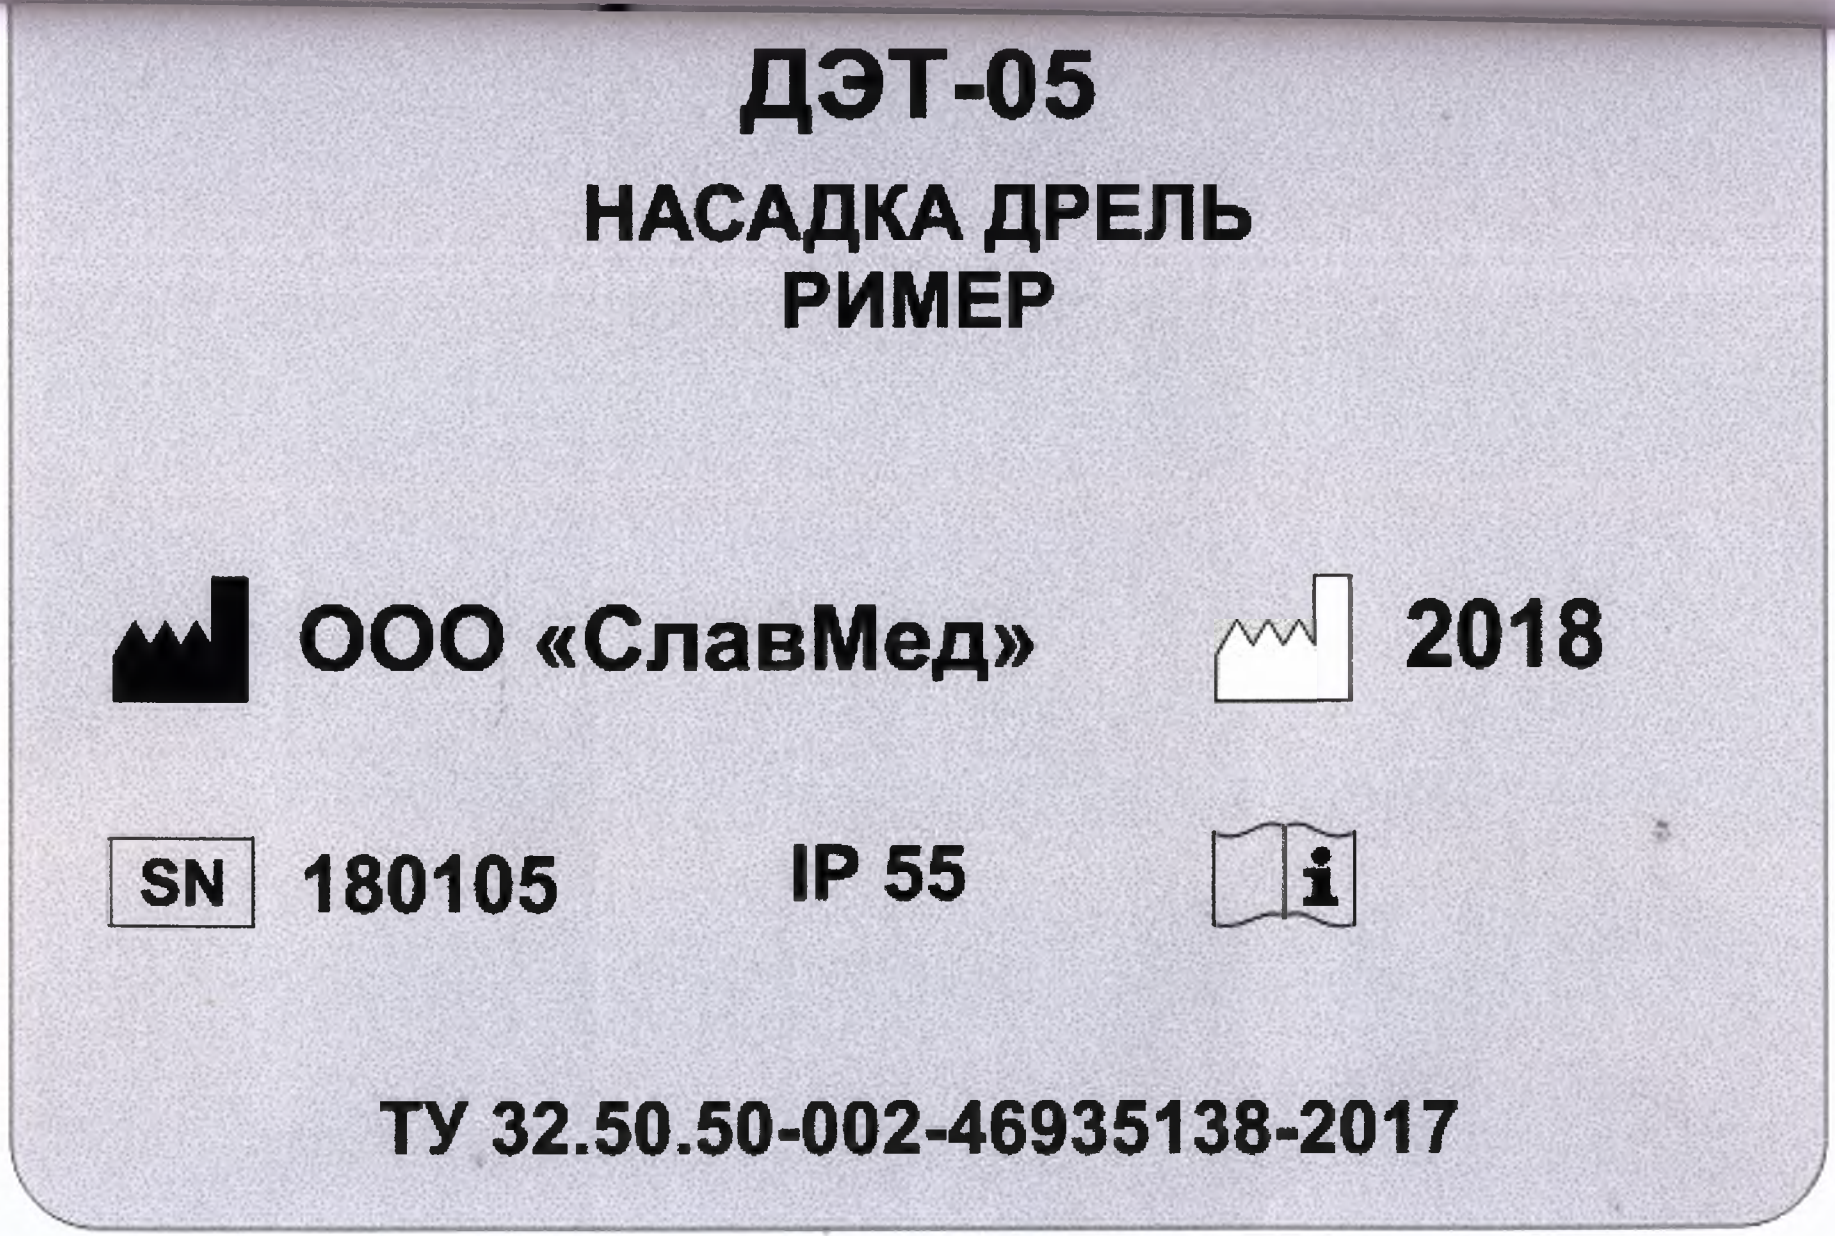

Насадка дрель ример для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

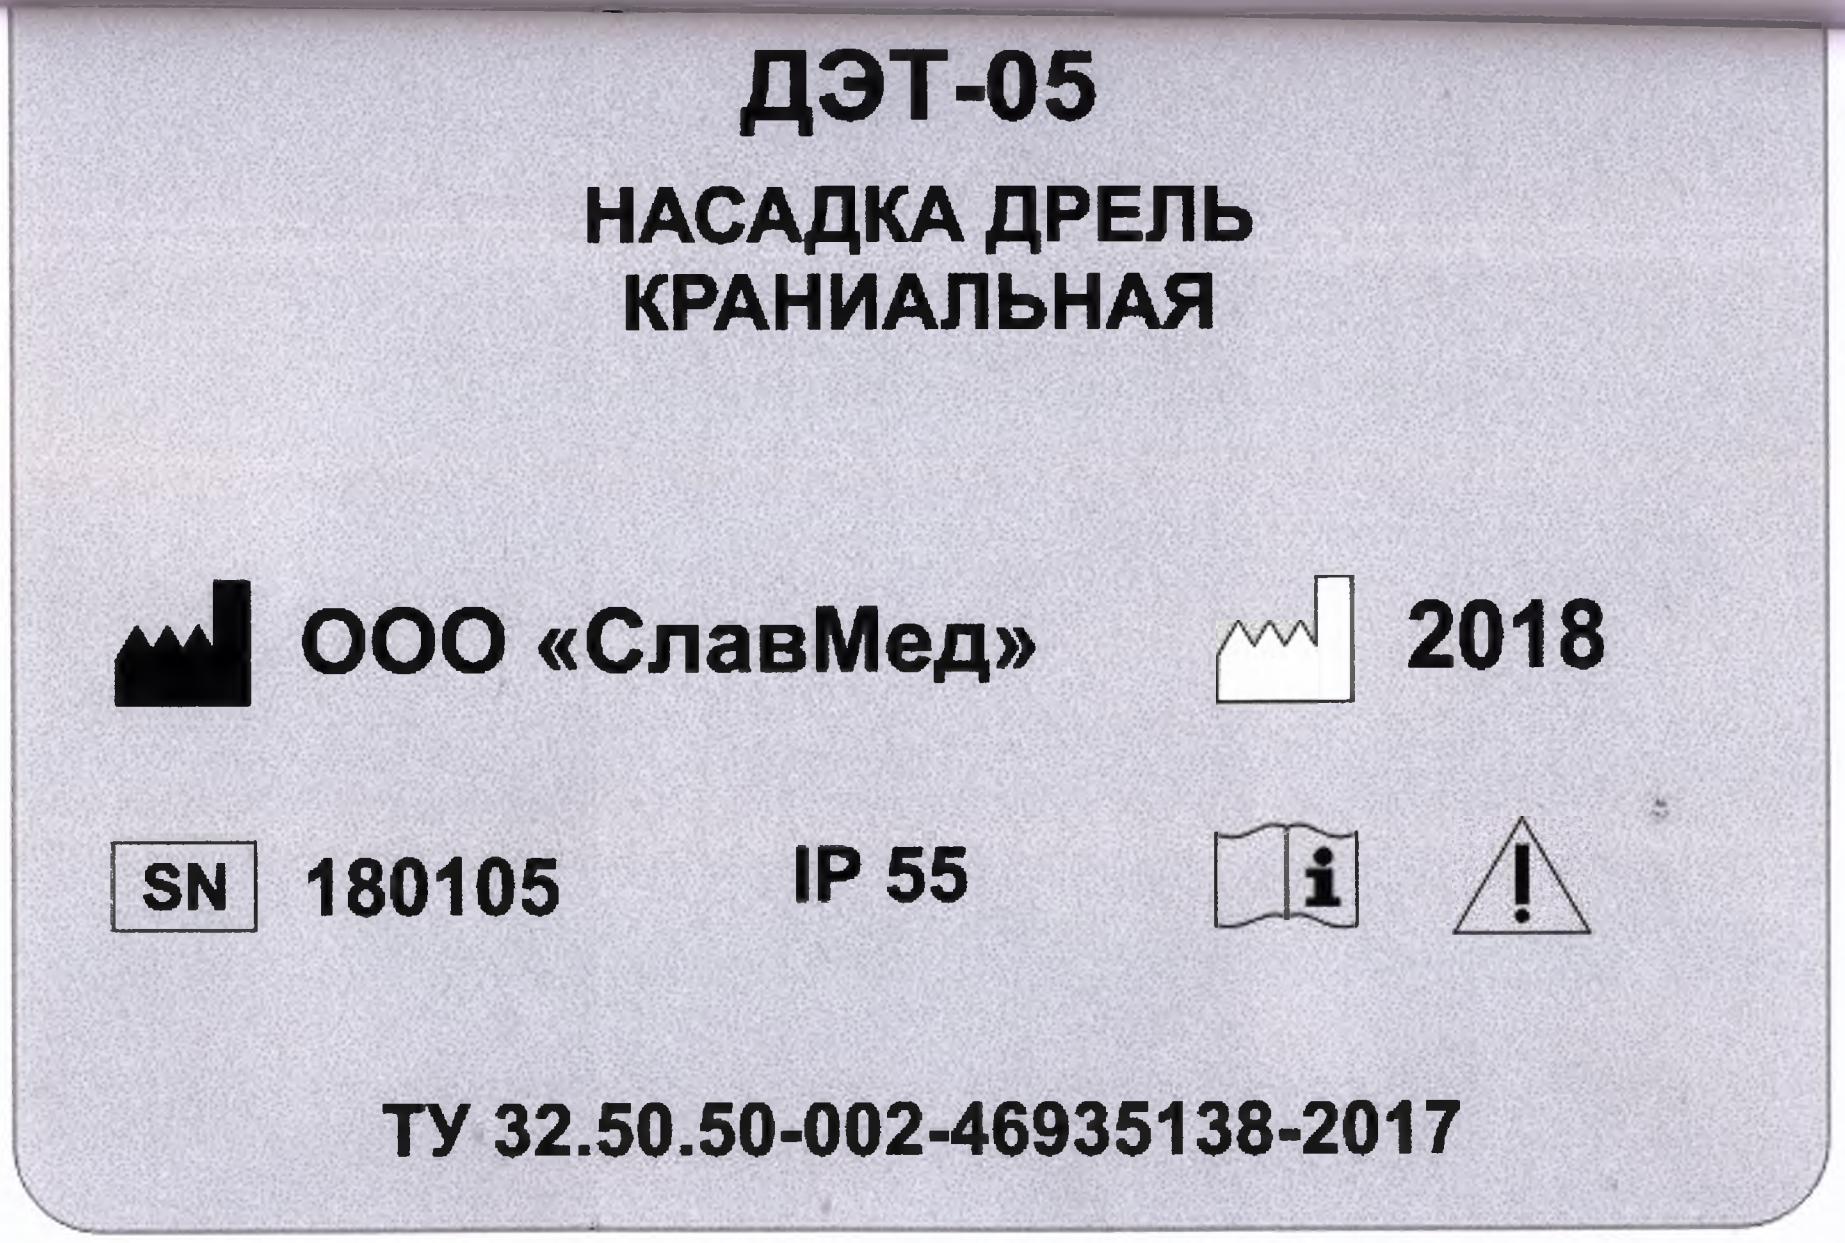

Насадка дрель краниальная для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Патрон быстрозажимной для электродрели ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

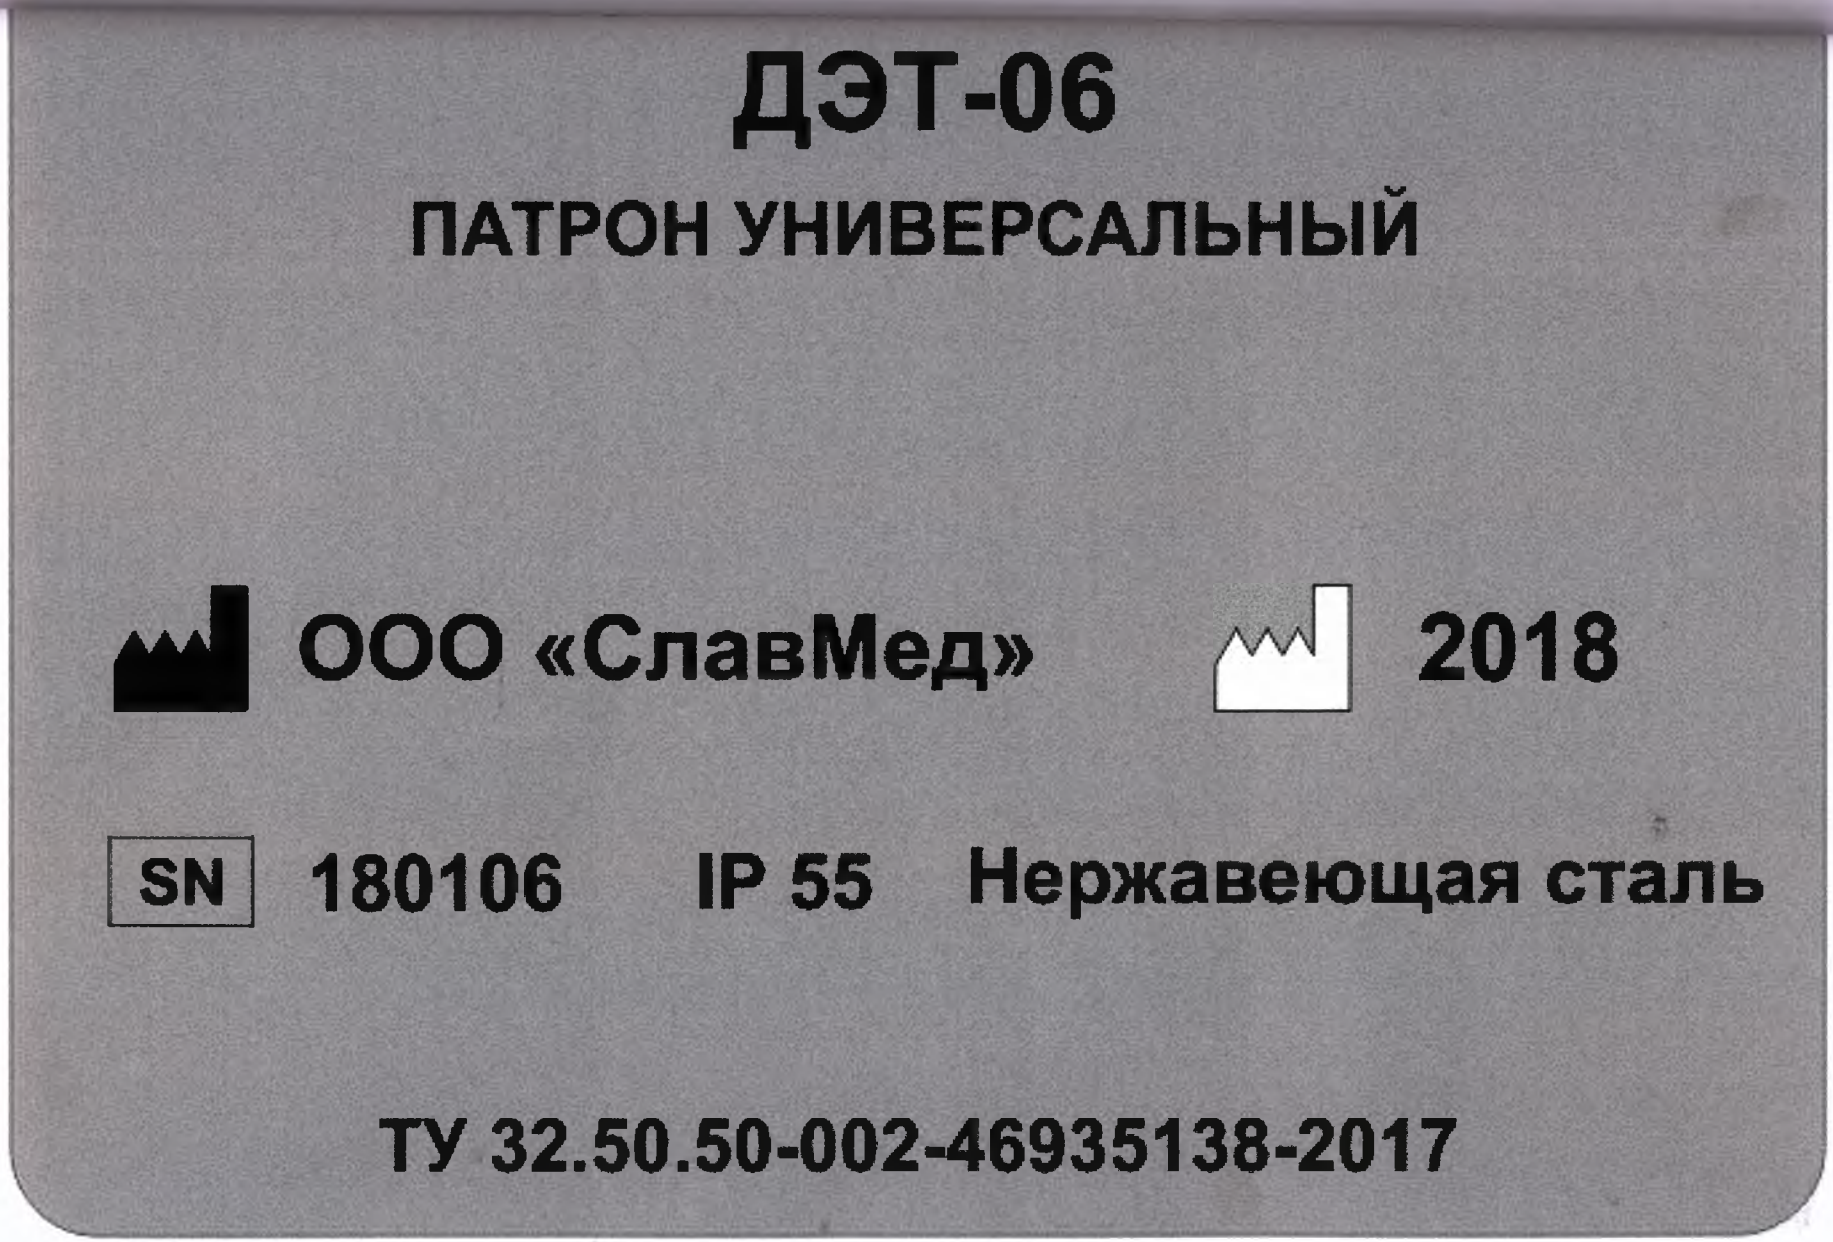

Патрон универсальный для электродрели ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

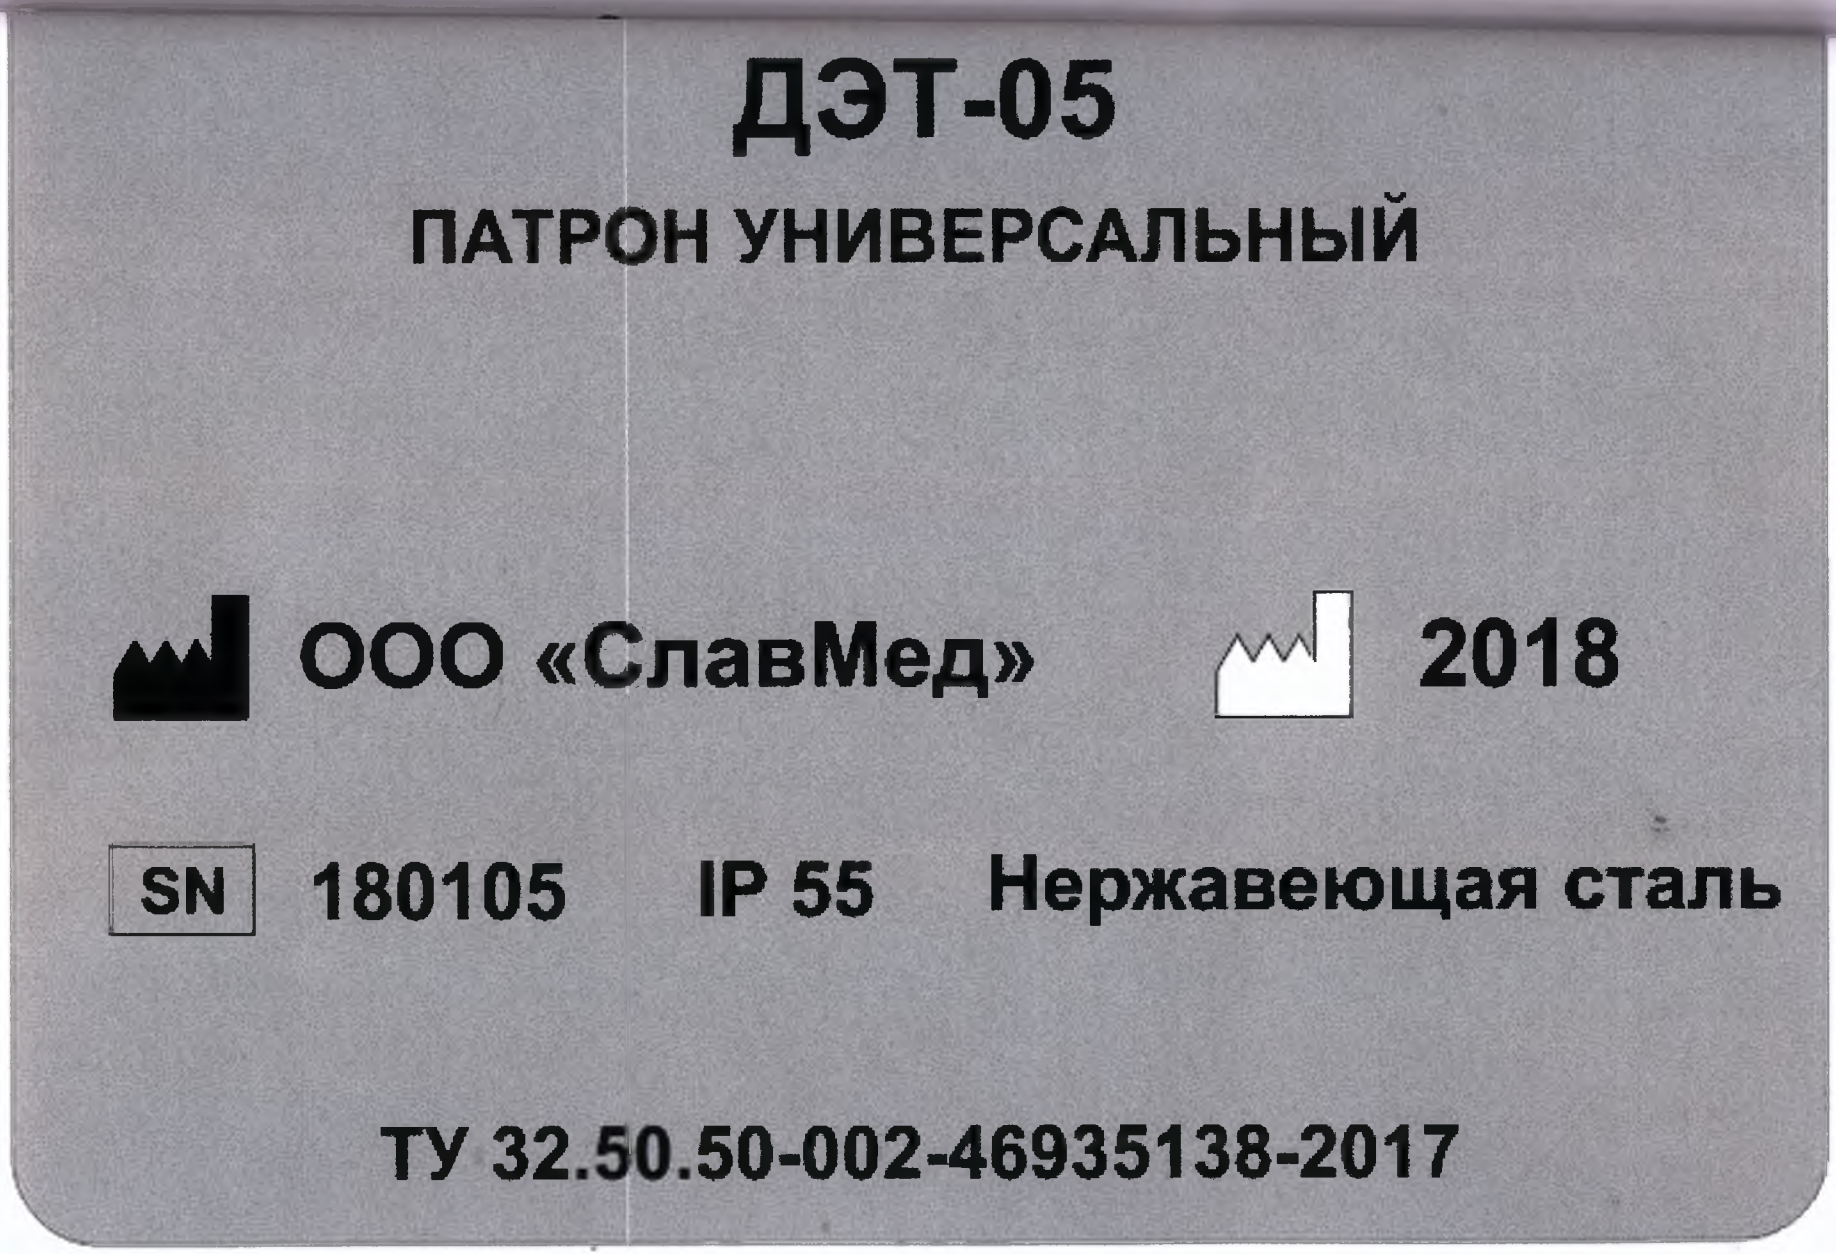

Патрон универсальный для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Патрон для спиц для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

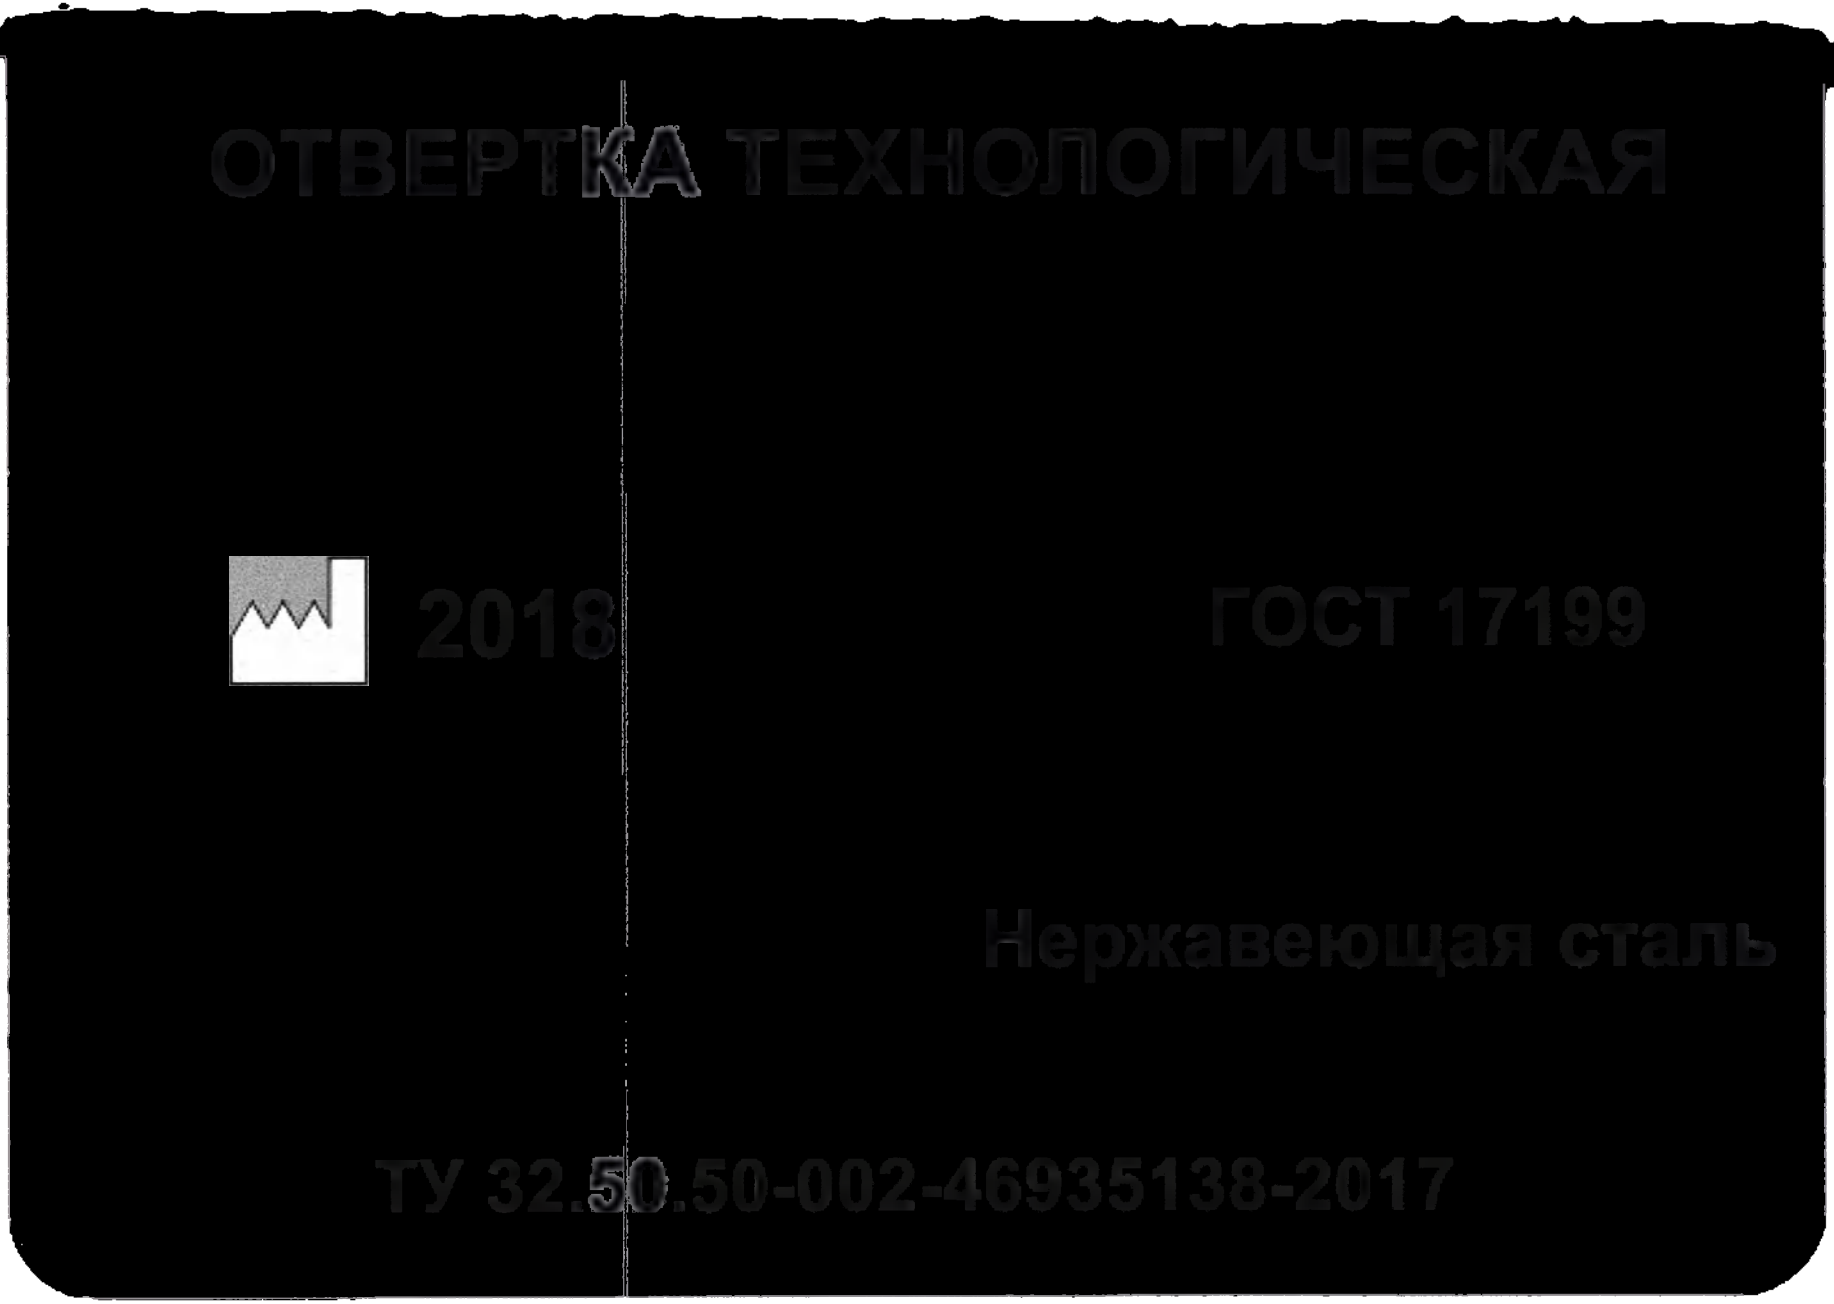

Отвертка технологическая для электродрели ДЭТ-02, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

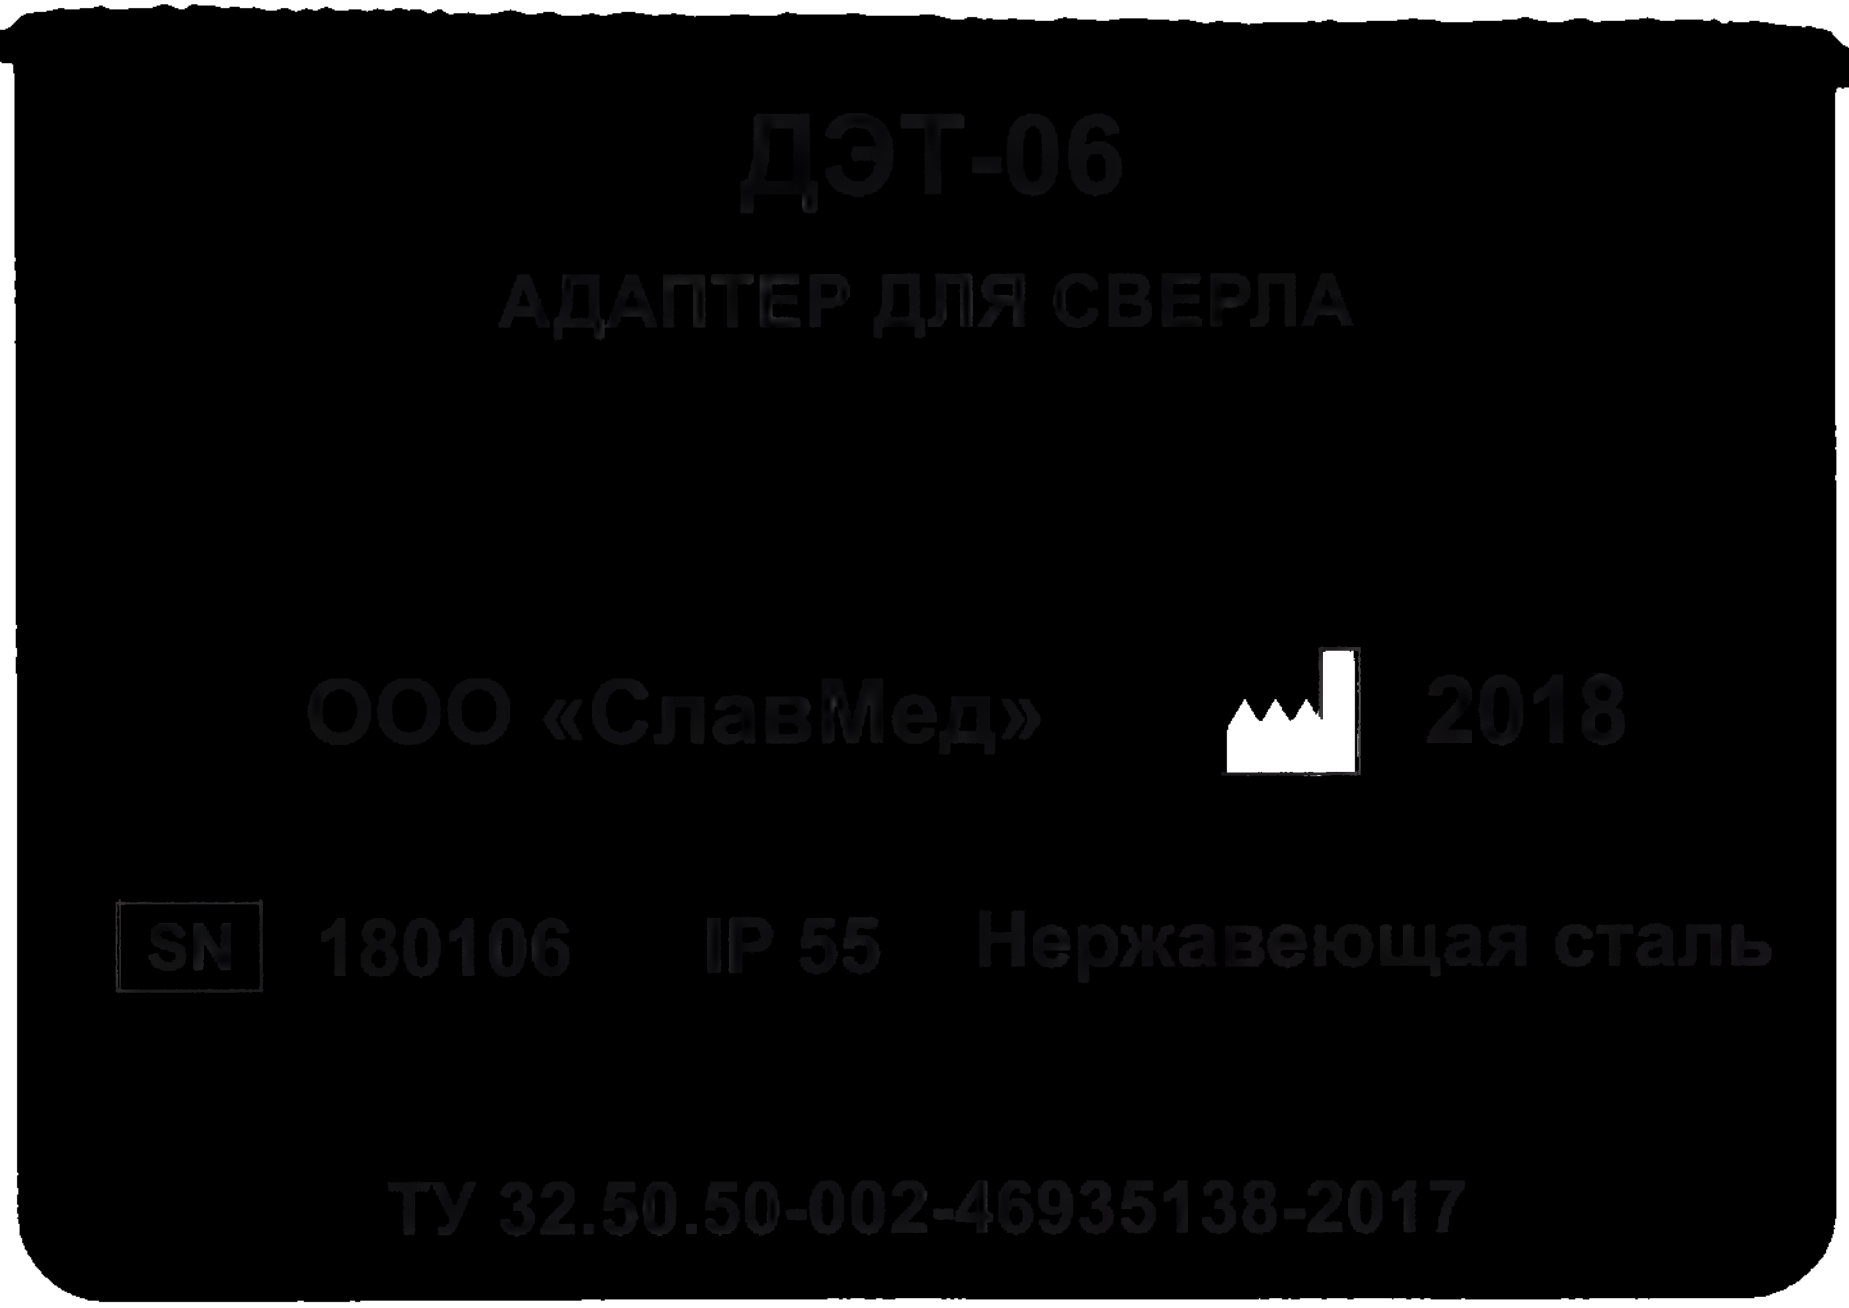

Адаптер для сверла для электродрели ДЭТ-02, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

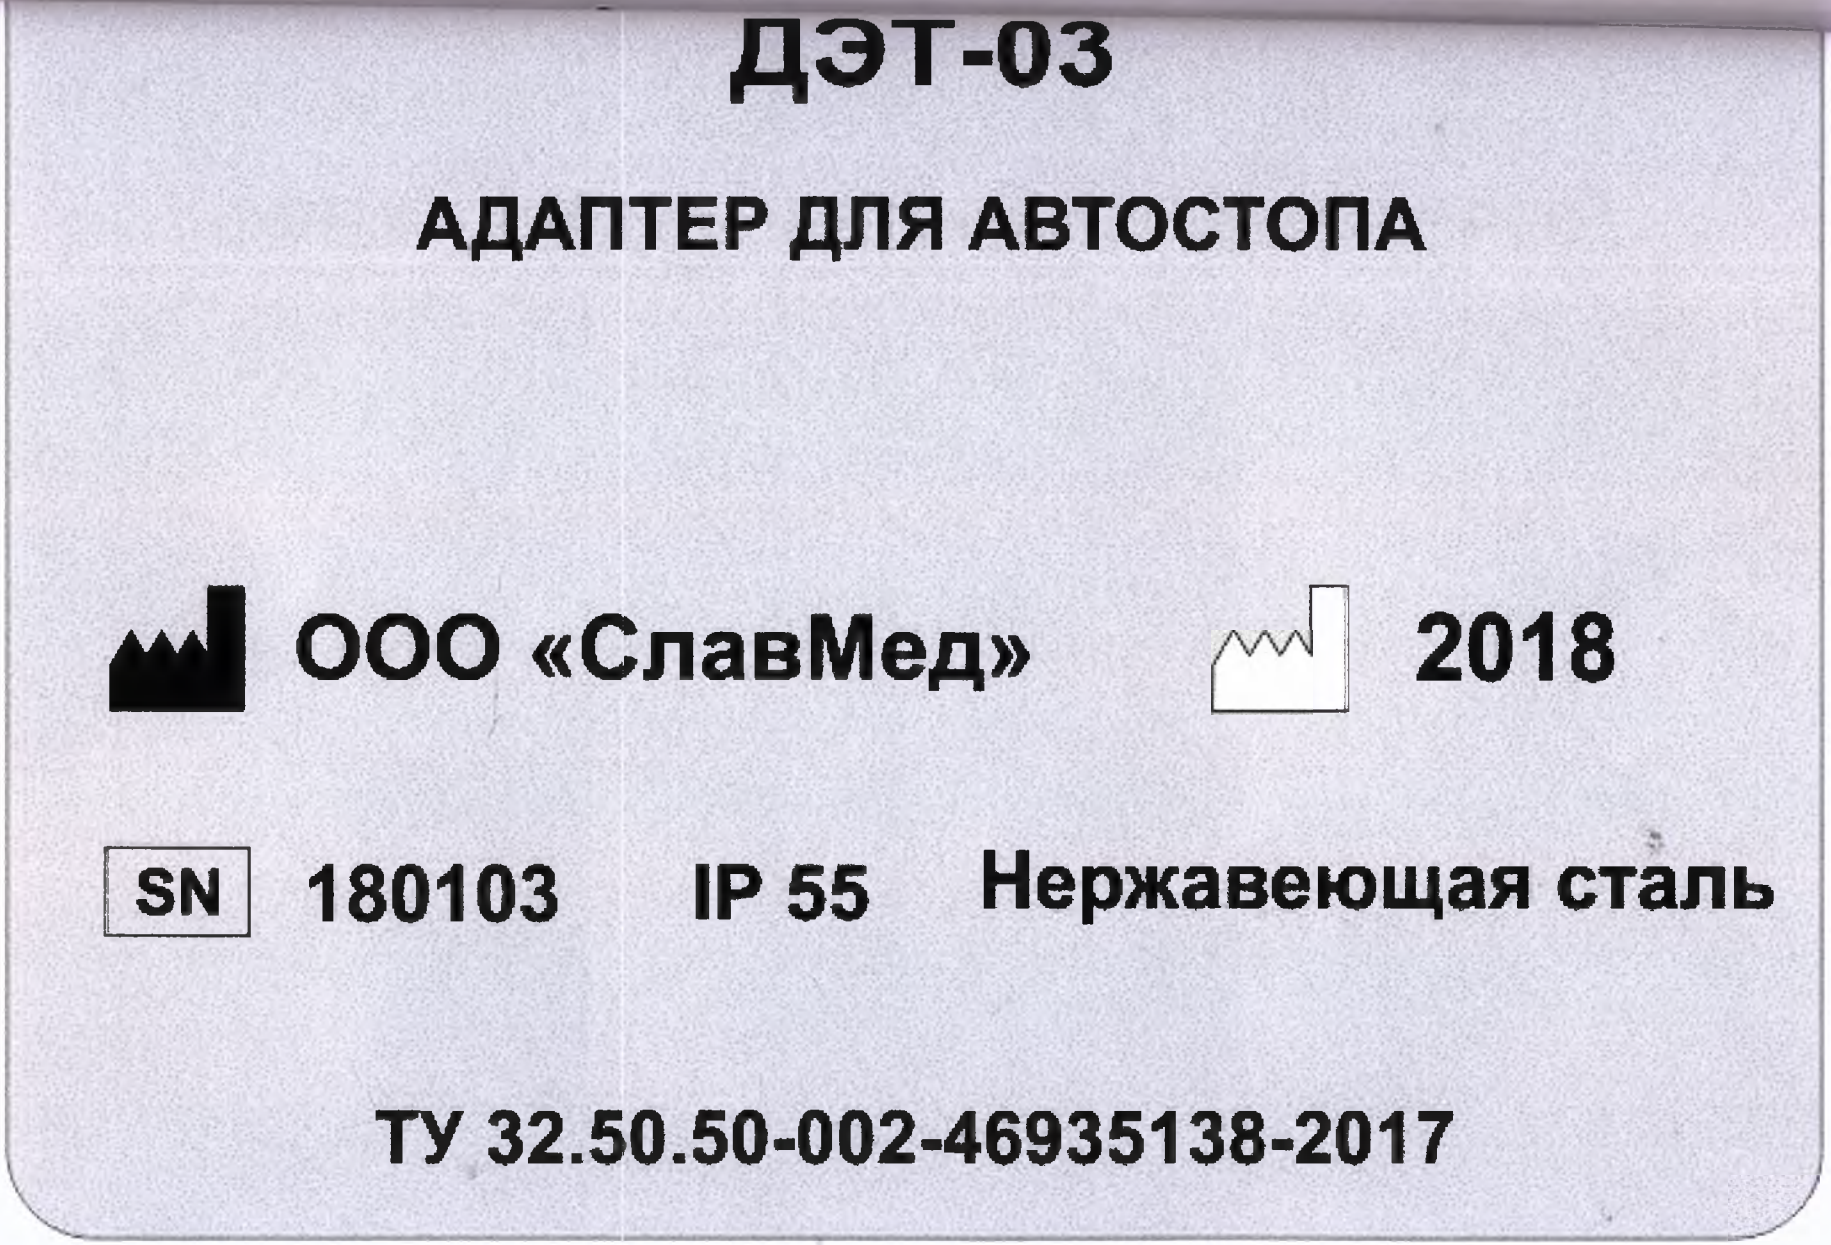

Адаптер для автостопа для электродрели ДЭТ-03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-04

ФРЕЗА СФЕРИЧЕСКАЯ С АДАПТЕРОМ

ООО «СлавМед» 2018

SN 180104 Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Фреза сферическая с адаптером для электродрели ДЭТ-04, ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ КРАНИОТОМИИ

d = 6.0; 9.0; 12.0 мм

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105

Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Комплект насадок для краниотомии для электродрели ДЭТ-03, ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

КЛЮЧ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПАТРОНУ

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105 IP 55 Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Ключ к универсальному патрону для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

ФРЕЗА ПОЛАЯ

d=7.0 мм

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105

Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Фреза полая для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

НАБОР МЕТЧИКОВ ДЛЯ КОРТИКАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ

d=3.5; 4.5 мм

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105

Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Набор метчиков для кортикальной резьбы для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

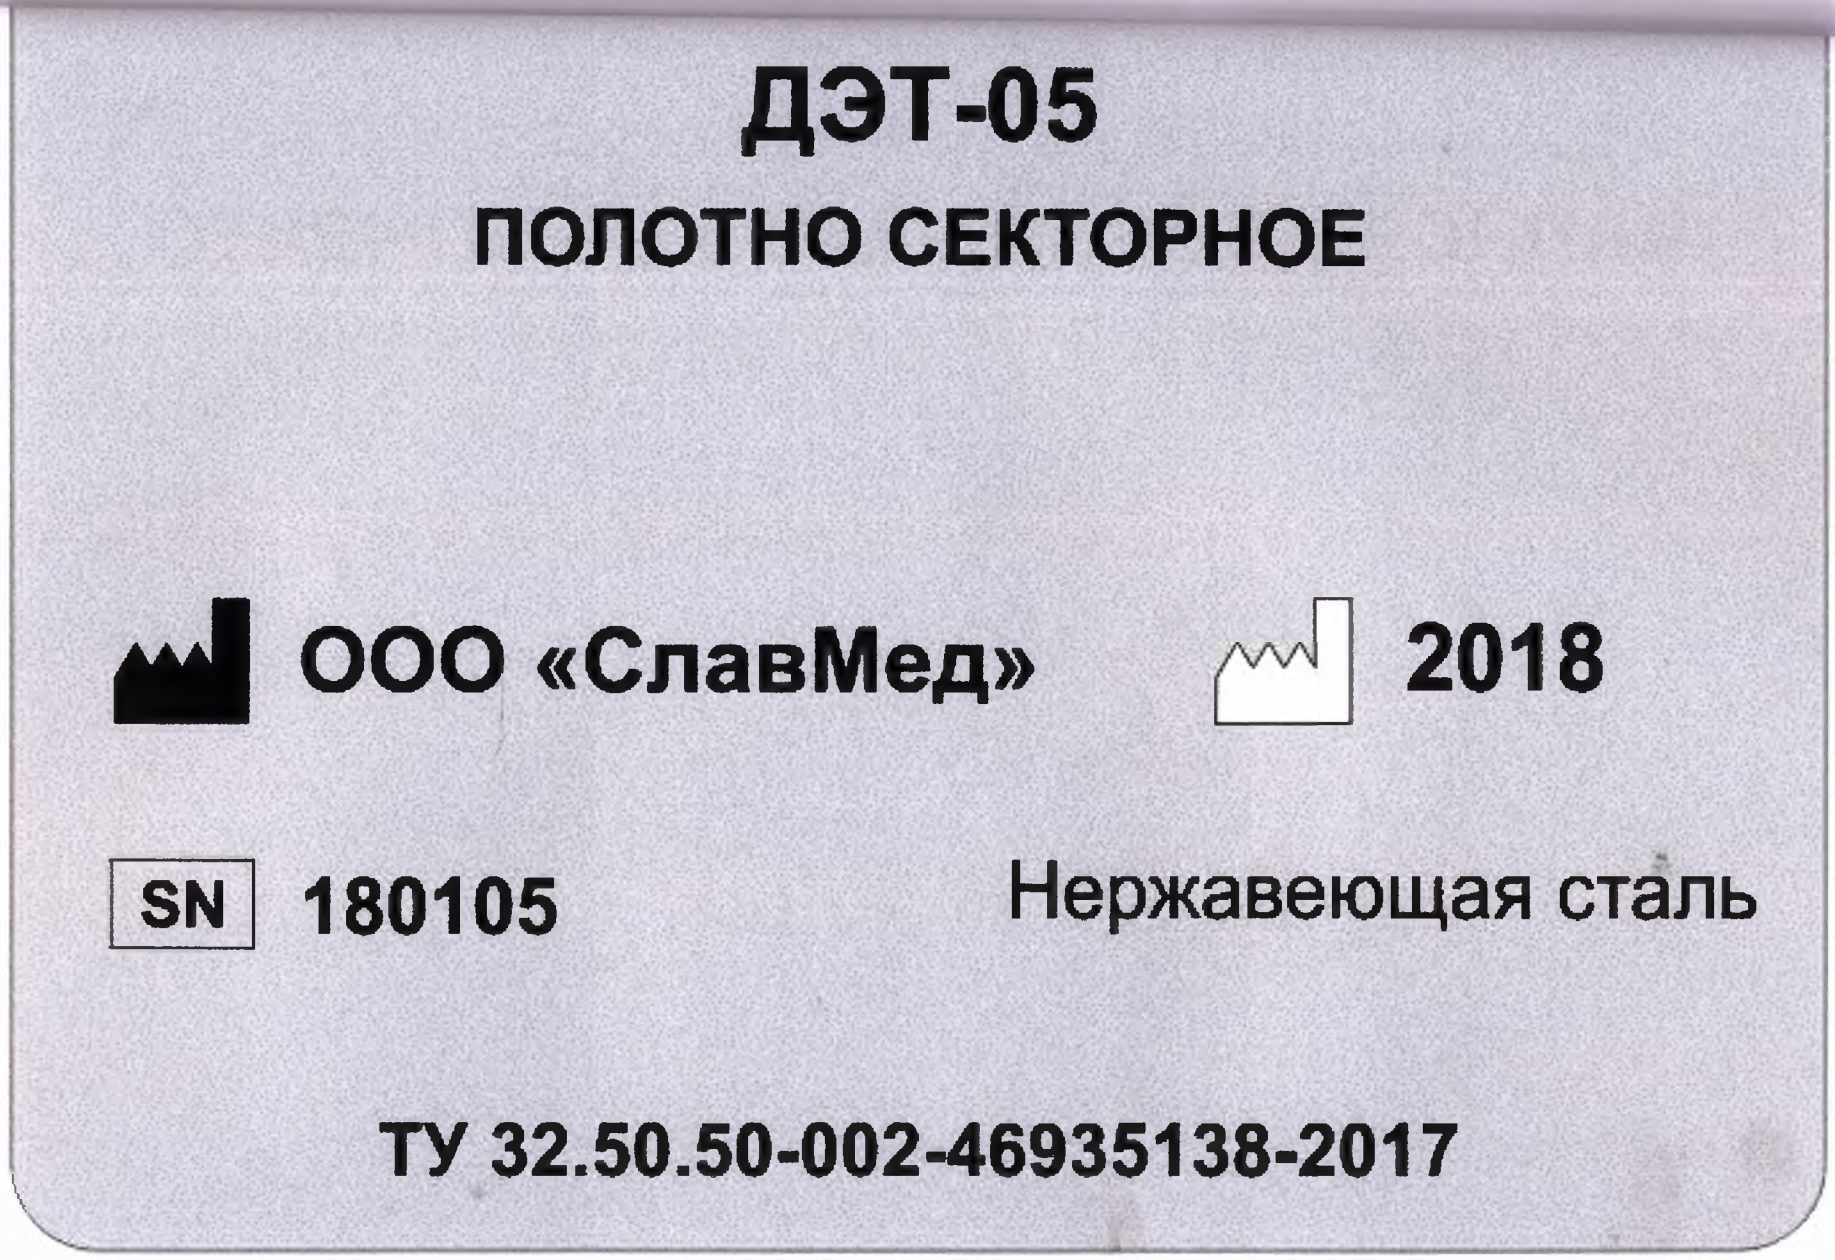

Полотно секторное для электродрели ДЭТ-05, электропилы ПЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105 Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Отвертка плоская двухсторонняя для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

ОТВЕРТКА ШЕСТИГРАННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ

S=2.5, 3.5 мм

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105

Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Отвертка шестигранная двухсторонняя для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-05

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ

ООО «СлавМед» 2018

SN 180105

Нержавеющая сталь

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Отвертка крестовая двухсторонняя для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

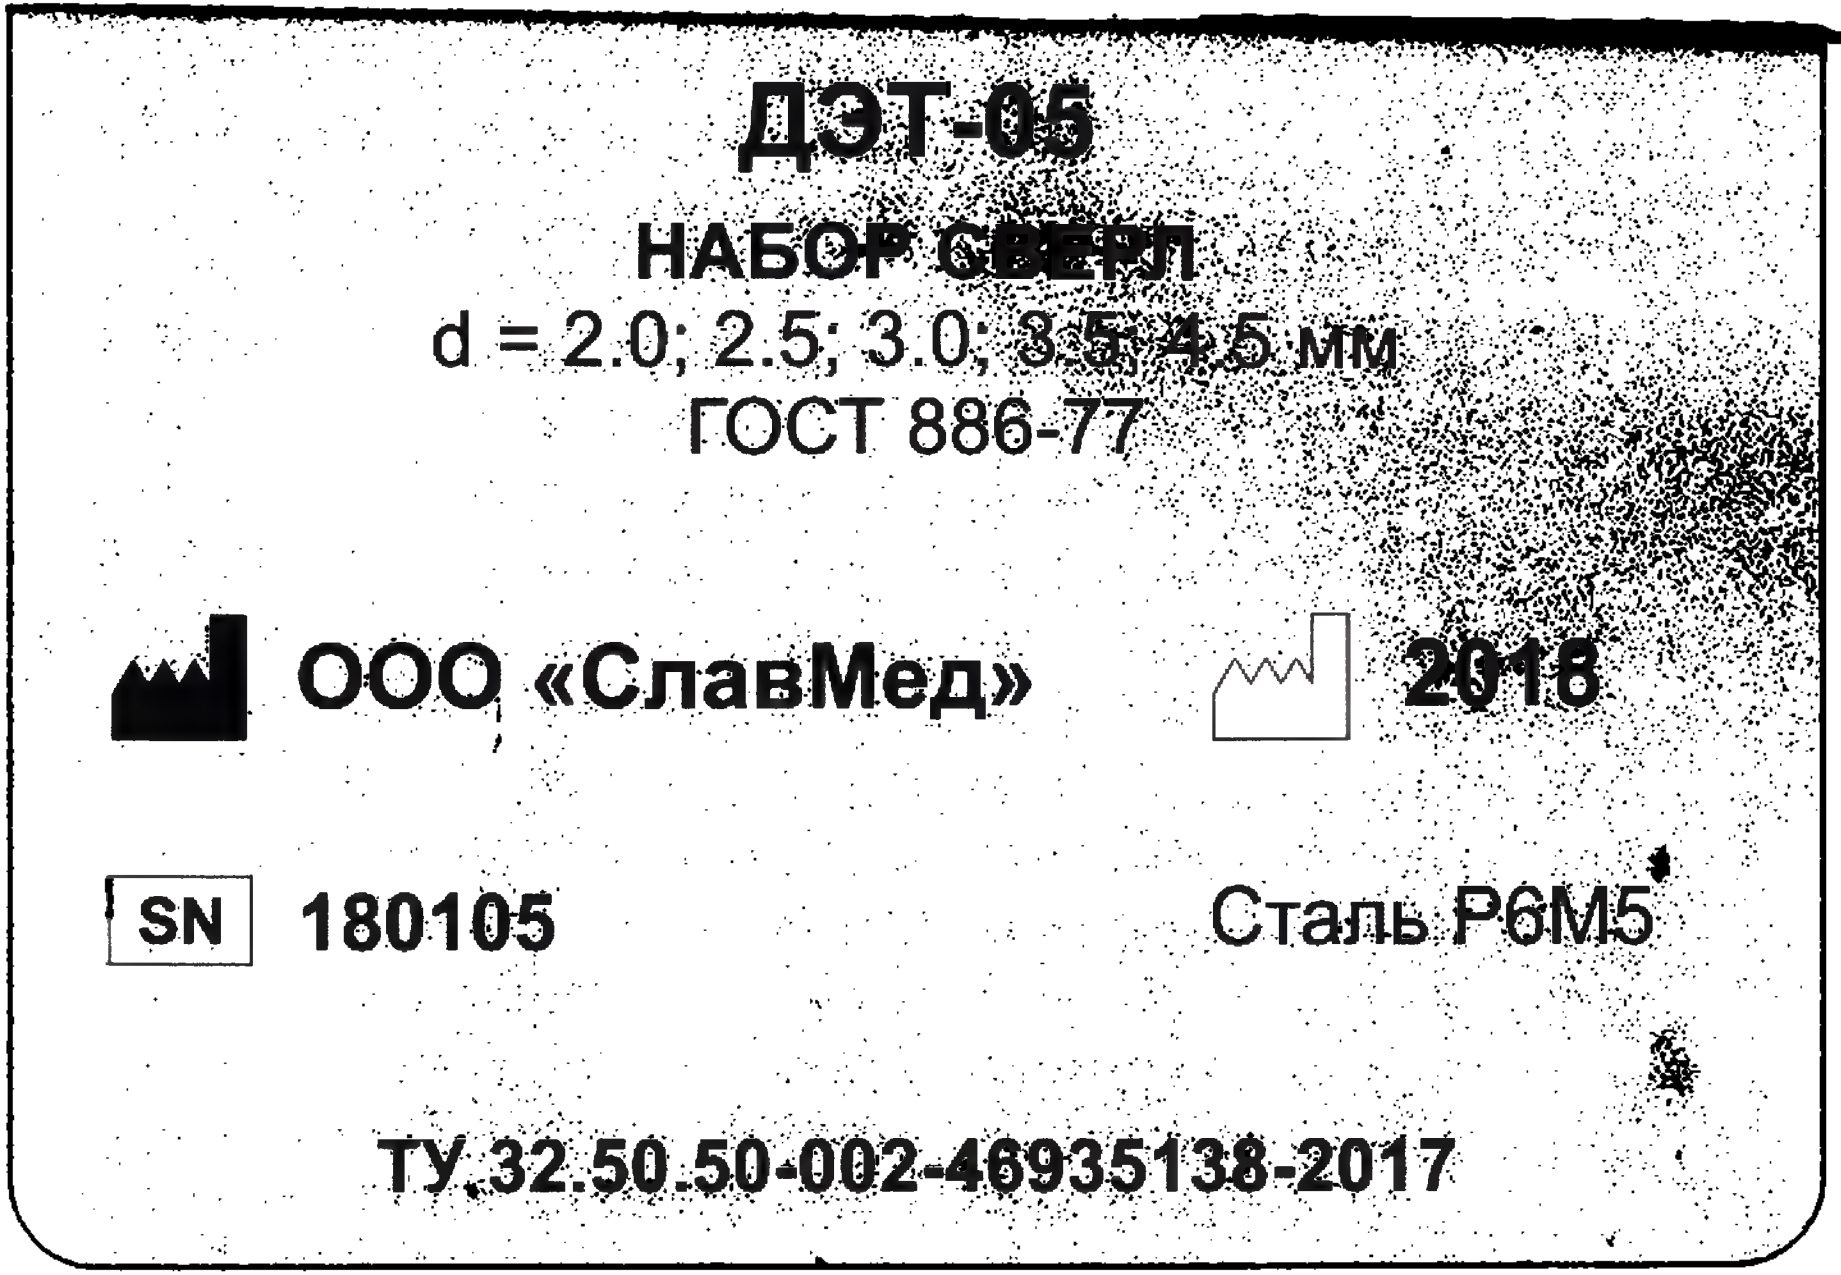

Набор сверл для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

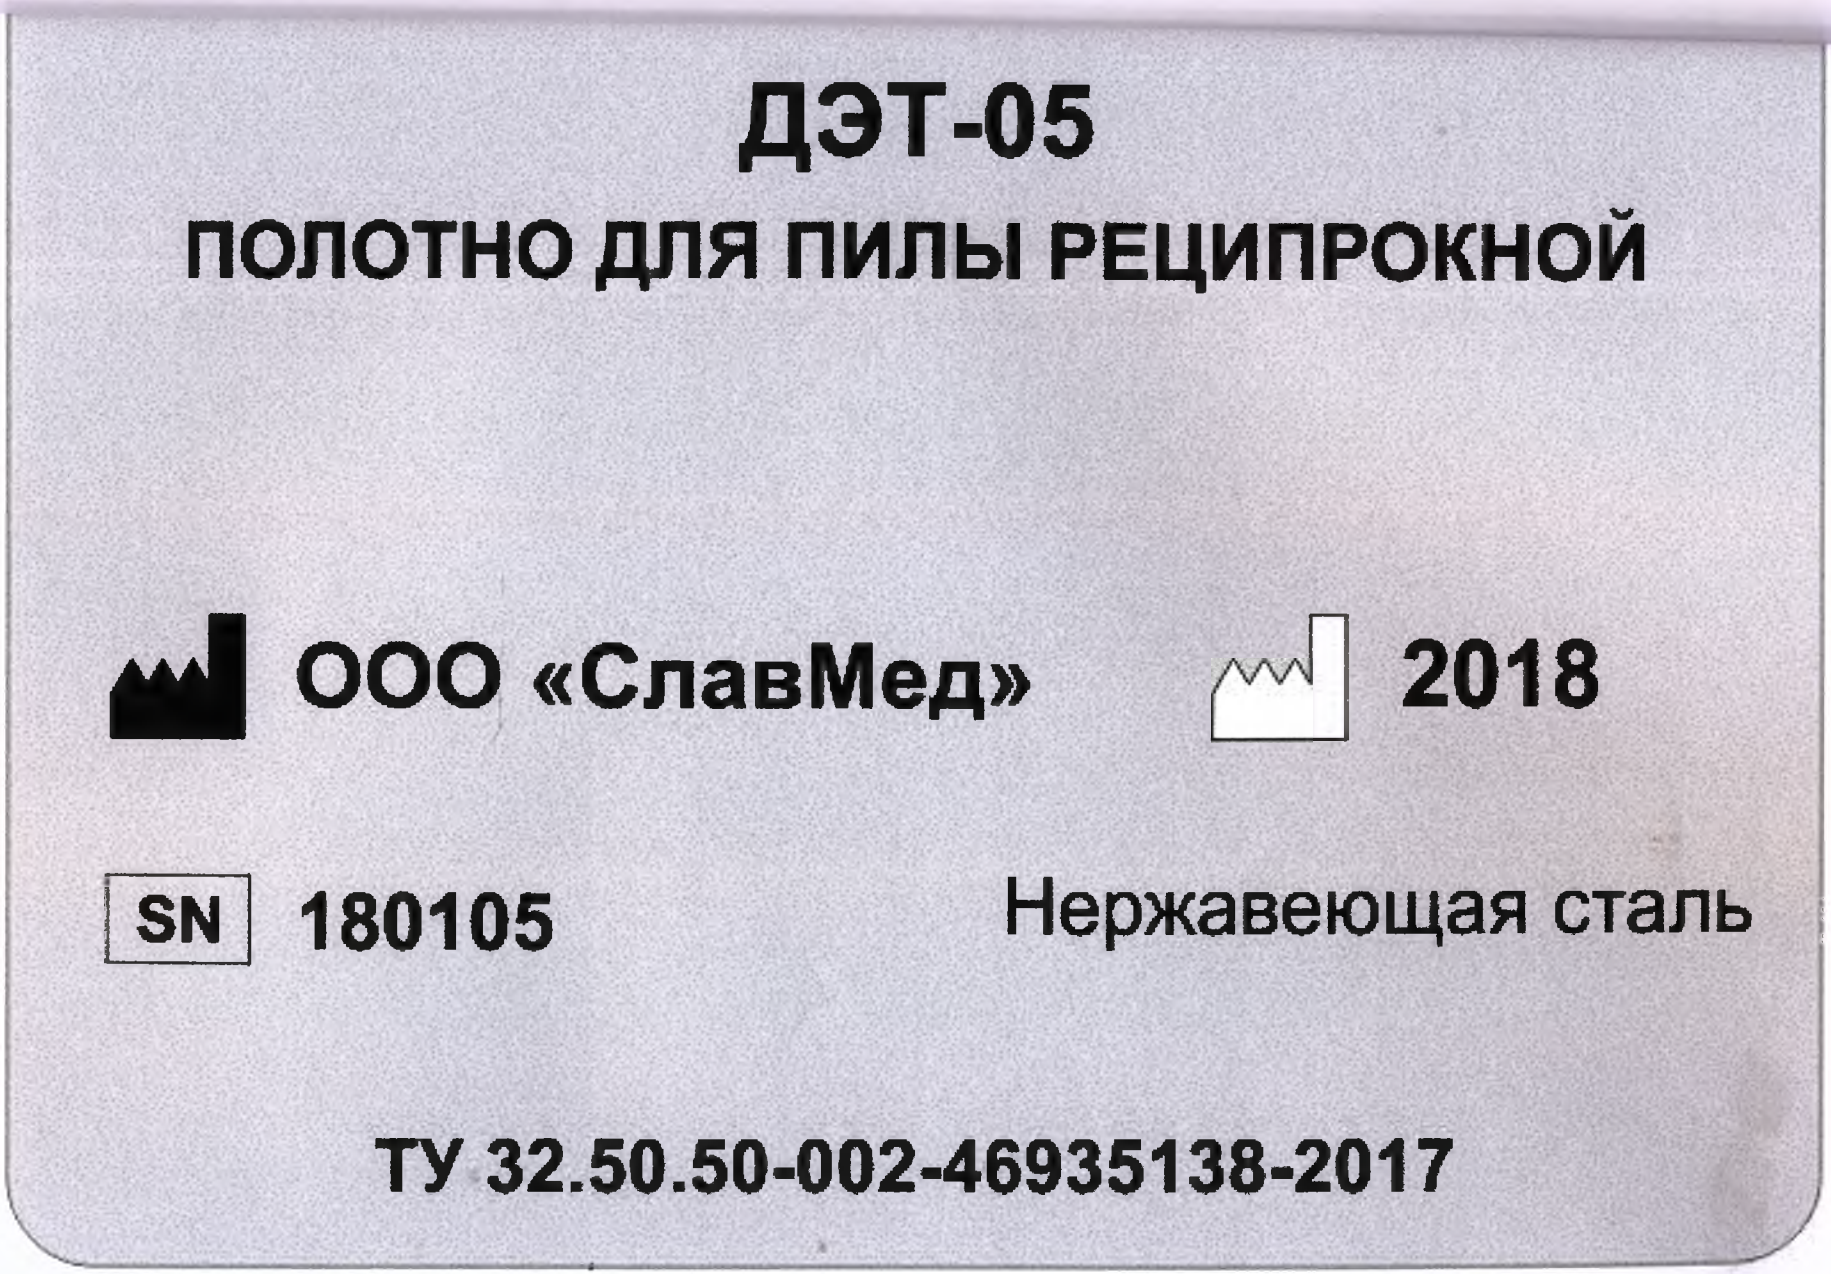

Полотно для электропилы реципрокной для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

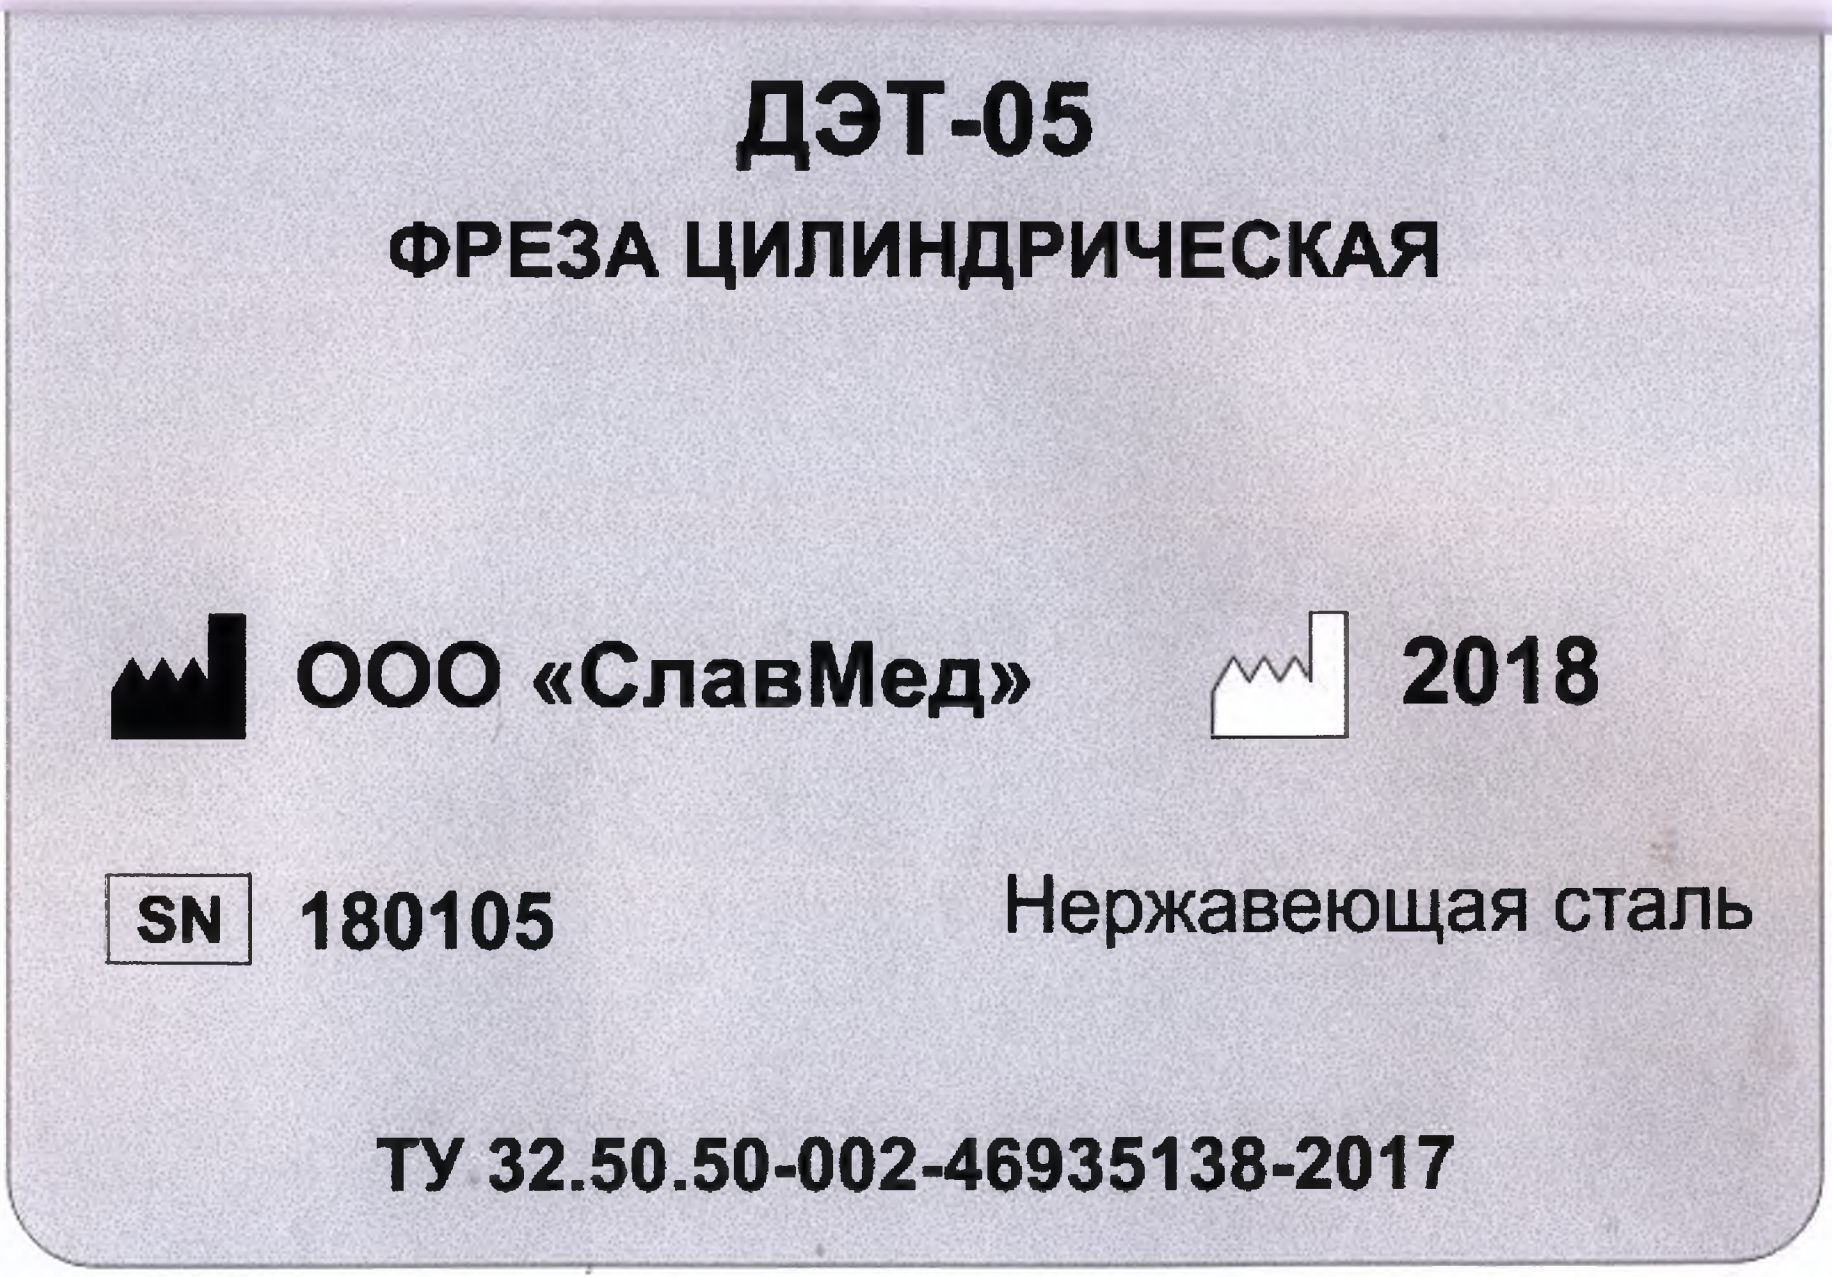

Фреза цилиндрическая для электродрели ДЭТ-05

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ДЭТ-01
КЕЙС УПАКОВОЧНЫЙ

ООО «СлавМед» 2018

SN 180101 IP 40

ТУ 32.50.50-002-46935138-2017

Кейс упаковочный для электродрели ДЭТ-01, ДЭТ-02, ДЭТ-03, ДЭТ-04, ДЭТ-05, ДЭТ-06, электропилы ПЭТ-01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

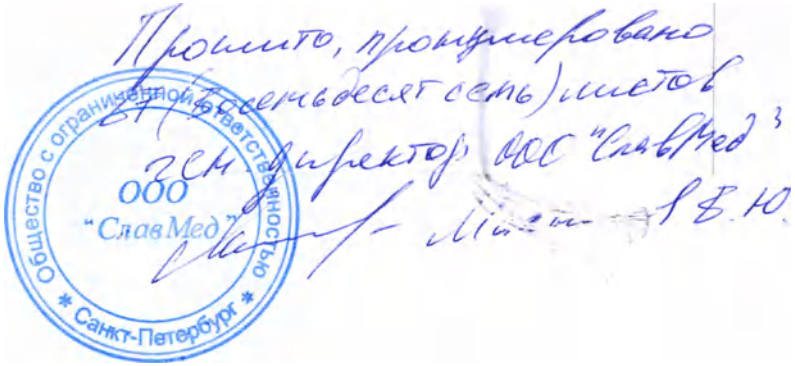

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU