

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»



М.В. Кротенко

"18" декабря 2013 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппараты стоматологические для получения и обработки цифровых трехмерных
моделей зубов в исполнении APOLLO DI, CEREC AC Connect, с принадлежностями,
производства SIRONA Dental Systems GmbH (СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

СОДЕРЖАНИЕ


1. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении APOLLO DI.....	3
2. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC AC Connect.....	4
3. Моноблок обработки данных APOLLO DI (вид спереди).....	5
3. Моноблок обработки данных APOLLO DI (вид сзади).....	6
4. Блок обработки данных CEREC AC Connect.....	7
5. Внутриротовая (интраоральная) камера APOLLO DI.....	8
6. Внутриротовая (интраоральная) камера CEREC Omnicam.....	9
7. Калибровочные насадки для внутриротовой (интраоральной) камеры.....	10
8. Чехлы защитные для внутриротовой (интраоральной) камеры APOLLO DI.....	11
9. Монитор специальный.....	12
10. Шар для трэкбола (вид 1).....	13
10. Шар для трэкбола (вид 2).....	14
11. Аккумулятор специальный.....	15
12. Крепежный винт для аккумулятора специального.....	16
13. Основание (платформа) для моноблока обработки данных APOLLO DI (вид спереди).....	17
14. Стойка для крепления моноблока обработки данных APOLLO DI (вид сбоку).....	18
14. Стойка для крепления моноблока обработки данных APOLLO DI.....	19
15. Средство APOLLO DI SpeedSpray для проведения оптических измерений в формате 3D.....	20
16. Модель челюсти фантомная.....	21
17. Шкалы расцветок CEREC Blocs Shade Guide.....	22
18. Винты крепежные, специальные.....	23
19. Заглушки для винтов.....	24
20. Кабели питания.....	25
21. Кабели соединительные.....	26
22. Носители электронные с ПО и технической документацией.....	27
23. Накопители USB.....	28
24. Конверты с защитным кодом License Voucher.....	29
25. Техническая документация.....	30
26. Брошюра для пациента.....	31
27. Приложение № 1.....	32


аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в
полнении APOLLO DI

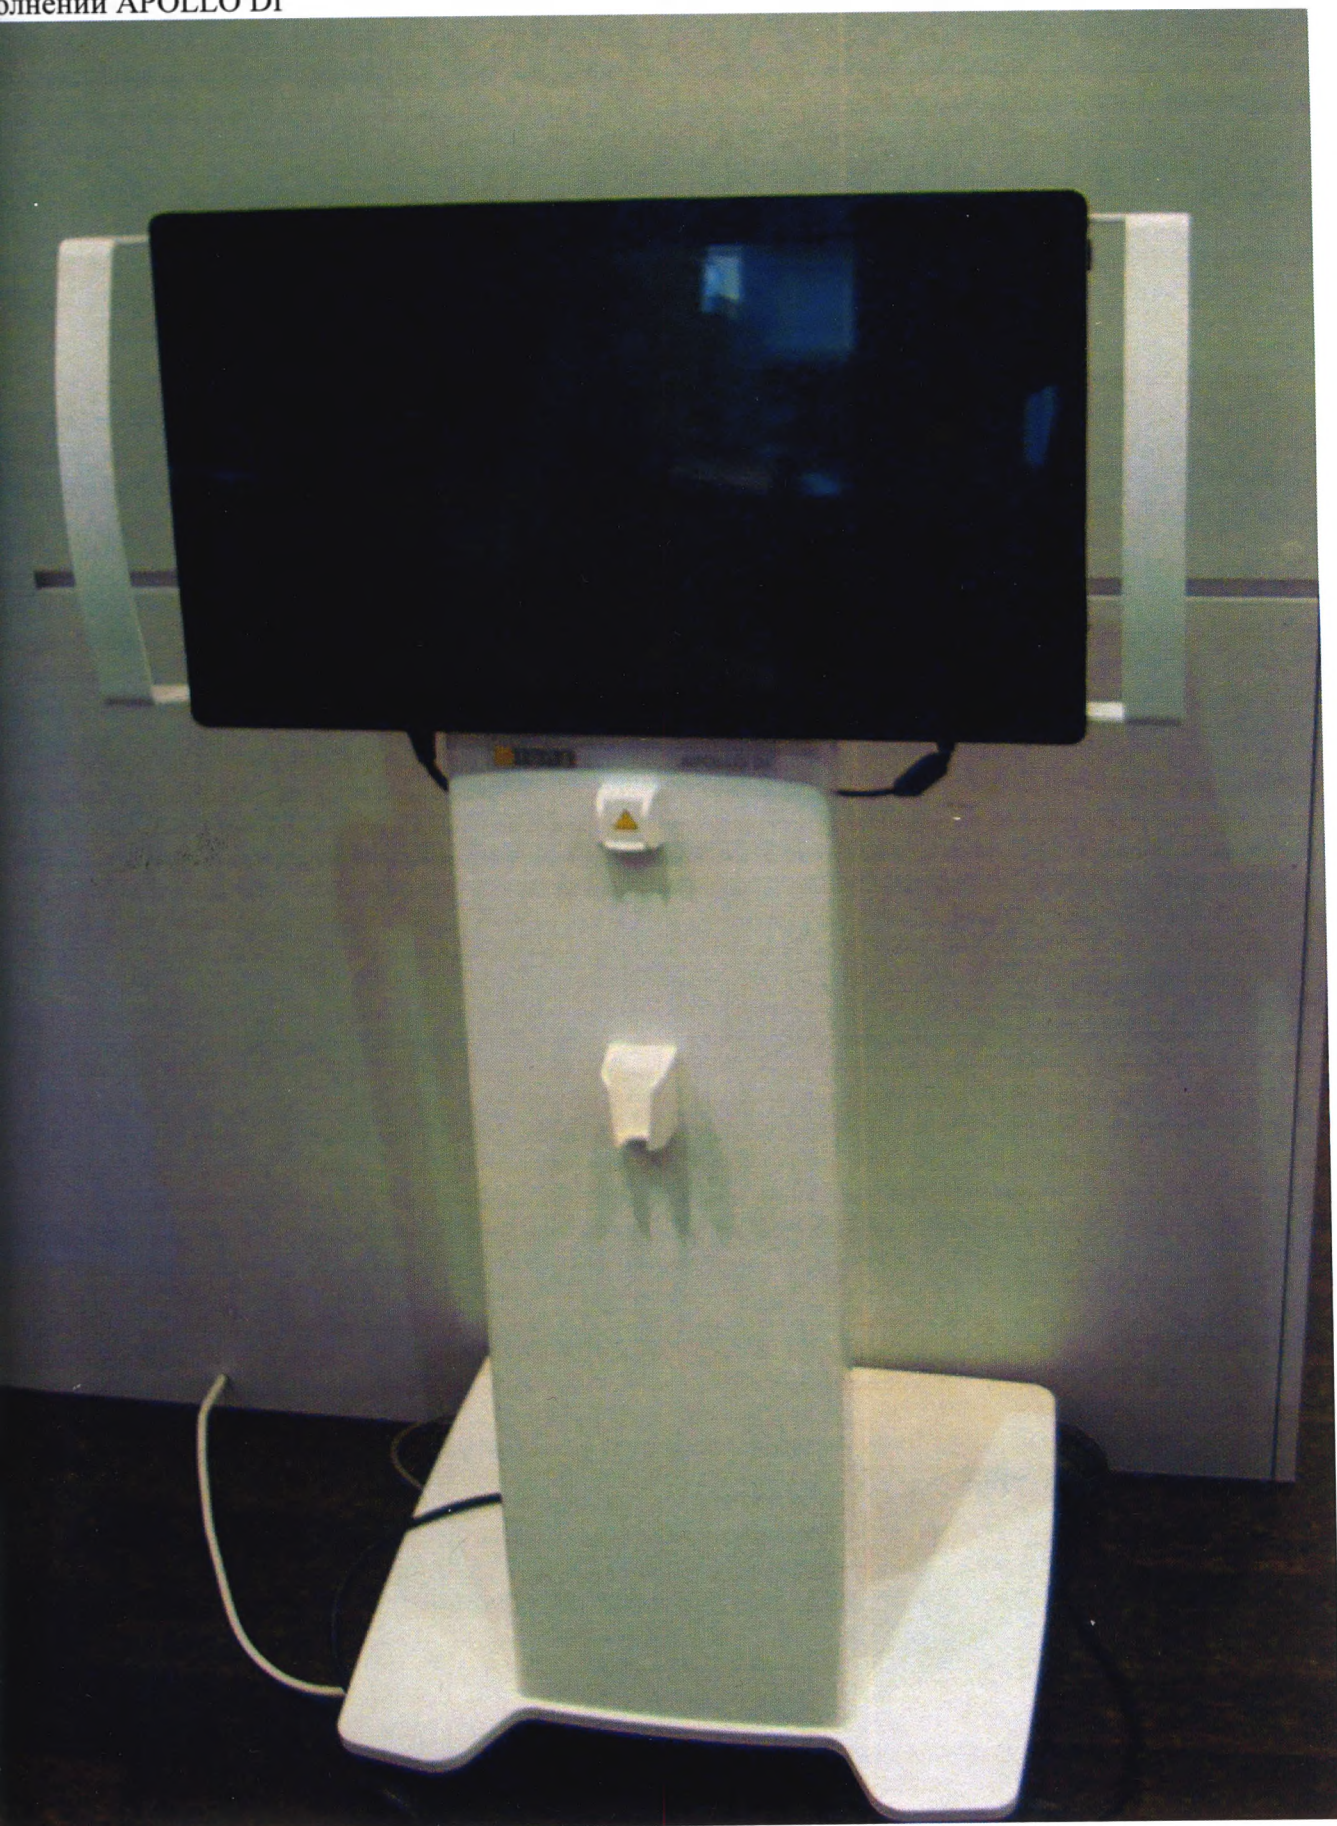


апарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в
лнении CEREC AC Connect



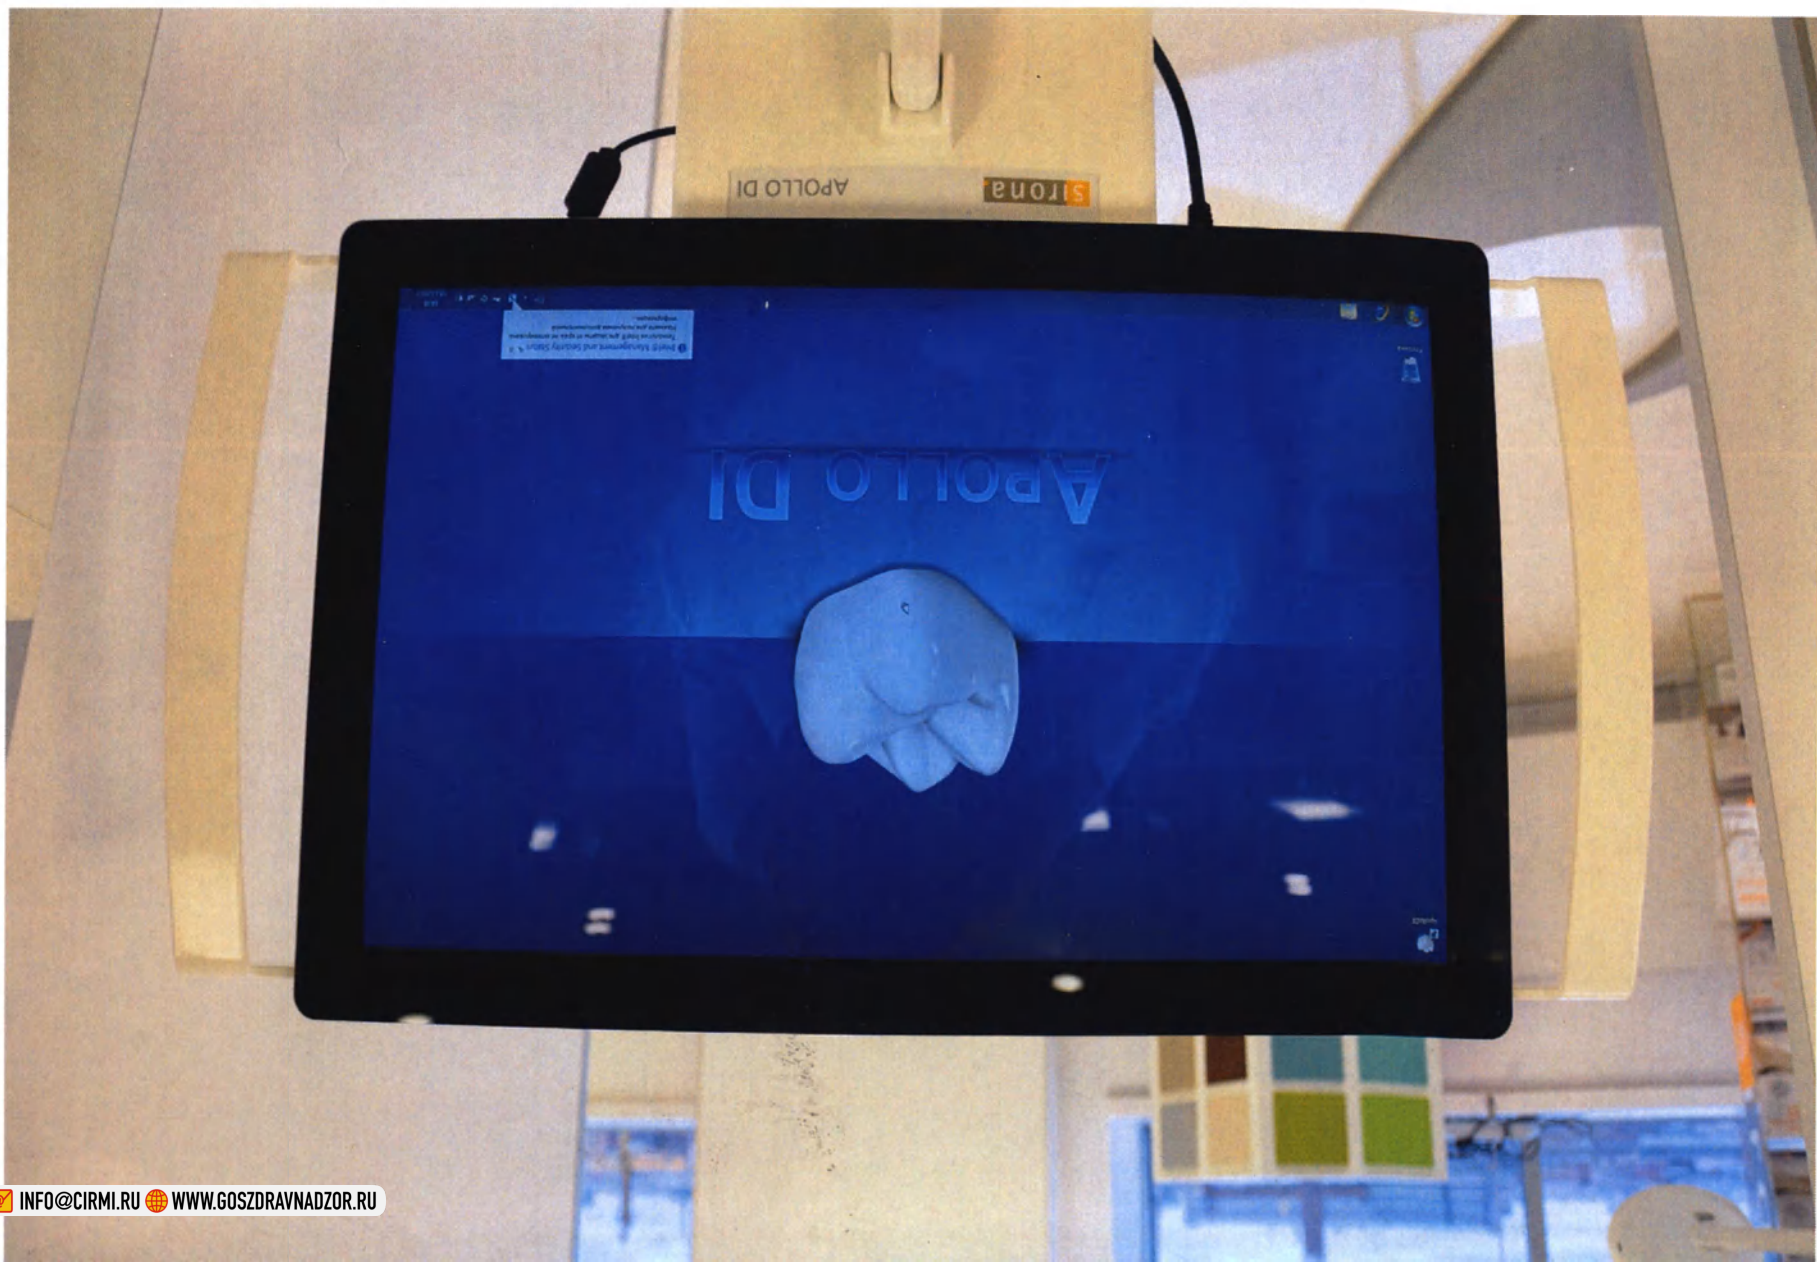



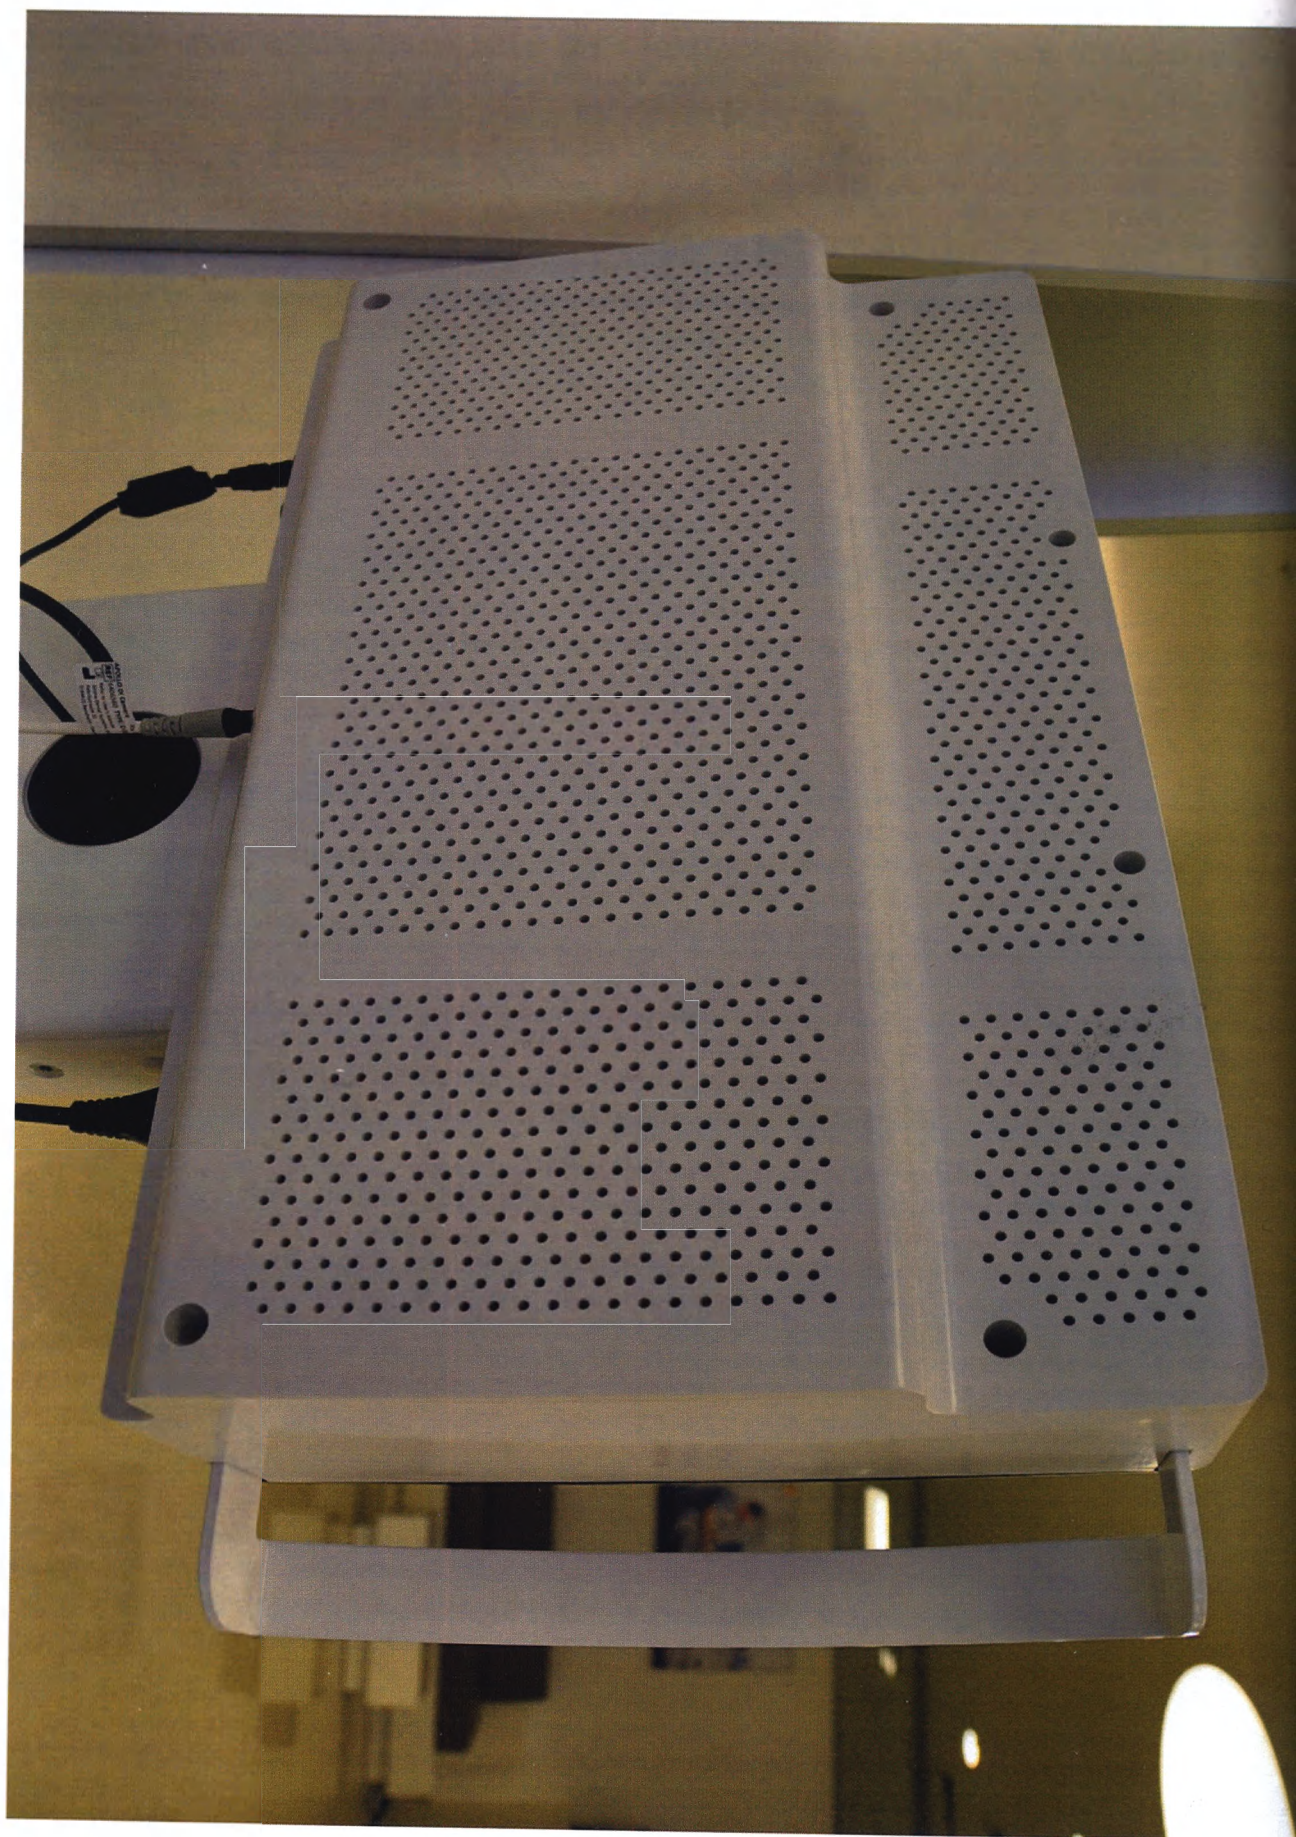




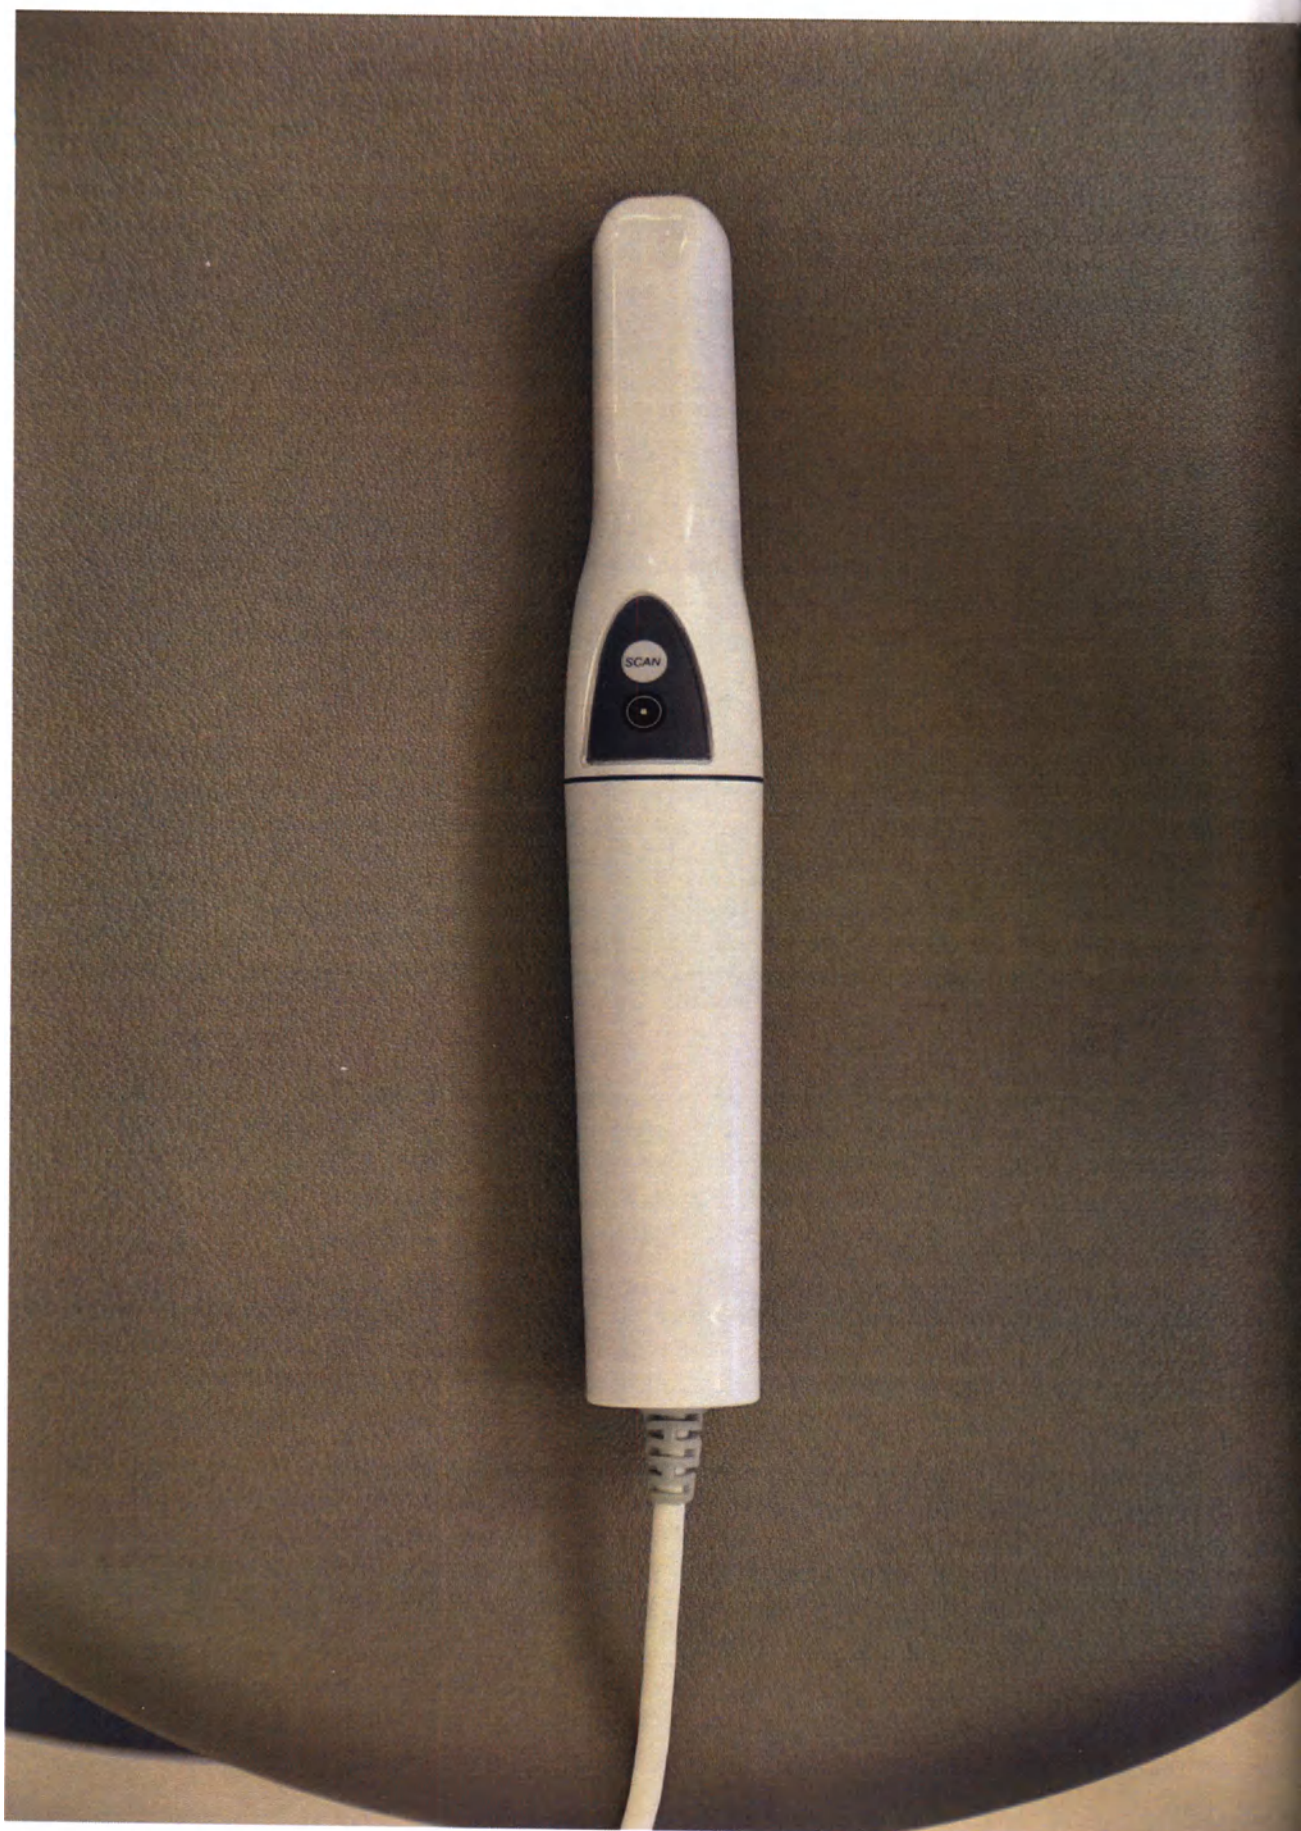




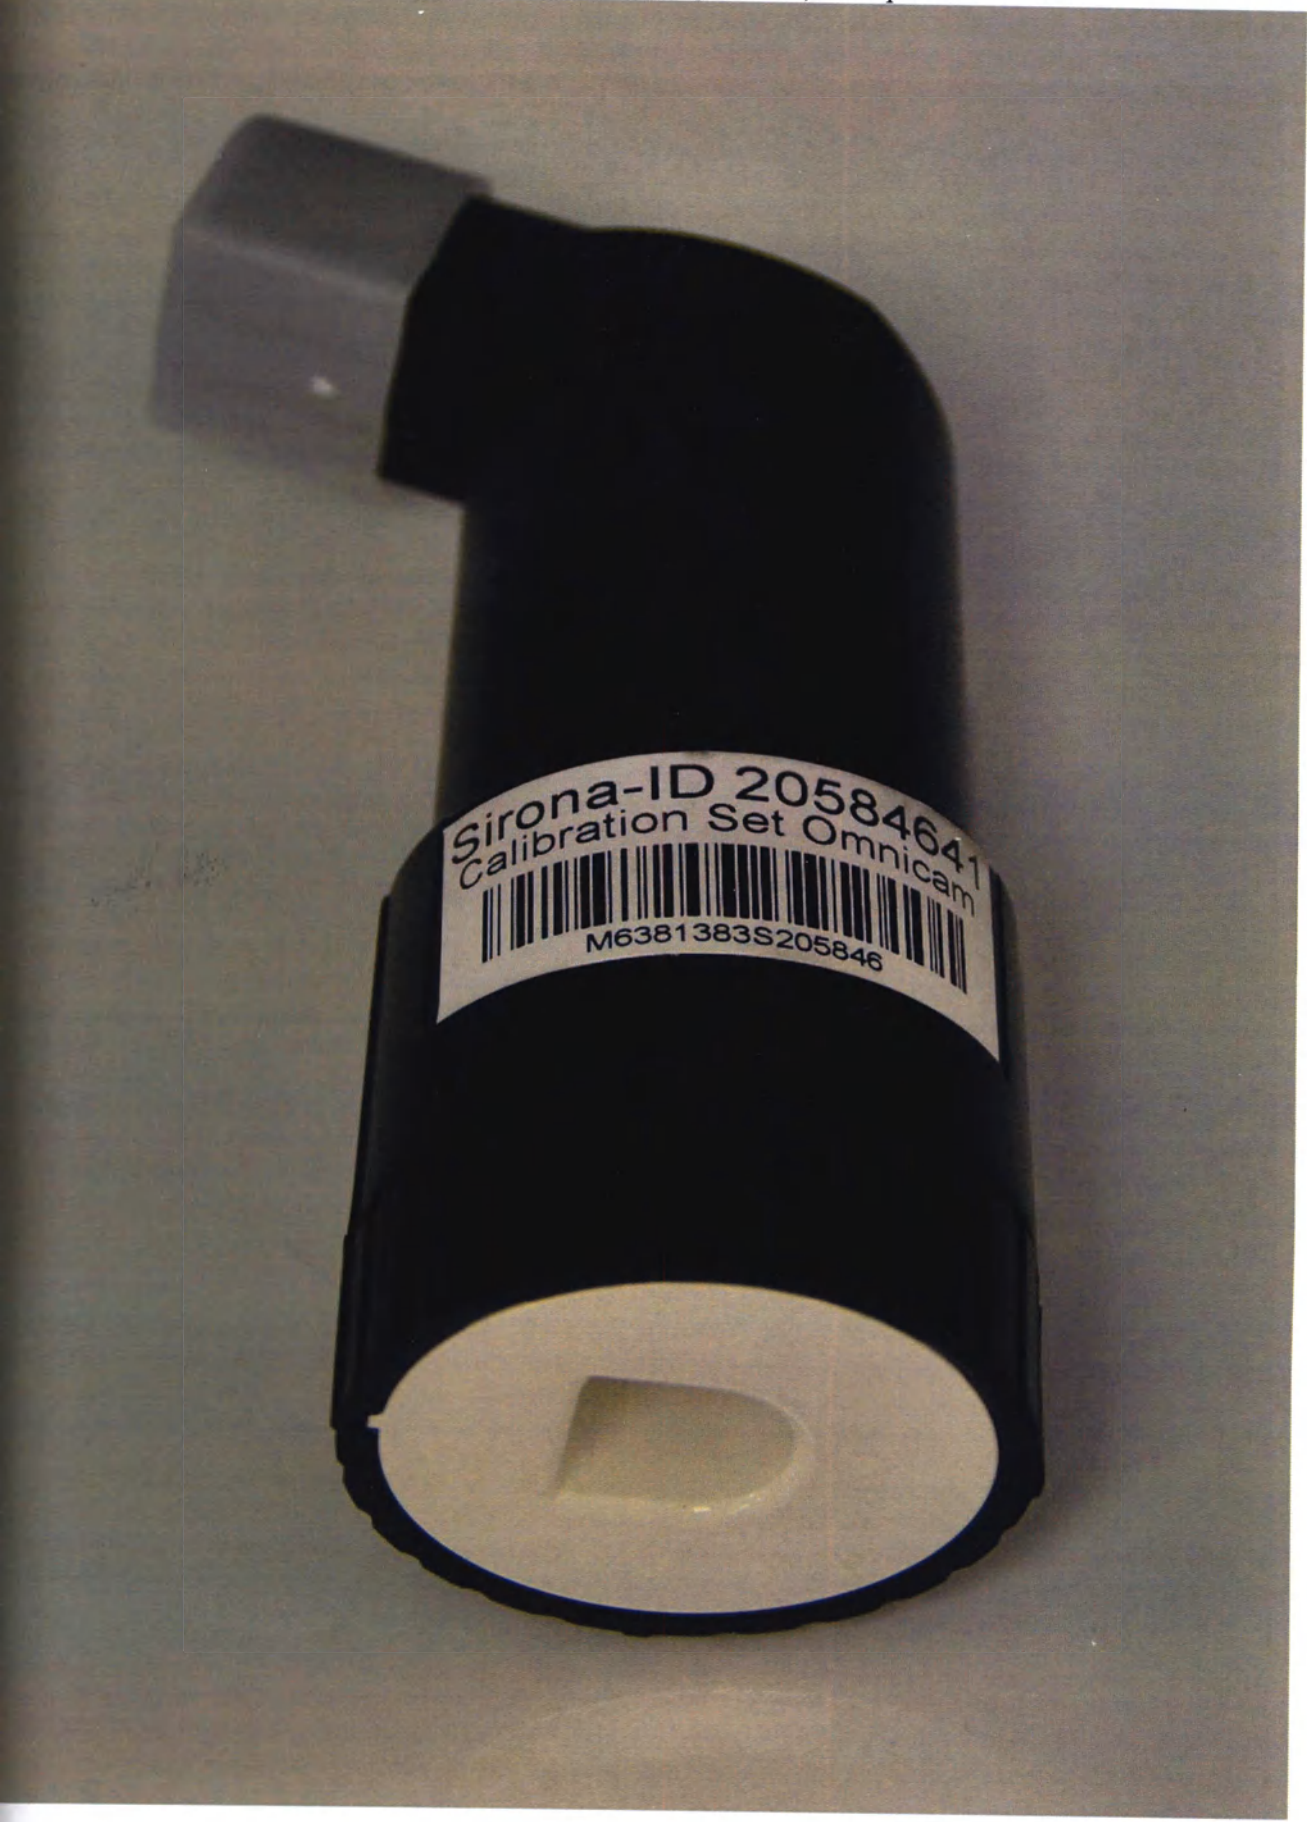

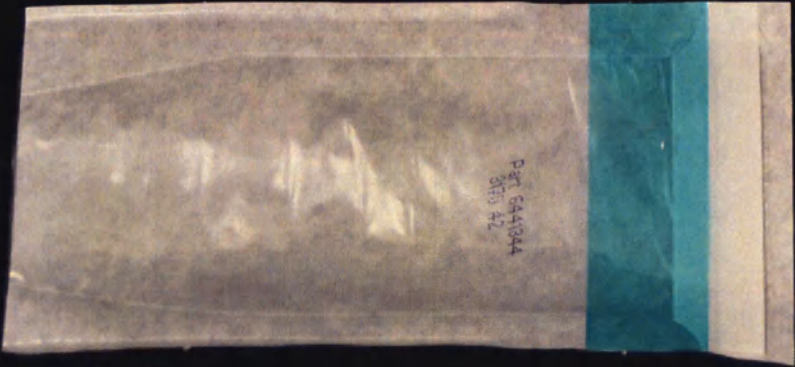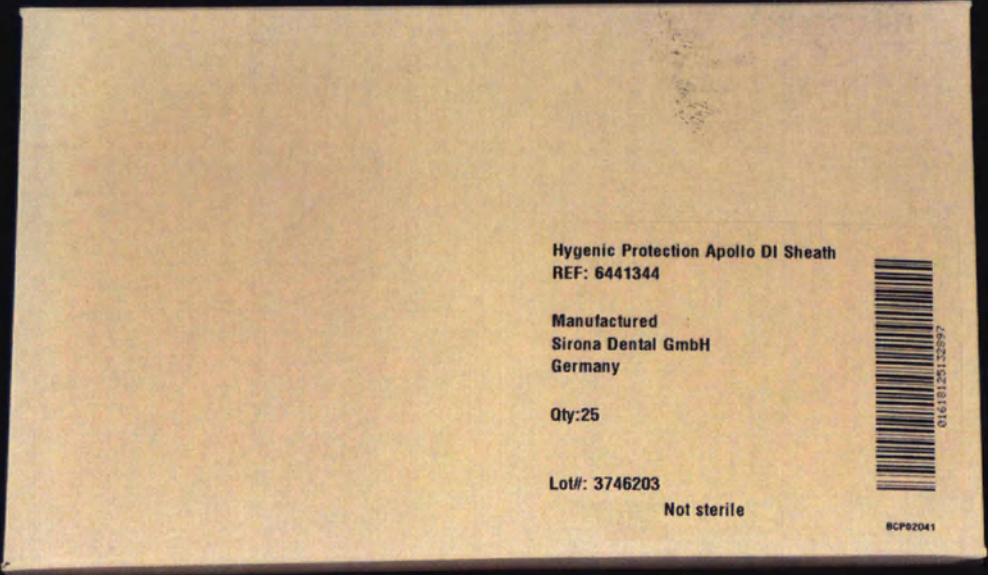







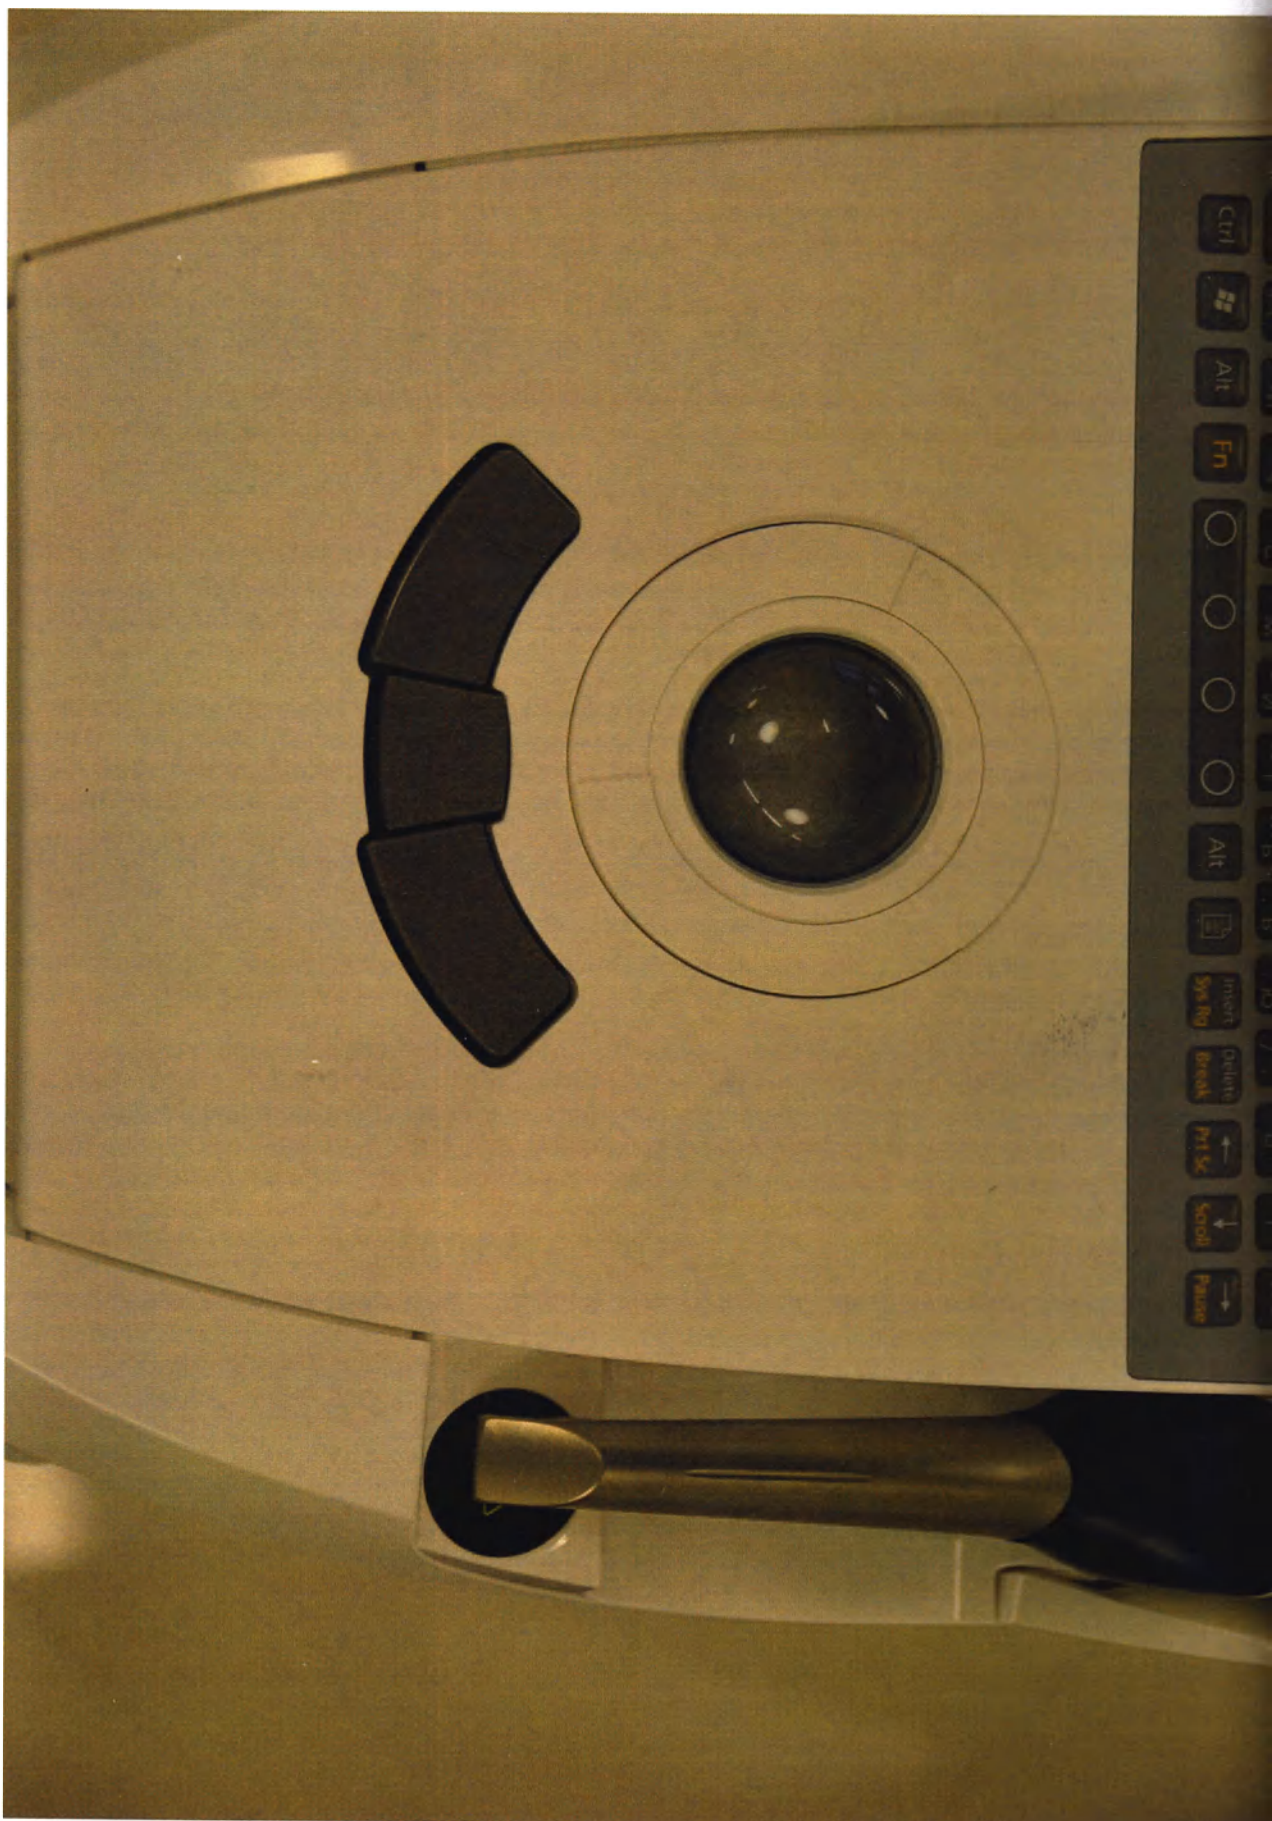



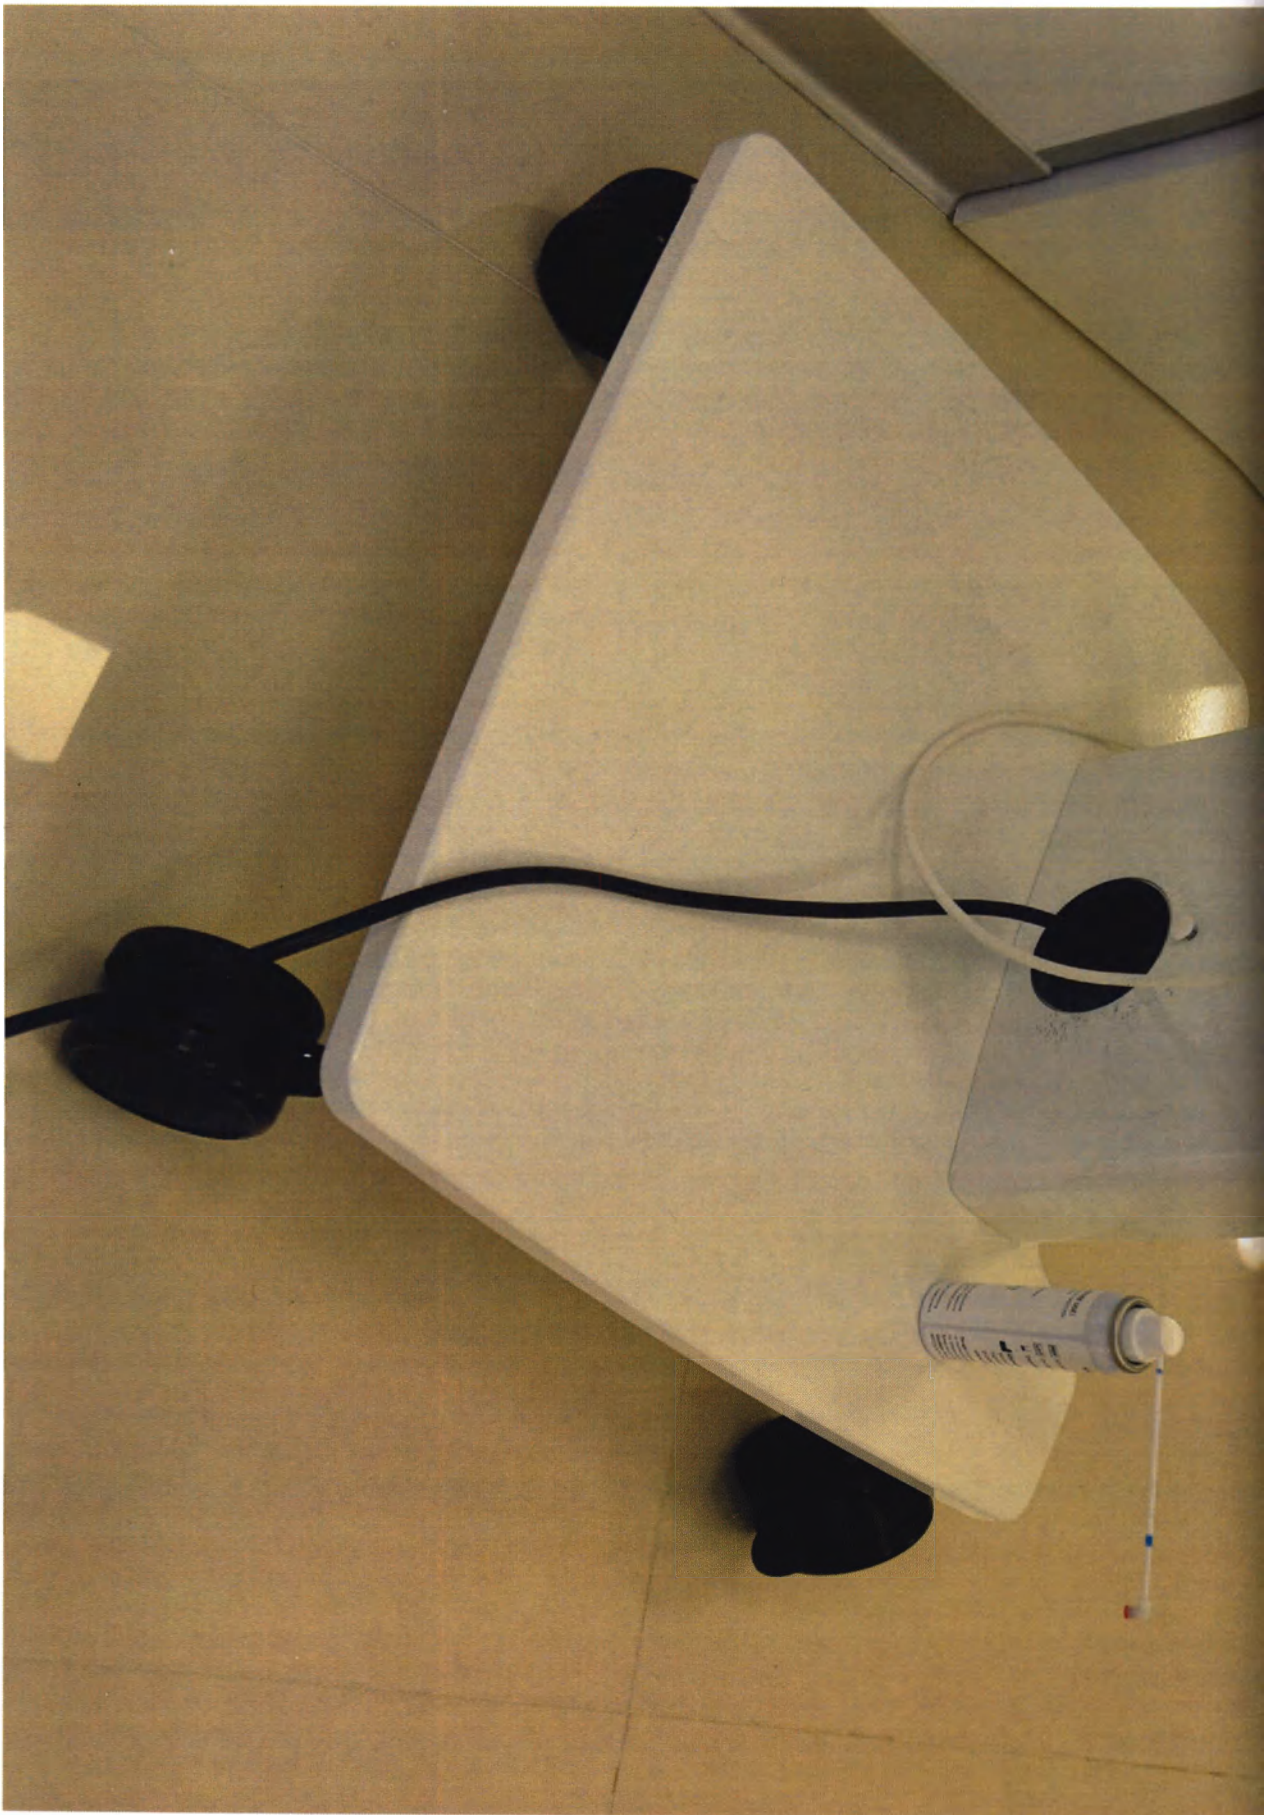


Стойка для крепления моноблока обработки данных APOLLO DI (вид спереди)

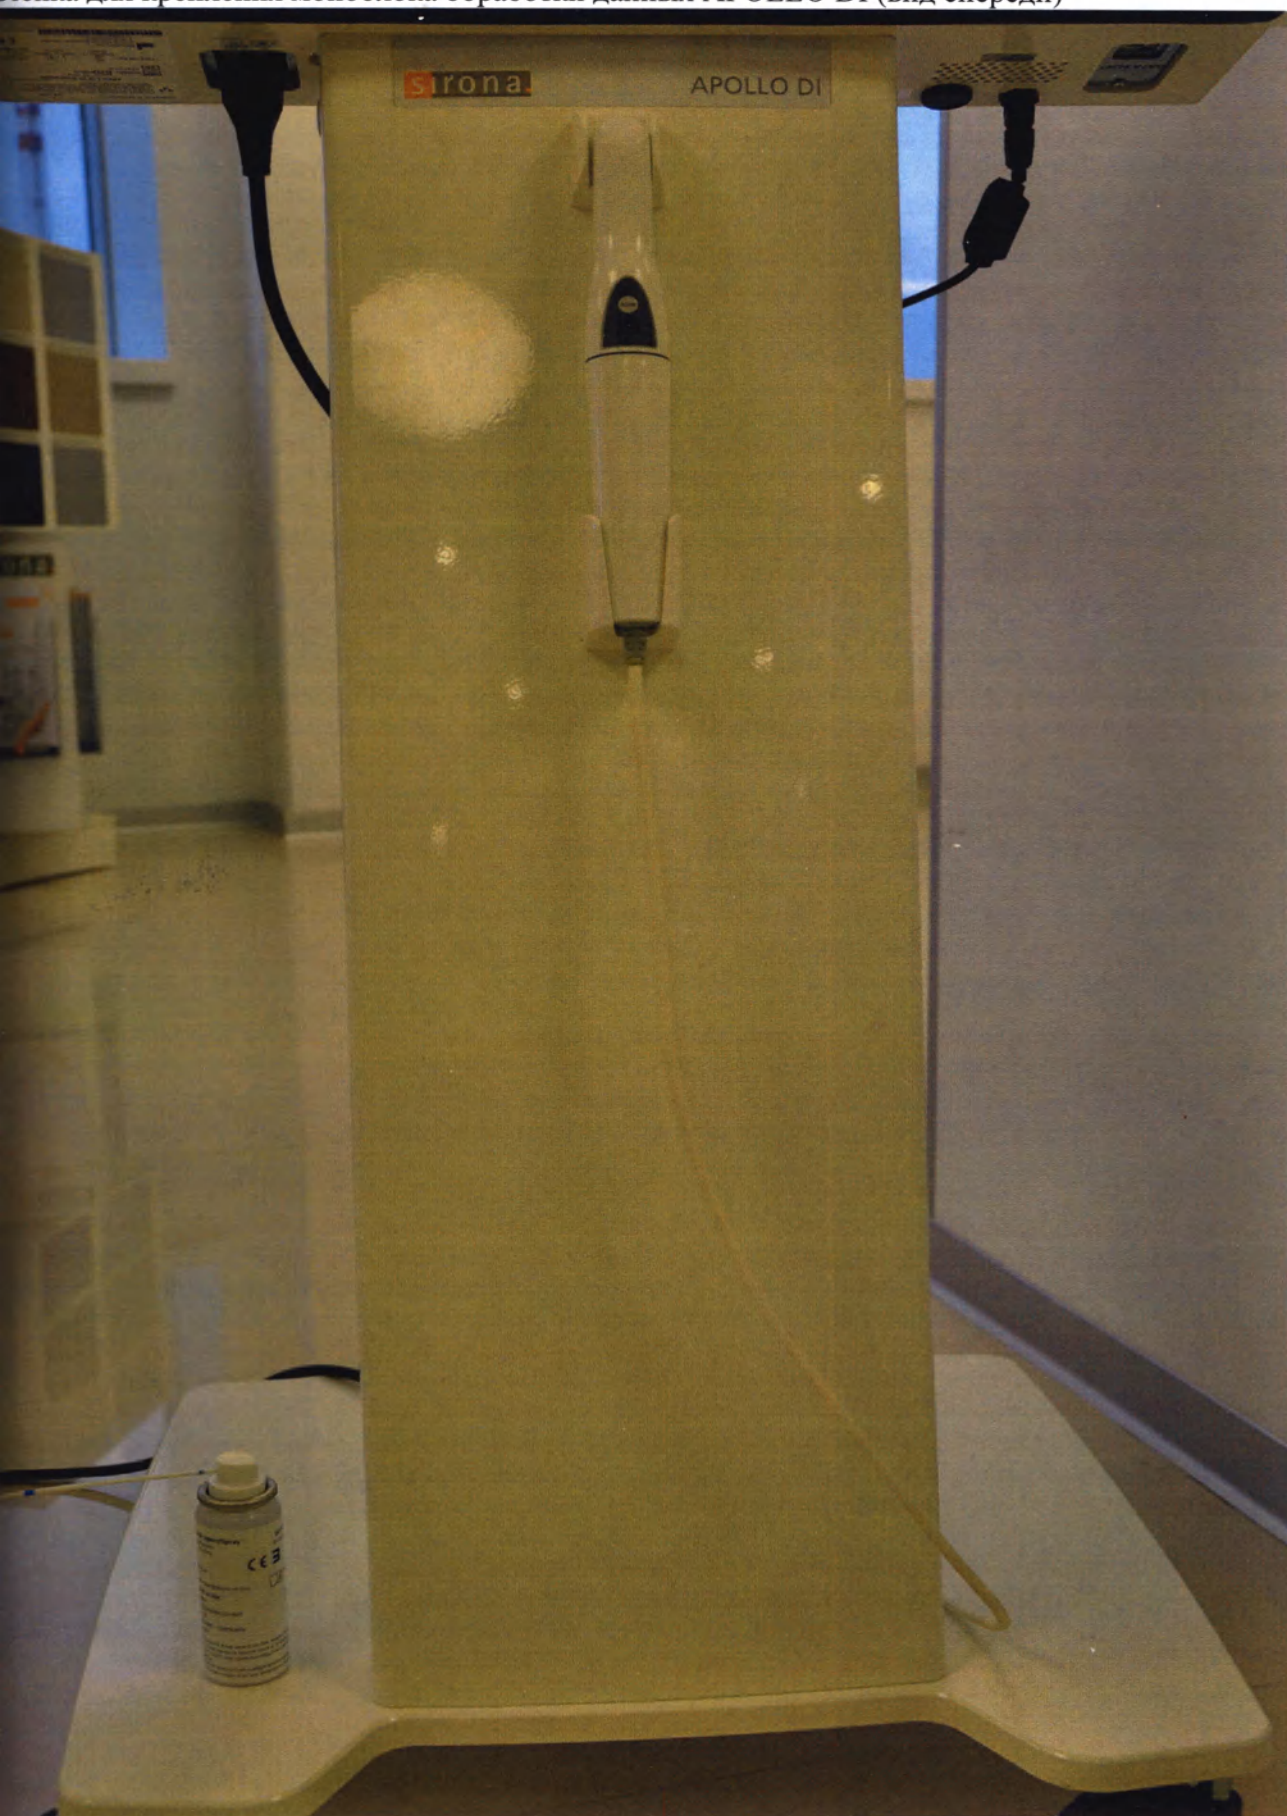


стойка для крепления моноблока обработки данных APOLLO DI (вид сбоку)



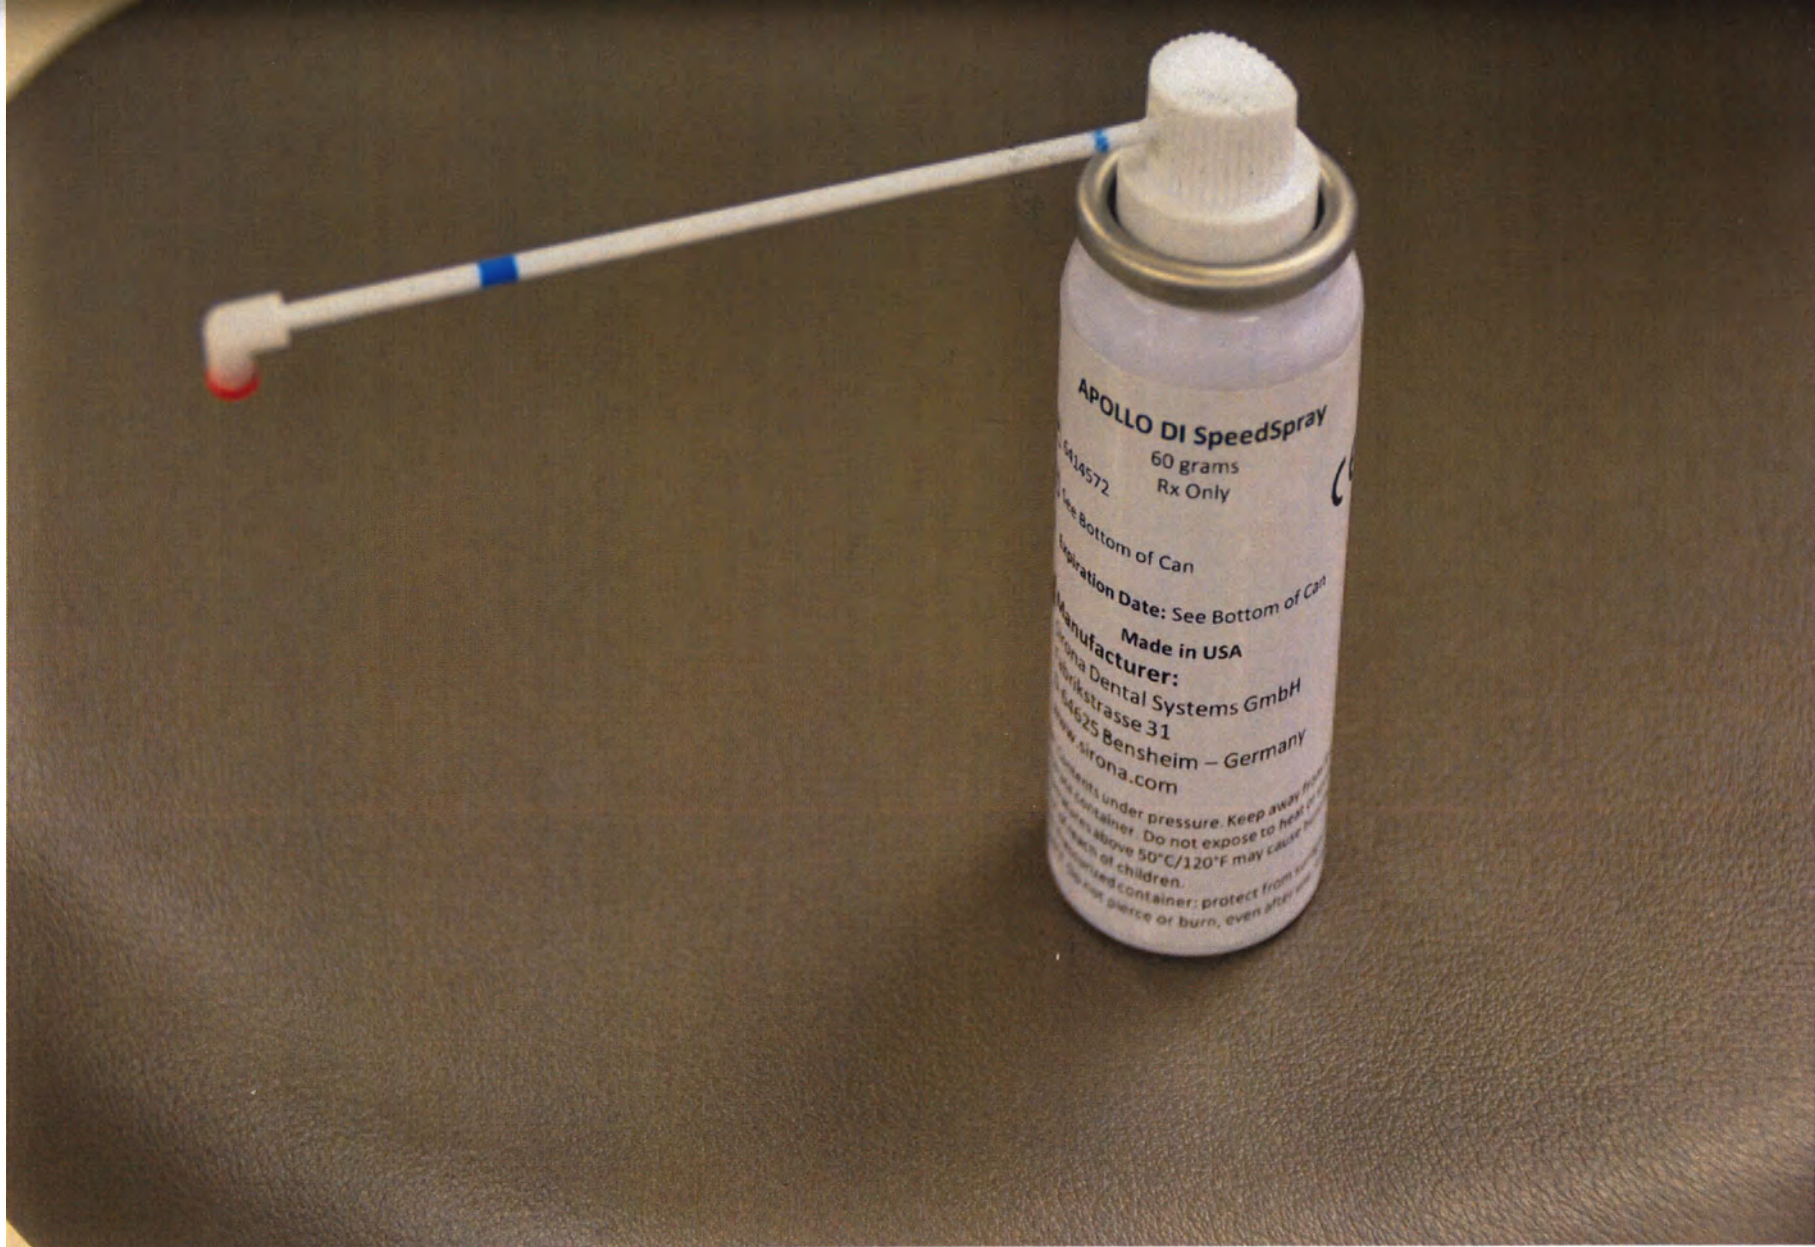






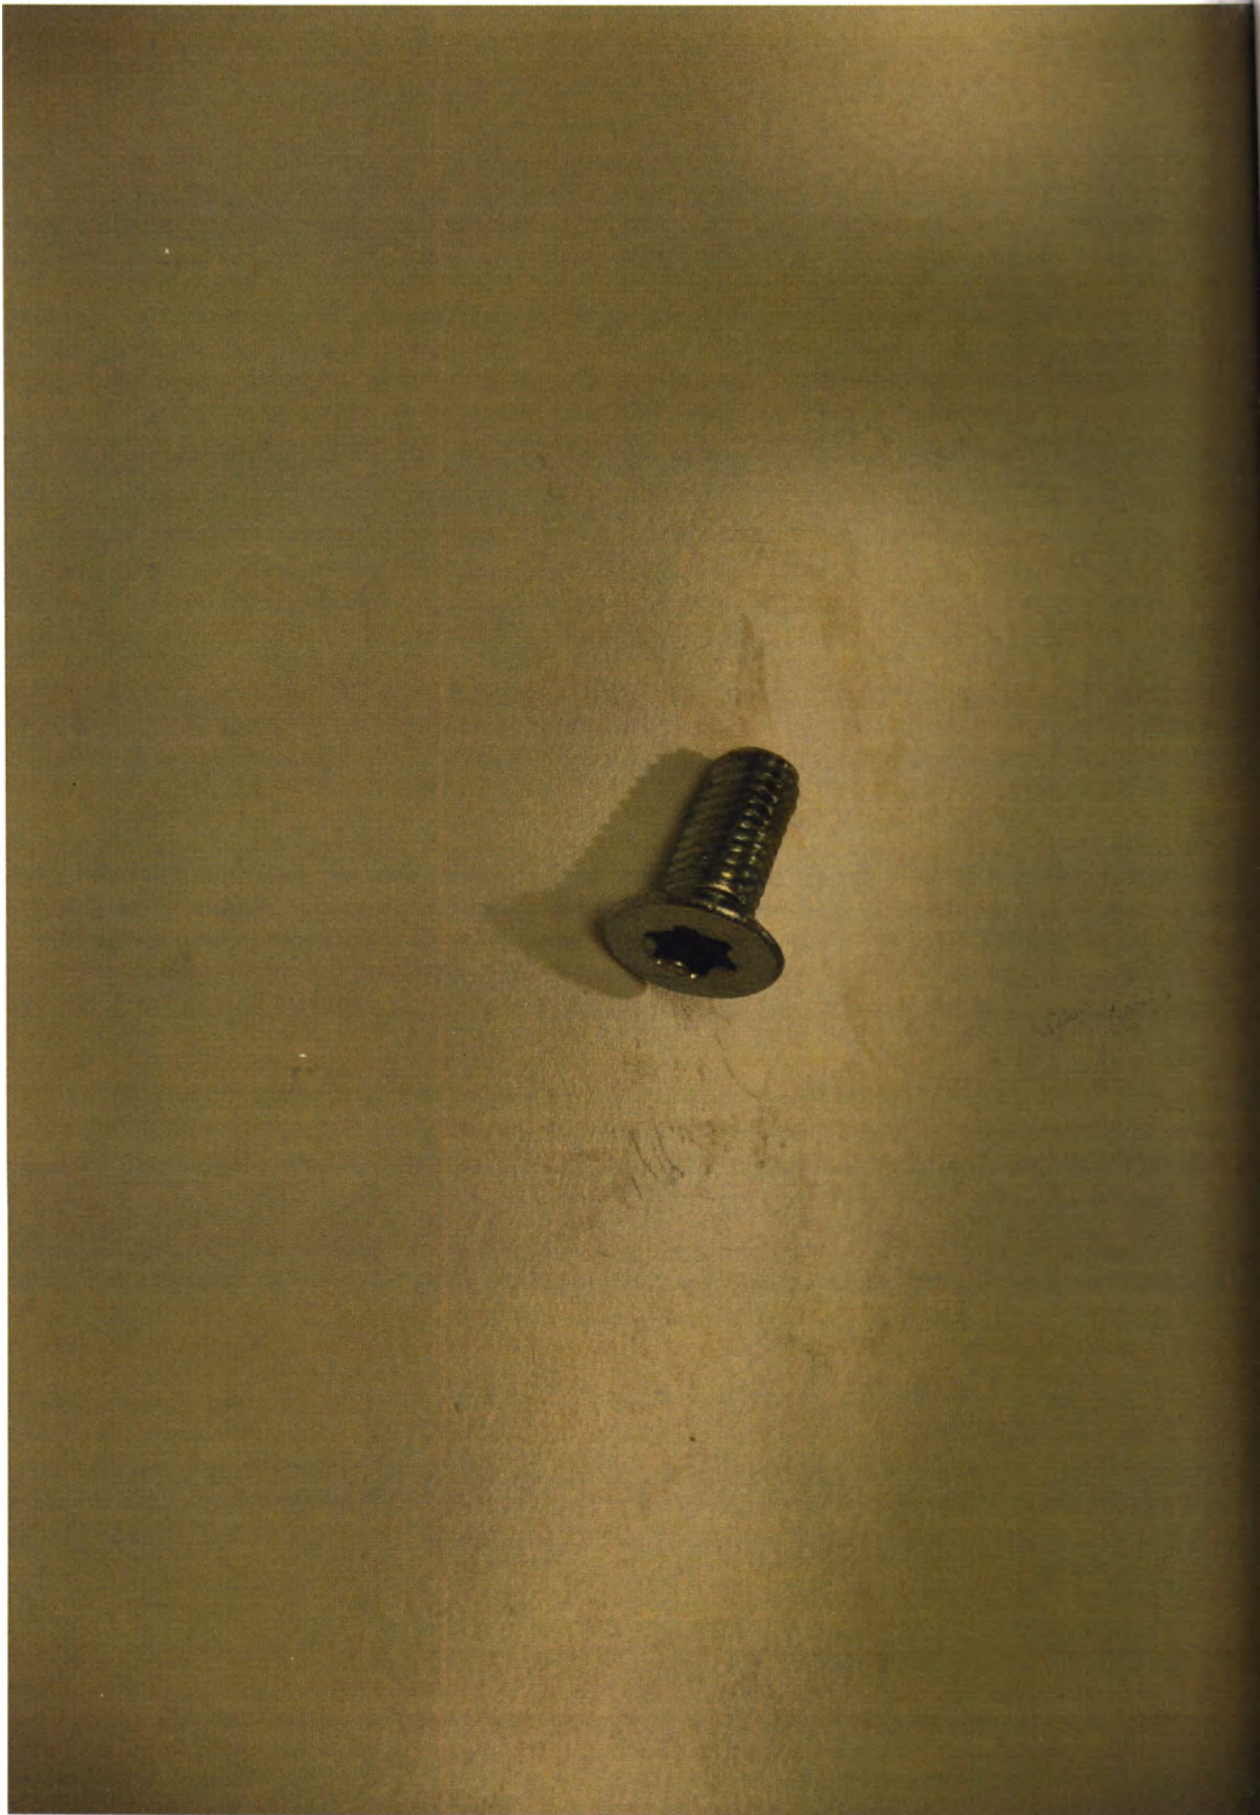






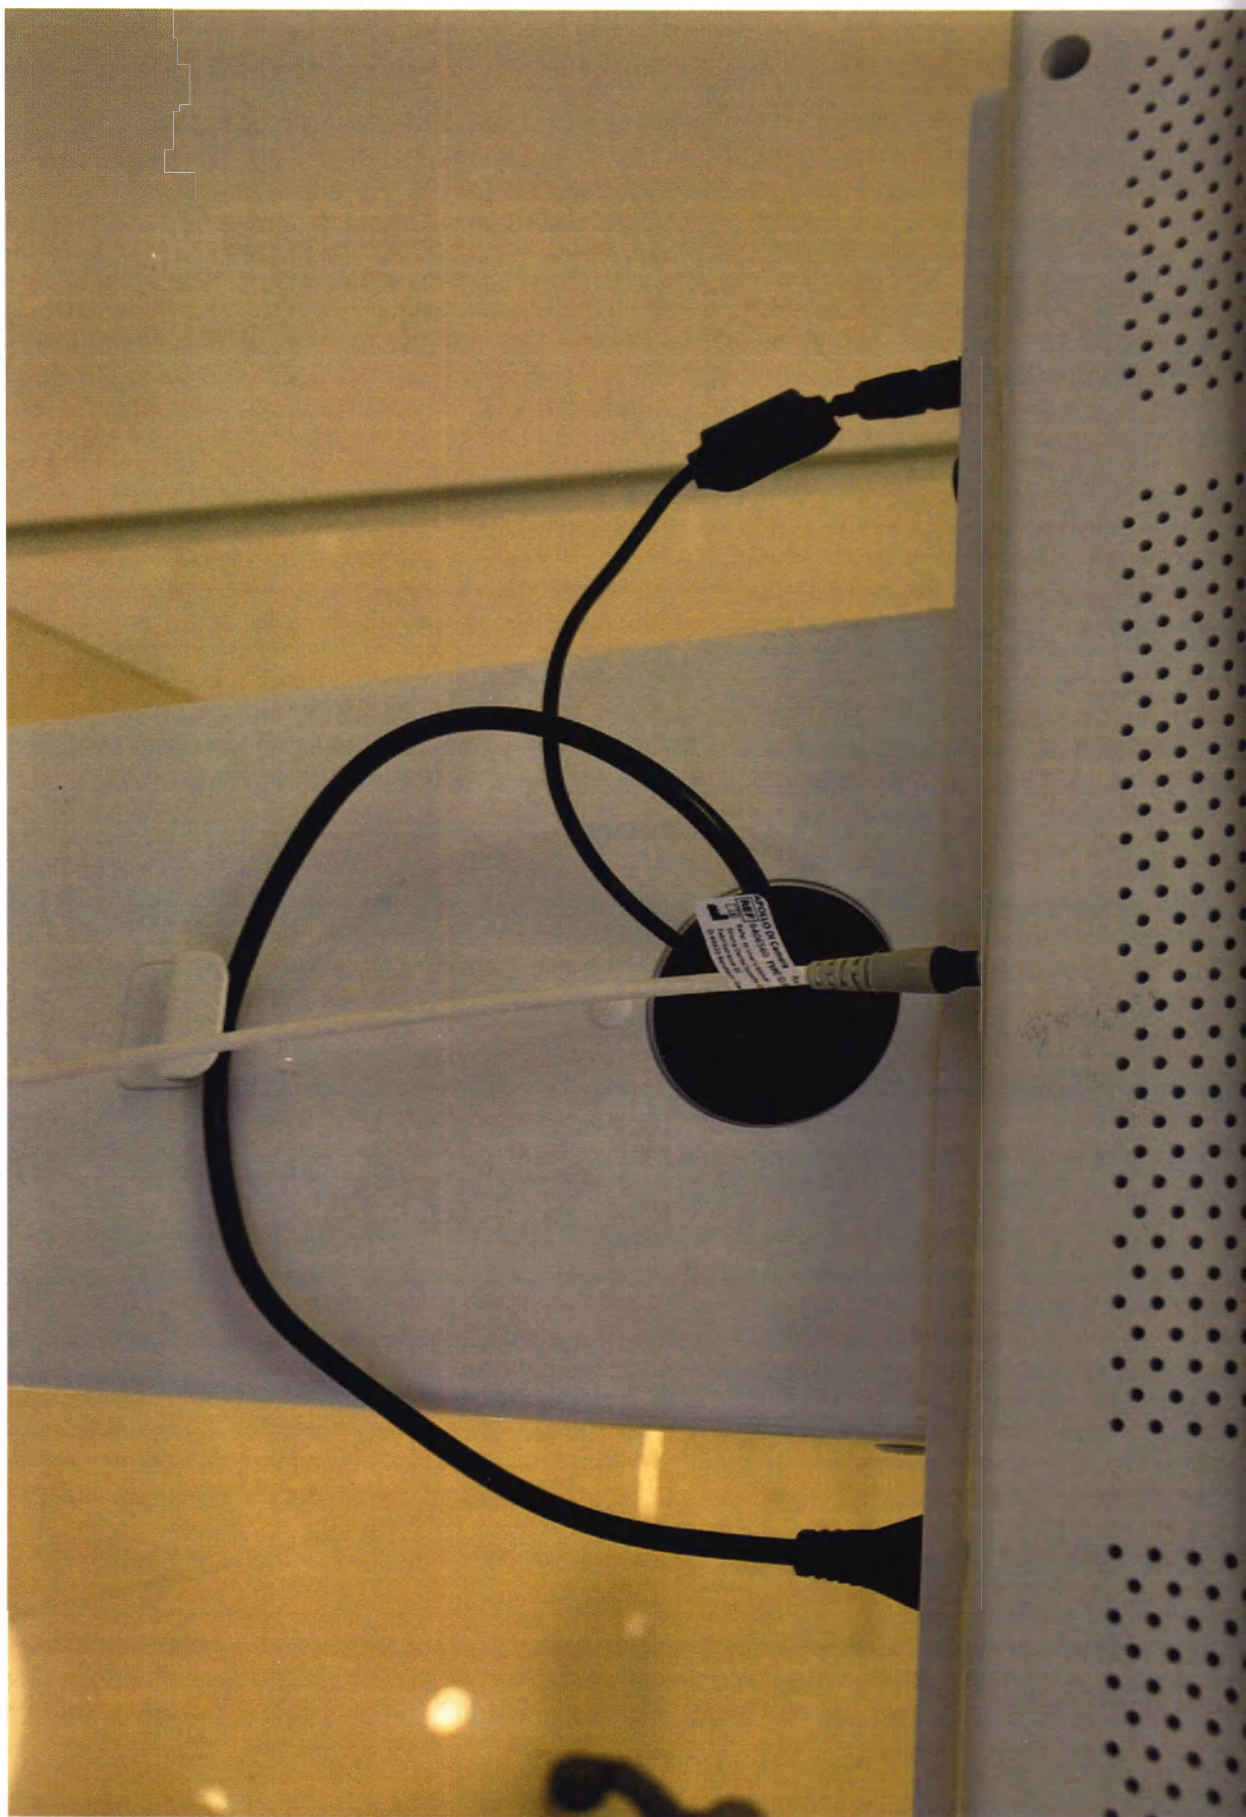



CAD/CAM SYSTEMS | INSTRUMENTS | HYGIENE SYSTEMS | TREATMENT CENTERS | IMAGING SYSTEMS

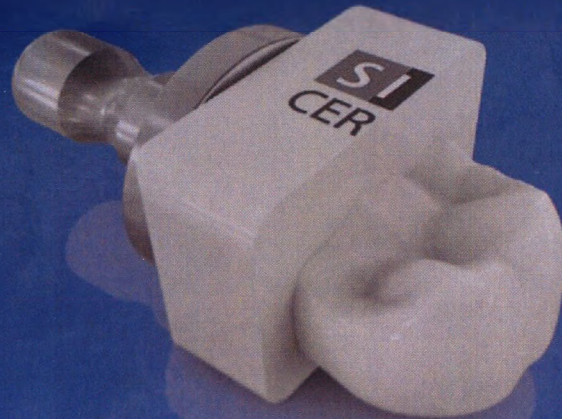

REF. No. 63 75 815



Product M6375815S0000002731

inLab SW 4.0 License, unvp.

License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza

sirona.
The Dental Company


Neu ab:
New since:
Nouveau depuis:
Nuevo desde:
Nuovo a partire da:

01.2010

sirona
The Dental Company

CEREC AC, inLab-System-PC, inEos Blue PC

Wiederherstellung des Software-Auslieferungszustandes mittels Restore-Boot-CD
 Restoring the default software state using the Restore-Boot CD
 Restauration de la configuration logicielle à la livraison au moyen du CD de démarrage et de restauration
 Restauración del estado de entrega del software con el CD de arranque para restauración
 Ripristino dello stato di fornitura del software mediante il CD Restore Boot

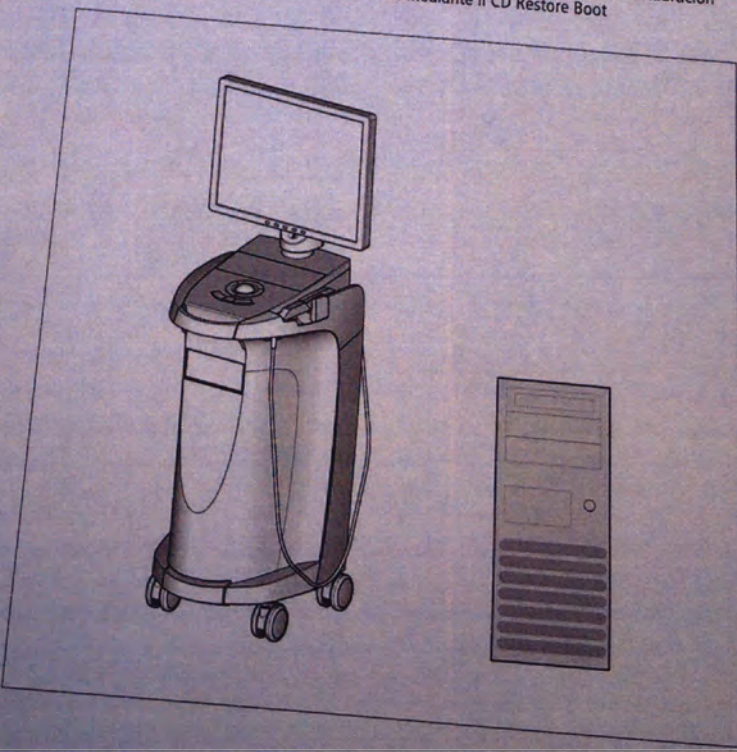

AVISO
 La avvertenza è valida solo per
 CEREC AC con Omnicam!
 Il CD è adatto per la versione
 hardware del sistema attuale.
AVISO
 Cada nota aplica solamente a
 cada tipo AC con Omnicam!

ALL-CERAMIC RESTORATIONS

Beautiful teeth with CEREC.

Amalgam filling CEREC Ceramic filling

sirona.
The Dental Company

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Аппараты стоматологические для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении APOLLO DI, CEREC AC Connect.

1. Принадлежности:

- Моноблок обработки данных APOLLO DI.
- Блок обработки данных CEREC AC Connect.
- Внутриротовая (интраоральная) камера APOLLO DI.
- Внутриротовая (интраоральная) камера CEREC Omnicam.
- Калибровочные насадки для внутриротовой (интраоральной) камеры – не более 5 шт.
- Чехлы защитные для внутриротовой (интраоральной) камеры APOLLO DI (упаковка 25 шт.) – не более 10 упаковок.
- Монитор специальный.
- Шар для трэкбола.
- Аккумулятор специальный.
- Крепежный винт для аккумулятора специального.
- 2. Основание (платформа) для моноблока обработки данных APOLLO DI.
- 1. Стойка для крепления моноблока обработки данных APOLLO DI.
- 2. Средство APOLLO DI SpeedSpray для проведения оптических измерений в формате 3D объемом от 50 до 200 мл – не более 10 шт.
- 3. Модель челюсти фантомная.
- 4. Шкалы расцветок CEREC Blocs Shade Guide – не более 5 шт.
- 5. Винты крепежные, специальные – не более 24 шт.
- 6. Заглушки для винтов – не более 24 шт.
- 7. Кабели питания – не более 2 шт.
- 8. Кабели соединительные – не более 5 шт.
- 9. Носители электронные с ПО и технической документацией – не более 10 шт.
- 10. Накопители USB – не более 10 шт.
- 11. Конверты с защитным кодом License Voucher – не более 10 шт.
- 12. Техническая документация.
- 13. Брошюра для пациента, не более 200 шт.

генеральный директор
ООО "Сирона Денталь Системс"

18" декабря 2013г.



М. В. Кротенко

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 32 лист

М.В. Кротен



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Аппараты стоматологические для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении APOLLO DI, CEREC AC Connect, с принадлежностями, производства SIRONA Dental Systems GmbH (СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

Аппарат стоматологические для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов



APOLLO DI



CEREC AC Connect.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Моноблок обработки данных APOLLO DI




Блок обработки данных CEREC AC Connect



Внутриротовая (интраоральная) камера APOLLO DI




Внутриротовая (интраоральная) камера CEREC Omnicam

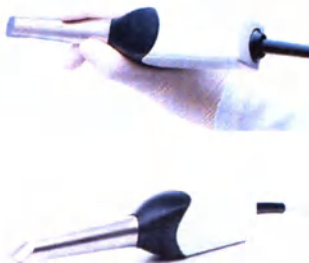

Калибровочные насадки для
внутриротовой (интраоральной) камеры



Чехлы защитные для внутриротовой
(интраоральной) камеры APOLLO DI

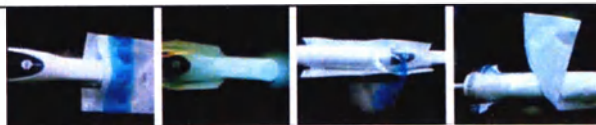

Монитор специальный



Шар для трэкбола



Аккумулятор специальный




Крепежный винт для аккумулятора
специального



Основание (платформа) для моноблока
обработки данных APOLLO DI.



Стойка для крепления моноблока
обработки данных APOLLO DI

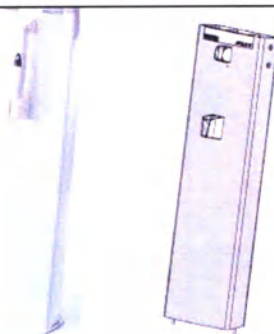

Средство APOLLO DI SpeedSpray для
проведения оптических измерений в
формате 3D



Модель челюсти фантомная.



Шкалы расцветок CEREC Blocs Shade
Guide



Винты крепежные, специальные



Заглушки для винтов



Кабели питания



Кабели соединительные



Носители электронные с ПО и
технической документацией



Накопители USB



Конверты с защитным кодом License
Voucher



Техническая документация

-

Брошюра для пациента

-

Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»



М. В. Кротенко

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист (

М.В. Крот

