

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

**Набор реагентов «Экспресс-тест ReaScan TBE IgM» для выявления вирусной инфекции острого клещевого энцефалита методом иммунохроматографического анализа в сыворотке и цереброспинальной жидкости человека,
«Экспресс-тест ReaScan TBE IgM»**





Набор в потребительской упаковке



Комплектация


Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) лист а

Генеральный директор ООО «МЕЛОН»
Побелянский Г.Э.



ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Экспресс-тест ReaScan TBE IgM» для выявления вирусной инфекции острого клещевого энцефалита методом иммунохроматографического анализа в сыворотке и цереброспинальной жидкости человека, «Экспресс-тест ReaScan TBE IgM»

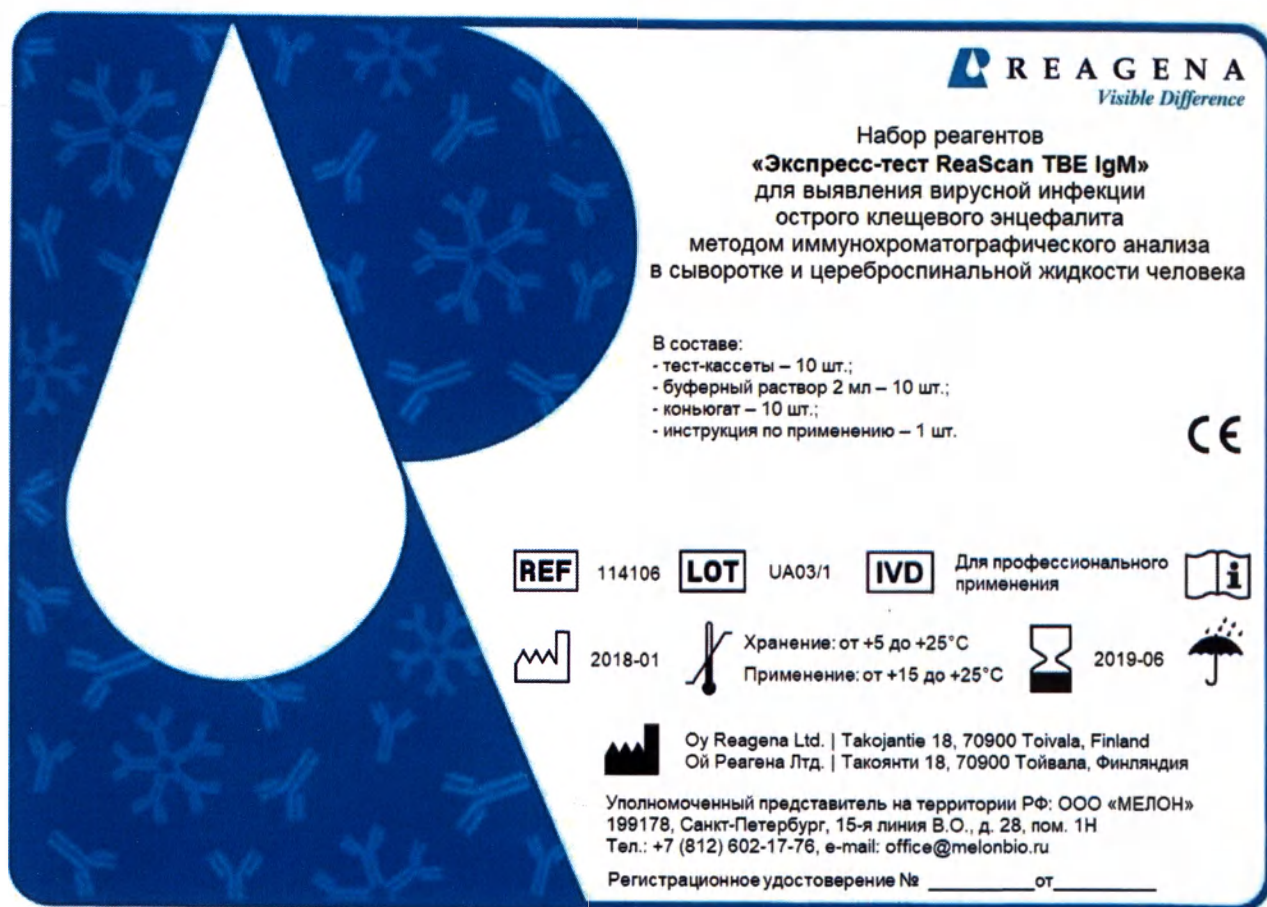

Маркировка потребительской упаковки

Экспресс-тест ReaScan TBE IgM Лот-специфичные пороговые значения, установленные для набора серии UA03/1	
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ	< 15
СЕРАЯ ЗОНА	15 - 30
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ	> 30

Пороговые значения, которое указываются на внутренней стороне
потребительской упаковки



Ой Реагена Лтд.



Экспресс-тест ReaScan TBE IgM

БУФЕРНЫЙ РАСТВОР 2 мл



5...25 °C



TM29/1



2019-06



114106v1

На пробирку с буферным раствором



Ой Реагена Лтд.



Экспресс-тест ReaScan TBE IgM

КОНЬЮГАТ



5...25 °C



TM21/1



2019-06



114106v2

На пробирку с конъюгатом



Ой Реагена Лтд.



Экспресс-тест ReaScan TBE IgM

ТЕСТ-КАССЕТА 1 шт.



5...25 °C



TM13/1



2019-06



114106tc

На первичную упаковку тест-кассеты

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист а

Генеральный директор ООО «МЕЛОН»
Побемянский Г.Э.

