

Polyefir

Воплощаем идеи в форму



Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 30 мл

Производитель: ОДО «Полиэфир», Республика Беларусь

222140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, АПЗ Литер А4/КП, к. 147

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5596 от 06.04.2017

Адрес места производства: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., Смолевичский р-н, промышленная зона «Заречье», ул. Фрунзе, д. 35

Произведено по НТД 6/н от 12.12.2016 г.

Номер партии: 13-С-052019

Дата изготовления: 05.2019

Срок годности: 5 лет

Хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте при постоянной температуре от +5 °С до 25 °С, вдали от огня и источников тепла.

Для однократного использования

Использовать при температуре от +15 °С до +38 °С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении 700 гПа -1060 гПа

Инструкция: Рекомендуется уточнить правила сбора биоматериала в лаборатории. Перед использованием не требует предварительной обработки. Вскрыть упаковку, открутить крышку, осуществить забор биоматериала, закрутить крышку, доставить контейнер в лабораторию.

Утилизация согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790

STERILE R

Апирогенно
Нетоксично внутри



IVD



Polyefir

Воплощаем идеи в форму



Контейнер стерильный для сбора биоматериалов с ложкой 30 мл

Производитель: ОДО «Полиэфир», Республика Беларусь

222140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, АПЗ Литер А4/КП, к. 147

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5596 от 06.04.2017

Адрес места производства: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., Смолевичский р-н, промышленная зона «Заречье», ул. Фрунзе, д. 35

Произведено по НТД 6/н от 12.12.2016 г.

Номер партии: 14-С-052019

Дата изготовления: 05.2019

Срок годности: 5 лет

Хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте при постоянной температуре от +5 °С до 25 °С, вдали от огня и источников тепла.

Для однократного использования

Использовать при температуре от +15 °С до +38 °С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении 700 гПа -1060 гПа

Инструкция: Рекомендуется уточнить правила сбора биоматериала в лаборатории. Перед использованием не требует предварительной обработки. Вскрыть упаковку, открутить крышку, осуществить забор биоматериала, закрутить крышку, доставить контейнер в лабораторию.

Утилизация согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790



STERILE R

Апирогенно
Нетоксично внутри



IVD



Polyefir

Воплощаем идеи в форму



Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 60 мл

Производитель: ОДО «Полиэфир», Республика Беларусь

222140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, АПЗ Литер А4/КП, к. 147

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5596 от 06.04.2017

Адрес места производства: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., Смолевичский р-н, промышленная зона «Заречье», ул. Фрунзе, д. 35

Произведено по НТД 6/н от 12.12.2016 г.

Номер партии: 2-С-052019

Дата изготовления: 05.2019

Срок годности: 5 лет

Хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте при постоянной температуре от +5 °С до 25 °С, вдали от огня и источников тепла.

Для однократного использования

Использовать при температуре от +15 °С до +38 °С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении 700 гПа -1060 гПа

Инструкция: Рекомендуется уточнить правила сбора биоматериала в лаборатории. Перед использованием не требует предварительной обработки. Вскрыть упаковку, открутить крышку, осуществить забор биоматериала, закрутить крышку, доставить контейнер в лабораторию.


Утилизация согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790

СТЕРИЛЕ R

Апирогенно
Нетоксично внутри

добровольная
сертификация
PG

IVD



Polyefir

Воплощаем идеи в форму



Контейнер стерильный для сбора биоматериалов со шпателем 60 мл

Производитель: ОДО «Полиэфир», Республика Беларусь

222140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, АПЗ Литер А4/КП, к. 147

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5596 от 06.04.2017

Адрес места производства: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., Смолевичский р-н, промышленная зона «Заречье», ул. Фрунзе, д. 35

Произведено по НТД 6/н от 12.12.2016 г.

Номер партии: 3-С-052019

Дата изготовления: 05.2019

Срок годности: 5 лет

Хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте при постоянной температуре от +5 °С до 25 °С, вдали от огня и источников тепла.

Для однократного использования

Использовать при температуре от +15 °С до +38 °С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении 700 гПа - 1060 гПа

Инструкция: Рекомендуется уточнить правила сбора биоматериала в лаборатории. Перед использованием не требует предварительной обработки. Вскрыть упаковку, открутить крышку, осуществить забор биоматериала, закрутить крышку, доставить контейнер в лабораторию.

Утилизация согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790

STERILE R

Апирогенно
Нетоксично внутри



IVD



Polyefir

Воплощаем идеи в форму



Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 120 мл

Производитель: ОДО «Полизфир», Республика Беларусь

222140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, АПЗ Литер А4/КП, к. 147

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5596 от 06.04.2017

Адрес места производства: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., Смолевичский р-н, промышленная зона «Заречье», ул. Фрунзе, д. 35

Произведено по НТД 6/н от 12.12.2016 г.

Номер партии: 1-С-052019

Дата изготовления: 05.2019

Срок годности: 5 лет

Хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте при постоянной температуре от +5 °С до 25 °С, вдали от огня и источников тепла.

Для однократного использования

Использовать при температуре от +15 °С до +38 °С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении 700 гПа -1060 гПа

Инструкция: Рекомендуется уточнить правила сбора биоматериала в лаборатории. Перед использованием не требует предварительной обработки. Вскрыть упаковку, открутить крышку, осуществить забор биоматериала, закрутить крышку, доставить контейнер в лабораторию.

Утилизация согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790

STERILE R

Апирогенно
Нетоксично внутри



IVD



Polyefir

Воплощаем идеи в форму



Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 120 мл
со встроенным устройством для вакуумного отбора мочи

Производитель: ОДО «Полиэфир», Республика Беларусь

222140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, АПЗ Литер А4/КП, к. 147

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5596 от 06.04.2017

Адрес места производства: Республика Беларусь, 222160, Минская обл.,
Смолевичский р-н, промышленная зона «Заречье», ул. Фрунзе, д. 35

Произведено по НТД 6/н от 12.12.2016 г.

Номер партии: 11-С-052019

Дата изготовления: 05.2019

Срок годности: 5 лет

Хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте при постоянной температуре от +5 °С до 25 °С, вдали от огня и источников тепла.

Для однократного использования

Использовать при температуре от +15 °С до +38 °С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении 700 гПа -1060 гПа

Инструкция: Рекомендуется уточнить правила сбора биоматериала в лаборатории. Перед использованием не требует предварительной обработки. Вскрыть упаковку, открутить крышку, осуществить забор биоматериала, закрутить крышку, доставить контейнер в лабораторию.

Утилизация согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790

STERILE R

Апирогенно
Нетоксично внутри



IVD





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Результат-Аудит»

Родина Г. В.

2019 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контейнер стерильный для сбора биоматериалов, варианты исполнения:

- контейнер стерильный для сбора биоматериалов 120 мл;
- контейнер стерильный для сбора биоматериалов 60 мл;
- контейнер стерильный для сбора биоматериалов со шпателем 60 мл;
- контейнер стерильный для сбора биоматериалов 30 мл;
- контейнер стерильный для сбора биоматериалов с ложкой 30 мл;
- контейнер стерильный для сбора биоматериалов 120 мл со встроенным устройством для вакуумного отбора мочи.

Производитель: ОДО «Полиэфир», Республика Беларусь

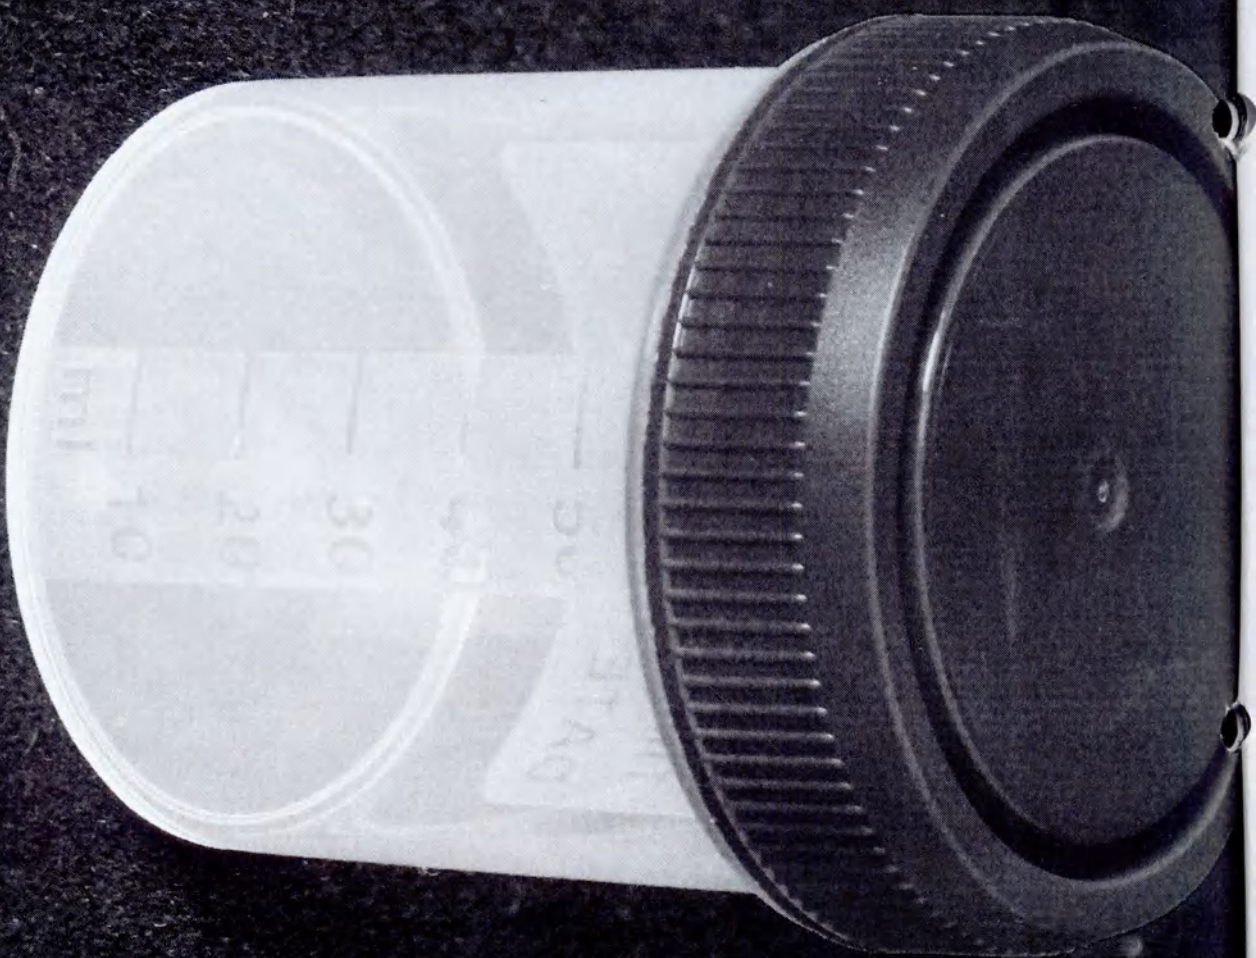

ООО "Глобмедиа"

Контейнер стерильный для сбора
биоматериалов 60 мл



Контейнер стерильный для сбора
биоматериалов со шпателем 60 мл

ОДО "Полиэспир"


ОДО "Топлиэфир"




Контейнер стерильный для сбора
биоматериалов 30 мл

Контейнер стерильный для сбора
биоматериала с ложкой 30 мл


ООО "Лондифир"

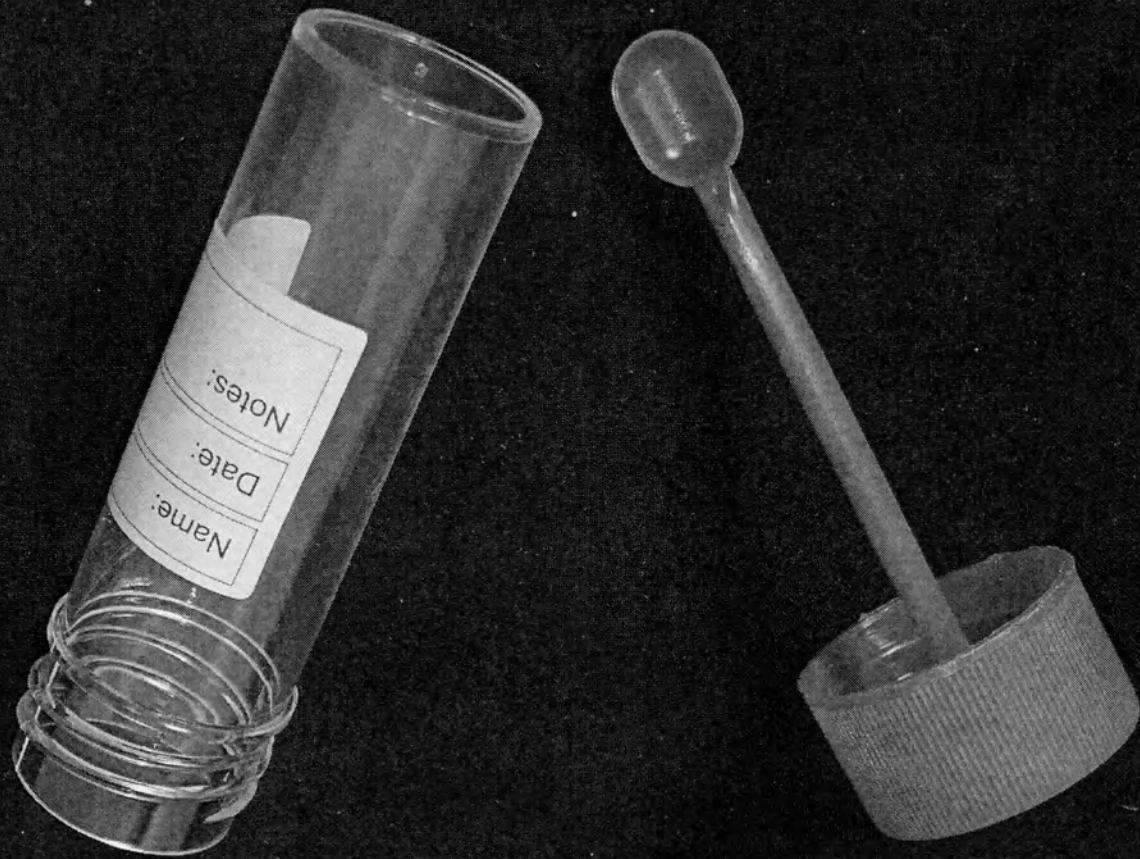

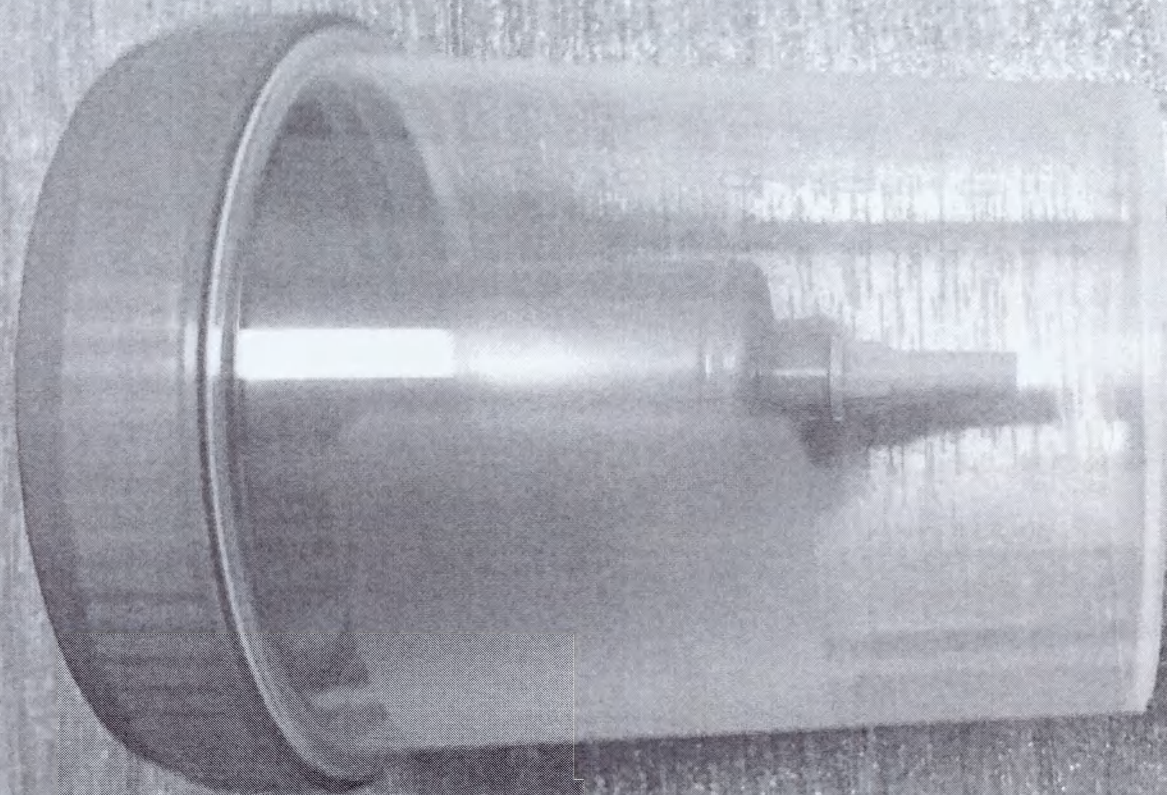


Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 120 мл со
встроенным устройством для вакуумного отбора мочи


1. Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 120 мл, фотографическое изображение упаковки медицинского изделия;

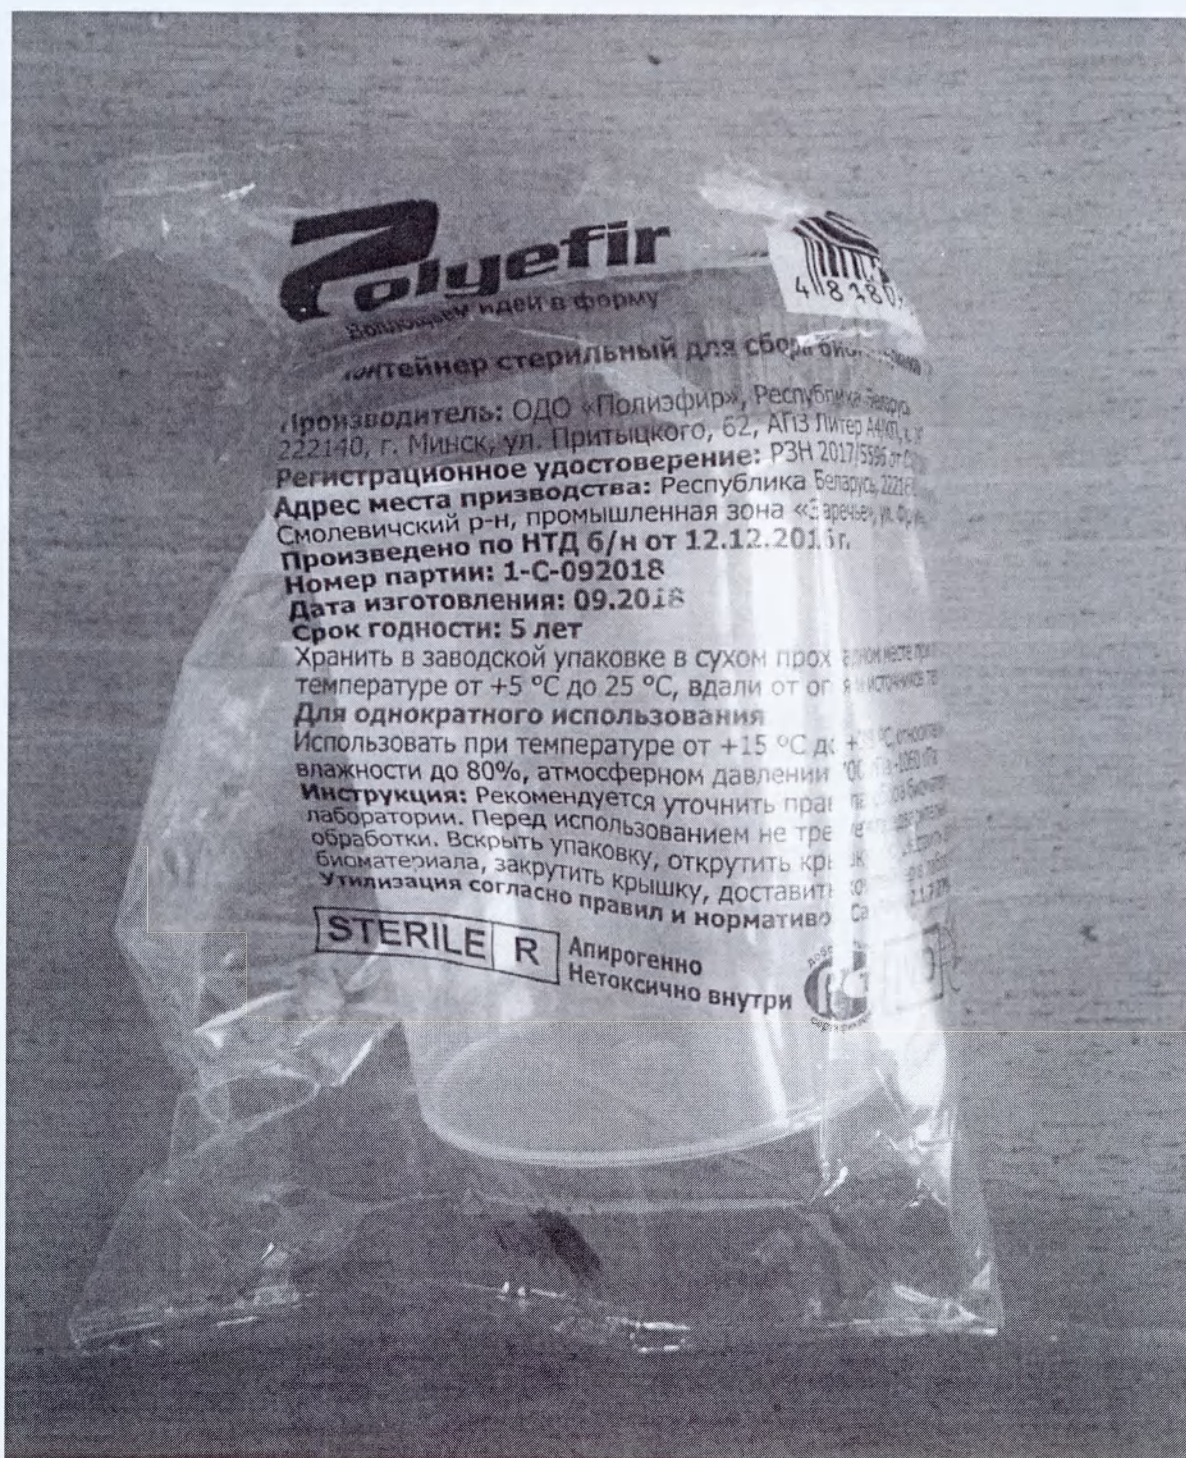


2. Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 60 мл, фотографическое изображение упаковки медицинского изделия;

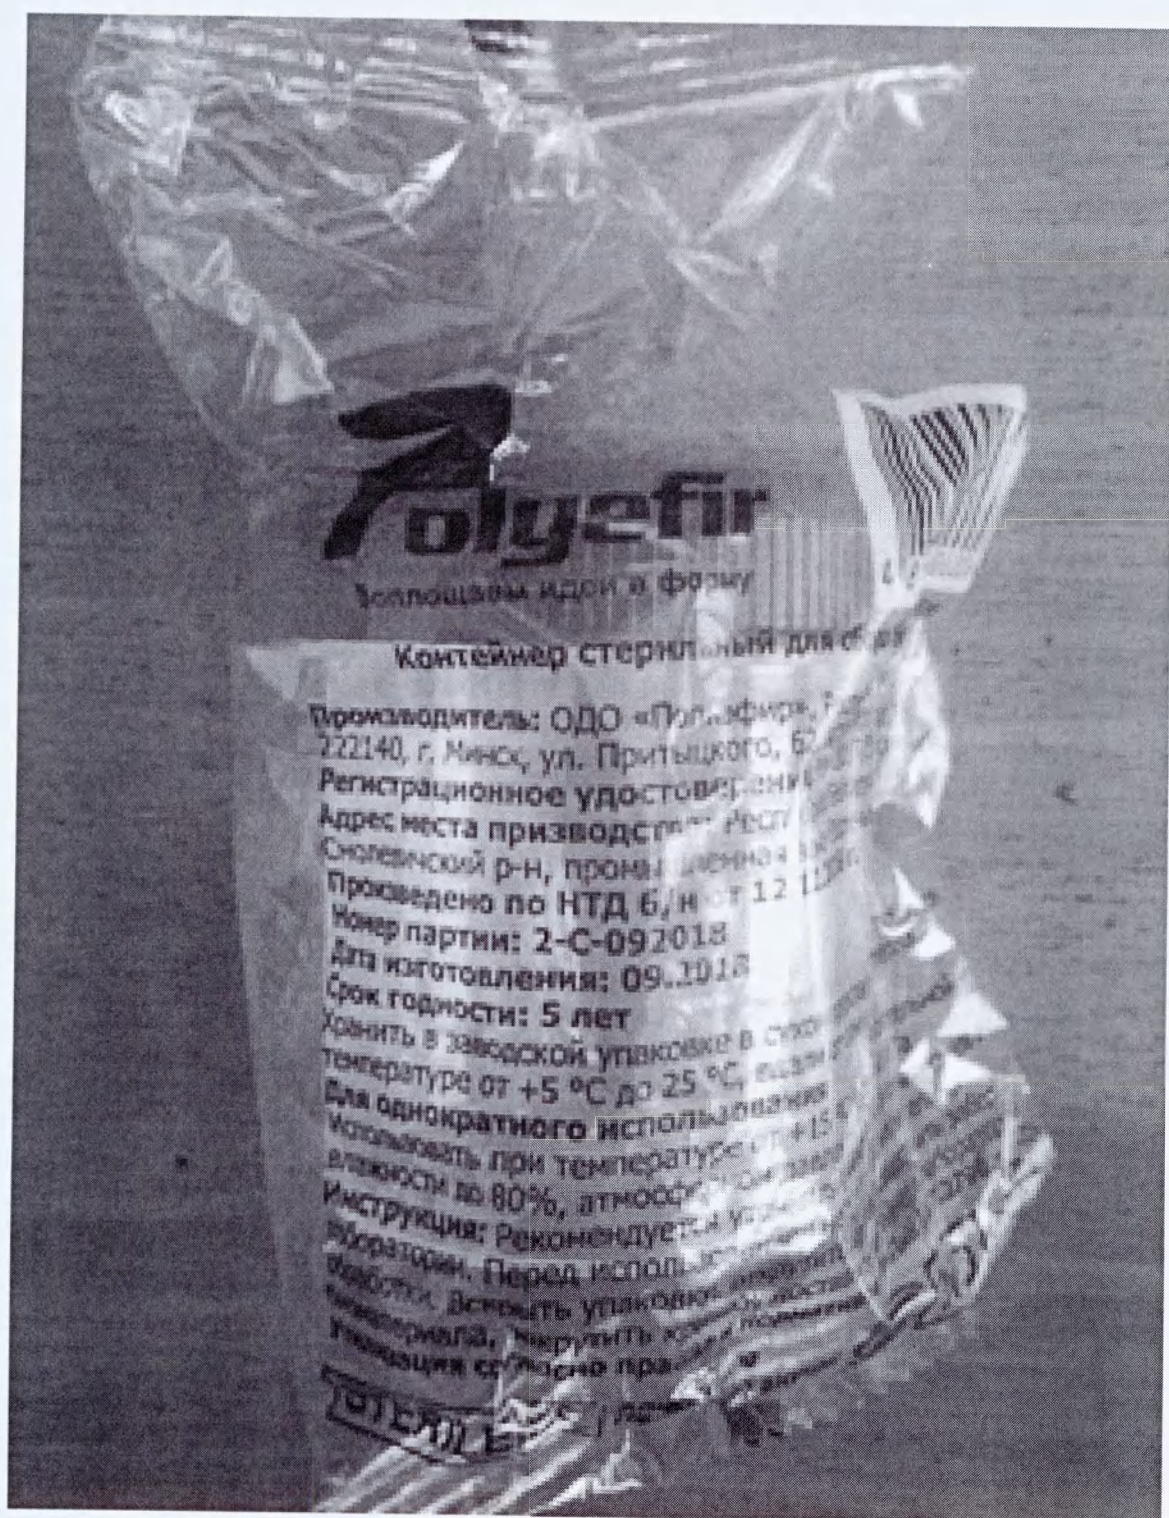

3. Контейнер стерильный для сбора биоматериалов со шпателем 60 мл, фотографическое изображение упаковки медицинского изделия;

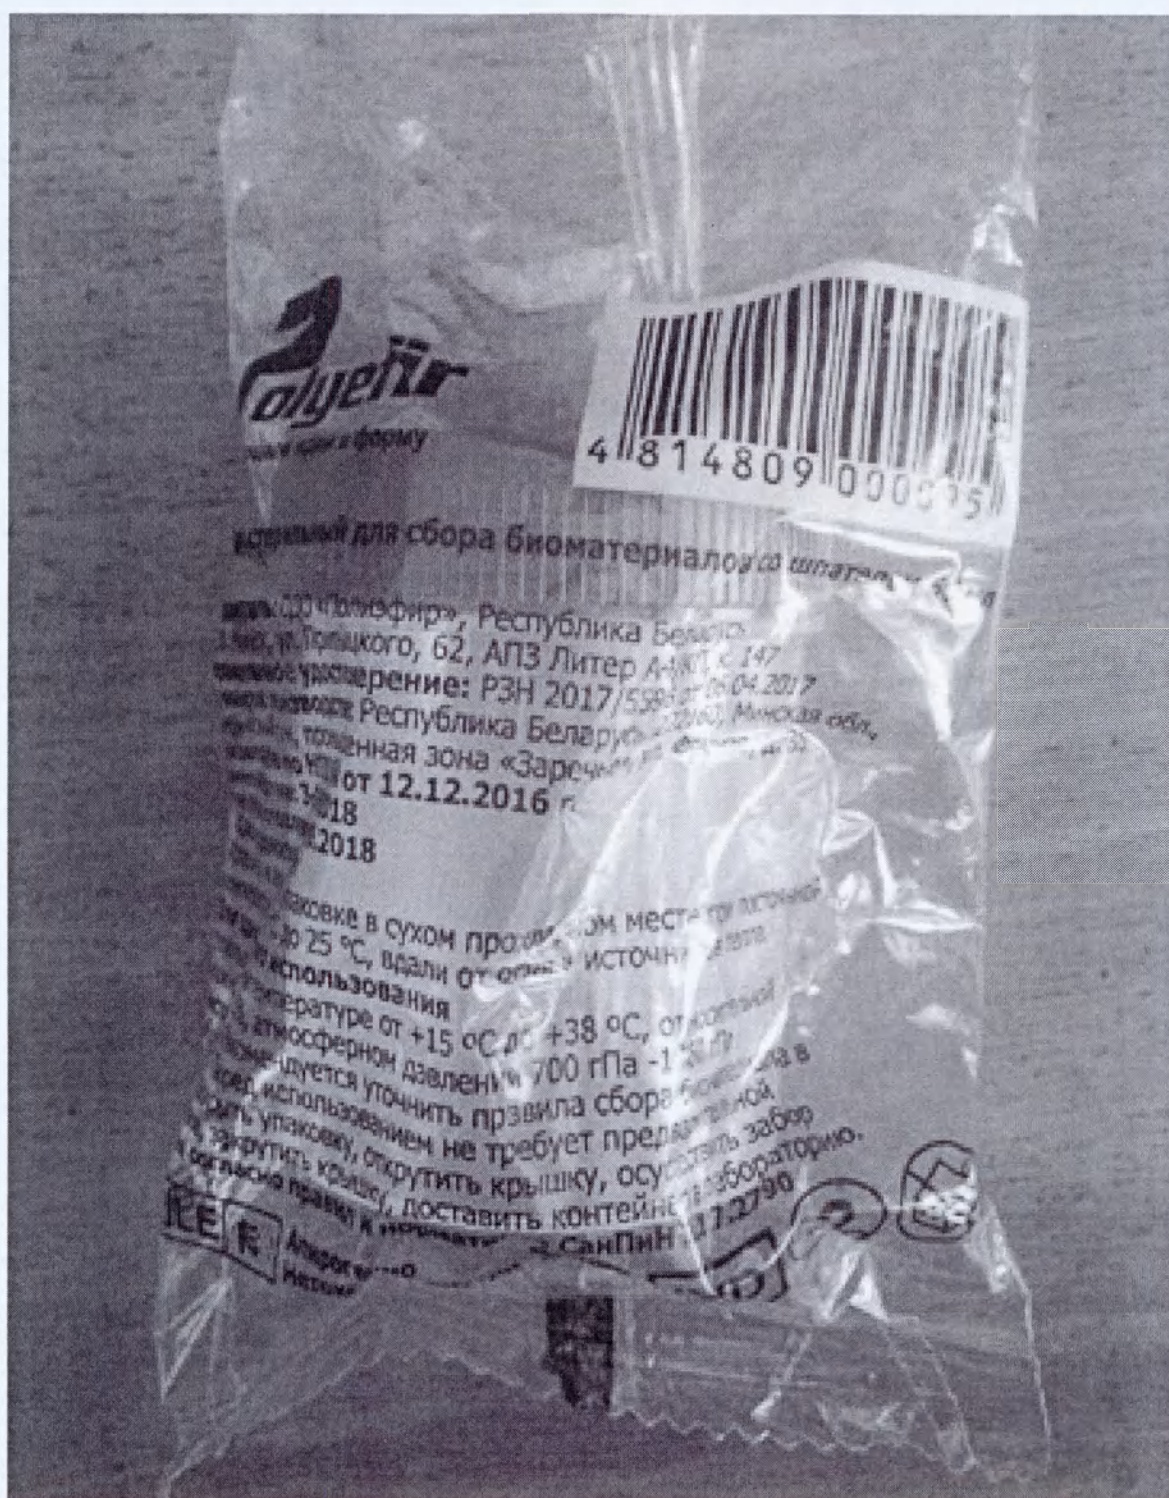


4. Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 30 мл, фотографическое изображение упаковки медицинского изделия;

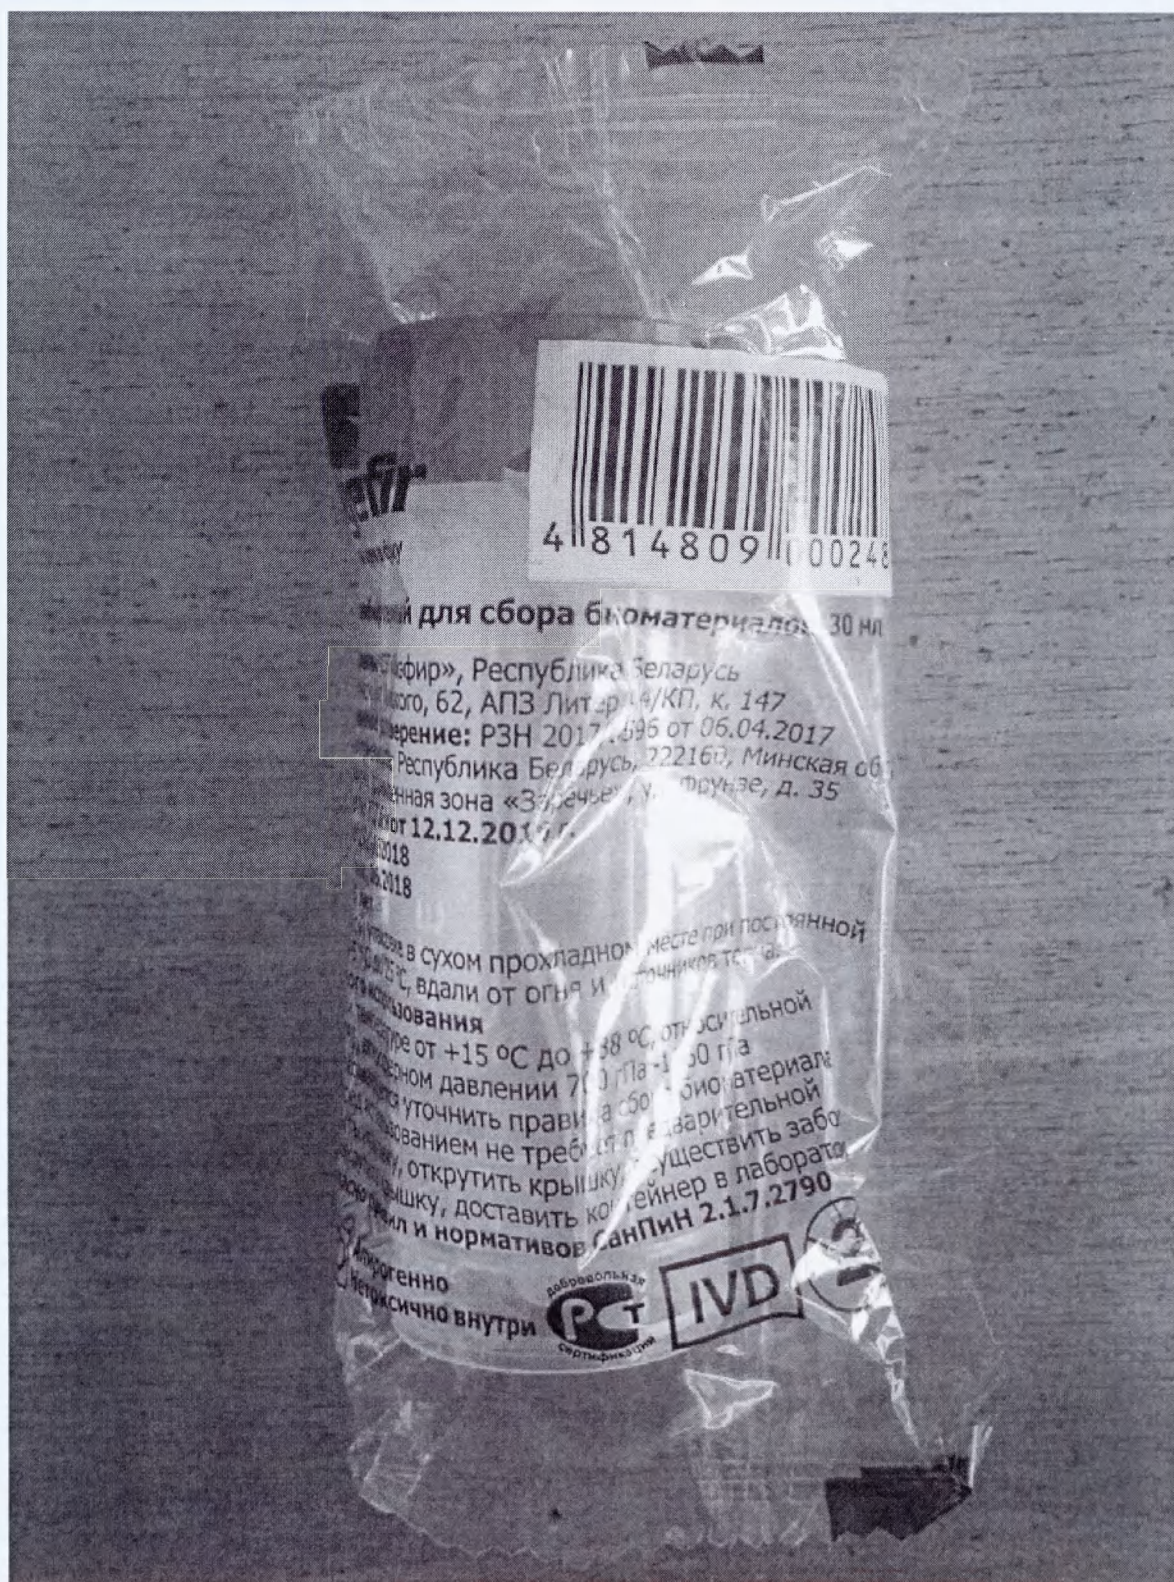

5. Контейнер стерильный для сбора биоматериалов с ложкой 30 мл, фотографическое изображение упаковки медицинского изделия;



6. Контейнер стерильный для сбора биоматериалов 120 мл со встроенным устройством для вакуумного отбора мочи, фотографическое изображение упаковки медицинского изделия;

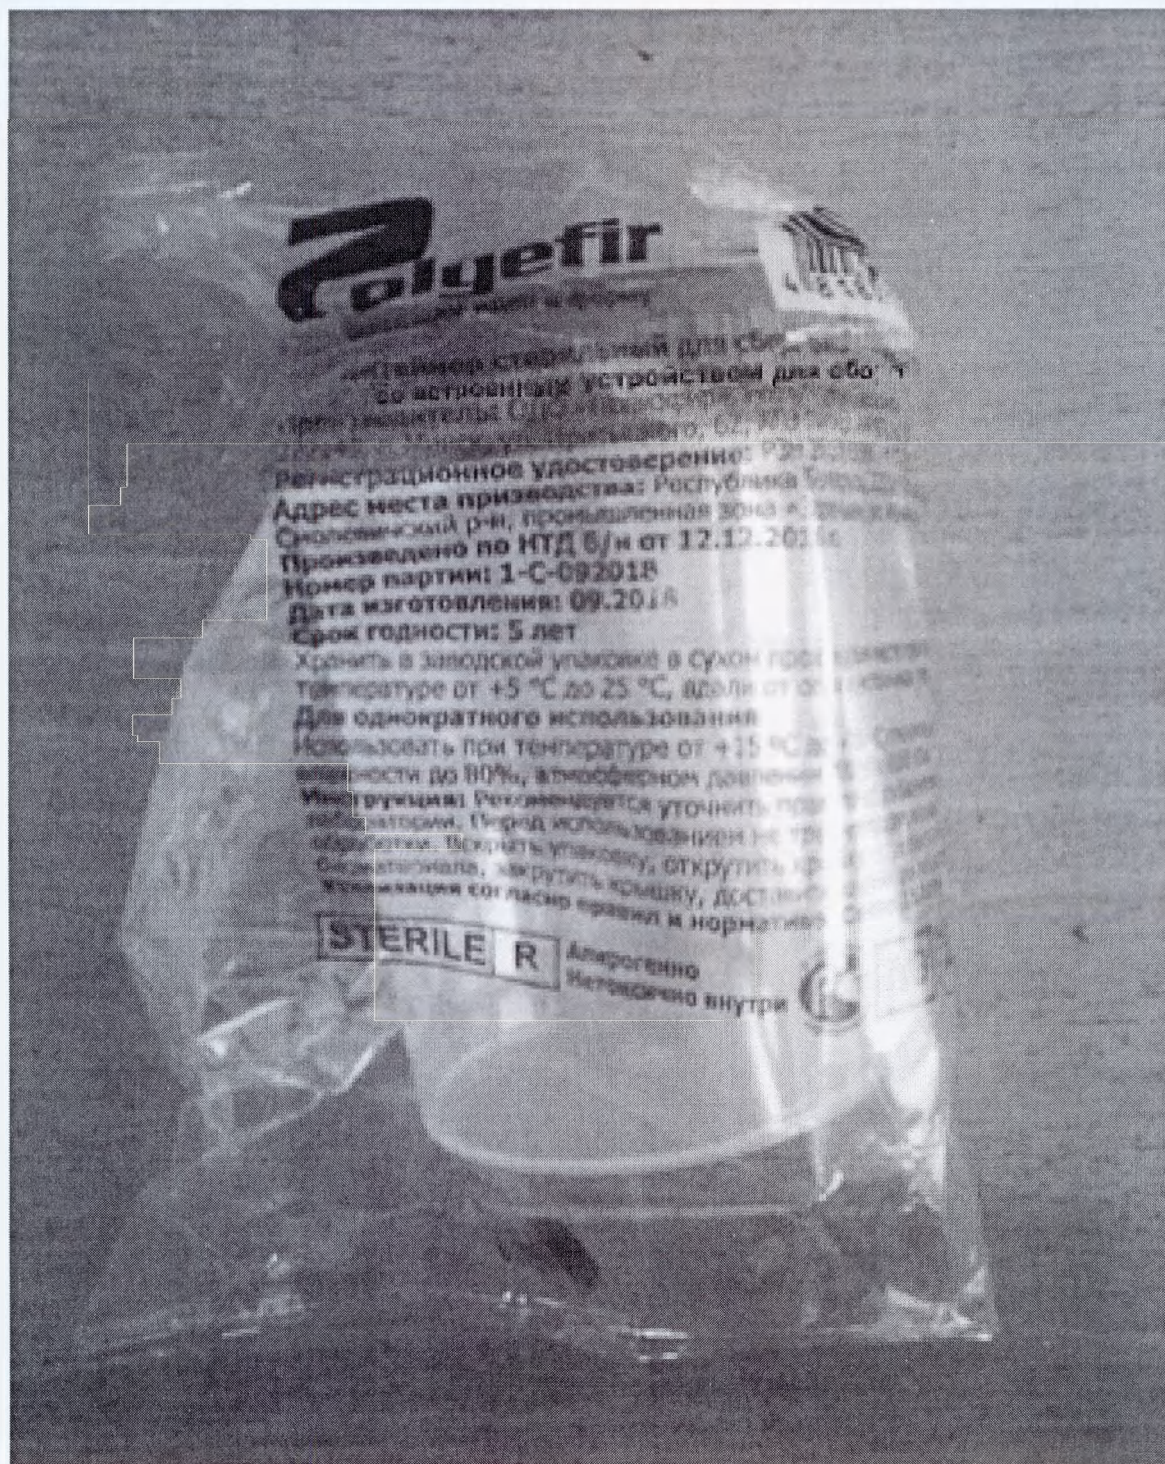



Контейнер стерильный для сбора
биоматериалов 120 мл

Прошнуровано и пронумеровано

13 лист об

Генеральный Директор

ООО "Результат-Аудит"

Г.В. Родина



Родина