

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визу-
ализации и обработки изображения с принадлеж-
ностями*

Производства

«Карл Шторц СЕ и Ко. КГ»

Karl Storz SE & Co. KG

Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения с принадлежностями: I. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S CONNECT, основной состав: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S CONNECT



Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения с принадлежностями: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S CONNECT, основной состав: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S CONNECT



Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения с принадлежностями: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S CONNECT, основной состав: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S CONNECT



2. Сетевой кабель, длина 300 см



3. Соединительный кабель DVI, длина 300 см



4. Соединительный кабель SCB, длина 100 см






6. Клавиатура с сенсорной панелью



6. Клавиатура с сенсорной панелью



6. Клавиатура с сенсорной панелью

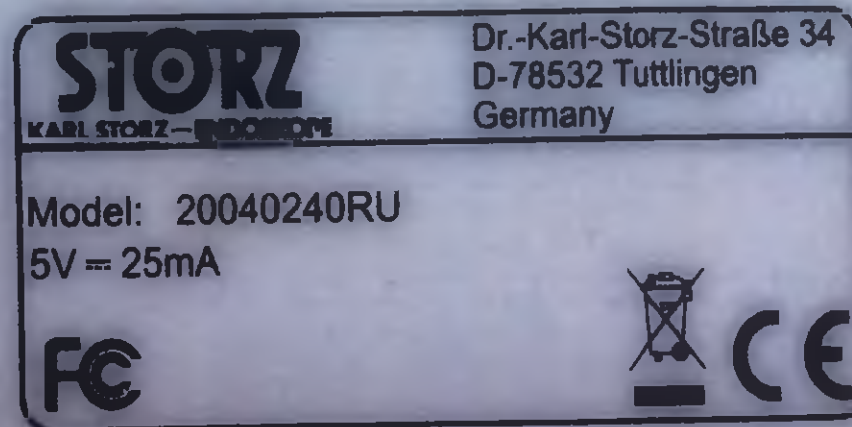

7. Инструкция по эксплуатации







WARRANTY
VOID
IF SEAL
IS BROKEN



STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

Model **TC201**



 **WEEE**

Voltage 100 - 240V~ 50/60 Hz
Power 100 - 135VA

Classification IEC
Class I

  **LR104841**



(01) 04048551423035
(21) XR793827-P
AN TC201

SN XR793827-P



2. Сетевой кабель, длина 300 см



3. Соединительный кабель DVI, длина 300 см



4. Соединительный кабель SCB, длина 100 см



5. Кабель 12G-/3G-SDI, длина 300 см



6. Кабель DisplayPort, длина 300 см





8. Клавиатура с сенсорной панелью



9. Инструкция по эксплуатации

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

IMAGE1 S™ – TC 200, TC 300, TC 301, TC 302, TC 304

**INSTRUCTION MANUAL**

IMAGE1 S™ – TC 200, TC 300, TC 301, TC 302, TC 304

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**Блок видеокамеры эндоскопической (только для РФ)
IMAGE1 S™ – TC 200, TC 300, TC 301, TC 302, TC 304



2. Сетевой кабель, длина 300 см



3. Кабель LINK, 20 см.



IV. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S X-LINK, основной состав: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S X-LINK



2. Сетевой кабель, длина 300 см



3. Кабель LINK, 20 см.









2. Сетевой кабель, длина 300 см



3. Кабель LINK, 20 см.



VI. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S 4U-LINK, основной состав: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S 4U-LINK



VI. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S 4U-LINK, основной состав: 1. Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S5 4U-LINK





2. Сетевой кабель, длина 300 см



3. Кабель LINK, 20 см.



VII. Принадлежности к блокам видеокамер: 1. Адаптер IMAGE1 S для видеоэндоскопа 0°.



2. Адаптер IMAGE1 S для видеоскопа 90°.



3. Удлинительный кабель IMAGE 1 FULL HD, длина 520 см.



4. USB для адаптера ACC.




5. Соединительный кабель АСС, для управления периферийными устройствами, длина 180 см.



6. Двухпедальный переключатель.



6. Двухпедальный переключатель.

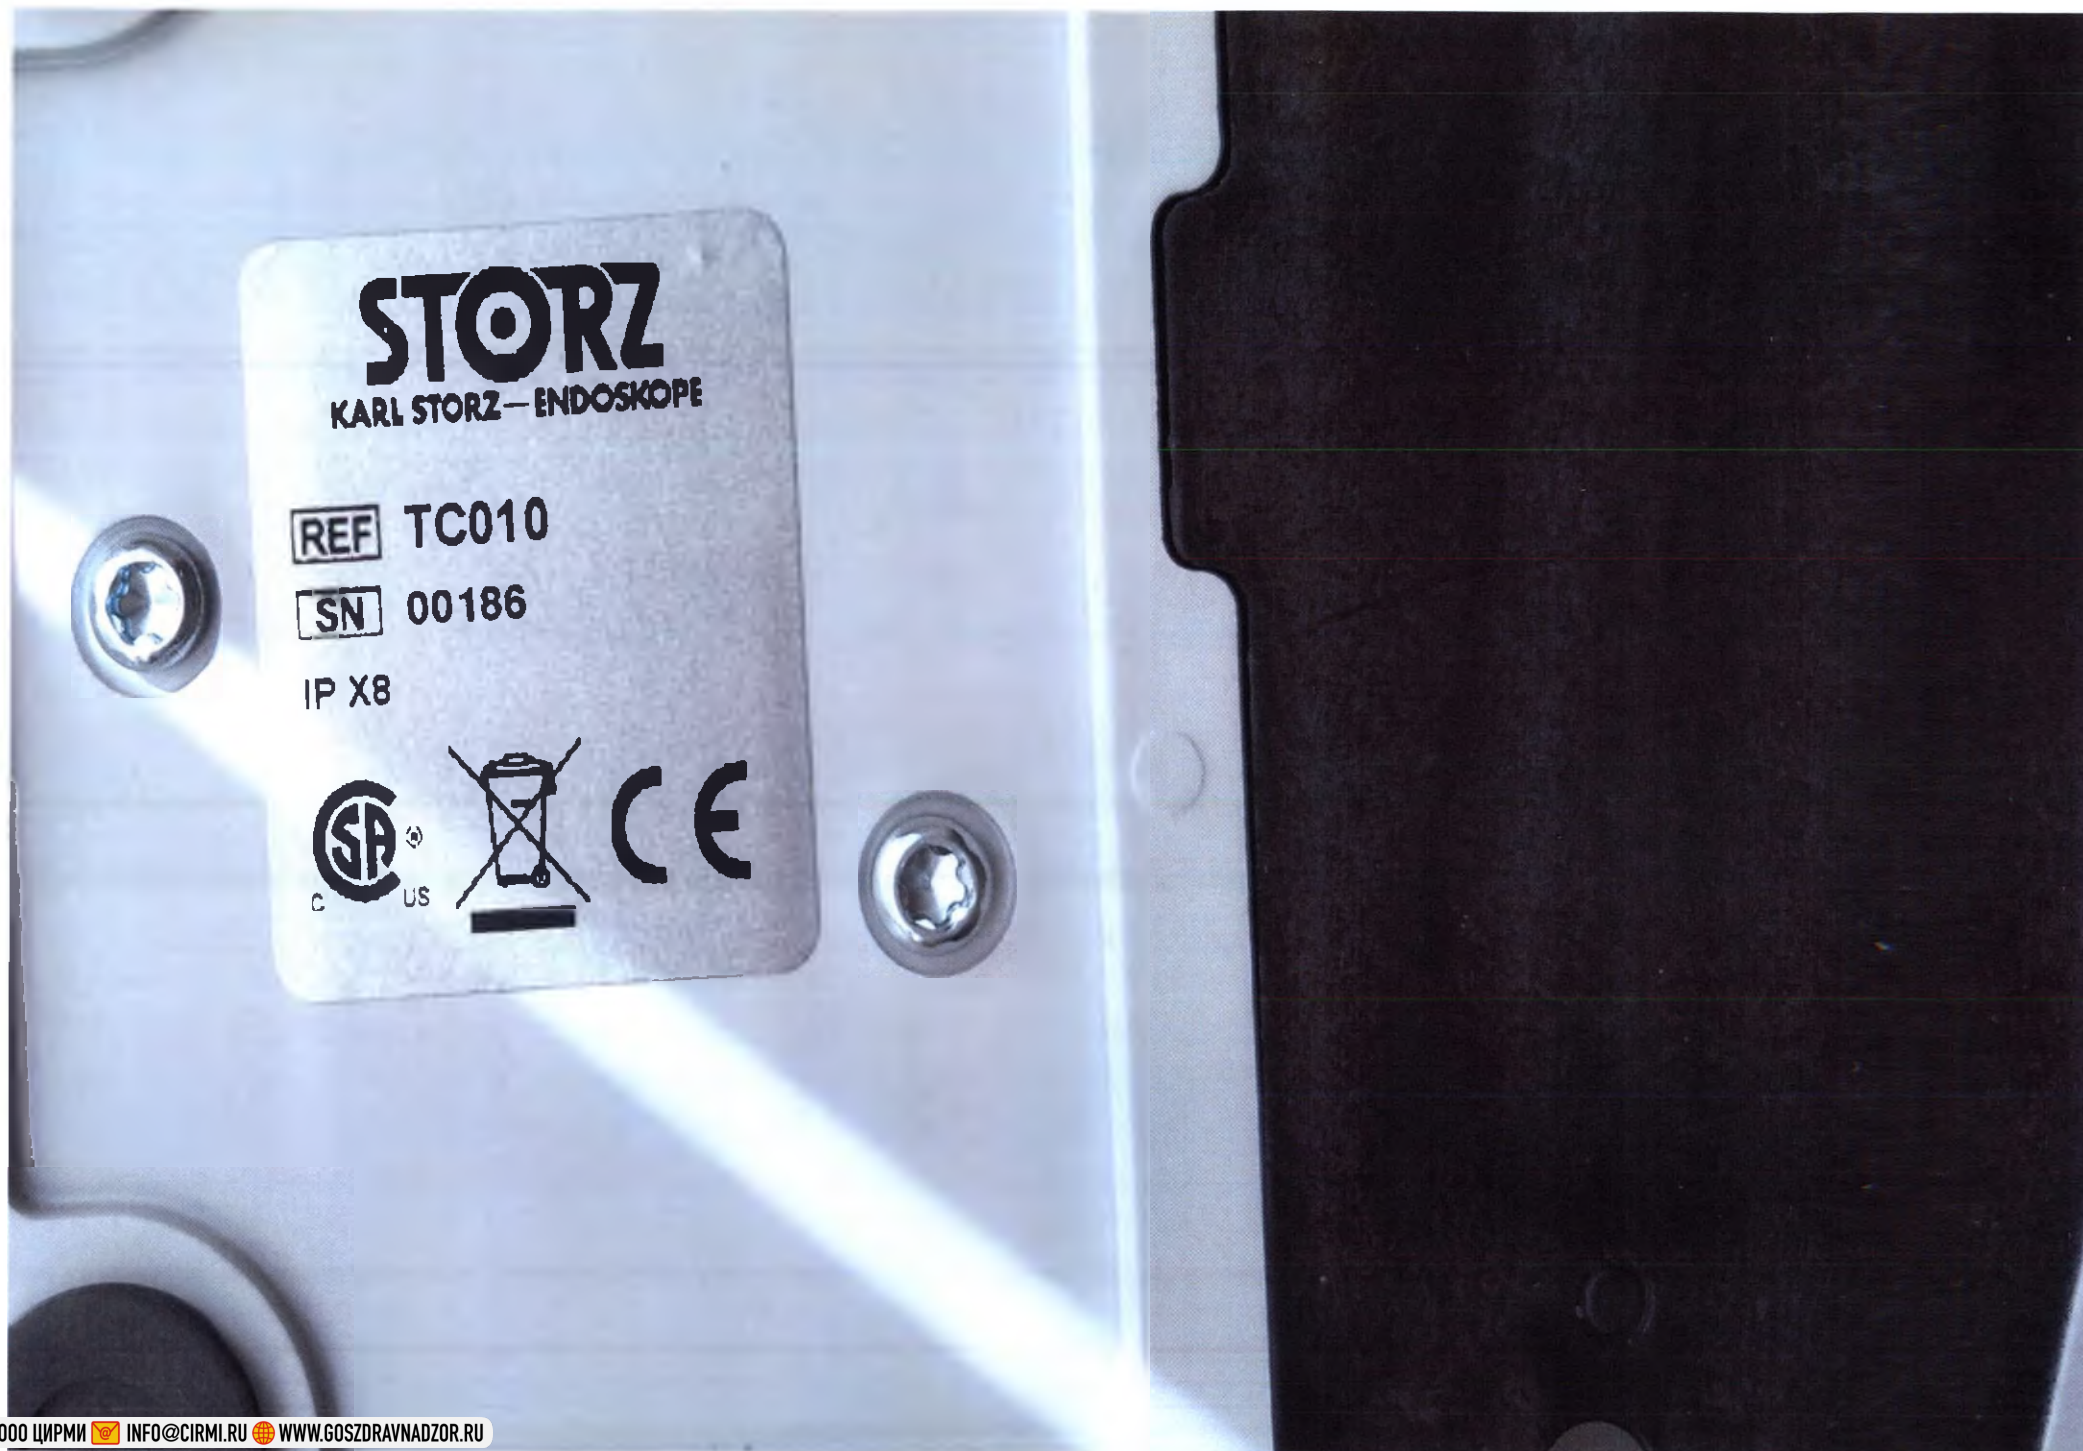

7. Соединительный кабель DVI, длина 200 см.



8. Кабель 3G-SDI, 10 м.







11. IMAGE 1 PILOT (3D мышь).






12. Кабель-удлиннитель IMAGE 1 S D3-LINK



VIII. Видеоголовка эндоскопическая, варианты исполнения: IMAGE1 S H3-Z



VIII. Видеоголовка эндоскопическая, варианты исполнения: IMAGE1 S H3-ZI

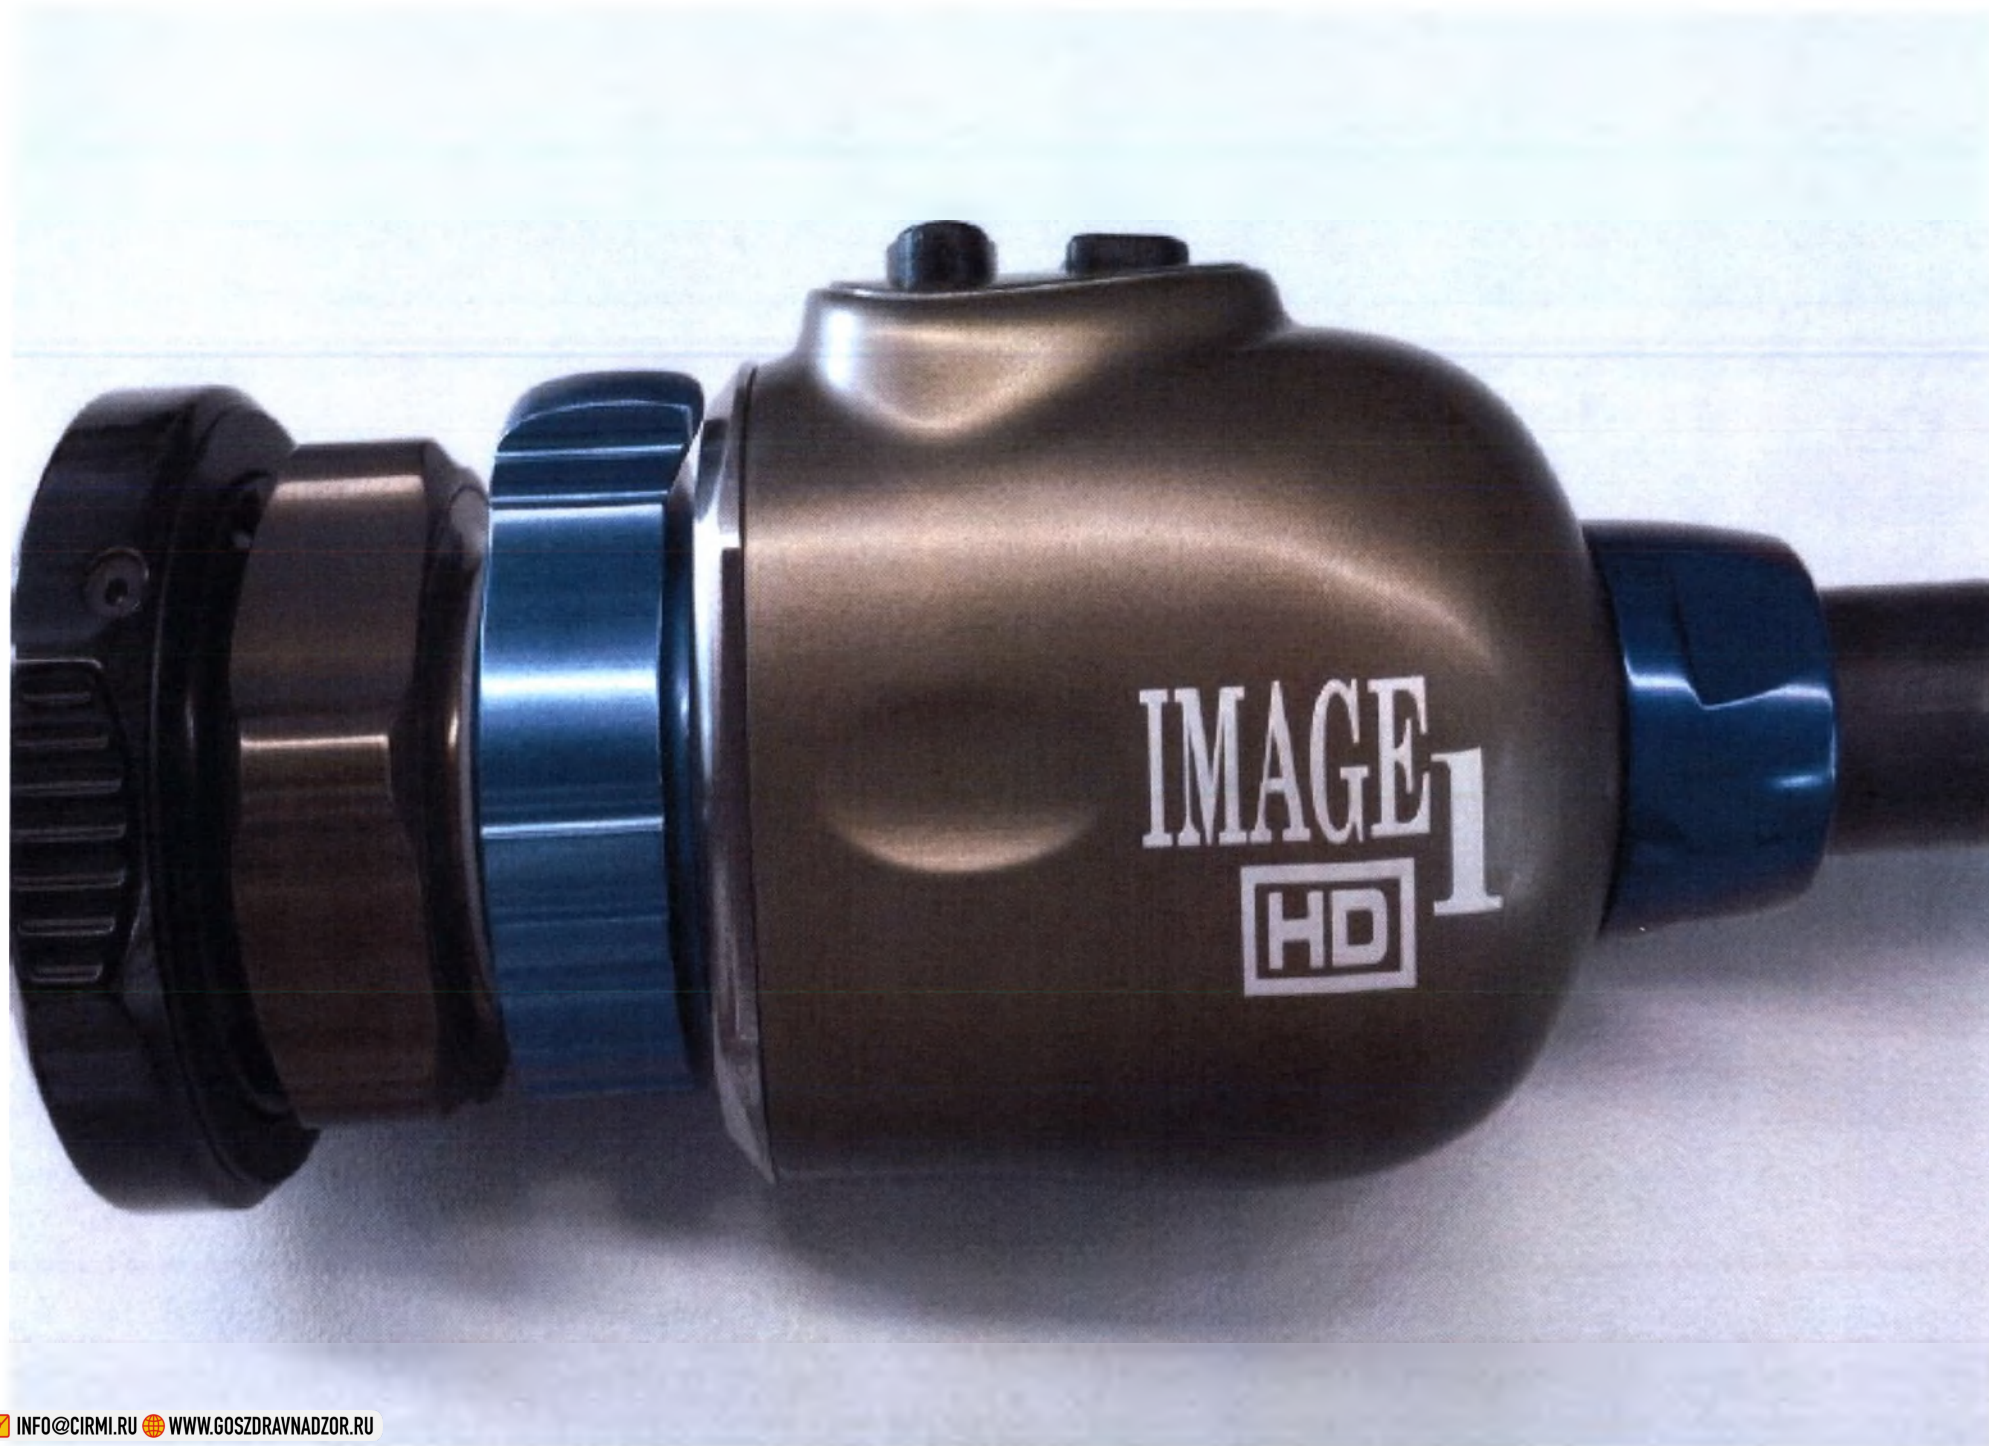

VIII. Видеоголовка эндоскопическая, варианты исполнения: IMAGE1 S H3-ZA



С принадлежностями: 1. Адаптер автоклавируемый, для замены оптики в стерильных условиях.



2. Интегрированный поворотный светоделитель, для одновременного отображения на оптическом приборе и мониторе.



3. Пылезащитный колпачок для видеоголовок.



4. Стерильные чехлы для видеокамер KARL STORZ.



4. Стерильные чехлы для видеокамер KARL STORZ.

STORZ
KARL STORZ ENDOSCOPE



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
72532 Tuttlingen/Germany

REF 040114-01

1 x 1: 040114-01

(01)G4048438001417(240)040114-01(17)230601(10)1814097V



Kameraüberzug gerollt mit
Kunststoffeinführhilfe

Camera cover rolled with plastic insertion
aid


Housse de caméra enroulé avec guide
d'introduction en matière plastique

Copertura per videocamera arrotolata con
supporto d'inserimento in plastica

Funda de cámara enrollada con
dispositivo de introducción de plástico

Revestimento da câmera enrolado com
apoio de introdução de plástico

17 x 242 cm



CE 0123

STERILE R



2023-06-01

LOT

1814097V




RxOnly

5. Удлинительный кабель IMAGE 1 FULL HD, длина 520 см.



6. Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения видеоголовок IMAGE1 S H3-Z и IMAGE1 S H3-ZA.

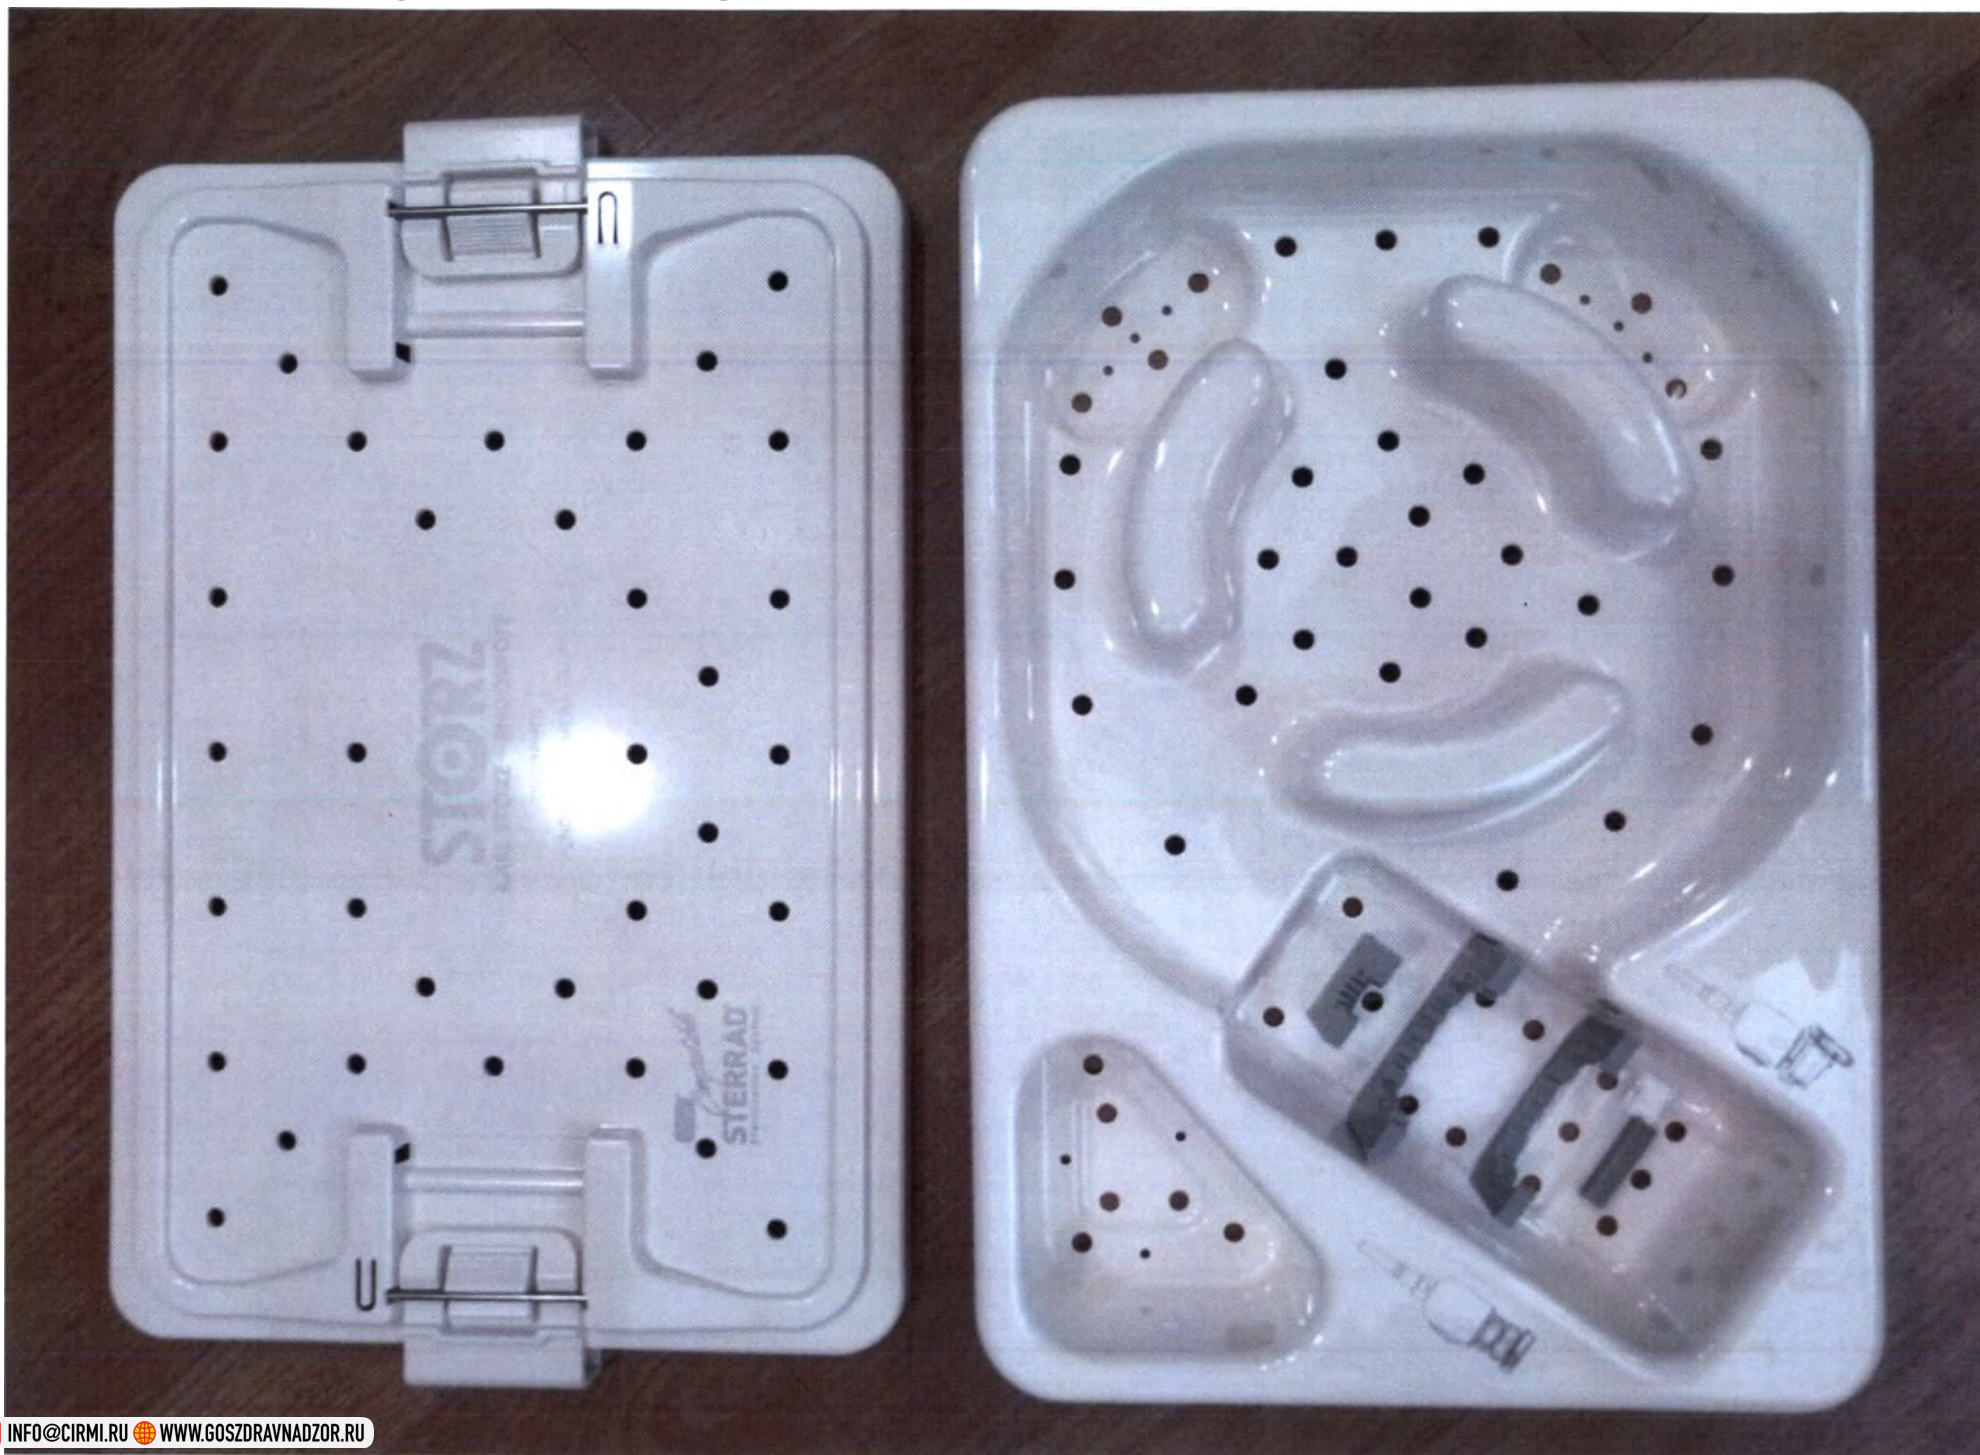

7. Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения видеоголовок IMAGE1 S H3-ZI и IMAGE1 S H3-P.



IX. Видеоголовка эндоскопическая, варианты исполнения: IMAGE1 S HX FI



IX. Видеоголовка эндоскопическая, варианты исполнения: IMAGE1 S HX FI



IX. Видеоголовка эндоскопическая, варианты исполнения: IMAGE1 S HX-P FI



IX. Видеоголовка эндоскопическая, варианты исполнения: IMAGE1 S HX-P FI



С принадлежностями: 1. Адаптер автоклавируемый, для замены оптики в стерильных условиях.



2. Интегрированный поворотный светоделитель, для одновременного отображения на оптическом приборе и мониторе.



3. Пылезащитный колпачок для видеоголовок.



4. Стерильные чехлы для видеокамер KARL STORZ.





5. Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения видеоголовок IMAGE1 S HX FI и IMAGE1 S HX-P FI.



X. Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S D1



Х. Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S D1



С принадлежностями: 1. Адаптер автоклавируемый, для замены оптики в стерильных условиях.



2. Интегрированный поворотный светоделитель, для одновременного отображения на оптическом приборе и мониторе.



3. Стерильные чехлы для видеокамер KARL STORZ.



3. Стерильные чехлы для видеокамер KARL STORZ.



XI. Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S 4U



XI. Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S 4U



С принадлежностями: 1. Адаптер автоклавируемый, для замены оптики в стерильных условиях.



2. Интегрированный поворотный светоделитель, для одновременного отображения на оптическом приборе и мониторе.



3. Пылезащитный колпачок для видеоголовки.



4. Стерильные чехлы для видеокамер KARL STORZ.



4. Стерильные чехлы для видеокамер KARL STORZ.

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

REF 040114-01

1 x 1: 040114-01

(01)04048438001417(240)040114-01(17)230891(10)1814097V



Kameraüberzug gerollt mit
Kunststoffeinführhilfe

Camera cover rolled with plastic insertion
aid


Housse de caméra enroulé avec guide
d'introduction en matière plastique

Copertura per videocamera arrotolata con
supporto d'inserimento in plastica

Funda de cámara enrollada con
dispositivo de introducción de plástico

Revestimento da câmera enrolado com
apoio de introdução de plástico

17 x 242 cm



CE 0123

STERILE R



2023-06-01

LOT

1814097V



RxOnly

Артикул: TC304

РЗН 2015/3274

Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации
и обработки изображения с принадлежностями

Срок действия: не ограничен

Наименование: Блок видеокамеры эндоскопической IMAGE1 S 4U-LINK

Изготовитель: Карл Шторц SE и Ко.КГ, Германия.

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34,
78532 Tuttlingen, Germany

Официальный дистрибьютор в России

Общество с ограниченной ответственностью

КАРЛ ШТОРЦ - Эндоскопы ВОСТОК

115114, Москва г, Дербеневская наб, дом № 7, стр. 4

Тел.: +7 (495) 983-02-40; Факс.: +7 (495) 983-02-41

www.karlstorz.com

info-ru@karlstorz.com



Артикул:

TH120

P3H 2015/3274

Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации
и обработки изображения с принадлежностями

Срок действия: не ограничен

Наименование: Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S 4U

Изготовитель: Карл Шторц SE и Ко.КГ, Германия.

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34,
78532 Tuttlingen, Germany

Официальный дистрибьютор в России

Общество с ограниченной ответственностью

КАРЛ ШТОРЦ - Эндоскопы ВОСТОК

115114, Москва г, Дербеневская наб. дом № 7, стр. 4

Тел.: +7 (495) 983-02-40; Факс.: +7 (495) 983-02-41

www.karlstorz.com

info-ru@karlstorz.com



ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО
ЛИСТОЗ

29/10/2017
г.в.в.в.

