

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «Научно-производственная
фирма «ВИНАР»



В.С. Андреев

2019 г

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МедИС-В
ТУ 9398-032-11764404-2004

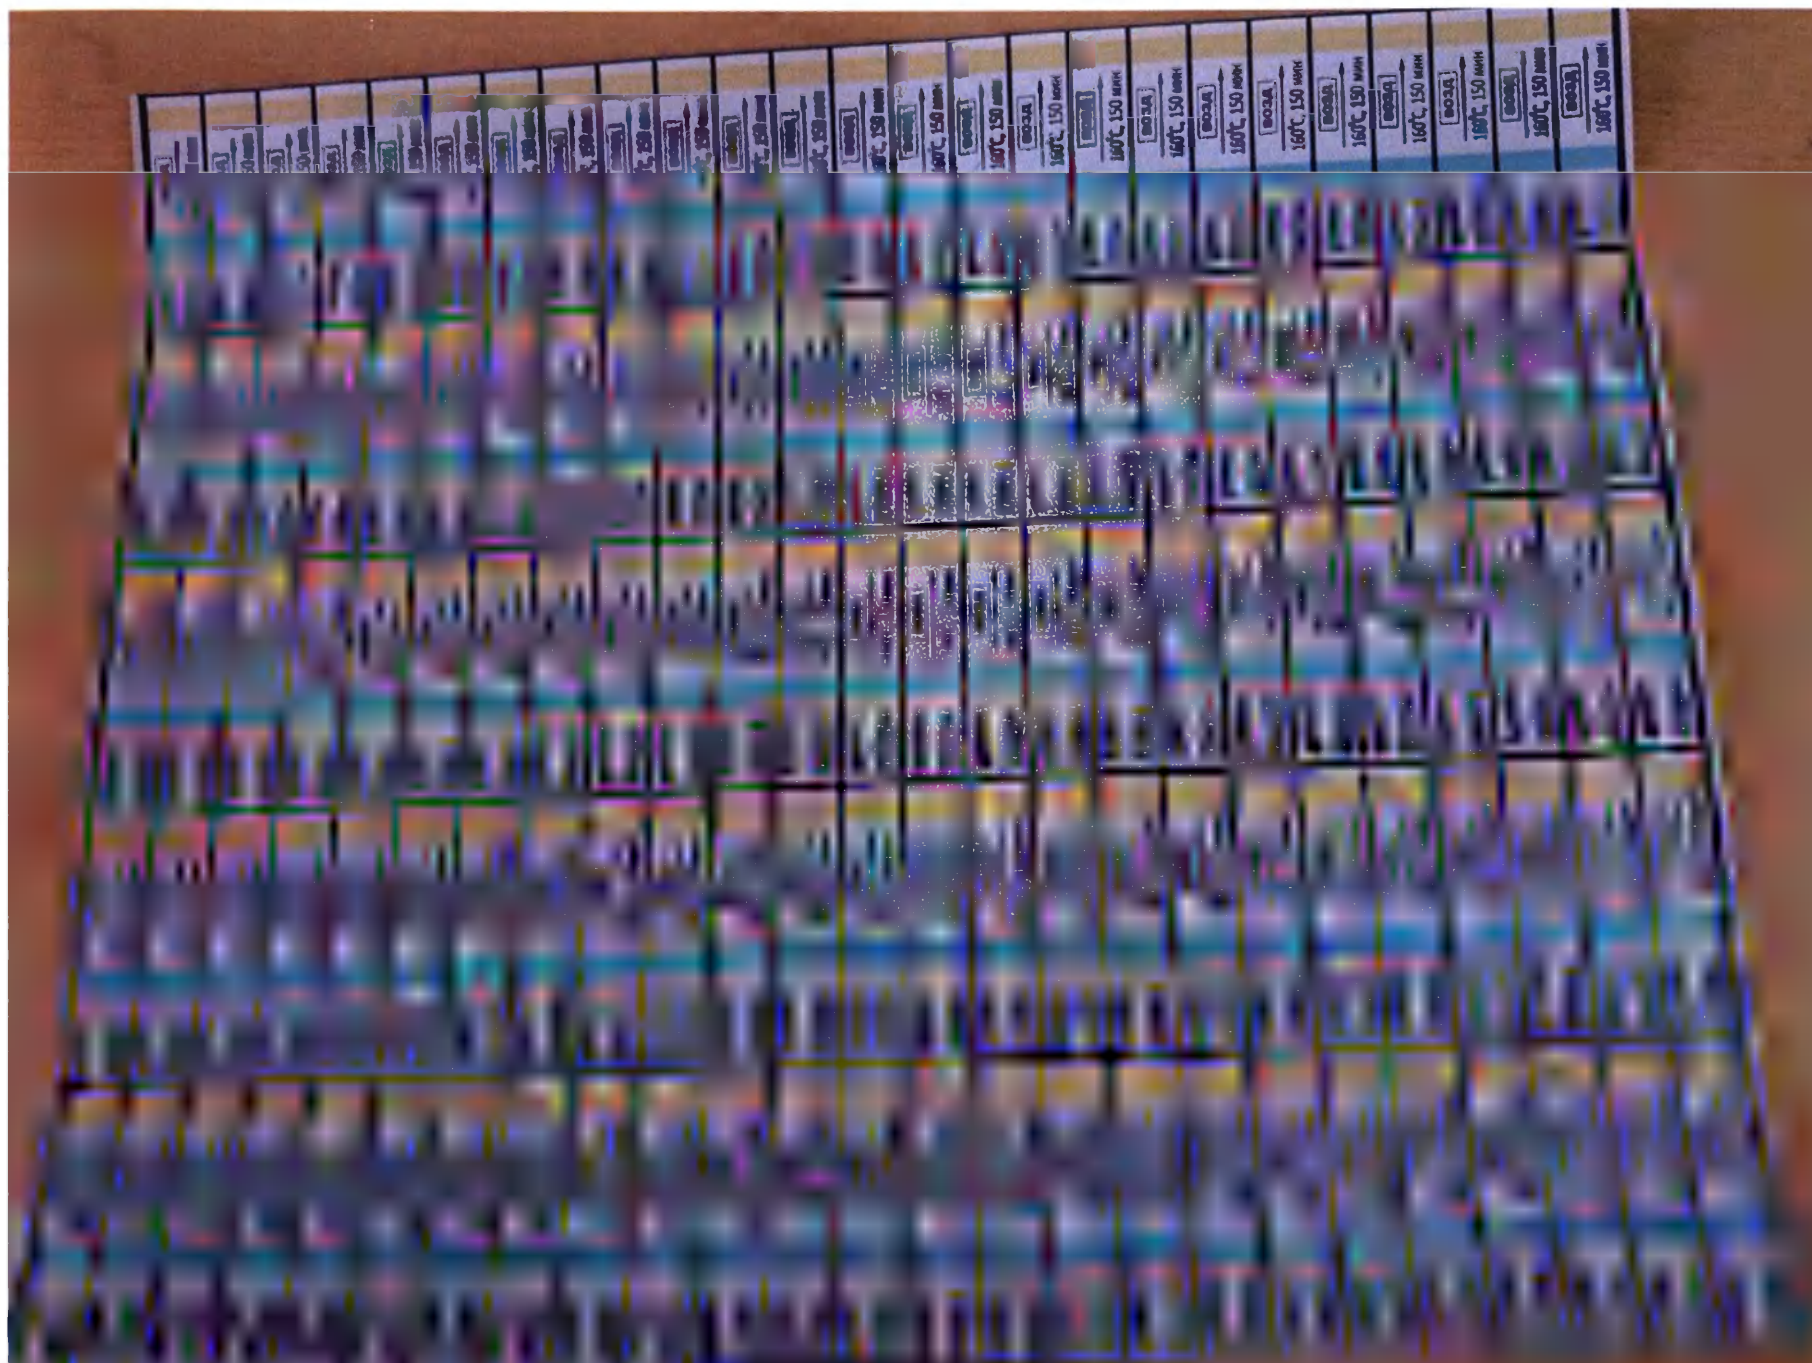



Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИС-В

МедИС-В-160/150

кол-во: 250 шт.

ТУ 9398-032-11764404-2004

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ФСР 2009/04944 от 06.03.2013 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
-Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

8093118

Ноя 2018



индикаторы химические одноразовые воздушной стерилизации МедИС-В-160/150 по ТУ 9398-032-11764404-2004



ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
МедИС-В-160/150

КОЛ-ВО: 250 шт.

ТУ 9398-032-11764404-2004
 ГОСТ ISO 11140-1:2011 (измен. 1)
 Пер. утв. № 607 2009/04/04 от 06.01.2013 г.
 Гарантийный срок годности 36 месяцев.
 Качество в упаковке сохраняется при 100% относительной влажности воздуха при 5-25 °С в течение всего срока годности.
 Срок годности не зависит от даты изготовления.
 Беречь от влаги.



ПАРТИЯ	8033118
ДАТА ПОСЛЕДНЕГО РЕМОНТА	ноябрь 2018
КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ	80
МАССА БРУТТО	50,0 кг

Государственное предприятие «Бирма» с адресом: 100 000, г. Москва, Россия, ул. Бирма, д. 1, стр. 10, пом. 101.
 Тел./факс: +7 (495) 784 7847, e-mail: info@birma.ru
 Для заказа: 800 44 11111, Москва, 810 20, e-mail: info@birma.ru



[illegible]



Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МедИС-В

МедИС-В-160/150-1

кол-во: 250 шт.

ТУ 9398-032-11764404-2004
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег.уд. № ФСР 2009/04944 от 06.03.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до -40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
-Научно-производственная фирма -ВИНАР- (ООО -НПФ -ВИНАР-)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМП ОТК

8 0 9 3 1 0 8

ОКТ 2018



ГОСТ 150-1 ГОСТ 9398-03-2-11/04404-2004



ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ИЗДАНИЕ №2013

МЕДИС-В-160/150-1

КОЛ-ВО: 250 шт.

ТУ 9398-032-11/04404-2004
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (корисс 4)
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (корисс 4)
Рег. уд. № ФСР 2009/04944 от 06.03.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев
Хранить в упаковке производителя не более 80% от 25 °С в защищенном от света месте.
Беречь от влаги.

2 B0321 C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ВНЕДР»
125040, Россия (495) Москва, Голубинский ул., д. 30, стр. 7А, пом. VIII
тел./факс: 1090041, Россия

ПАРТИЯ	8093108
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	04.10.2018
КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ	40
МАССА БРУТТО	10,0 кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от влаги, света, пыли, температуры от 5 до 25 °С, относительная влажность не более 80%.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

Лист 06

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»


В.С. Андреев

