


8. Приложение 1:



Анализатор гематологический автоматический URIT-2900Plus.
Вид спереди
Фото 1

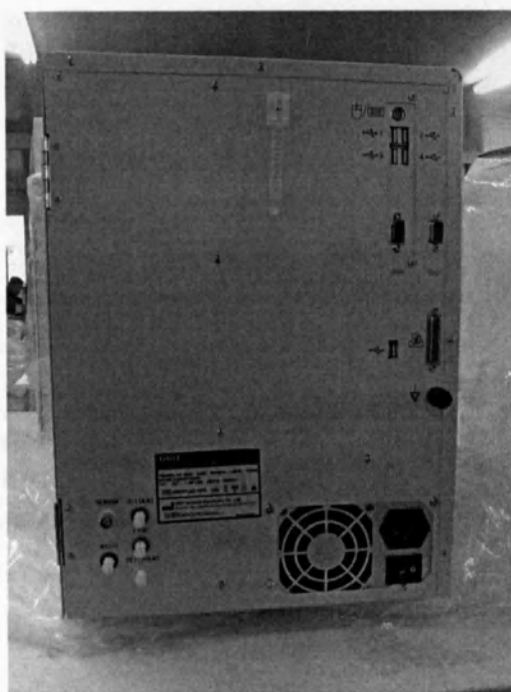

Анализатор гематологический автоматический URIT-2900Plus.
Вид сзади
Фото 2

Акт приемочных технических испытаний

№ 029/ПТИ-12

от 28.02.2012 г. на 6 листах

Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения
ИЛЦ ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России