



Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 100 мл (вид 152430)




Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 160 мл (вид 152430)

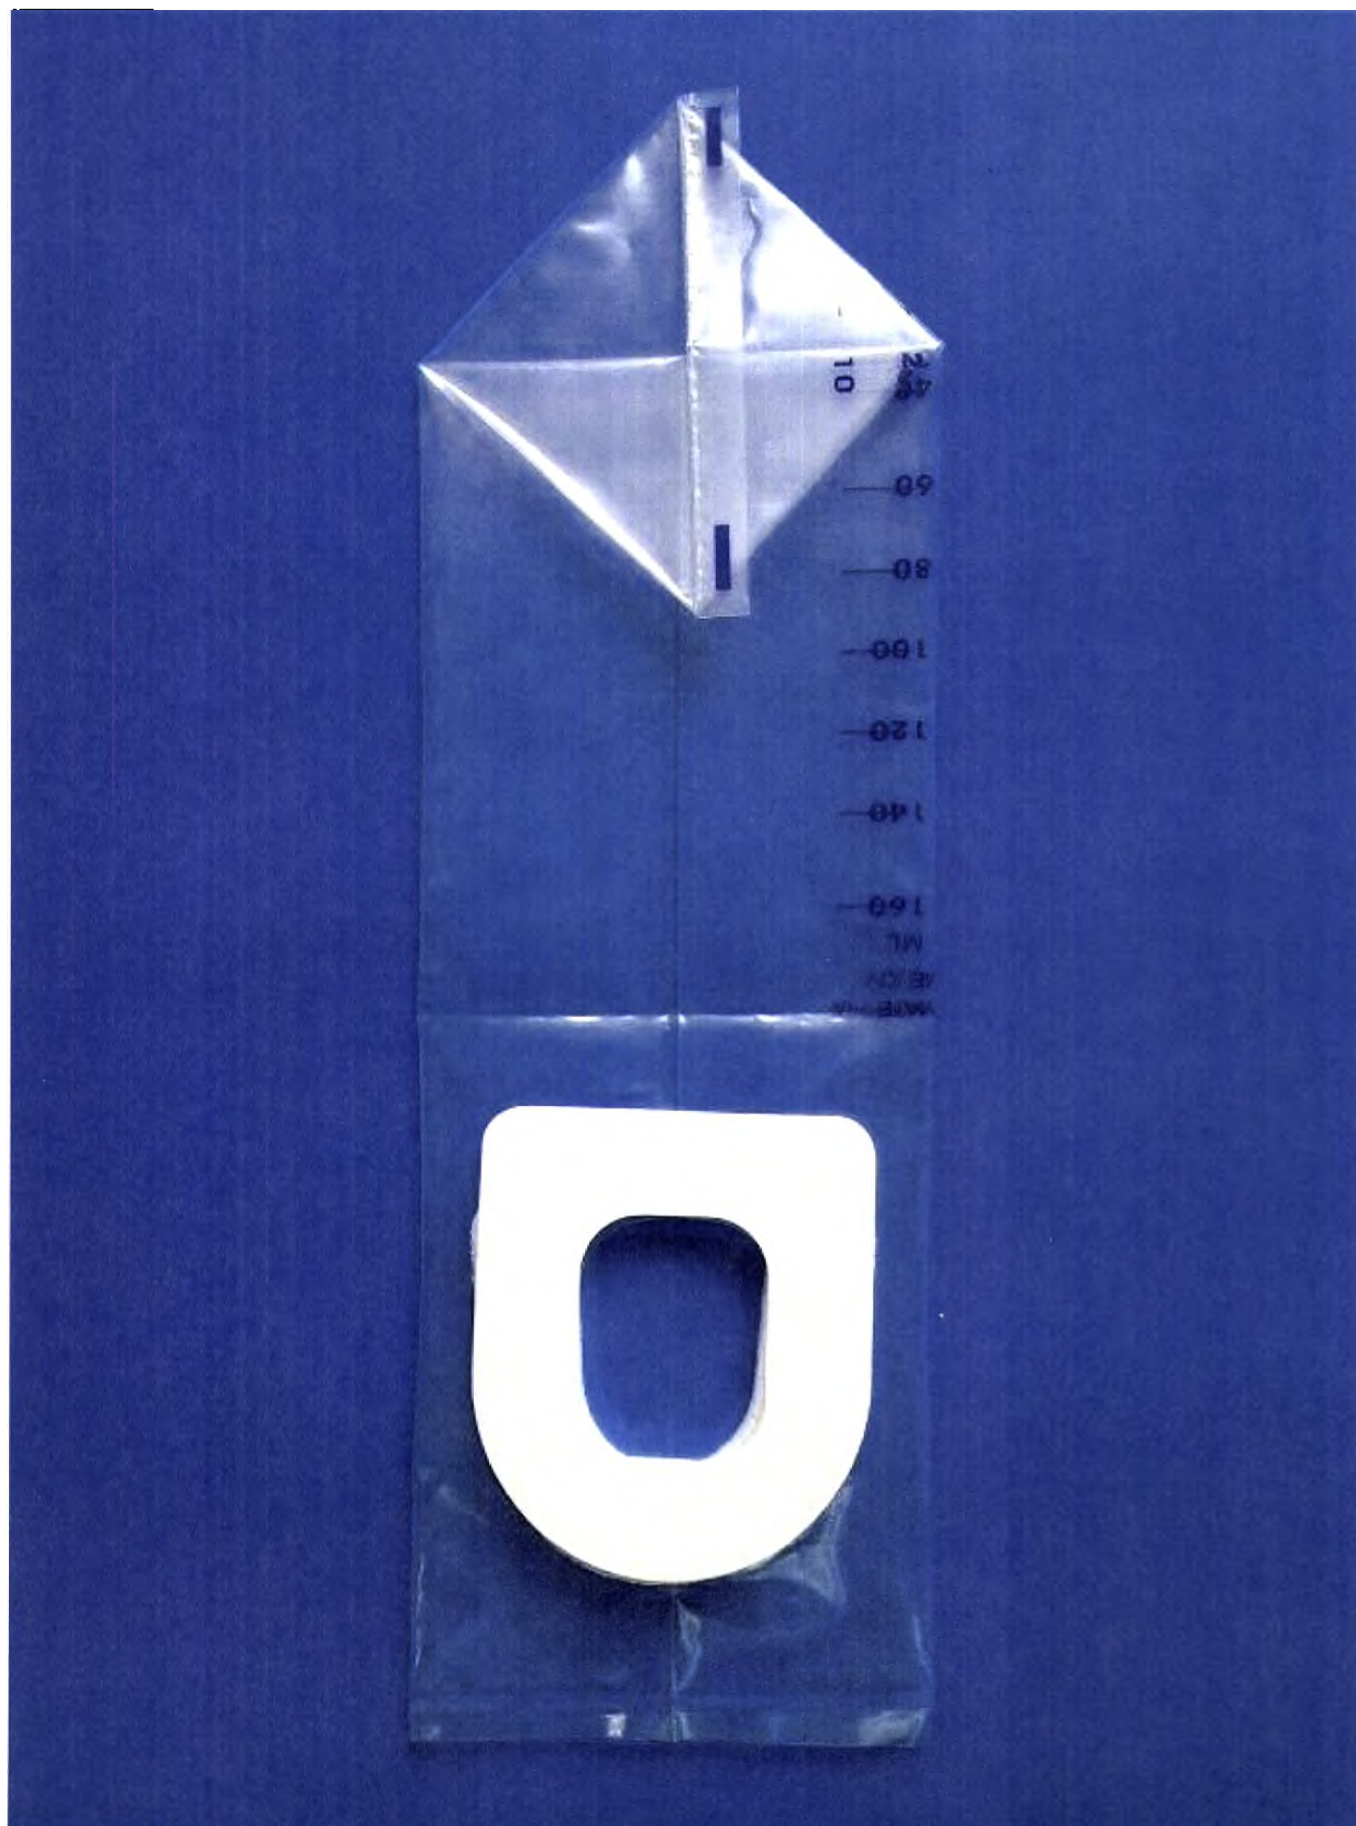


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 200 мл (вид 152430)

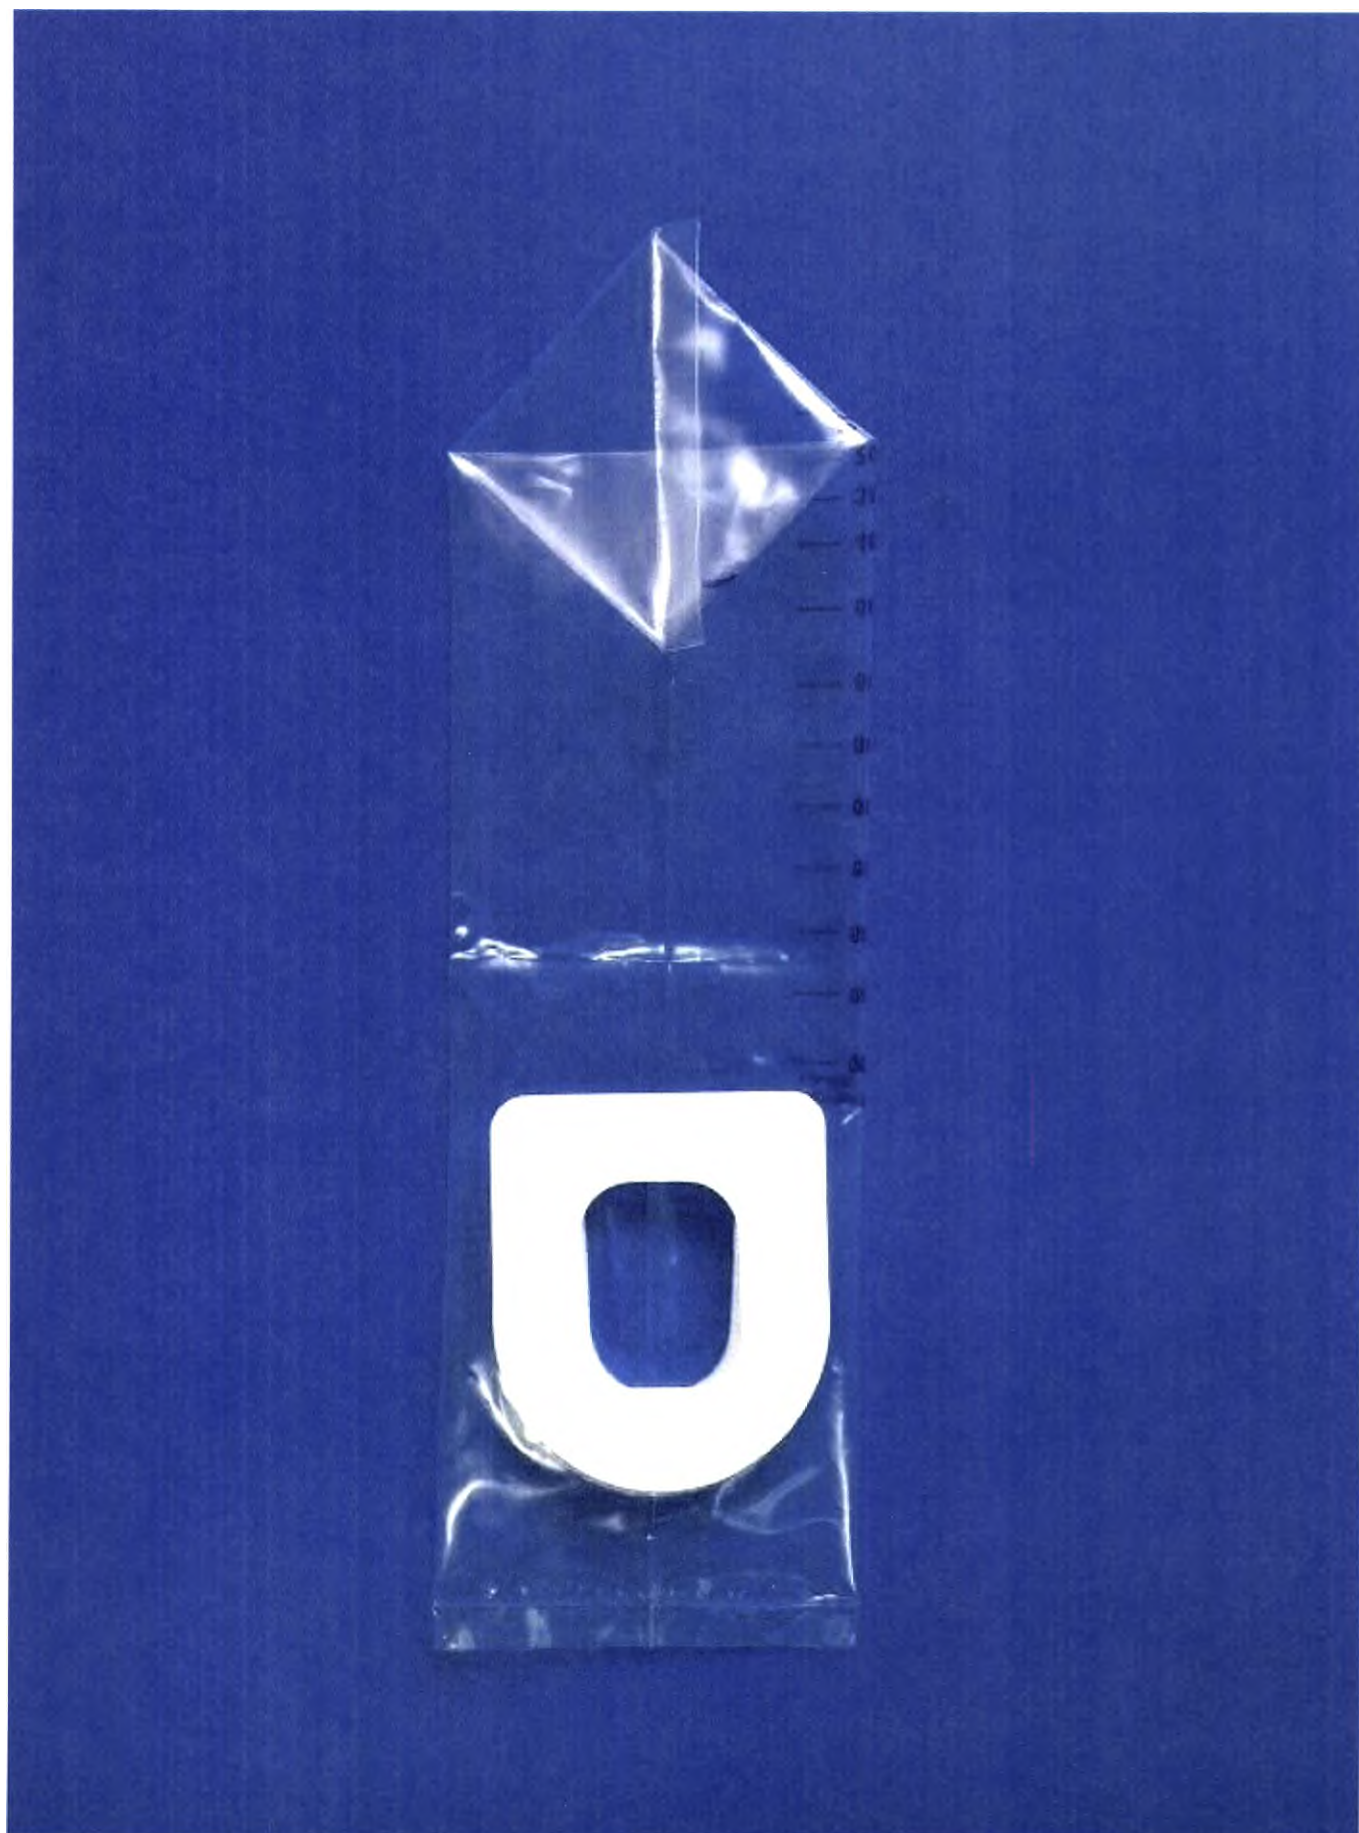


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 500 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (вид 156390)

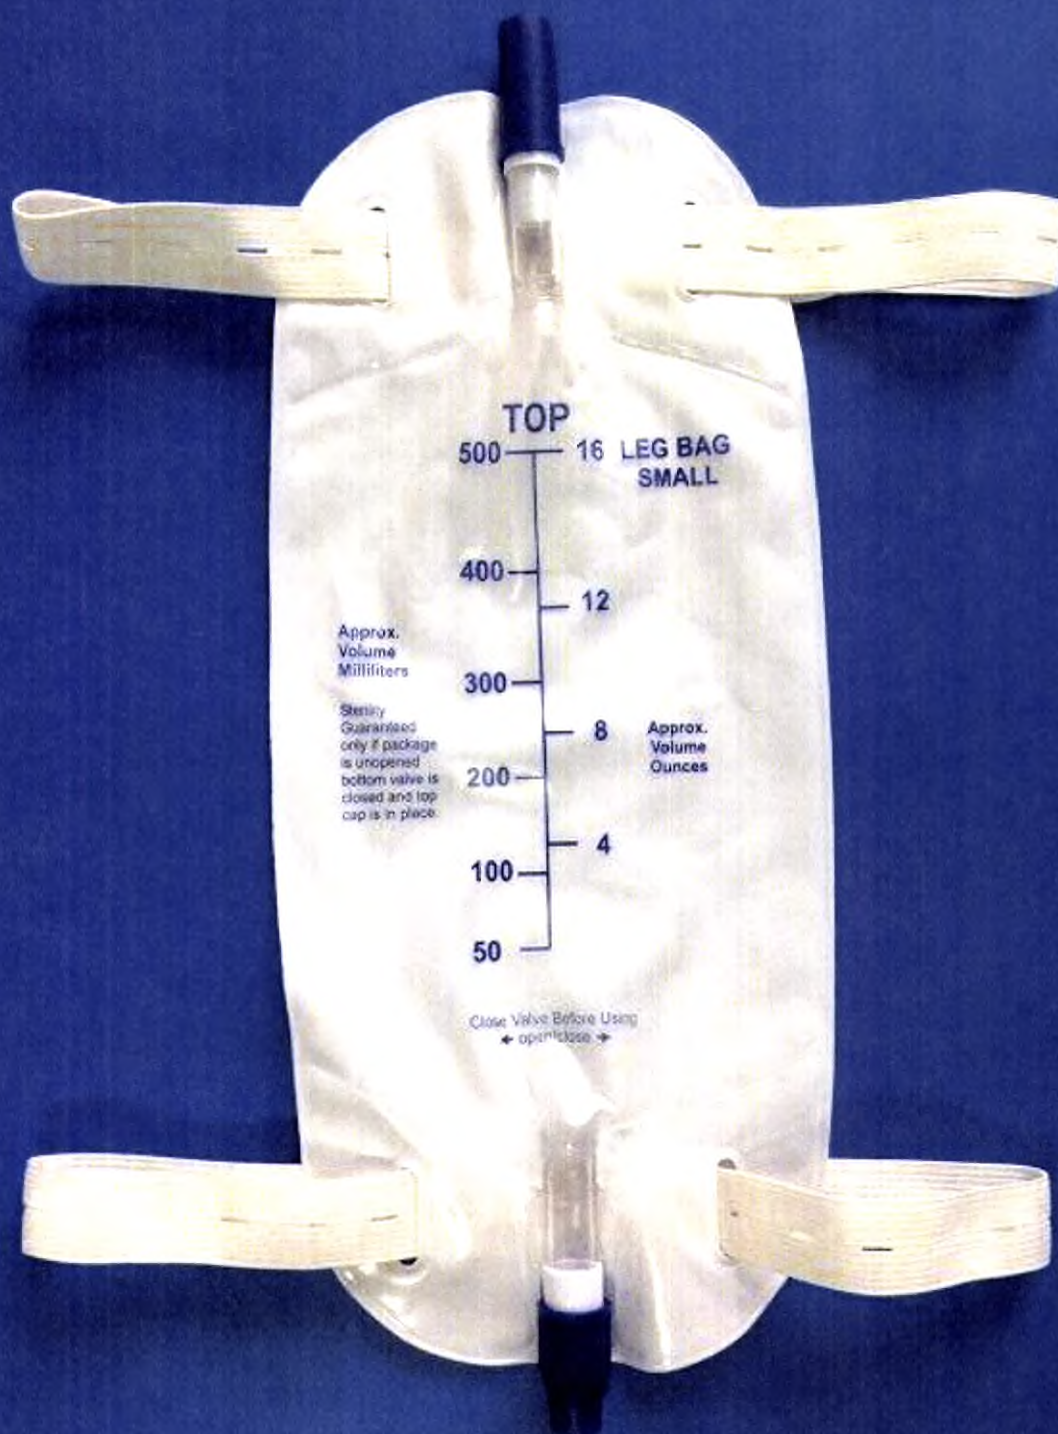


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 500 мл с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого (вид 156390)

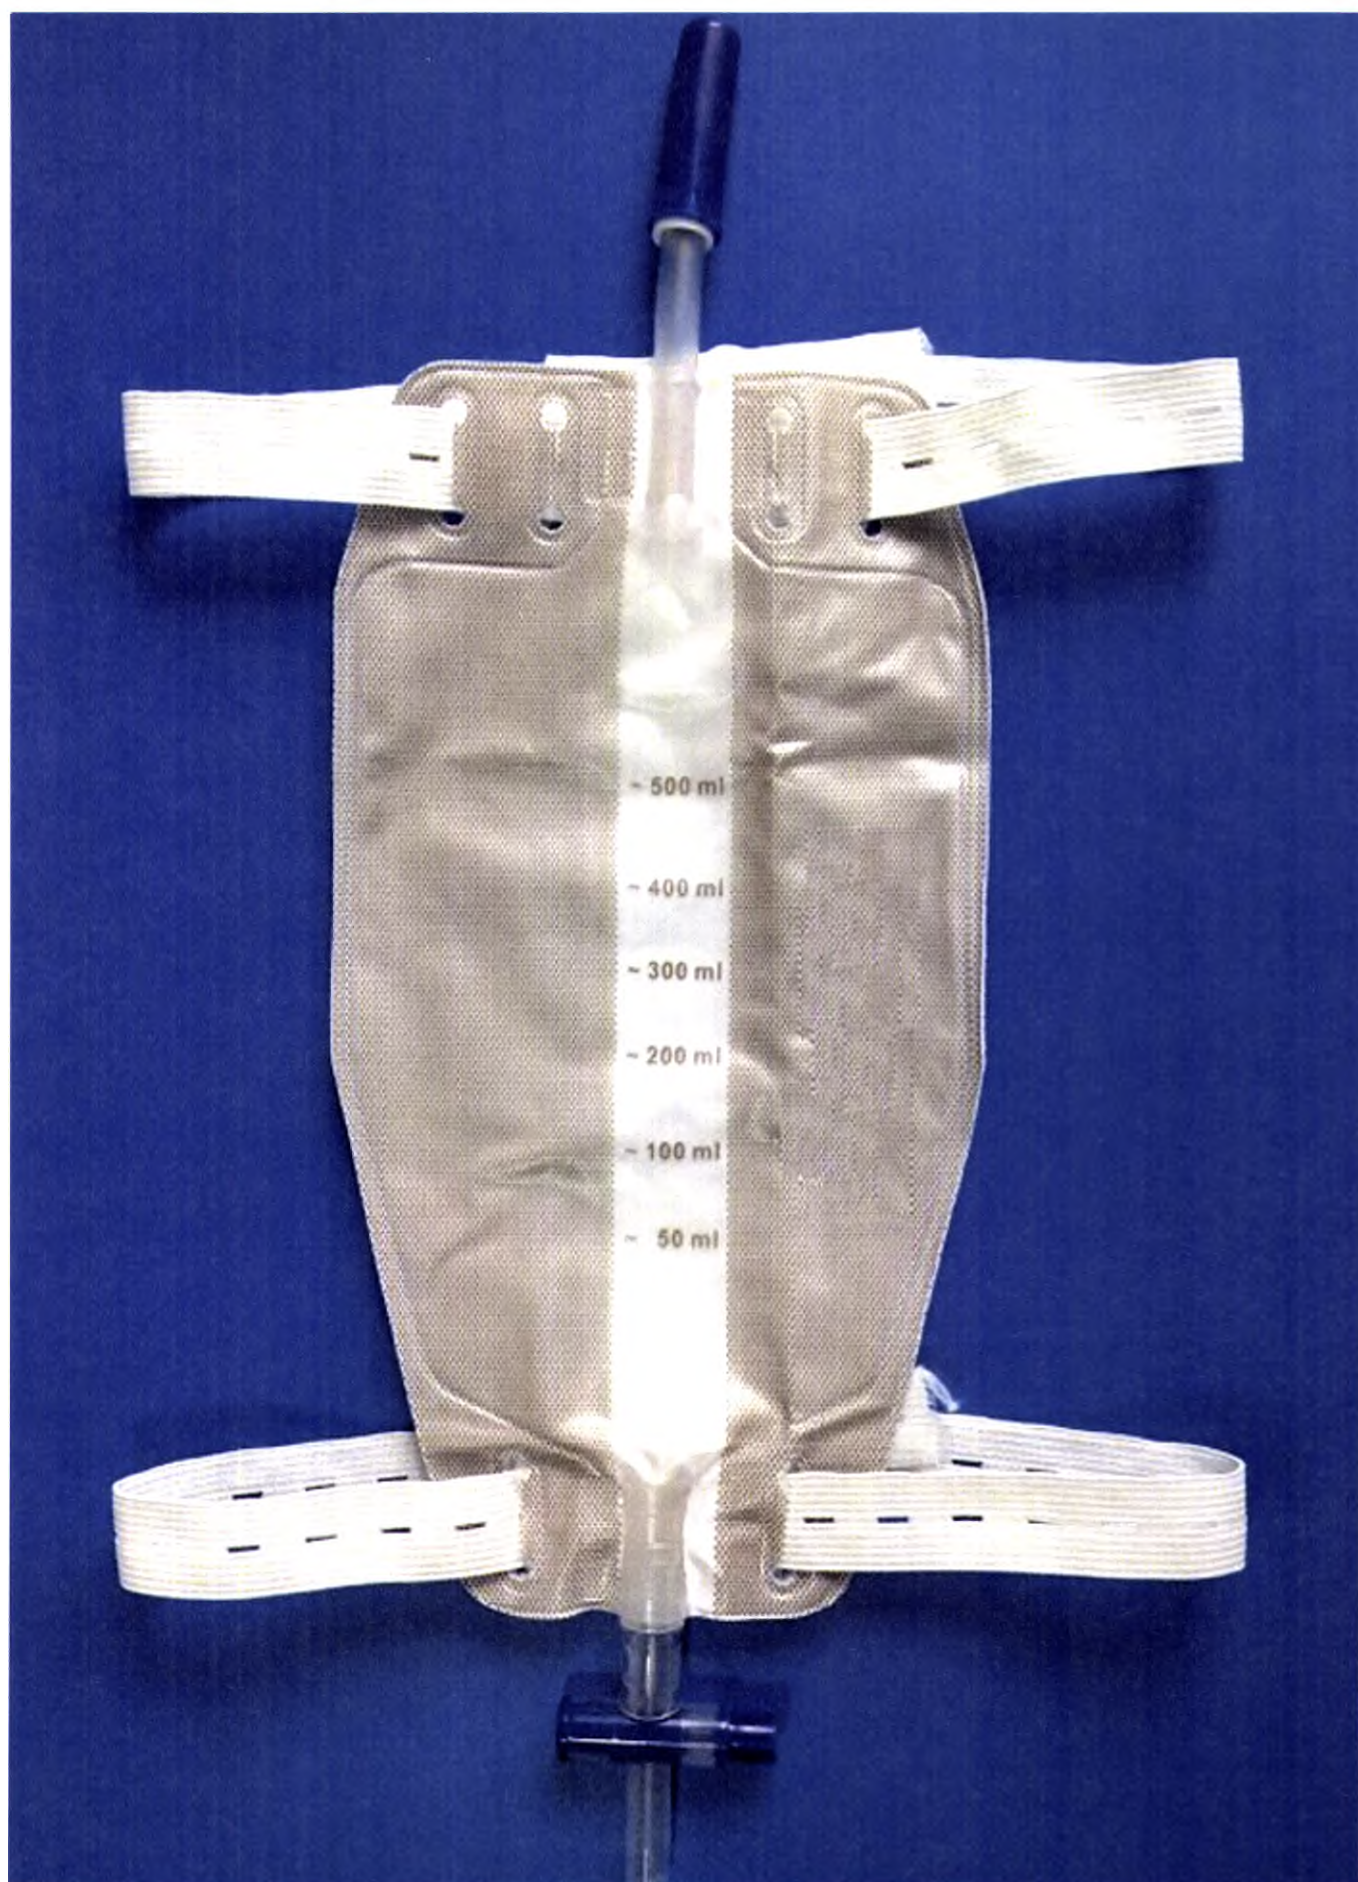


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 600 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (вид 156390)

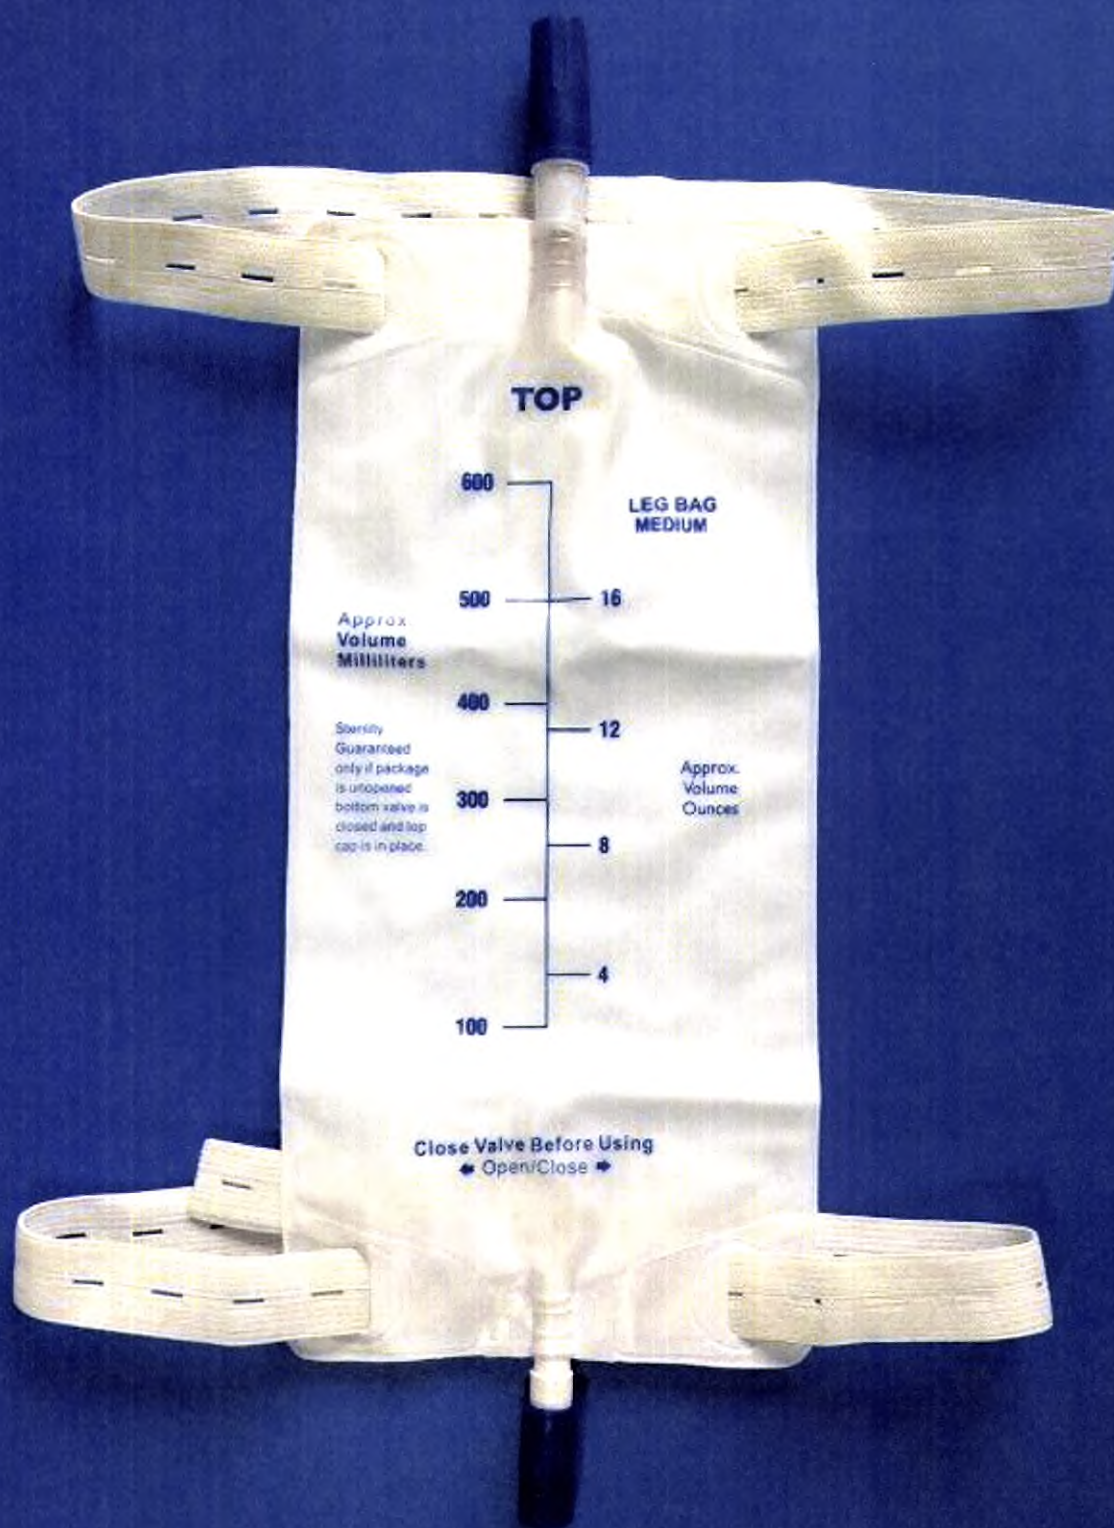

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 750 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156390)

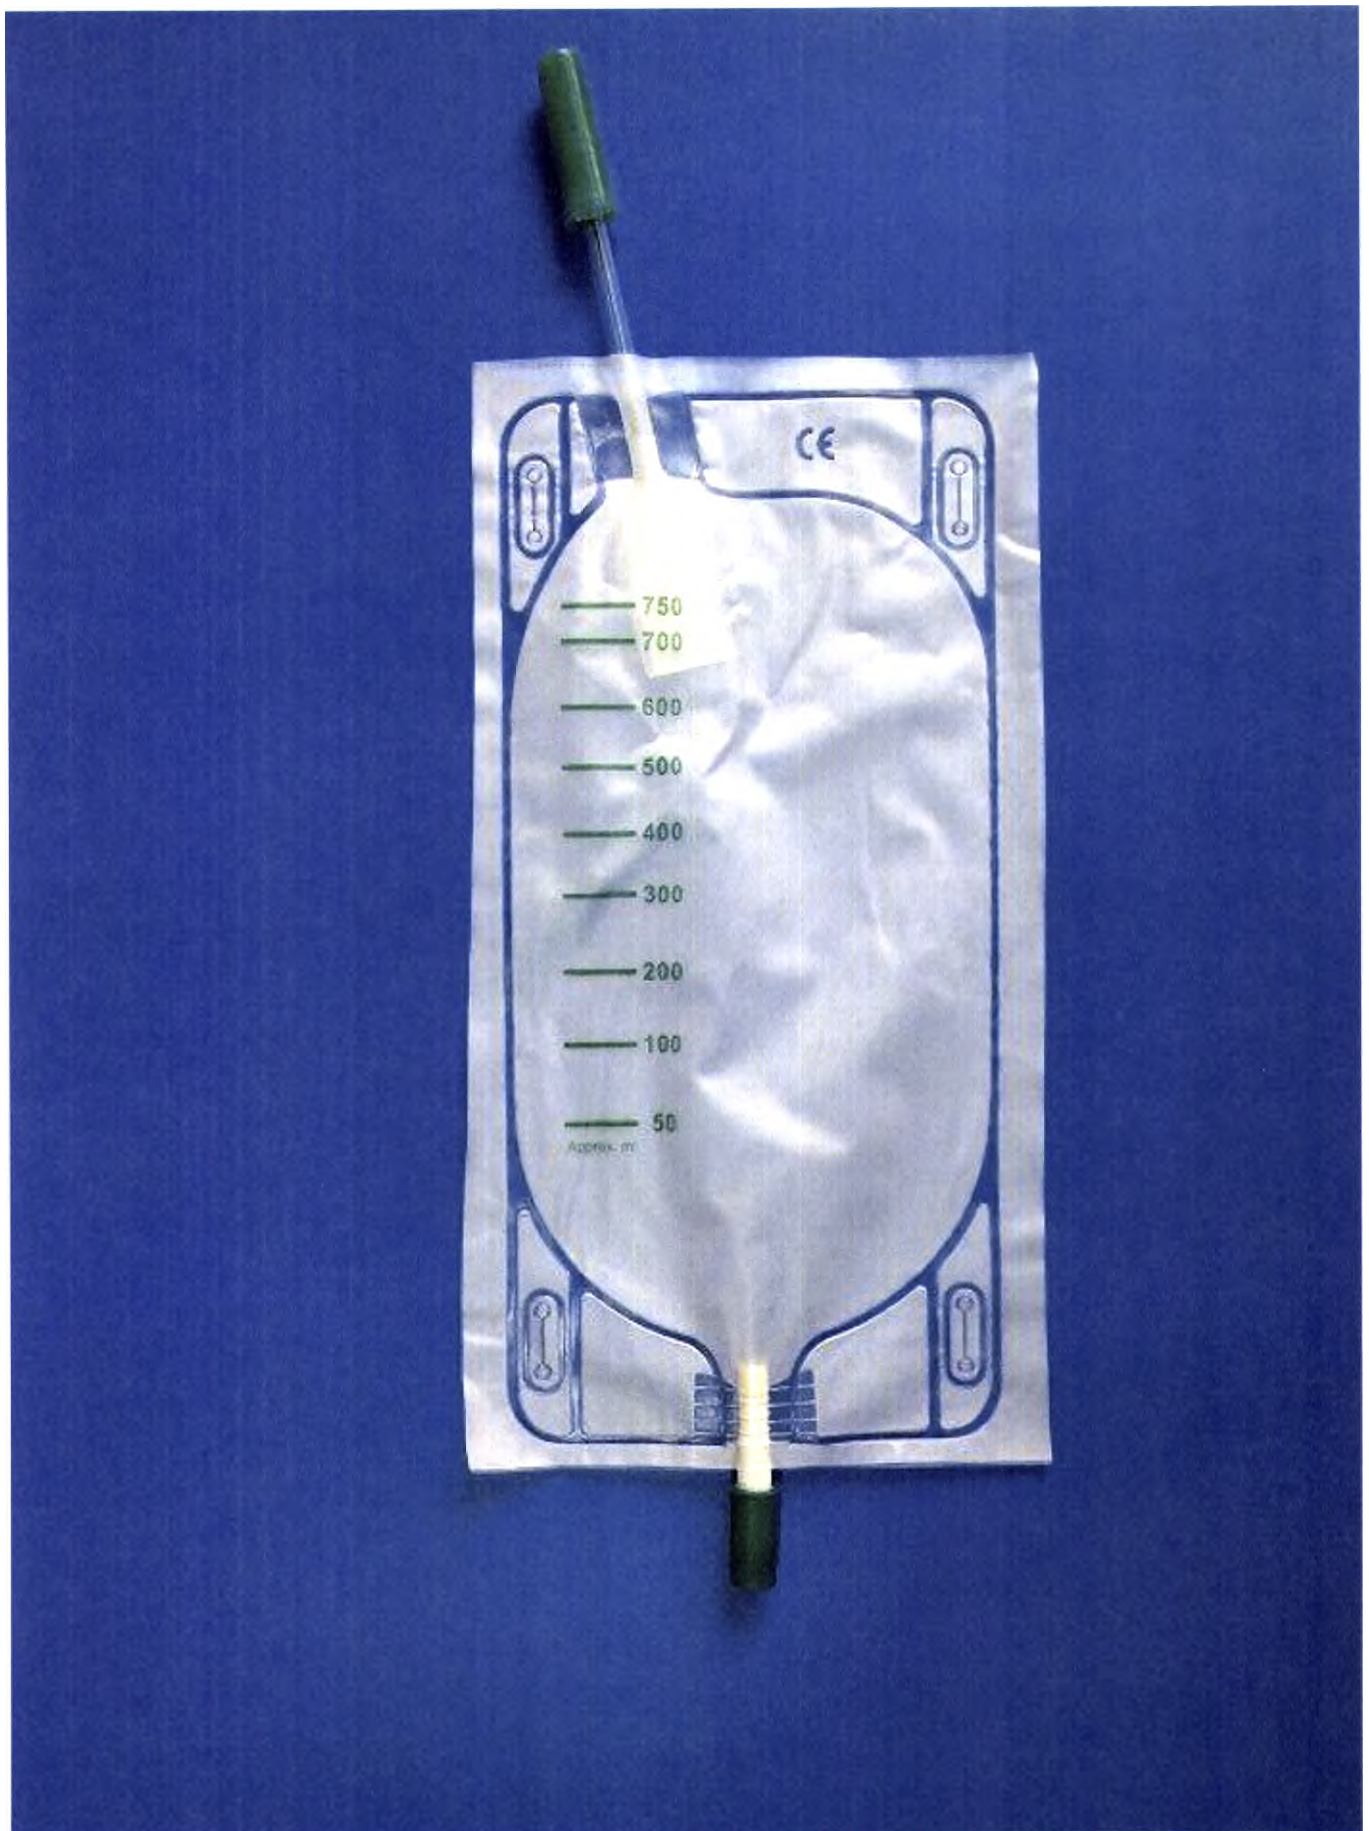


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 750 мл с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156390)

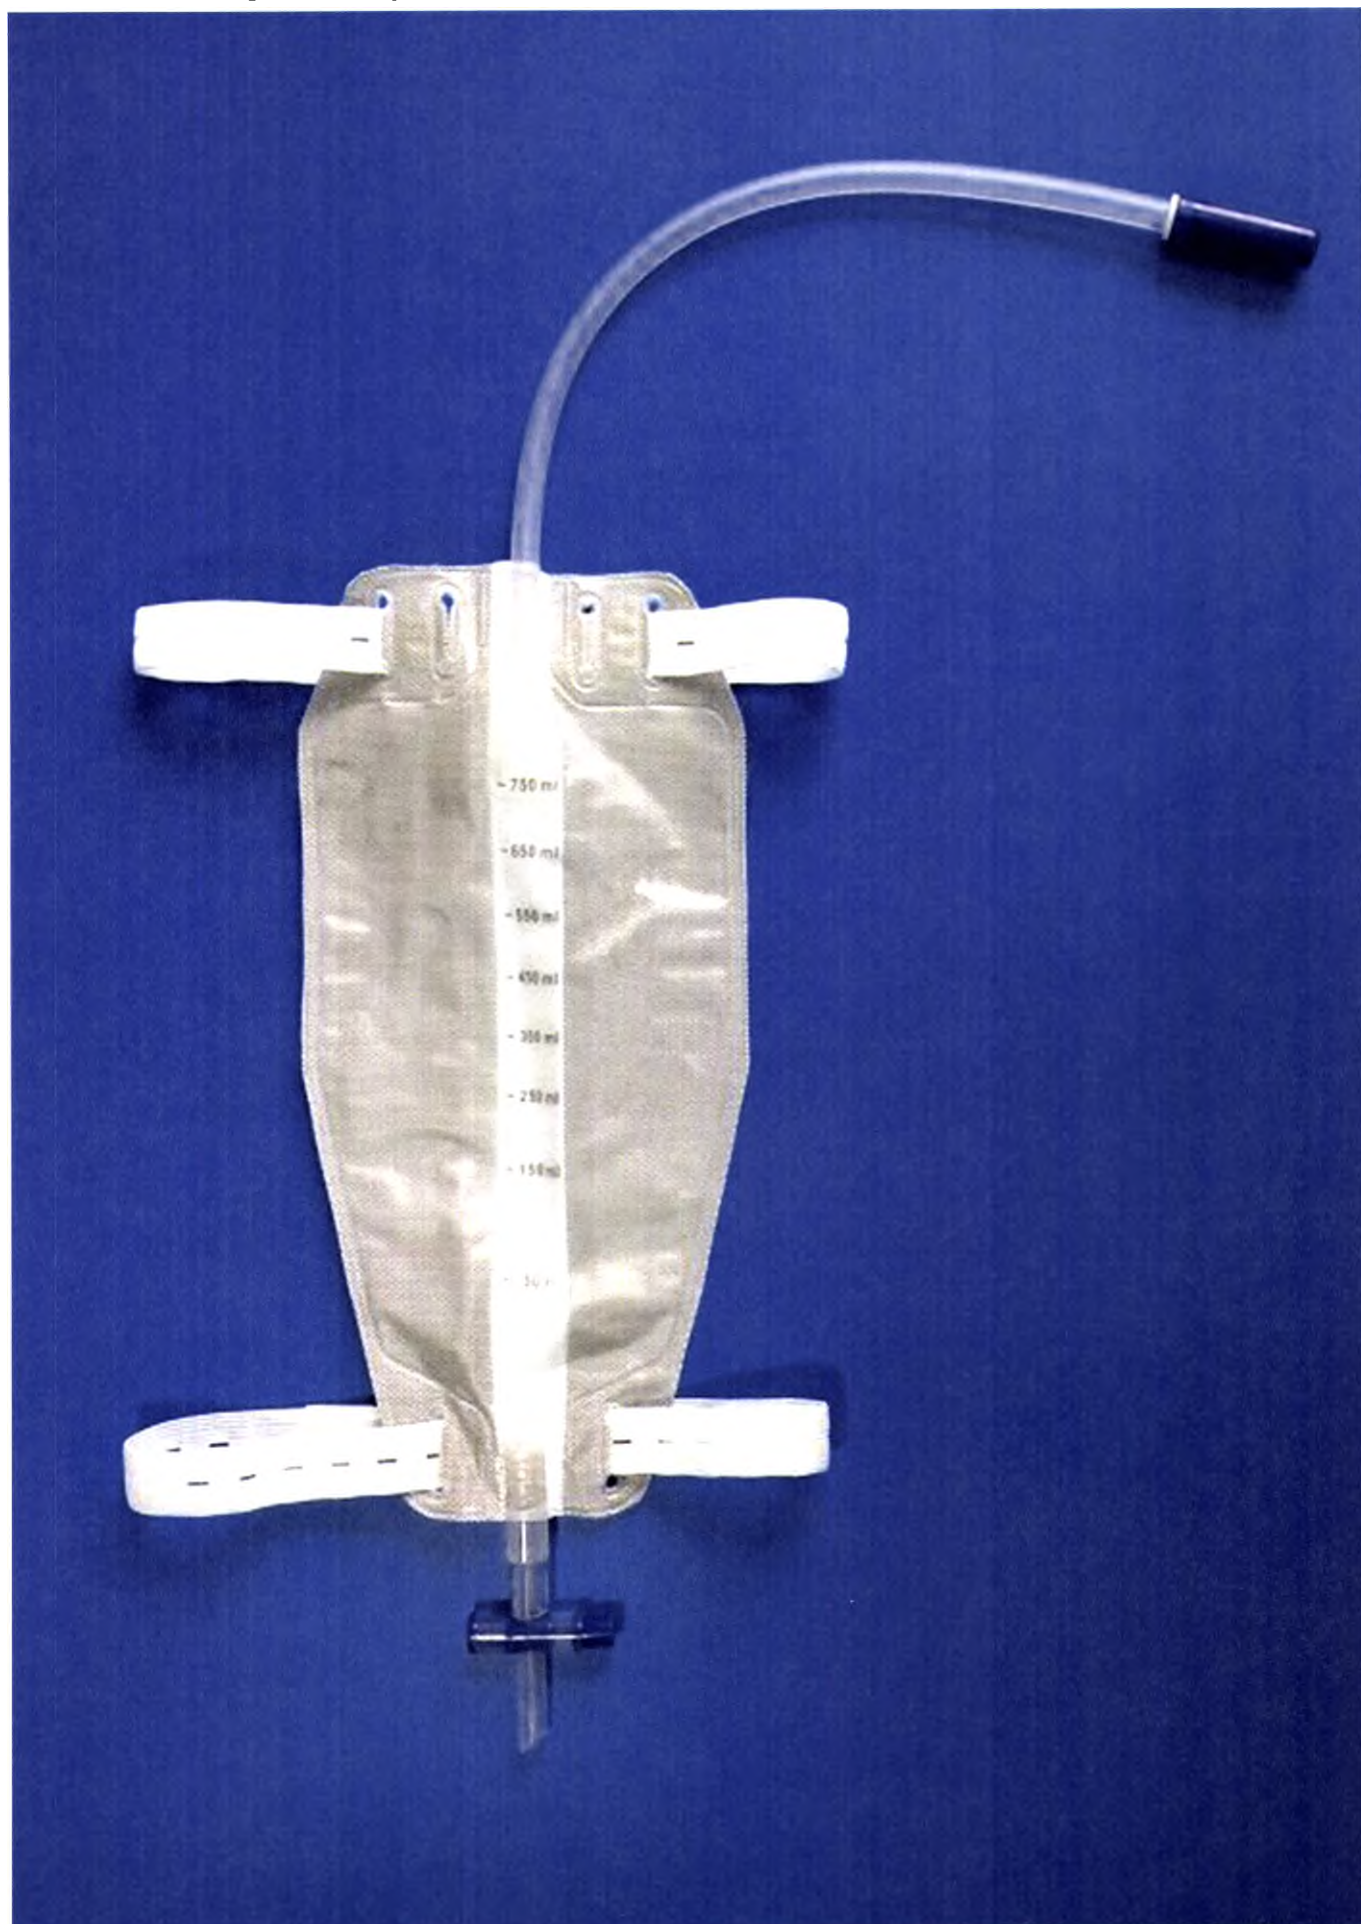


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 800 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (вид 156390)




Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 900 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (вид 156390)

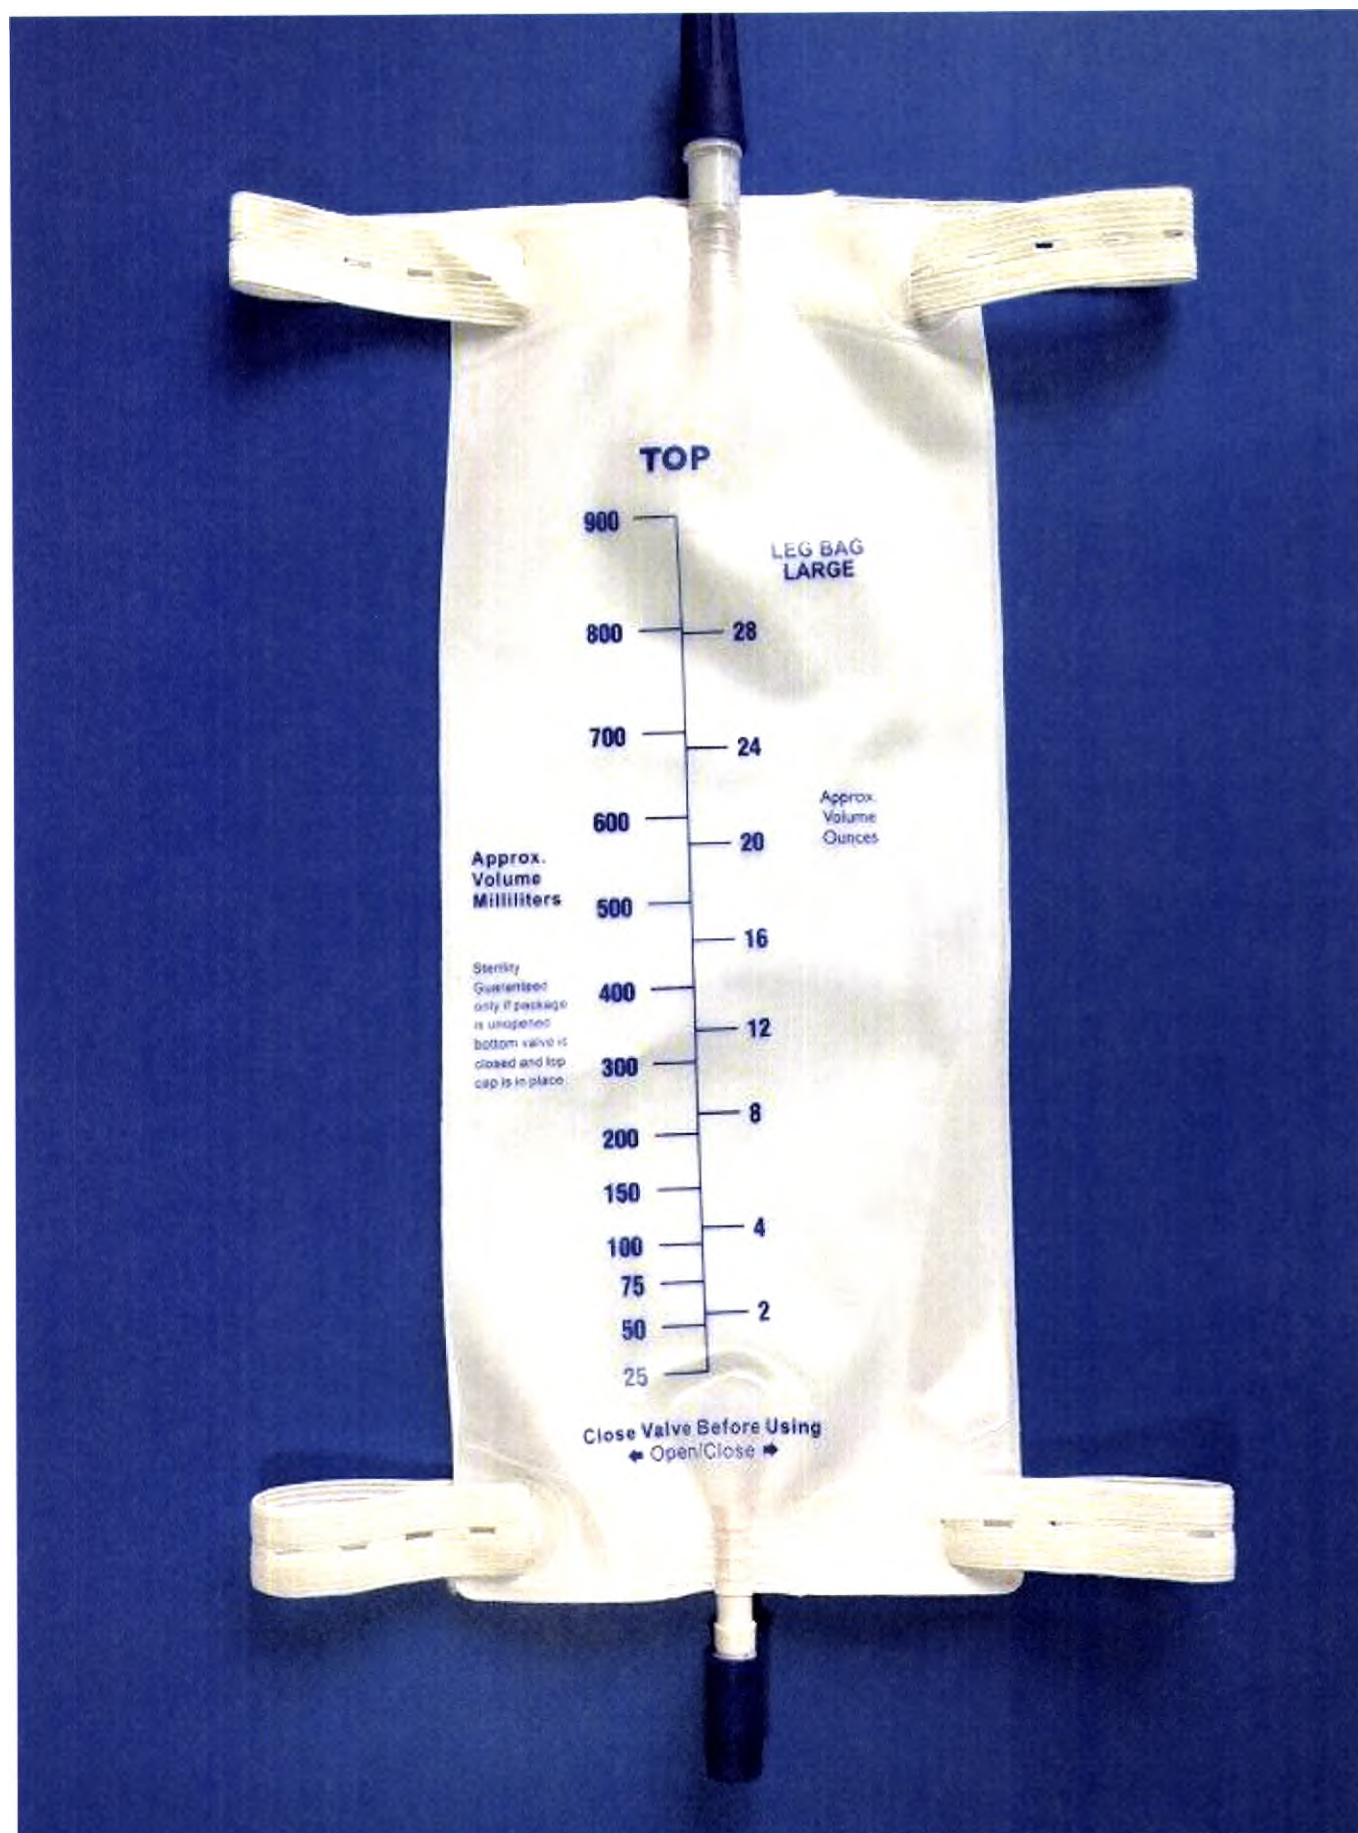


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1000 мл с прямым краном для слива  
содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

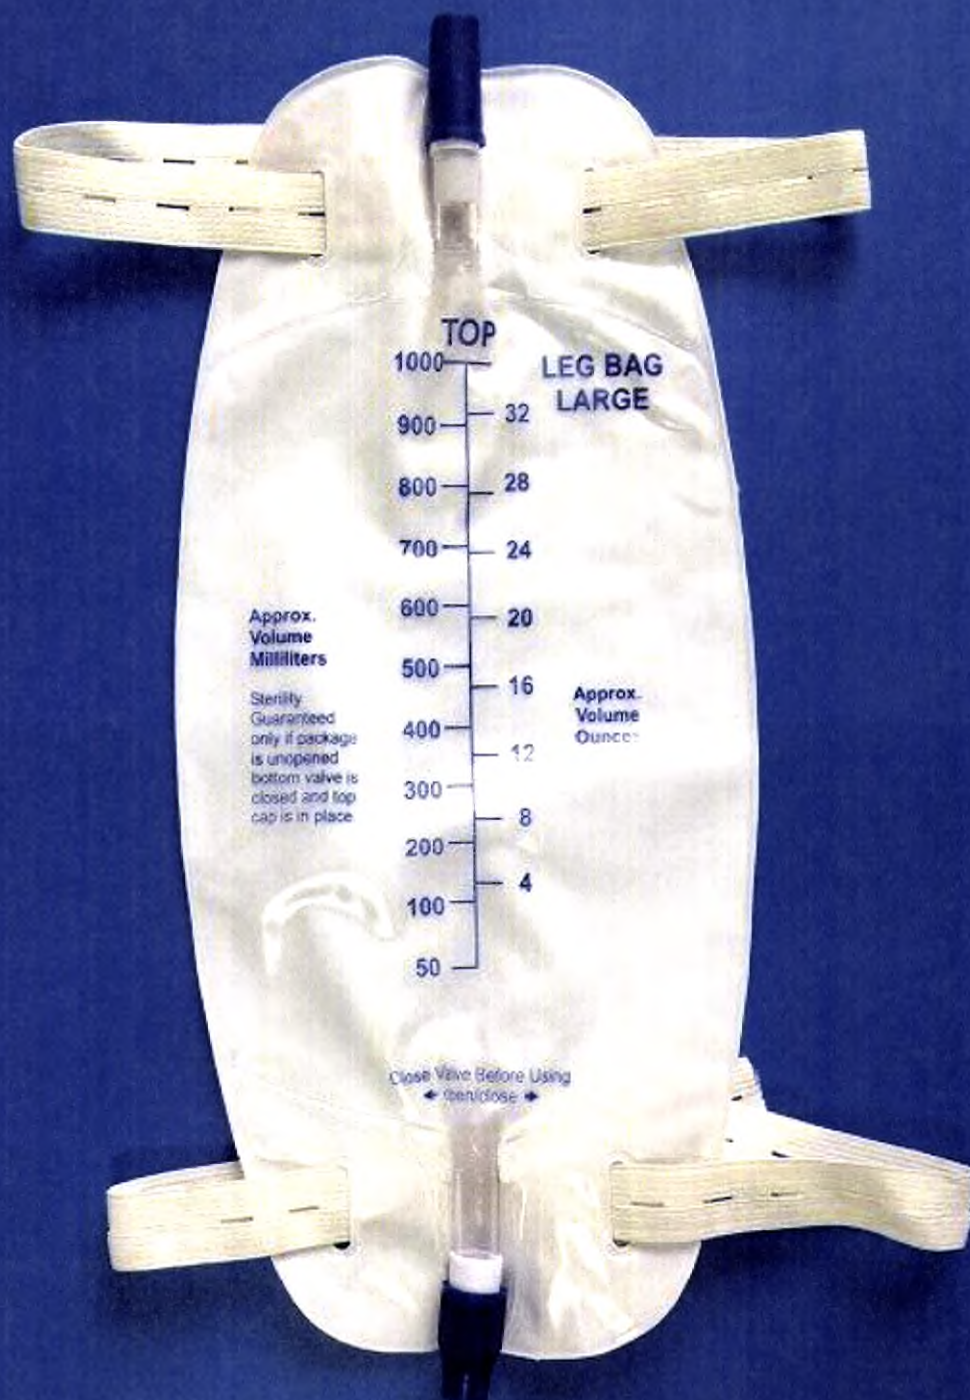


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1000 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

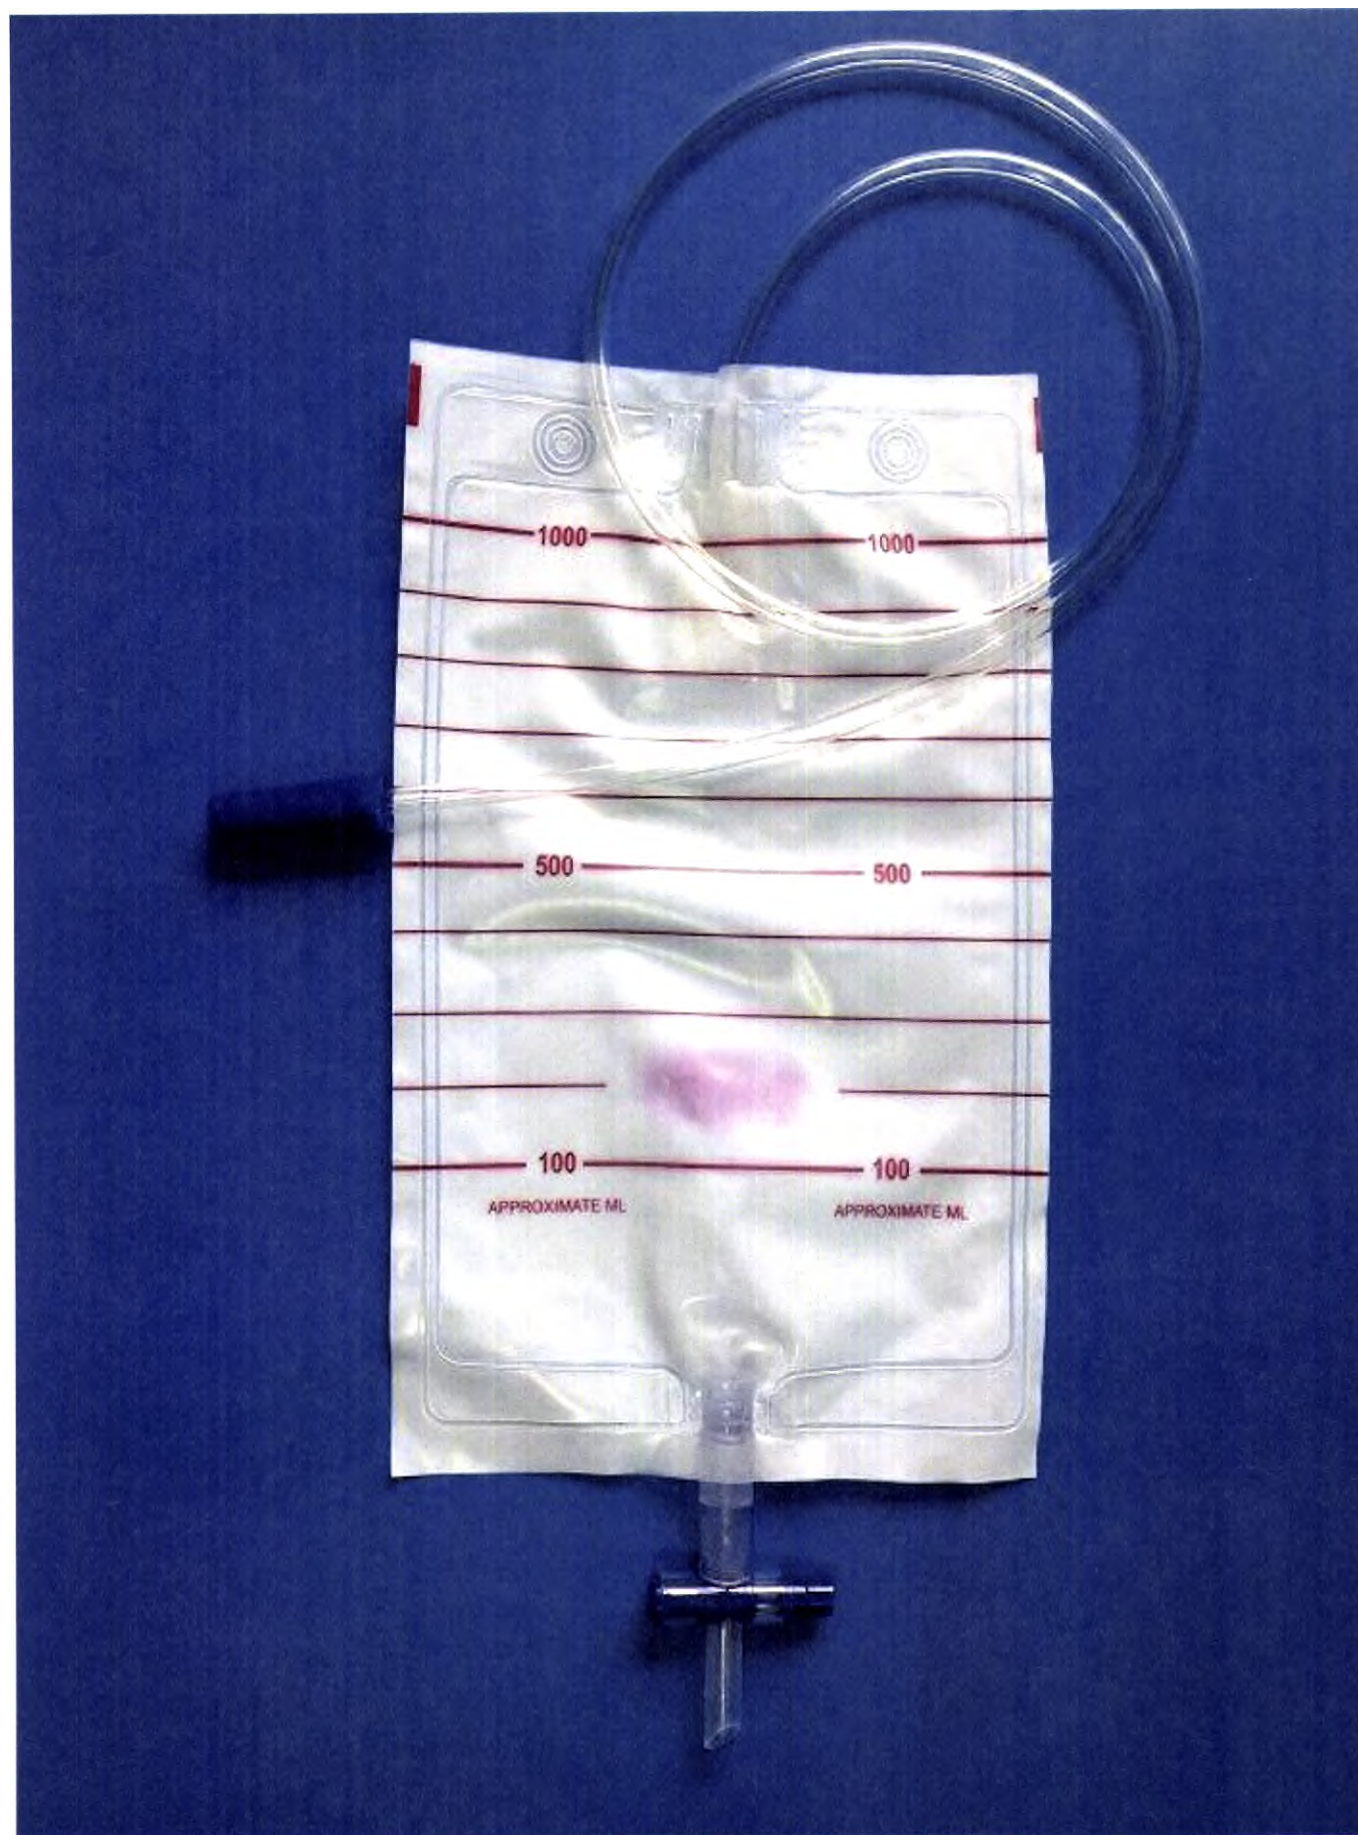


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1000 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (вид 156390)

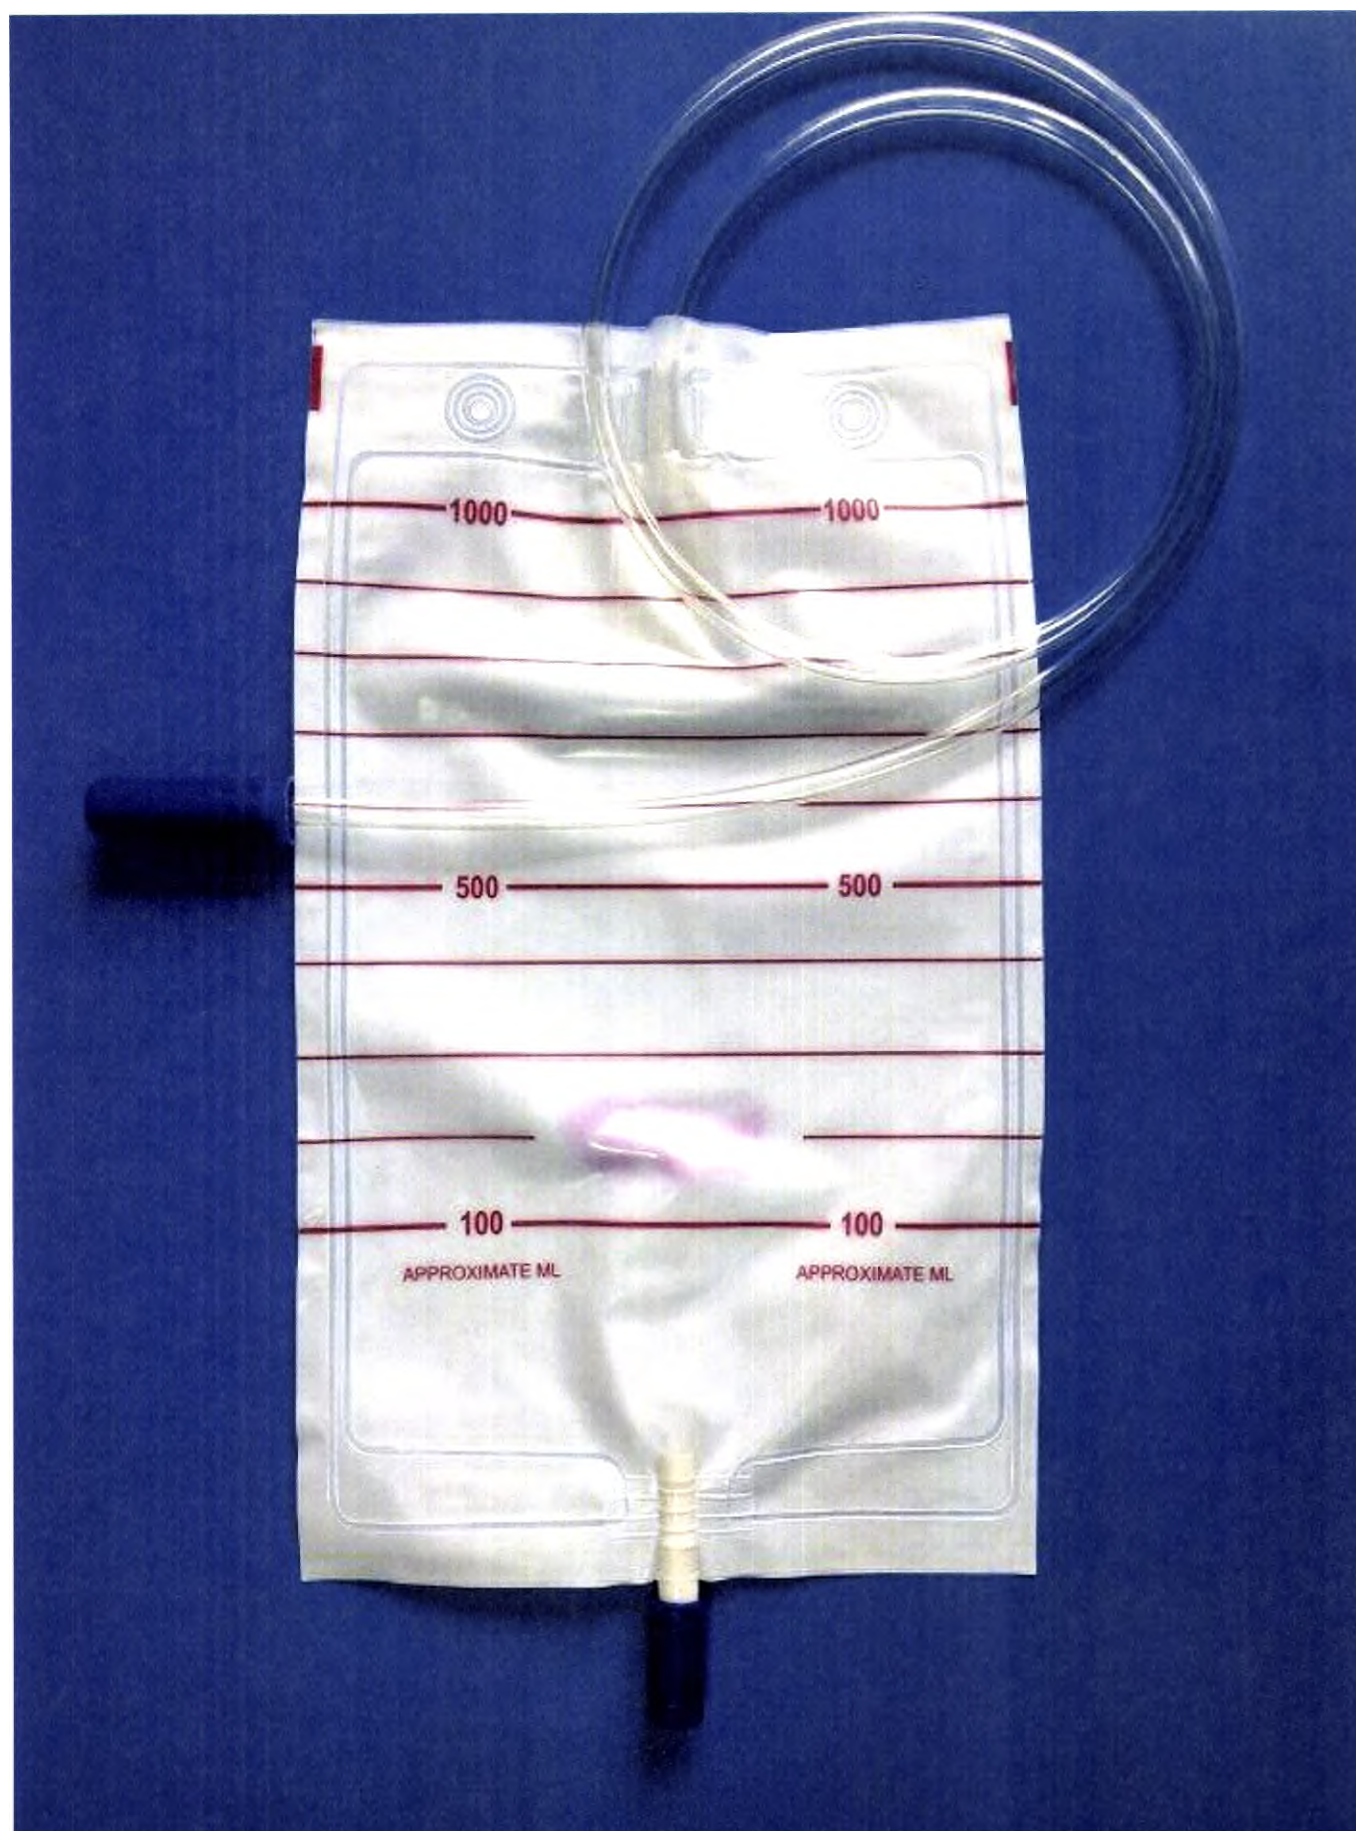


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1500 мл, с приводной трубкой (вид 152470)

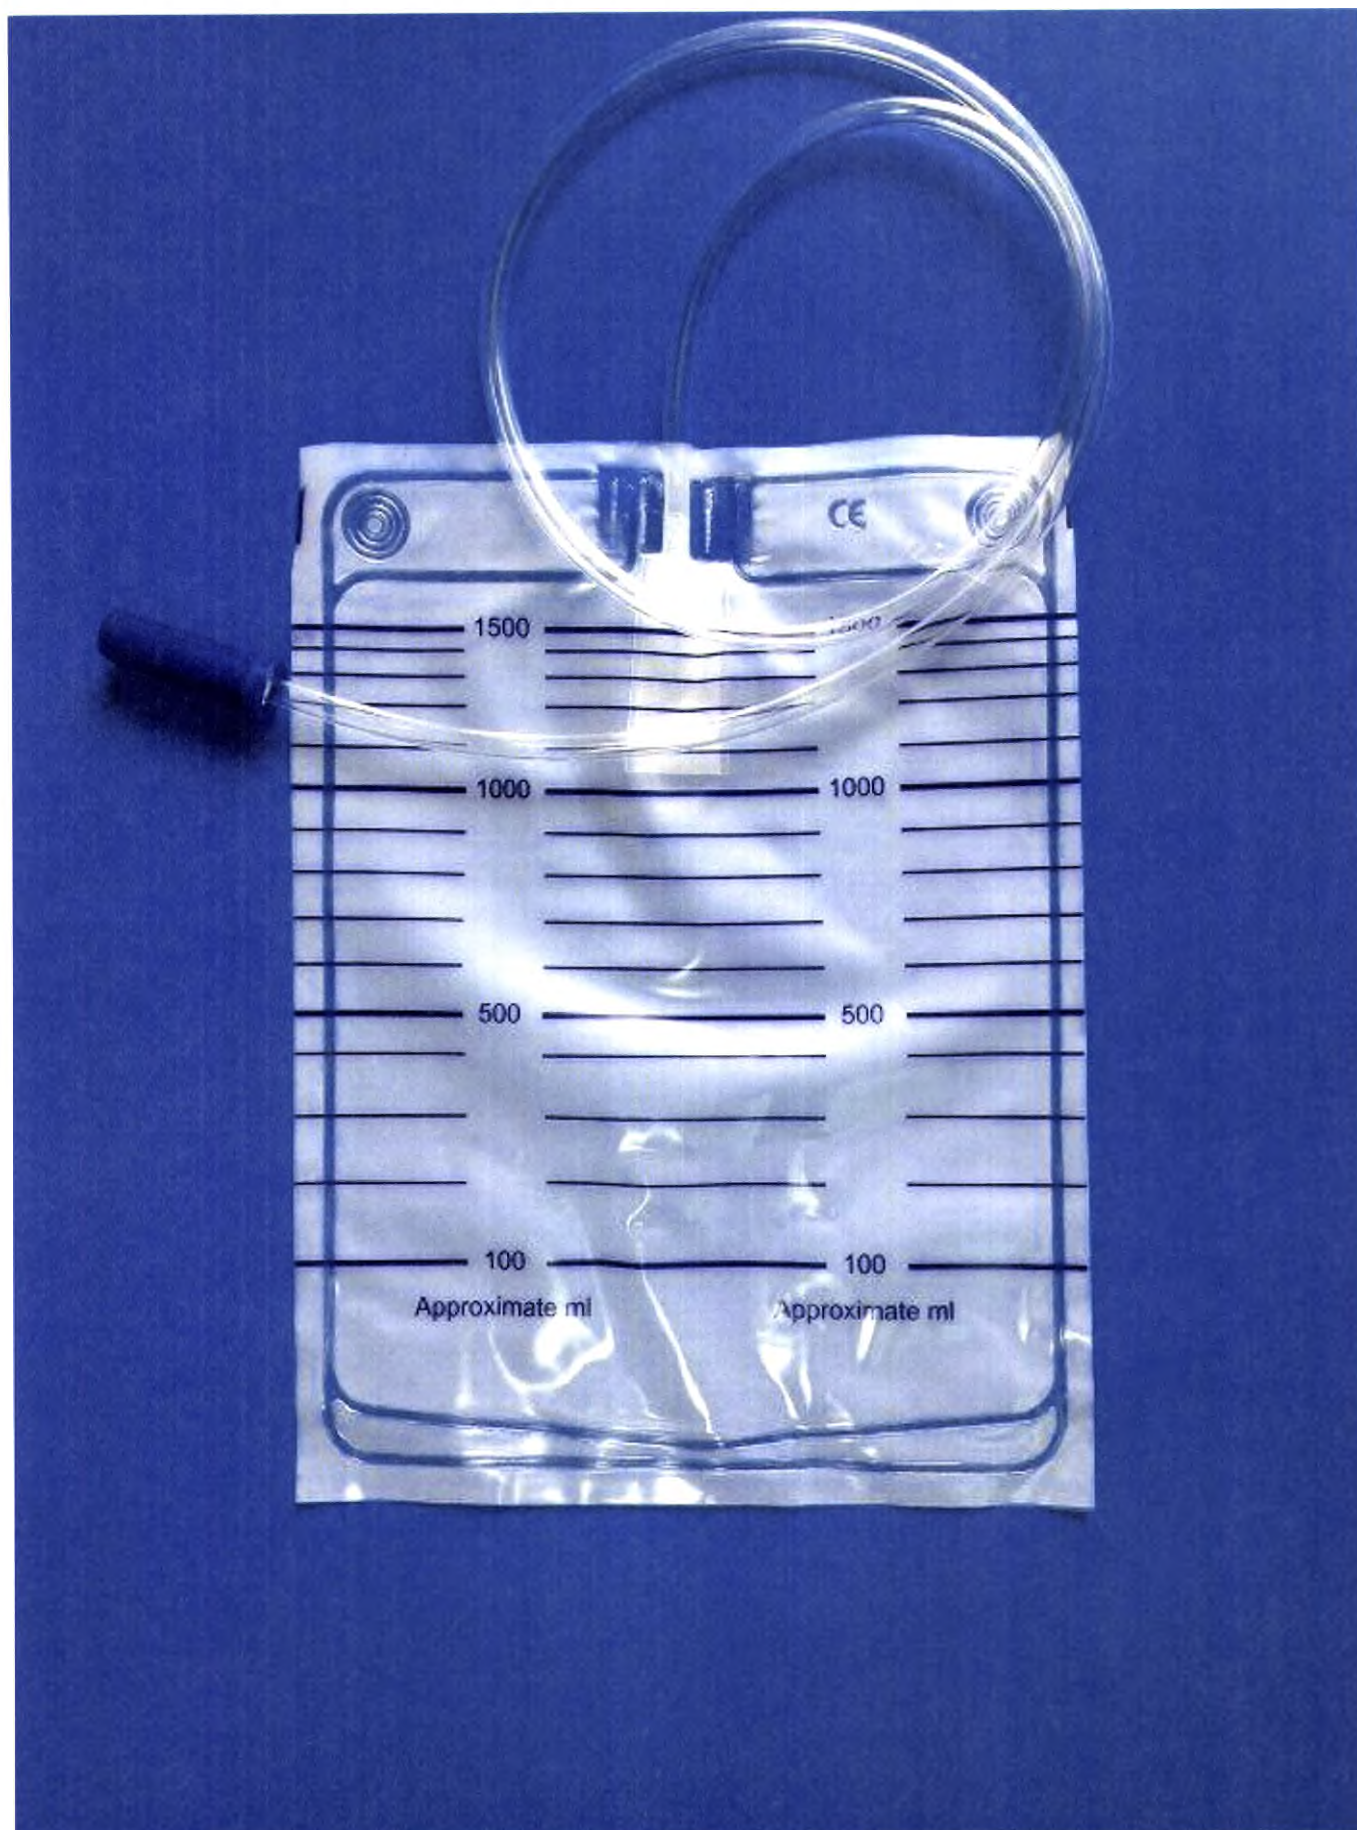

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1500 мл с прямым краном для слива  
содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

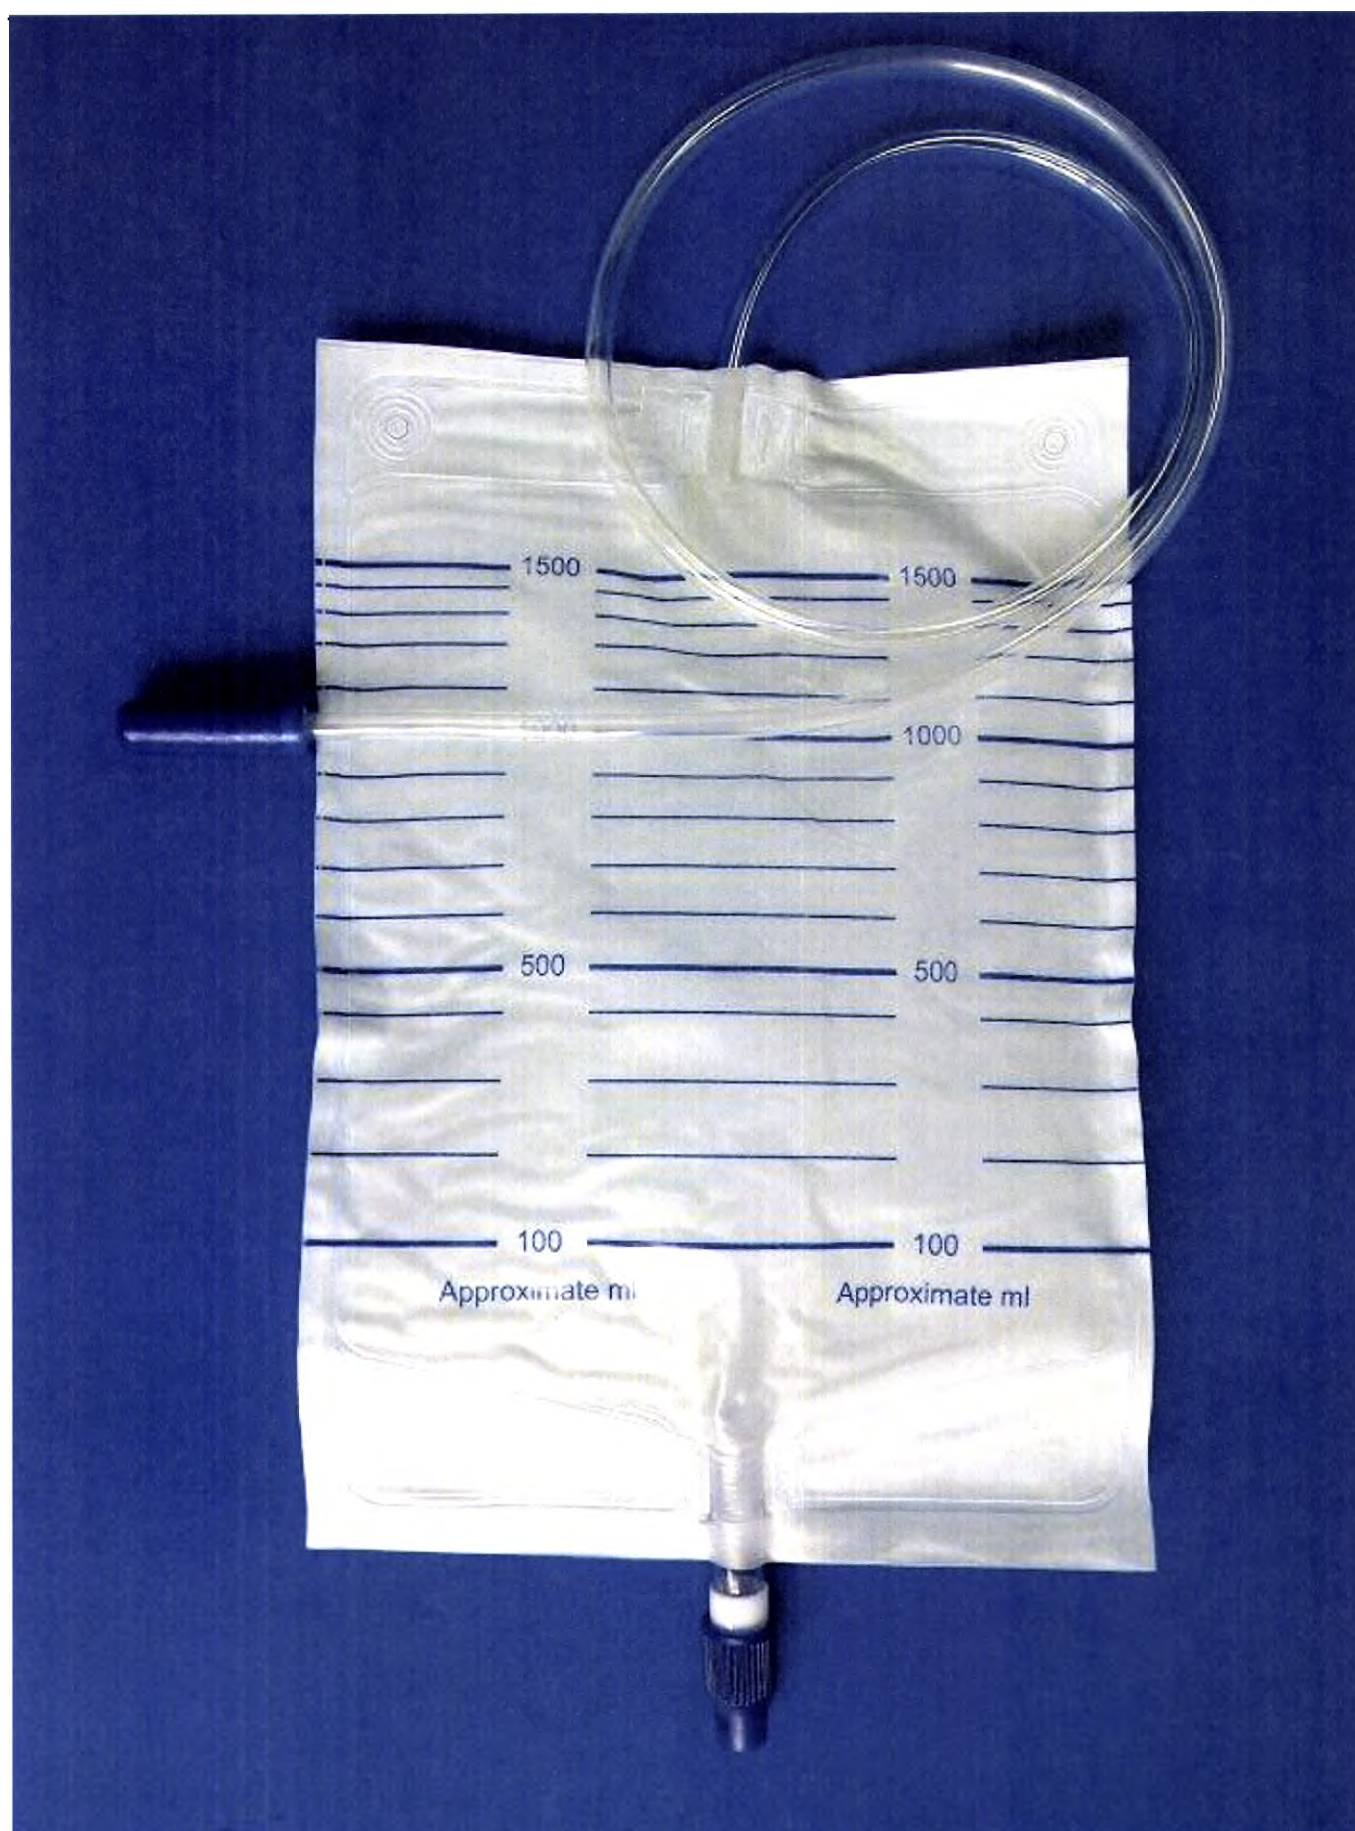


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1500 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

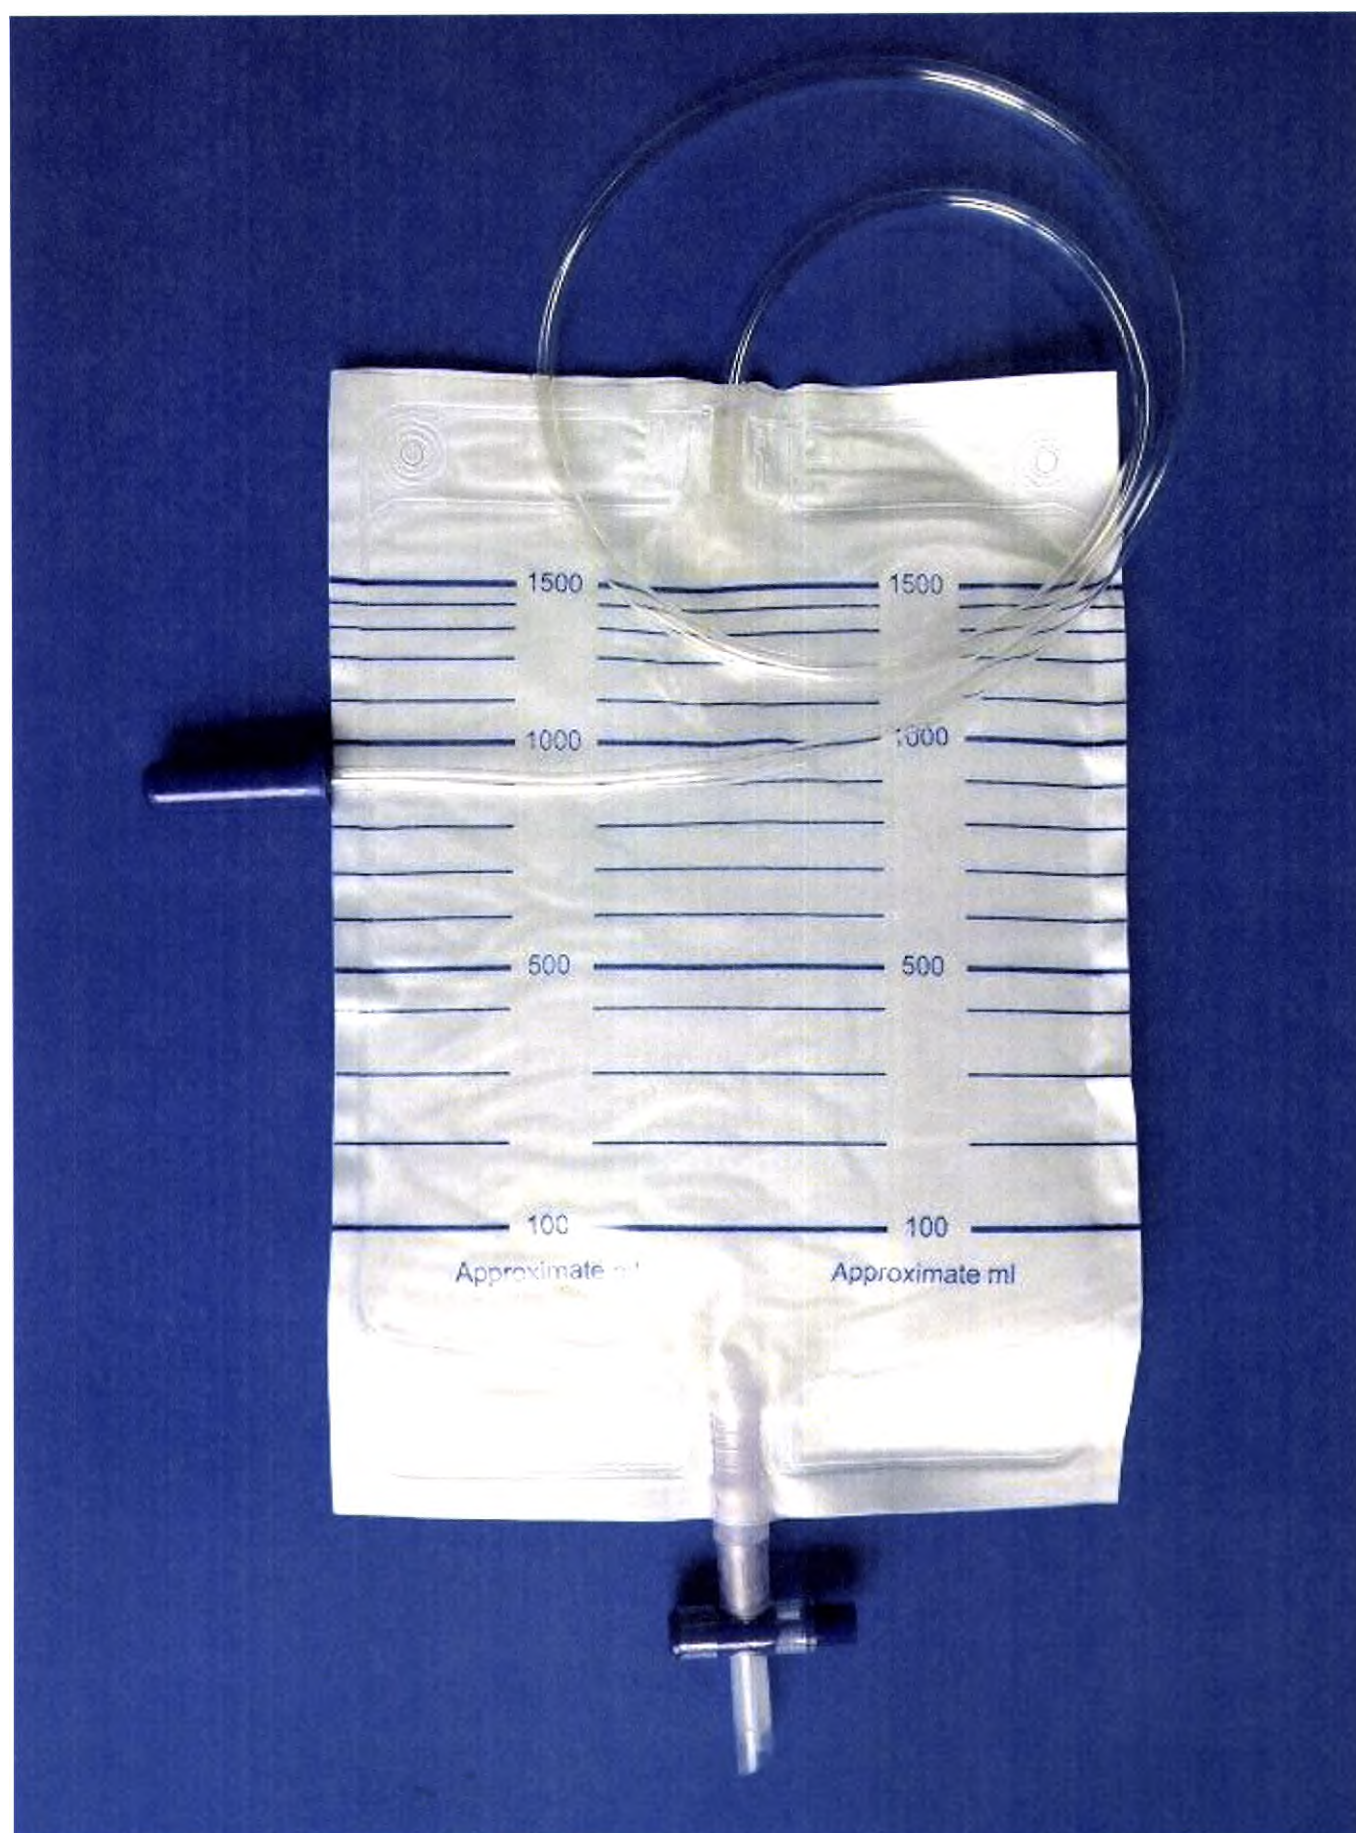


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)




Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

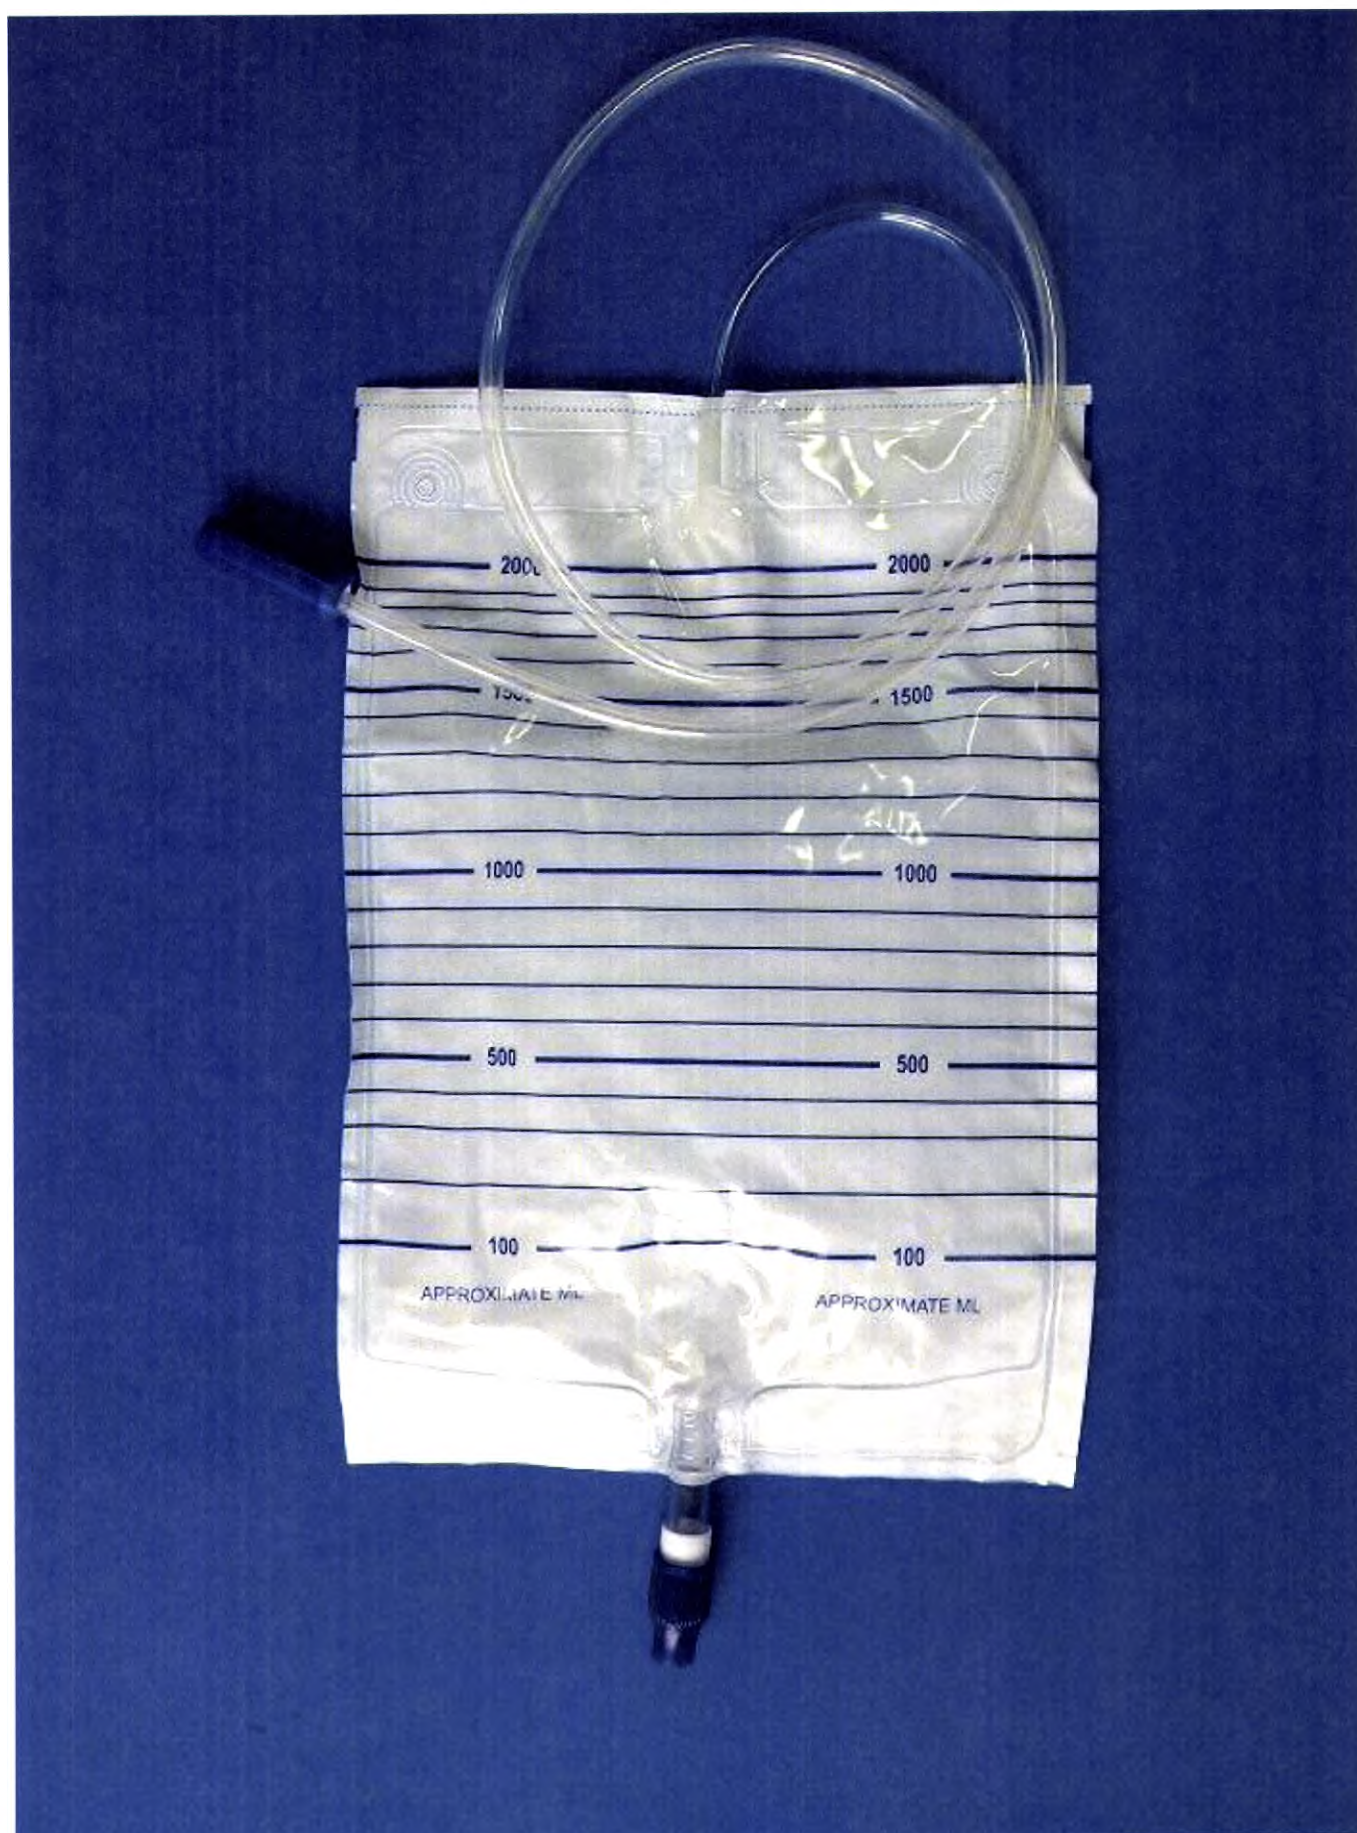

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл, с приводной трубкой (вид 152470)

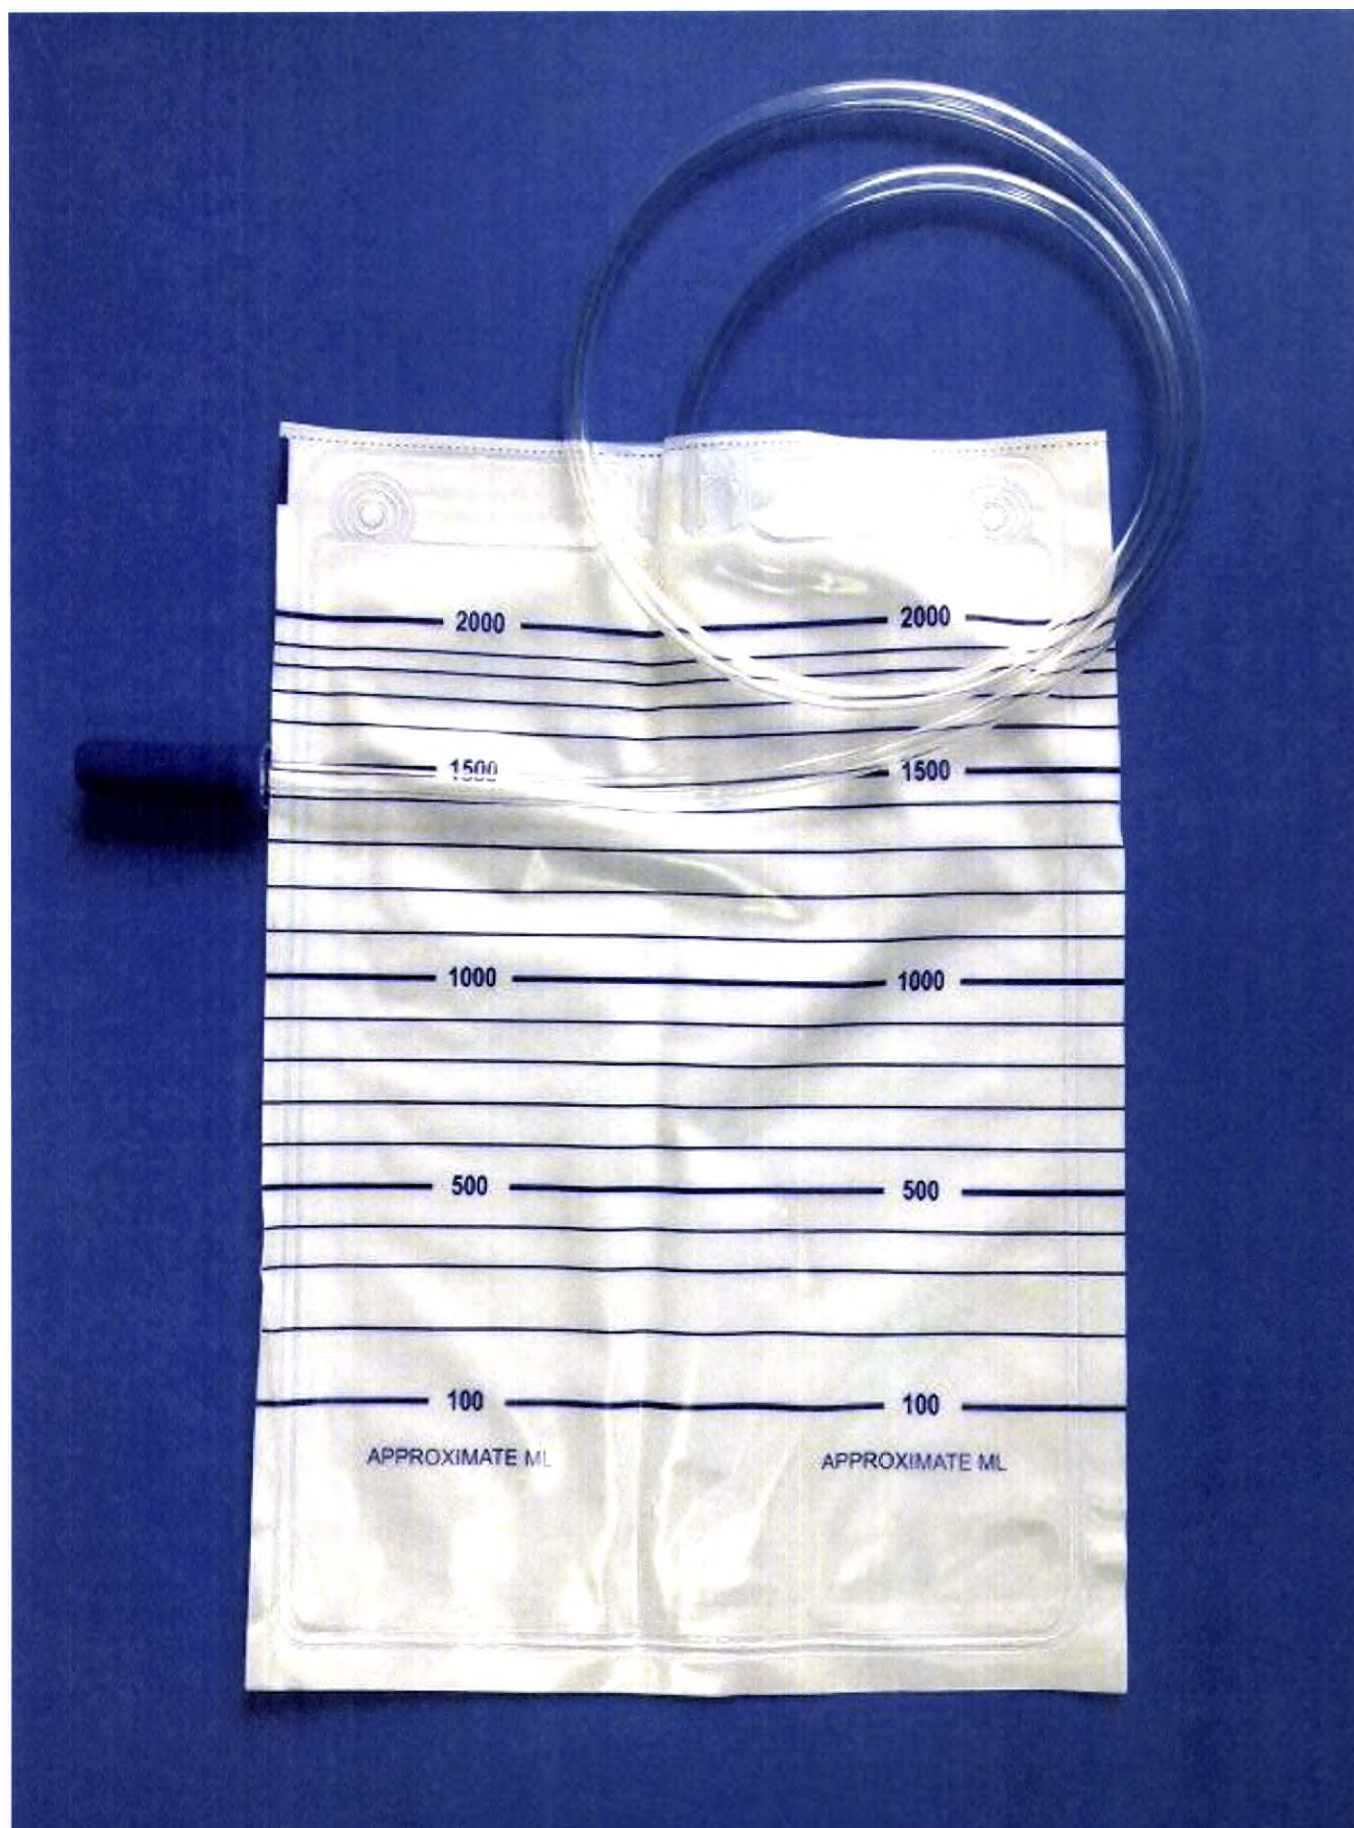

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

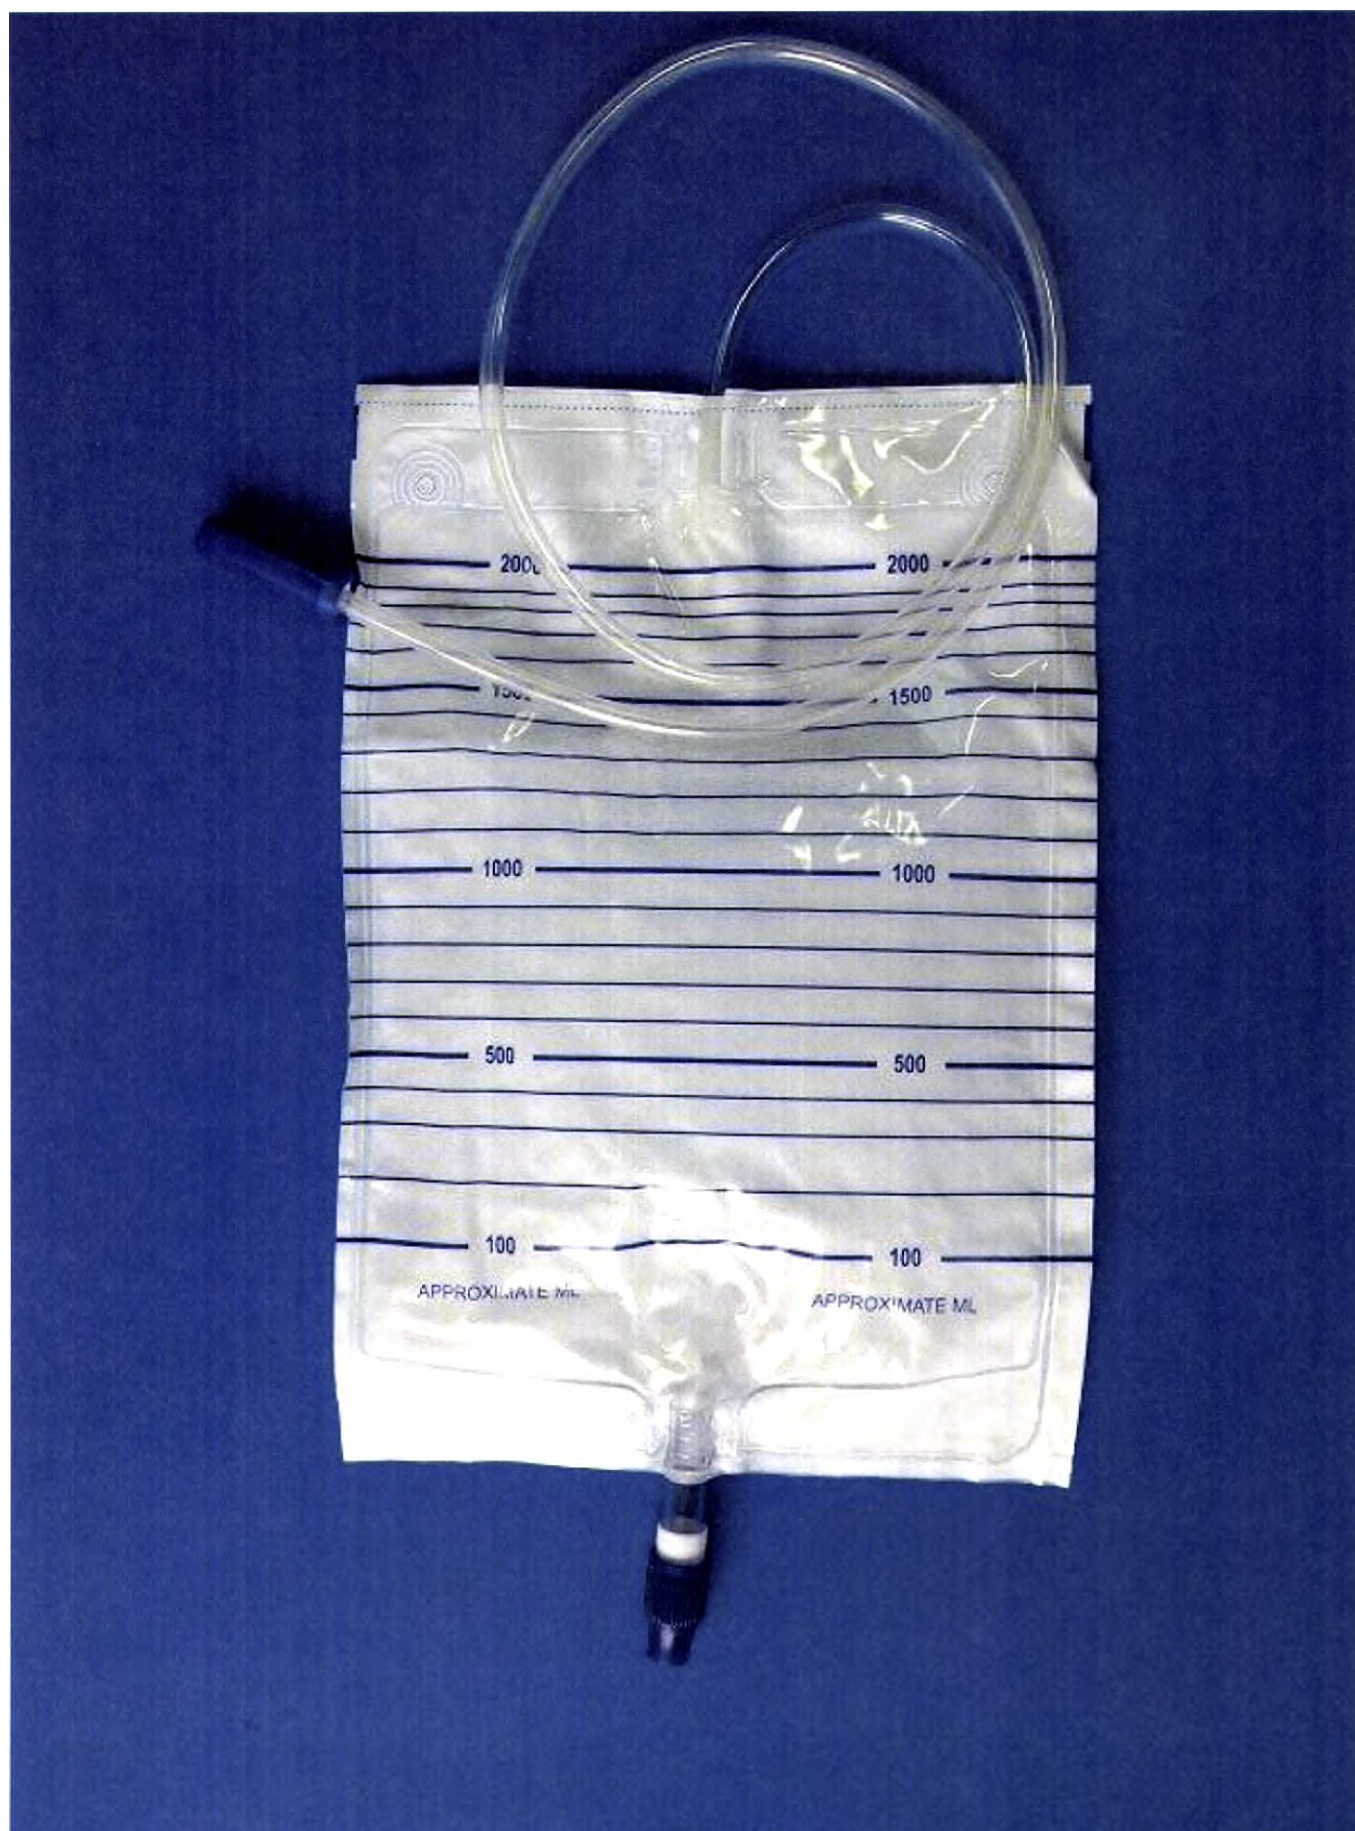


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)




Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2500 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)




Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 + (200) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

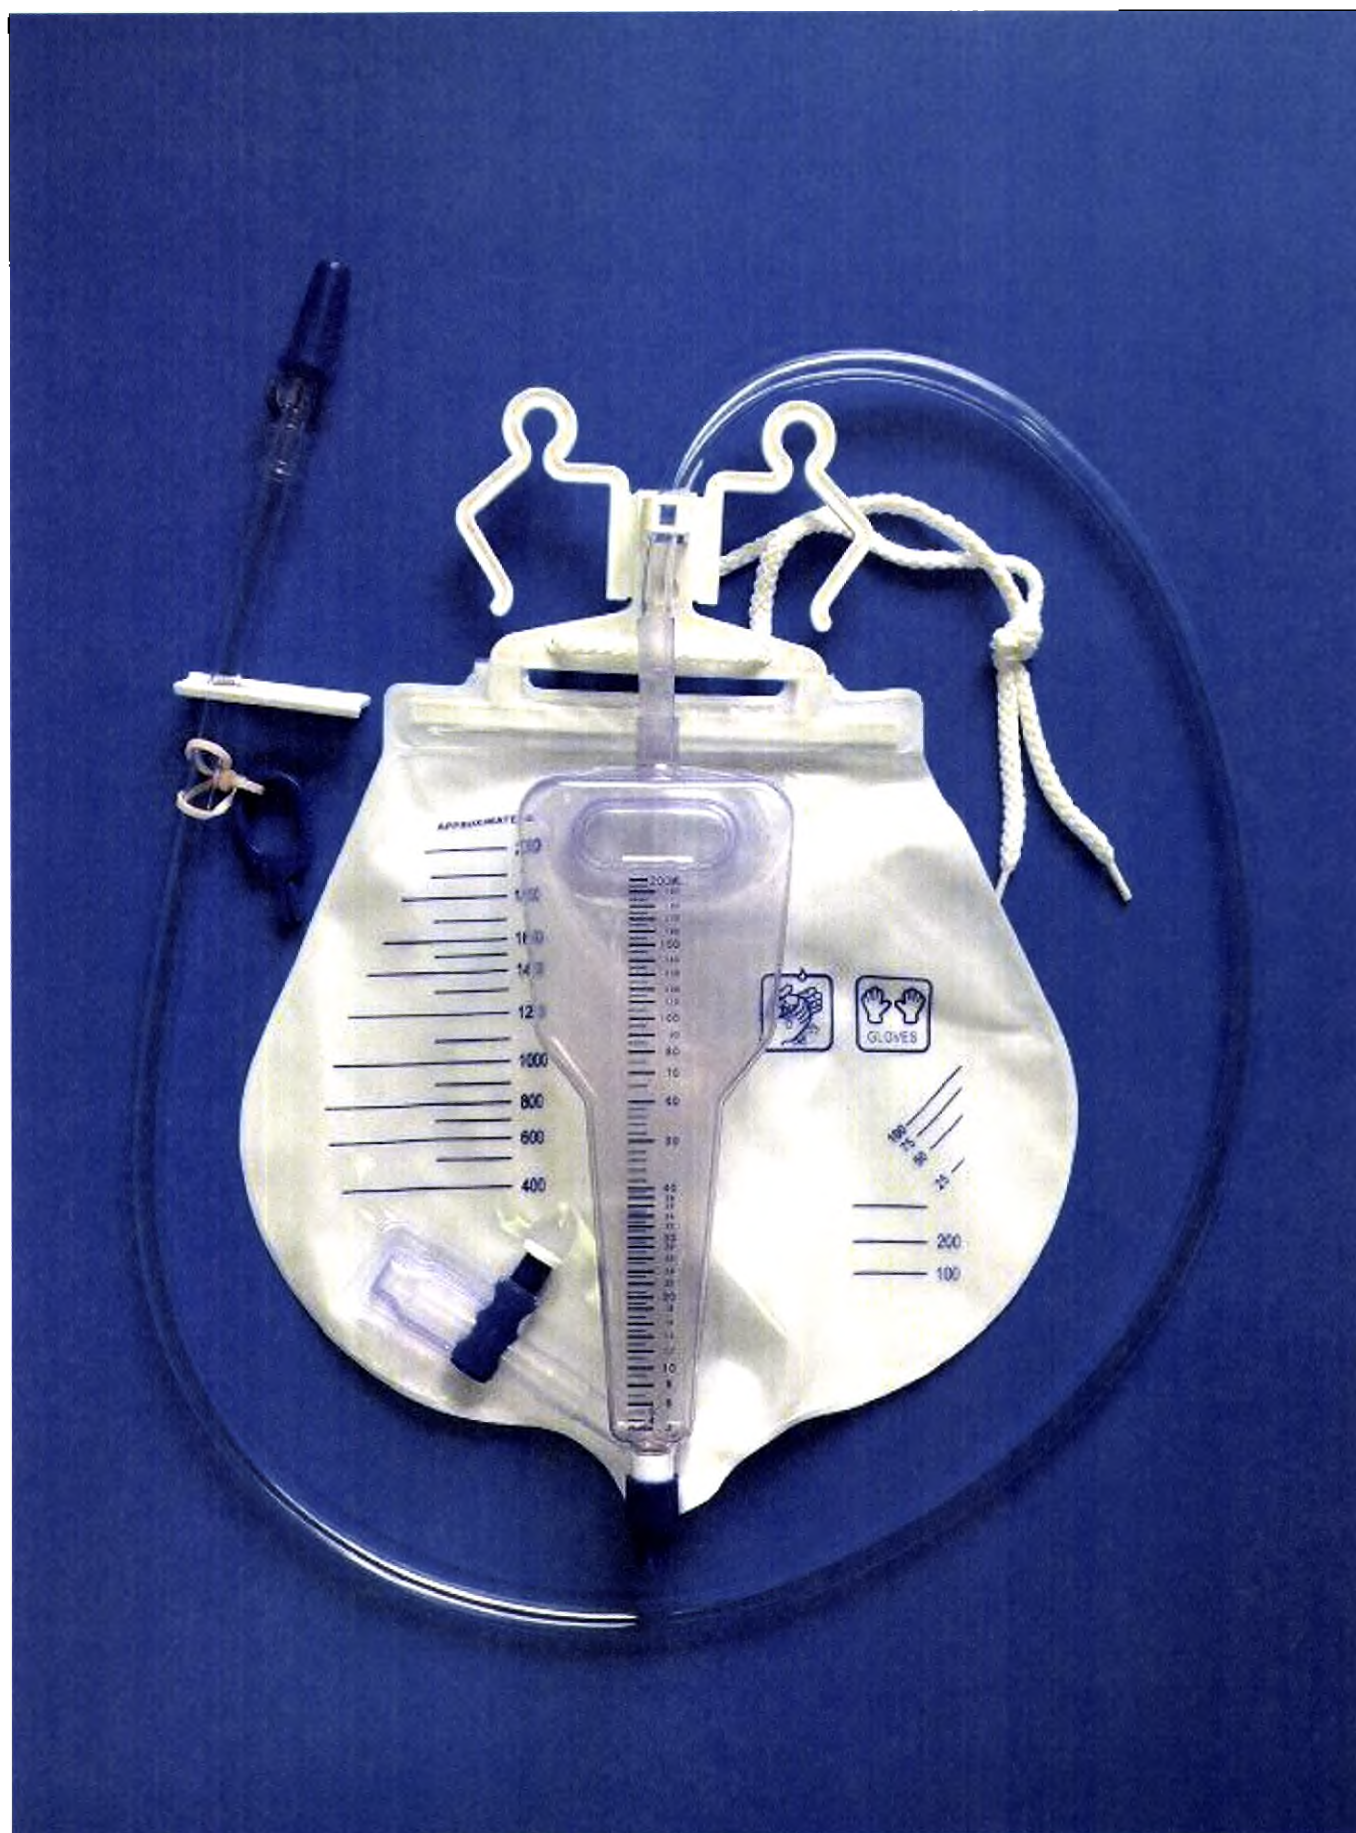


**Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 + (500) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)**

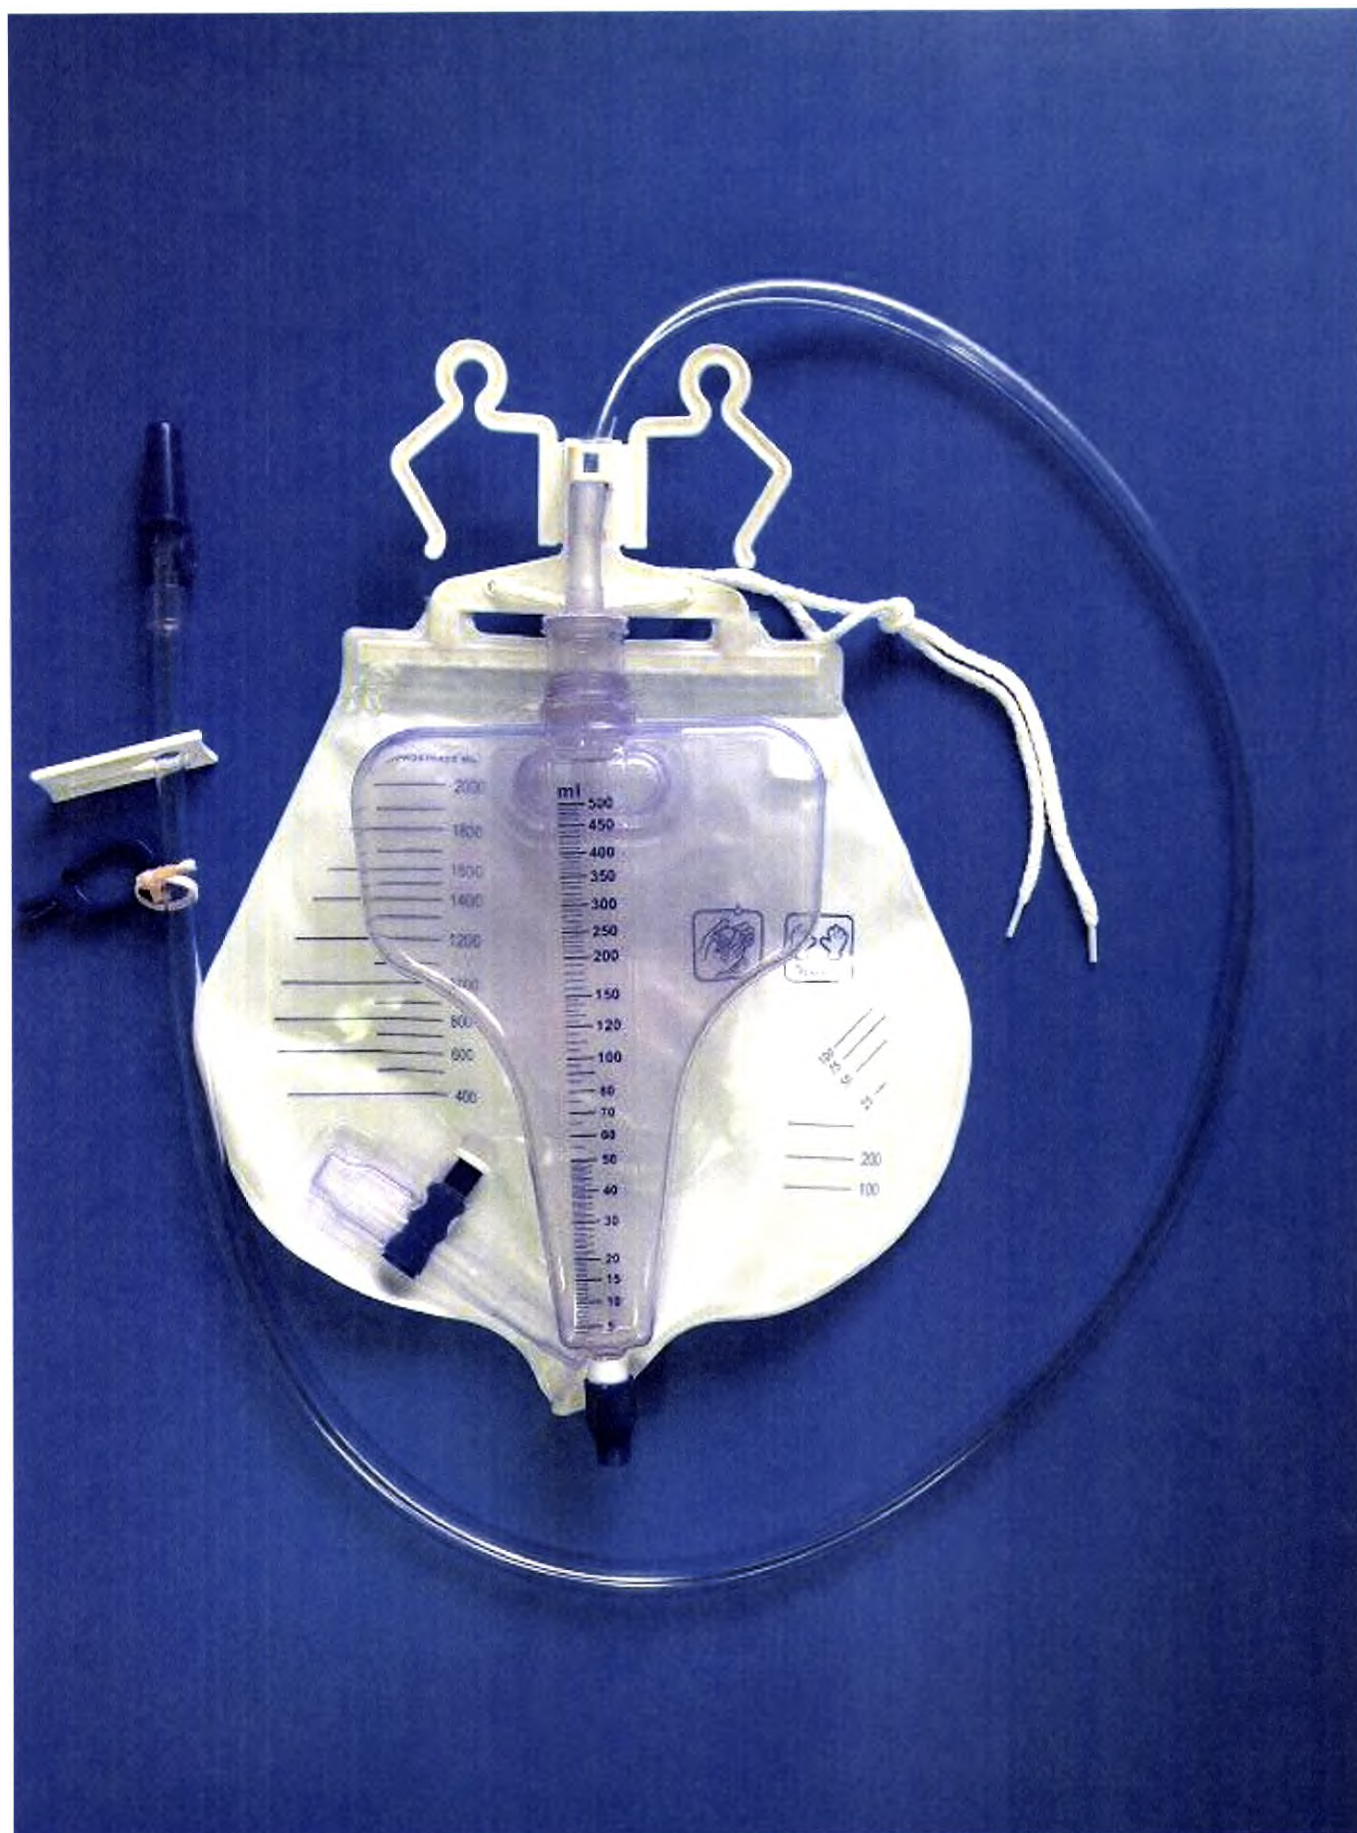


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2600 + (200) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

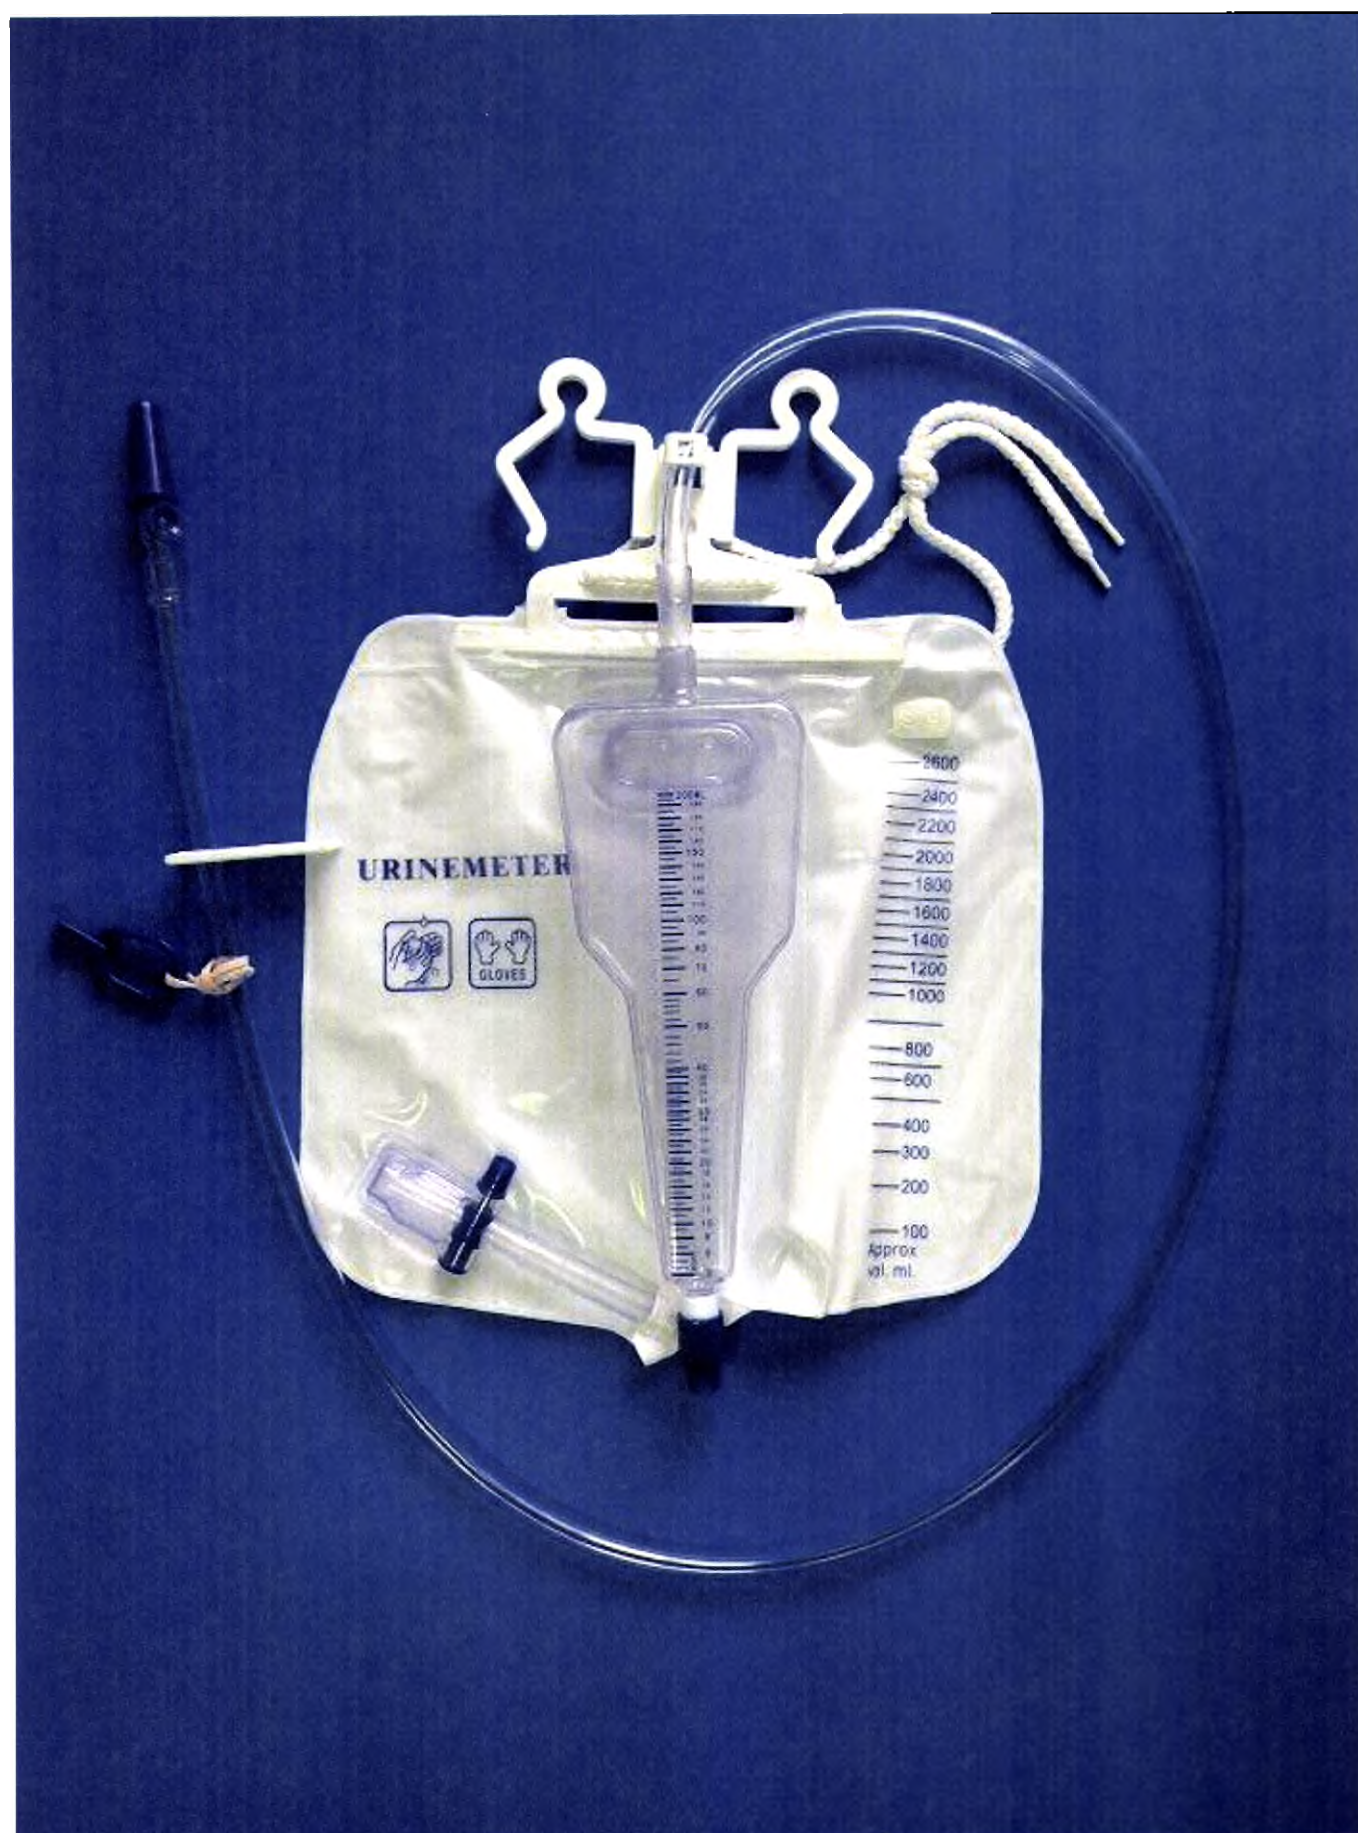


Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2600 + (400) мл. с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

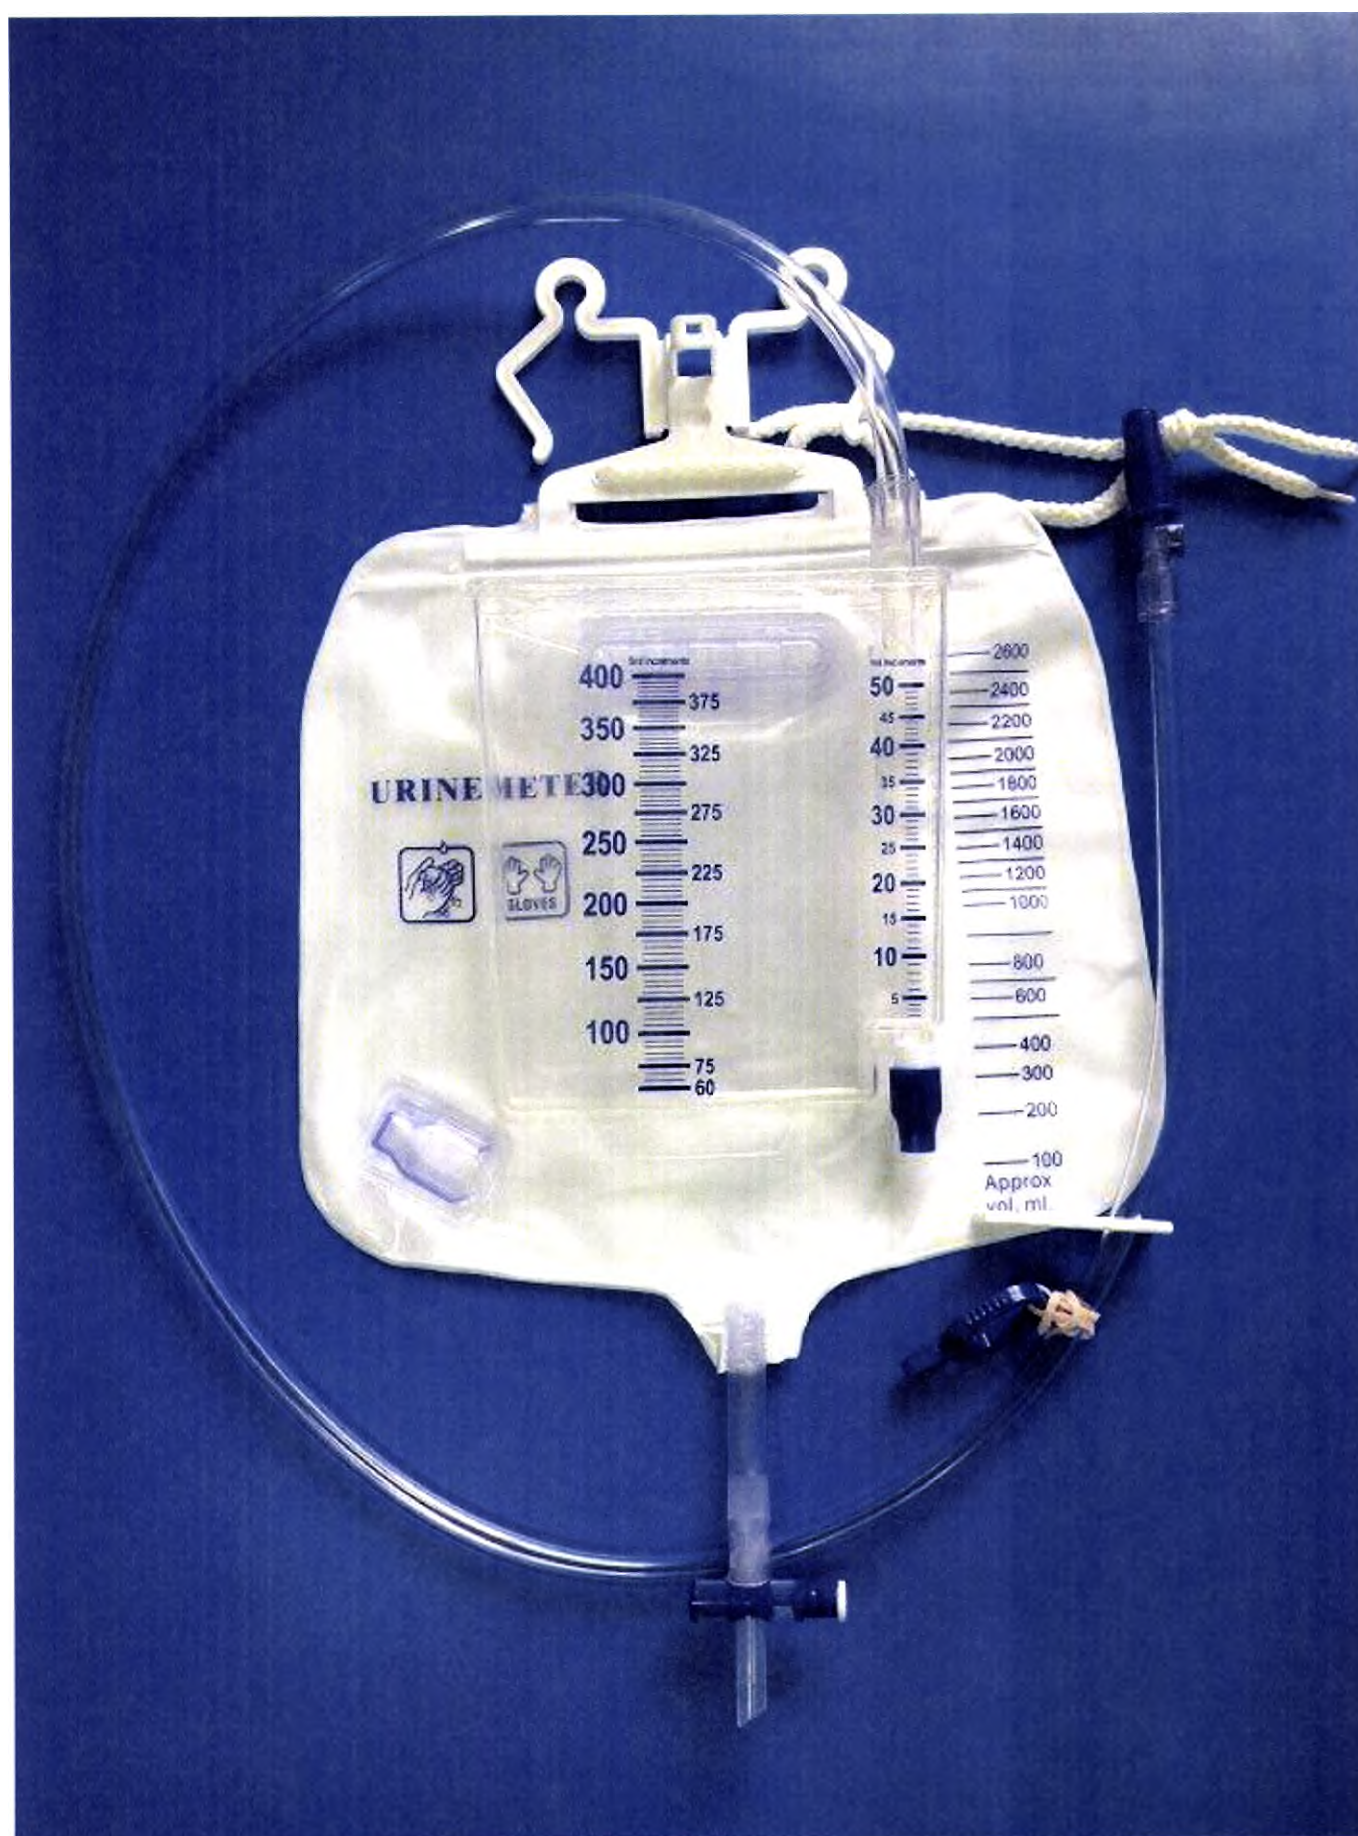

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2600 + (500) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

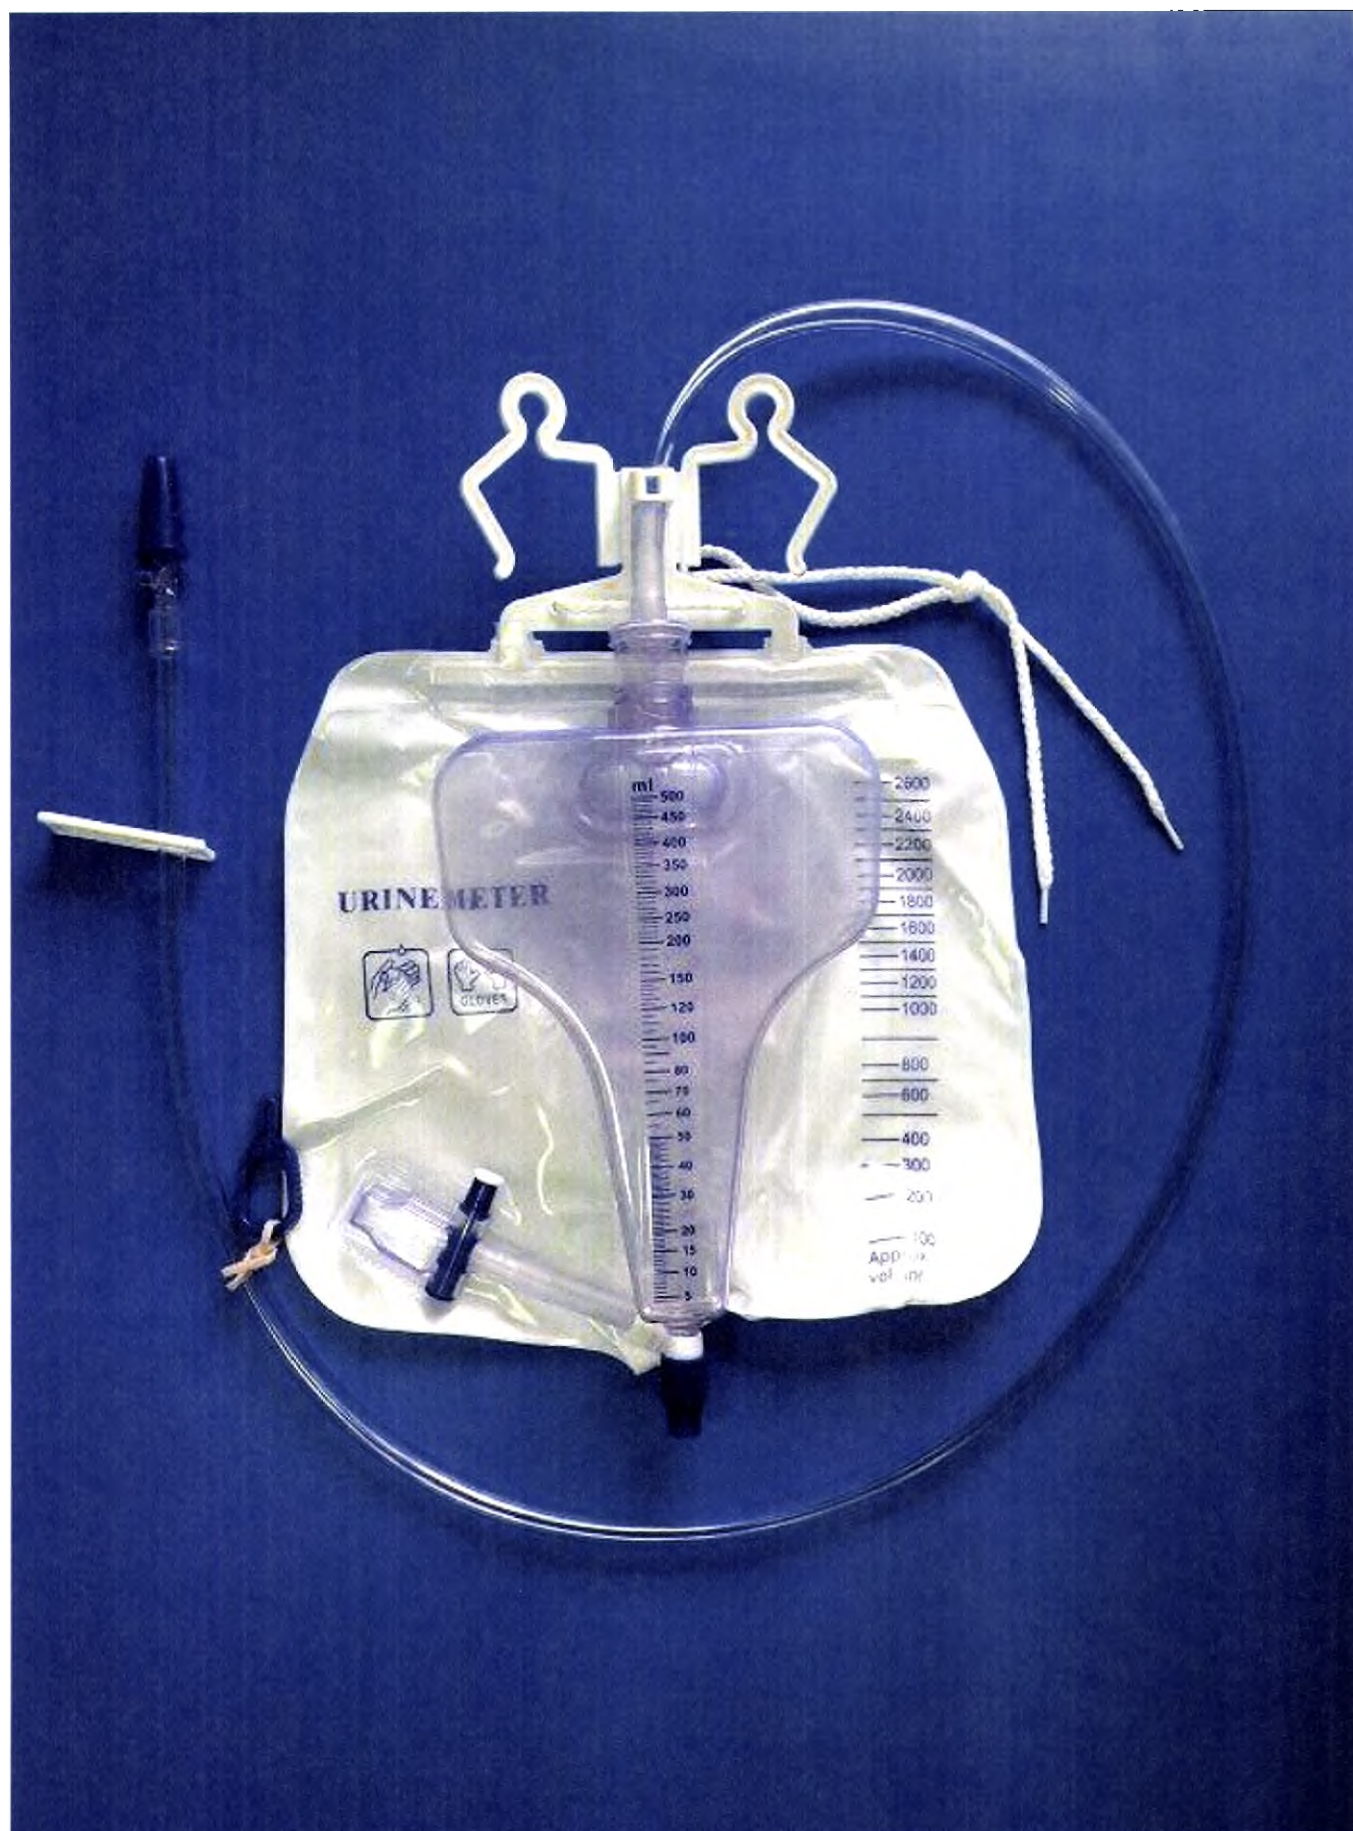

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 4000 мл, с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

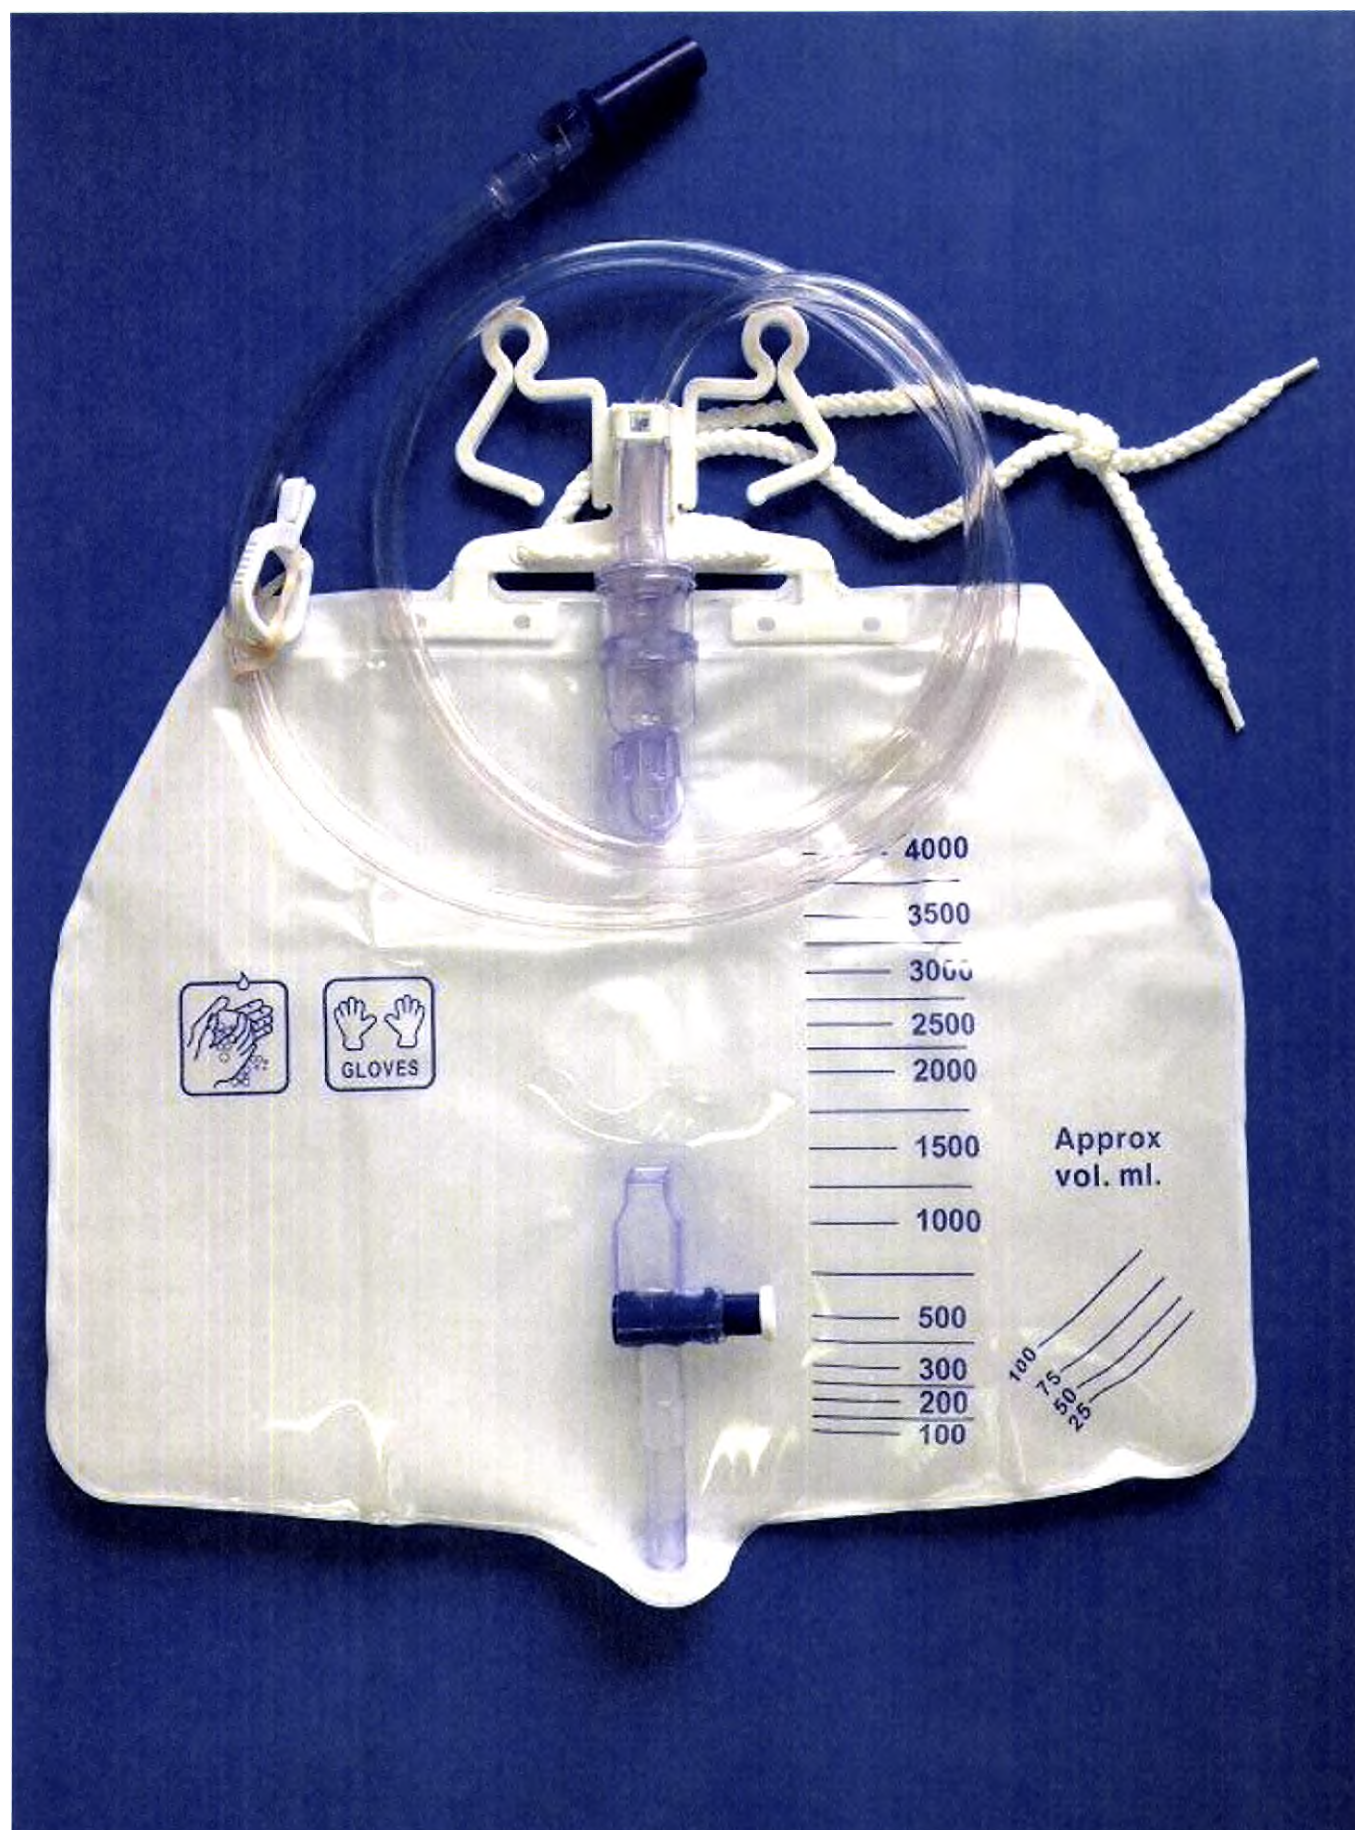



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 100 мл (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



Открывать  
здесь

- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорн.мед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 160 мл (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 200 мл (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



Открывать  
здесь

- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 500 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10

(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 500 мл с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO

2

ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 600 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

CE 0197 STERILE EO 2 ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник однократный стерильный объемом 750 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

ПУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO

2

ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

**Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 750 мл с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)**

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 800 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник однократный стерильный объемом 900 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (1 шт.)

ПУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO

2

ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник однократный стерильный объемом 1000 мл с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник однократный стерильный объемом 1000 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1000 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого (1 шт.)

ПУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)

- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



Номер партии/Lot 20160920  
 Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016  
 Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 1500 мл, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник однократный стерильный объемом 1500 мл с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO

2

ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник однократный стерильный объемом 1500 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10

(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншун Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншун, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник однократный стерильный объемом 2000 мл с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник однократный стерильный объемом 2000 мл, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл с устройством для крепления, с прямым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

ПУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012



Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 мл с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

ПУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO

ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

## Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2500 мл с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO

2

ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.

Образец маркировки мочевого катетера однократного стерильного объема 2000 + (200) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник однократный стерильный объемом 2000 + (200) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь



«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.

Образец маркировки мочевого катетера однократного использования объемом 2000 + (500) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

Открывать  
здесь



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2000 + (500) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Образец маркировки мочевого приемника одноразового стерильного объемом 2600 + (200) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

Открывать  
здесь



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2600 + (200) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO 9001 & EN 46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.

Образец маркировки мочевого приемника одноразового стерильного объемом 2600 + (400) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

Открывать  
здесь



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

**Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2600 + (400) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)**

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

«Чаншу Канбао Медикал Аплайнс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Образец маркировки мочевого приемника одноразового стерильного объемом 2600 + (500) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (вид 156370)

Открывать  
здесь



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

**Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 2600 + (500) мл, с устройством для крепления, с прямым и крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)**

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197

STERILE EO



ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.



LOT Номер партии/Lot 20160920

Дата изготовления/стерилизации 20.09.2016

Годен до 19.09.2021

Мочеприемник одноразовый стерильный объемом 4000 мл, с устройством для крепления, с крестовым краном для слива содержимого, с приводной трубкой (1 шт.)

РУ № ФСЗ 2012/11749 от 14.03.2012

Открывать  
здесь

«Чаншу Канбао Медикал Аплайенс Фэктори» (Changshu Kangbao Medical Appliance Factory), Деревня Фужон, Баймао, Гули Таун, 215500 г. Чаншу, провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика (Furong Village, Baimao, Guli Town 215500 Changshu City, Jiangsu Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Артикул: МП01-12

СанПин 2.1.7.2790-10  
(Класс Б)



- \* Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
- \* Для однократного применения
- \* Стерилизовано оксидом этилена
- \* Не использовать при нарушении целостности упаковки
- \* Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре
- \* После использования утилизировать
- \* Срок годности 5 лет с даты стерилизации



PYROGEN FREE  
NON TOXIC

не токсично внутри

CE 0197 STERILE EO ISO9001 & EN46001



Уполномоченный представитель производителя: ООО «Юникорнмед», Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, 18/А, т/ф. (812) 702-33-04.