

УТВЕРЖДАЮ

Старший специалист по регистрации

ООО "Страйкер"

Моисеева А.В.

По доверенности

от 04.07.2019

9 декабря 2019 г.

(Подпись)



Фотографические изображения медицинского изделия:

Система получения флуоресцентных изображений в ближнем инфракрасном диапазоне, в вариантах исполнения

Общество с ограниченной ответственностью «Страйкер»

ИНН 7731561935 | ОГРН 1077746362770 125167 | г. Москва, проспект Ленинградский, дом 39,
строение 80, этаж 3, часть помещения 1 | тел. +7 (495) 785-07-18 | stryker.com

I. Система получения флуоресцентных изображений в ближнем инфракрасном диапазоне, в вариантах исполнения:

1. Блок обработки видеосигнала и осветитель (VPI).




2. Камера PINPOINT




3. Световодный кабель



4. Лапароскоп для получения флюоресцентных изображений, диаметр 10 мм, угол обзора 30°, длина 32 см.

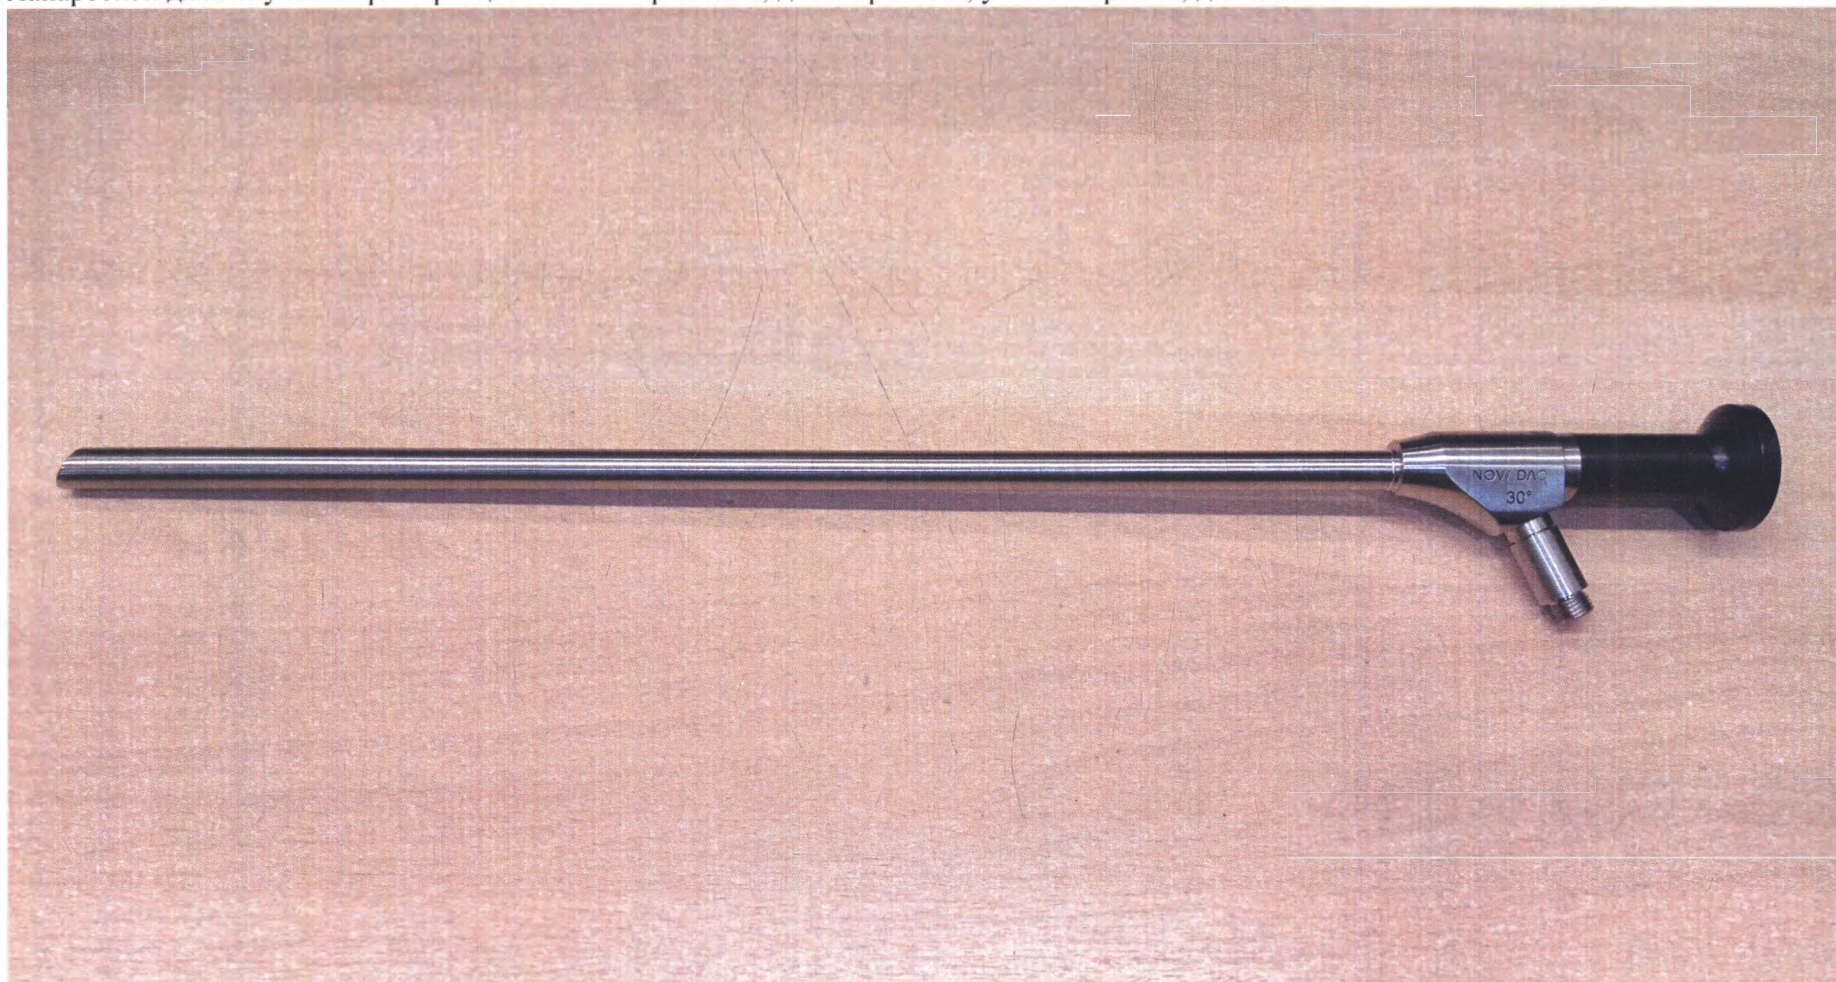


5. Лапароскоп для получения флюоресцентных изображений, диаметр 5 мм, угол обзора 0°, длина 30 см.

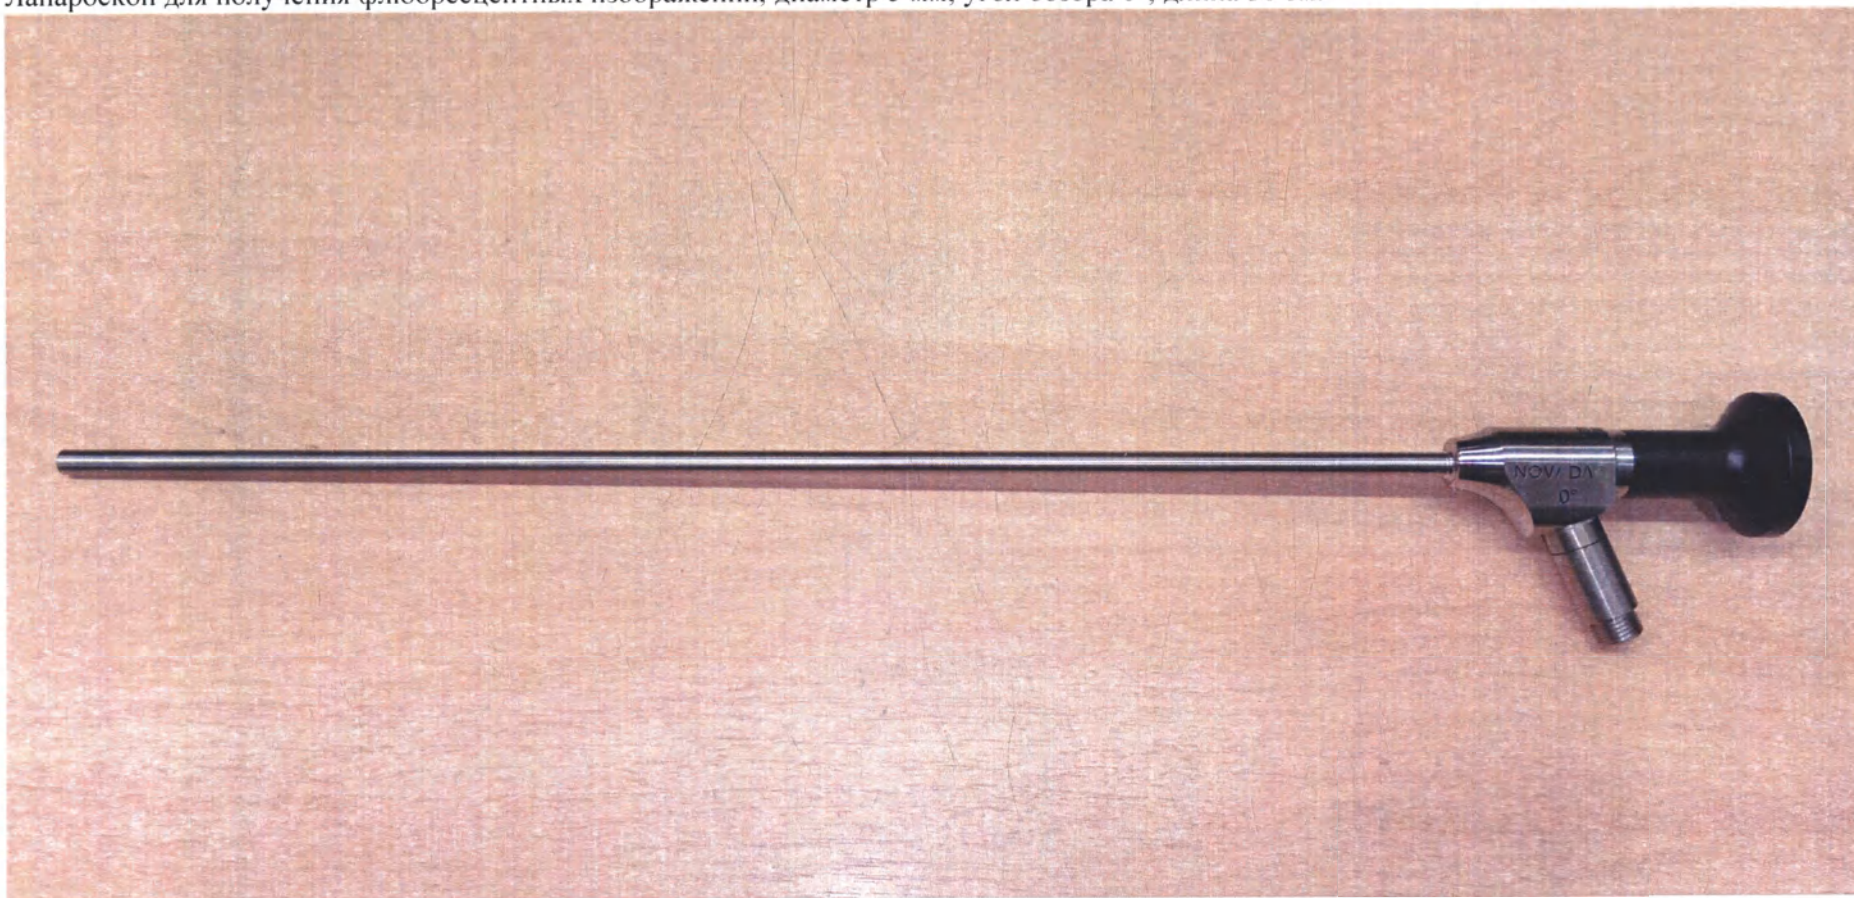


6. Головка визуализации SPY-PHI



7. Кабель питания.

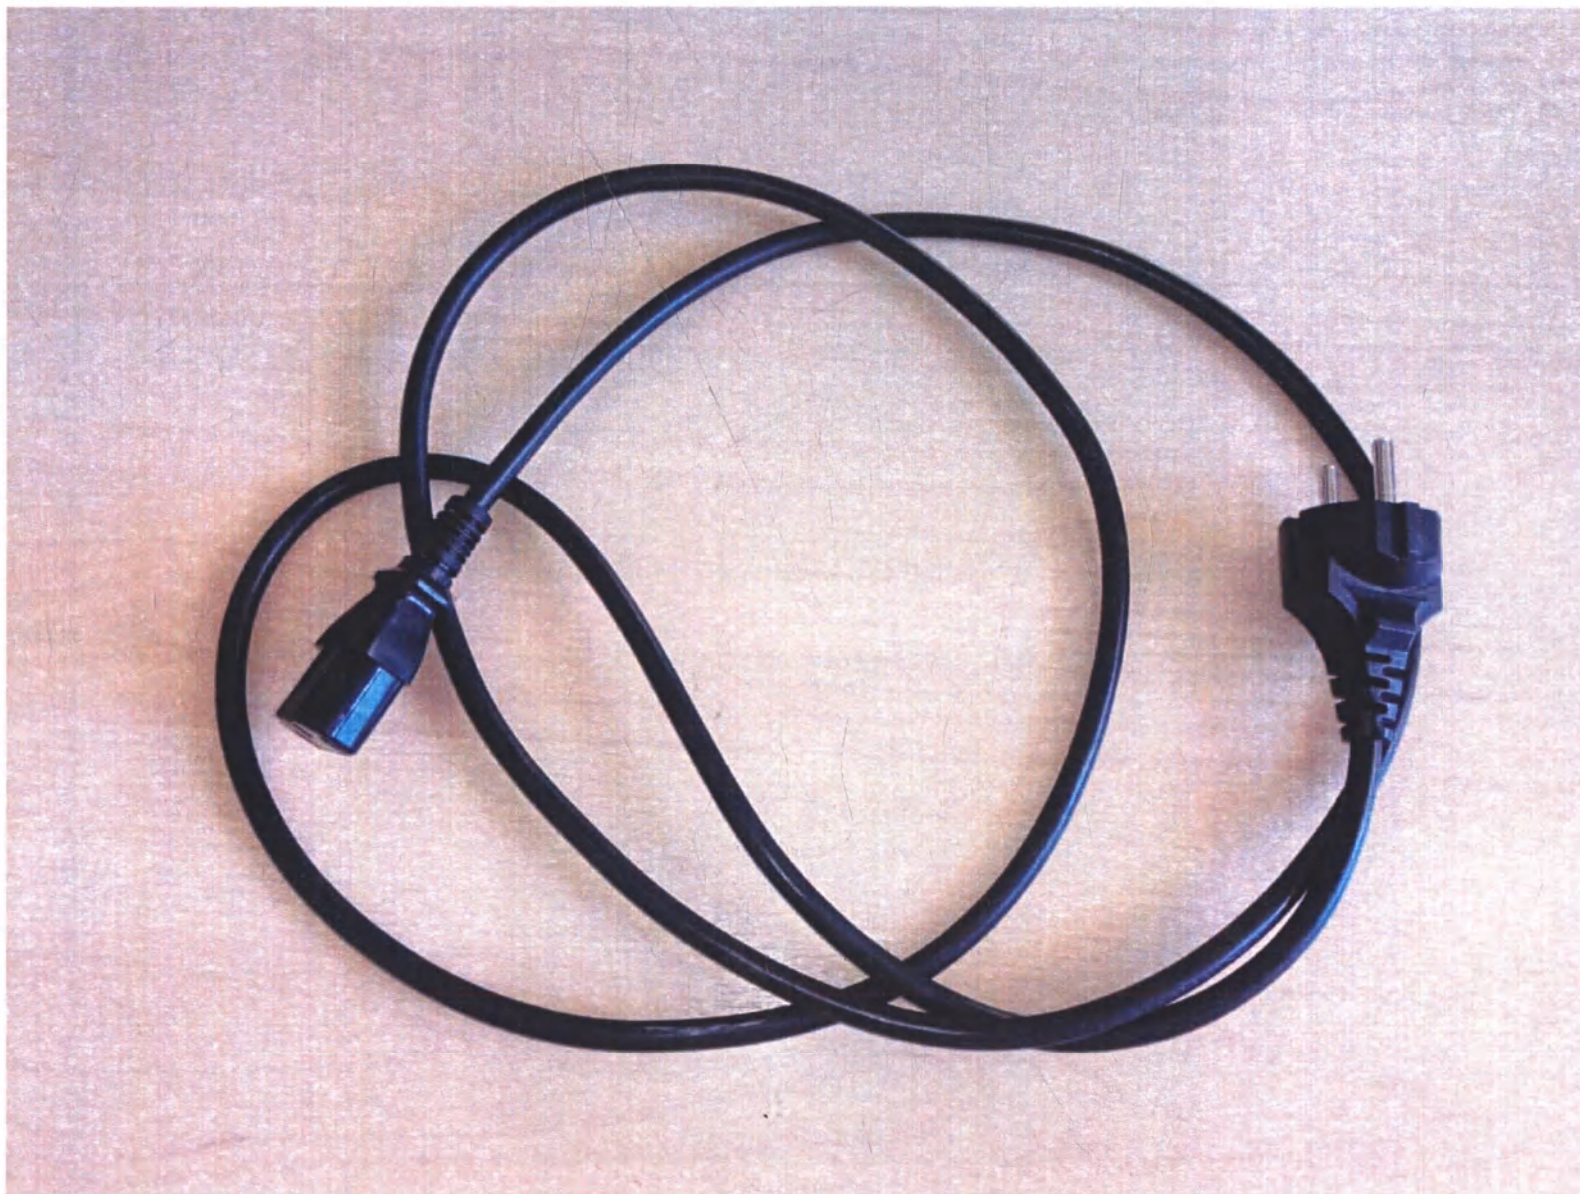


8. Адаптер световода, Olympus.

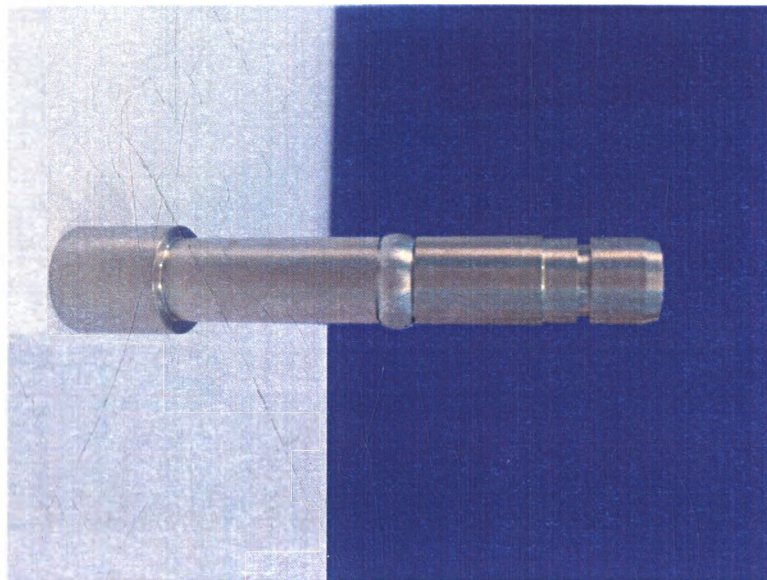


9. Адаптер световода, Storz.




10. Адаптер эндоскопа, Storz.

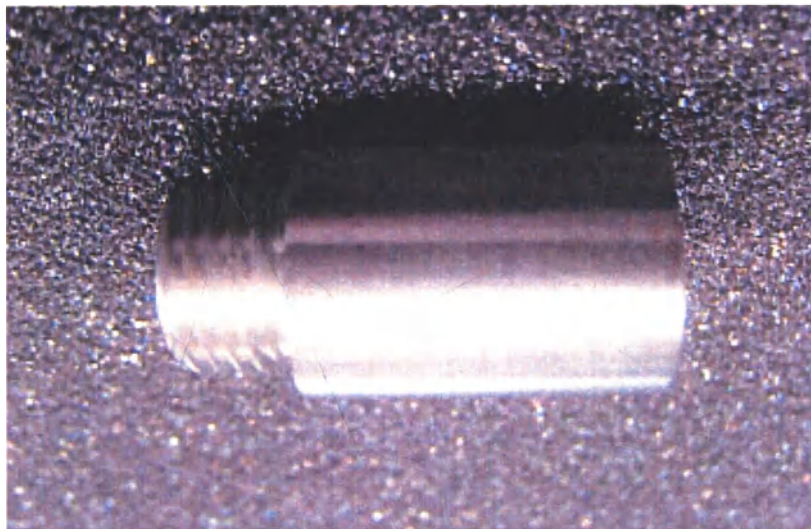


11. Адаптер эндоскопа, Wolf.

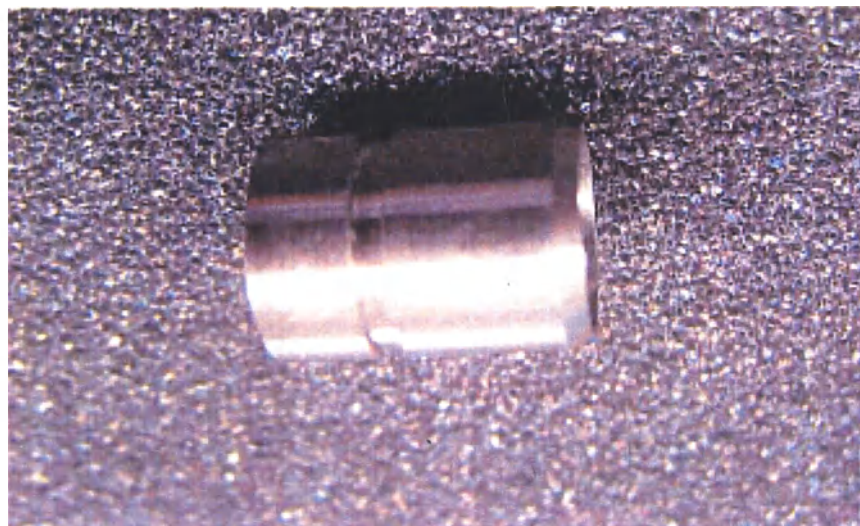


12. Держатель головки визуализации SPY-PHI.

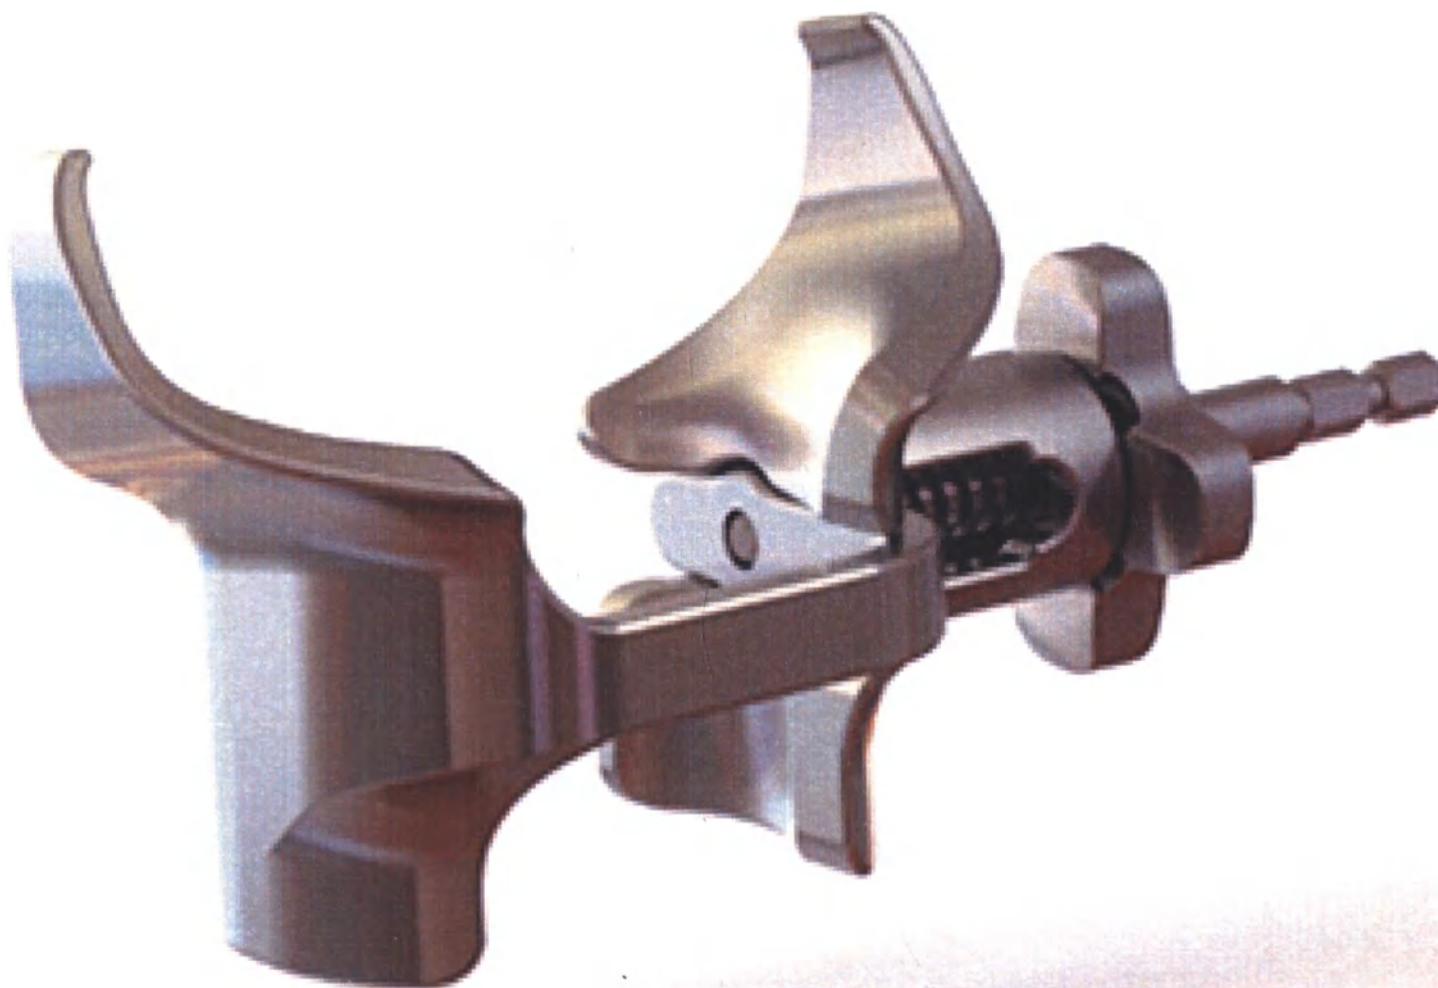


13. Драпировка SPY-PH1 (20 шт. в уп.).

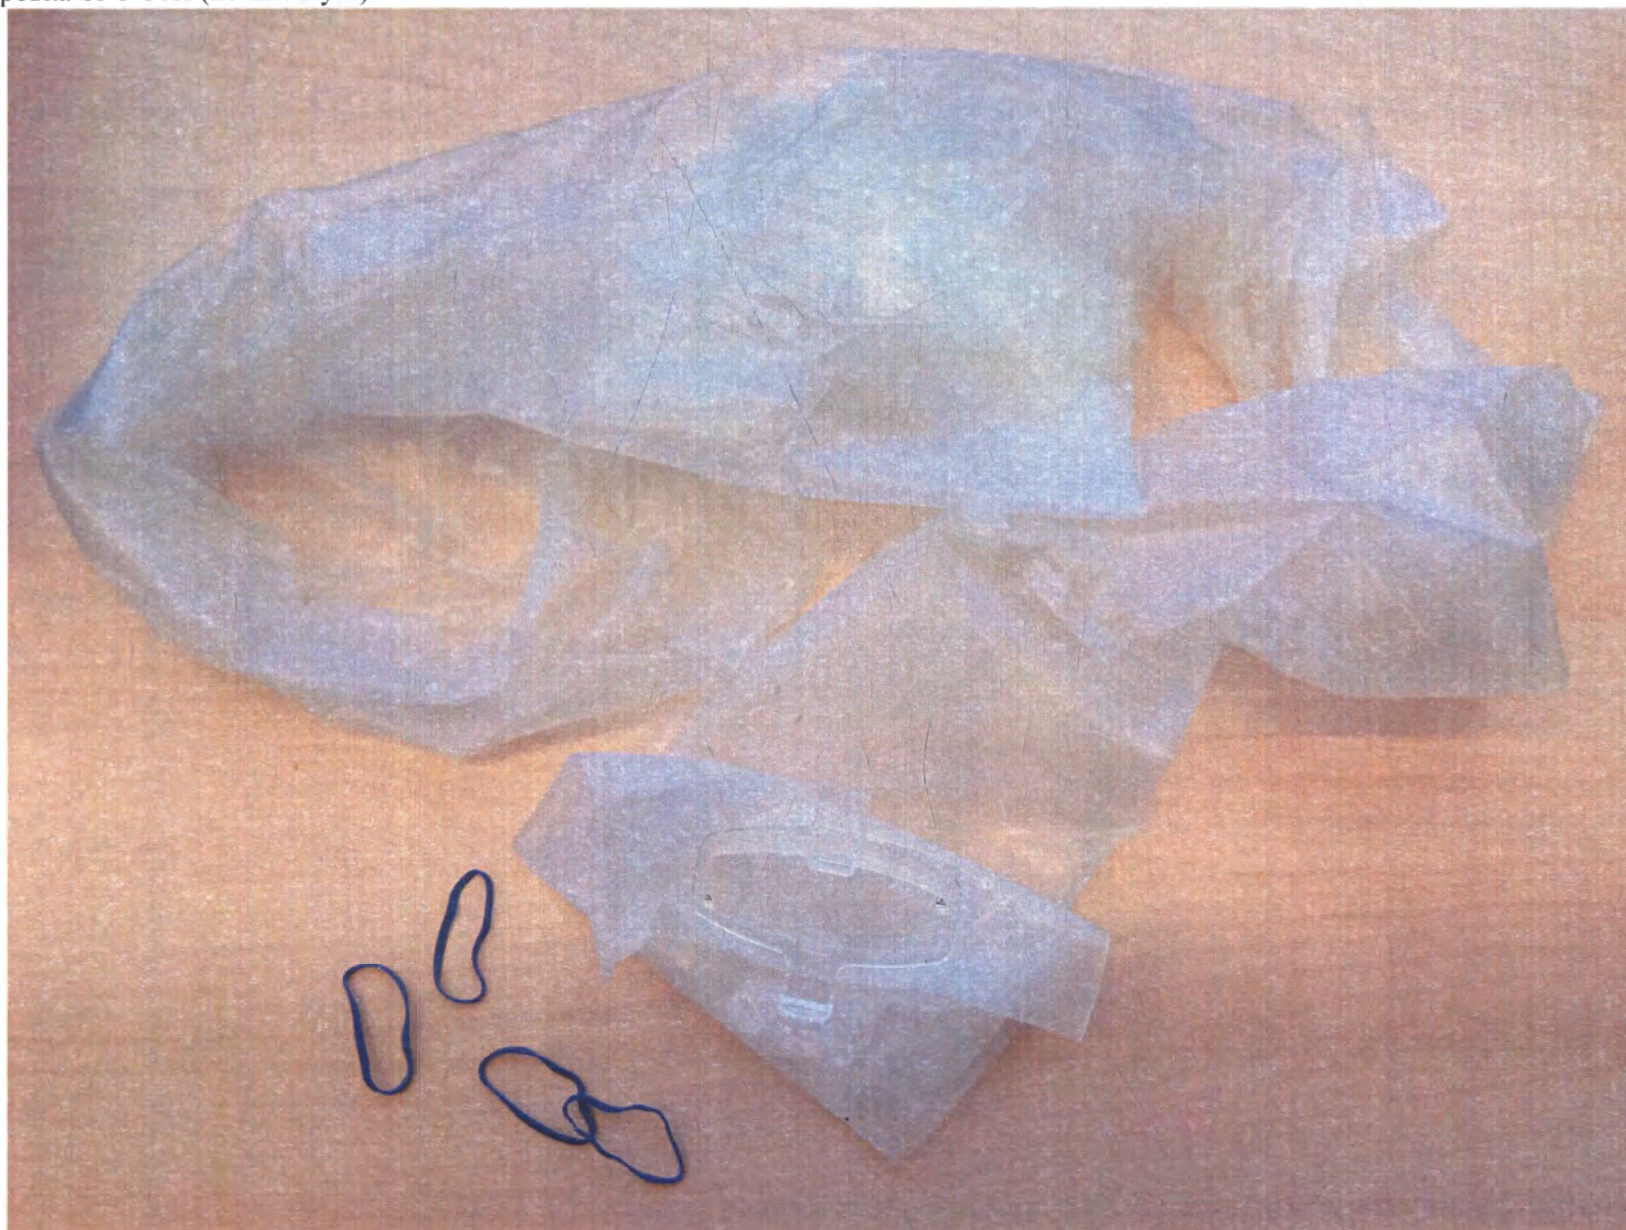


14. Штатив SPY-PHI

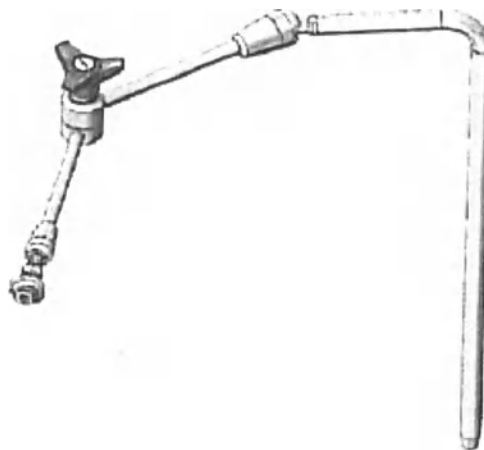


15. Зажим для штатива SPY-PHI.

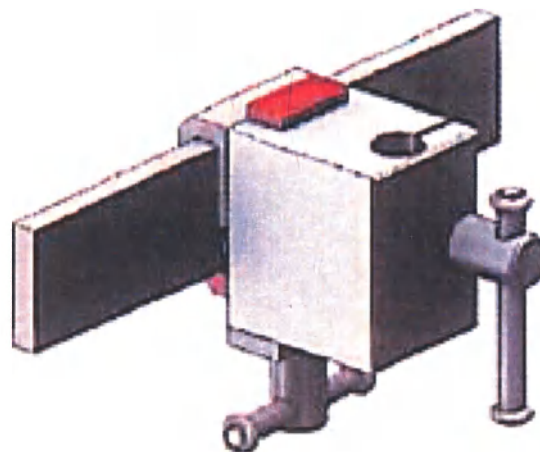


16. Кабель HD-SDI

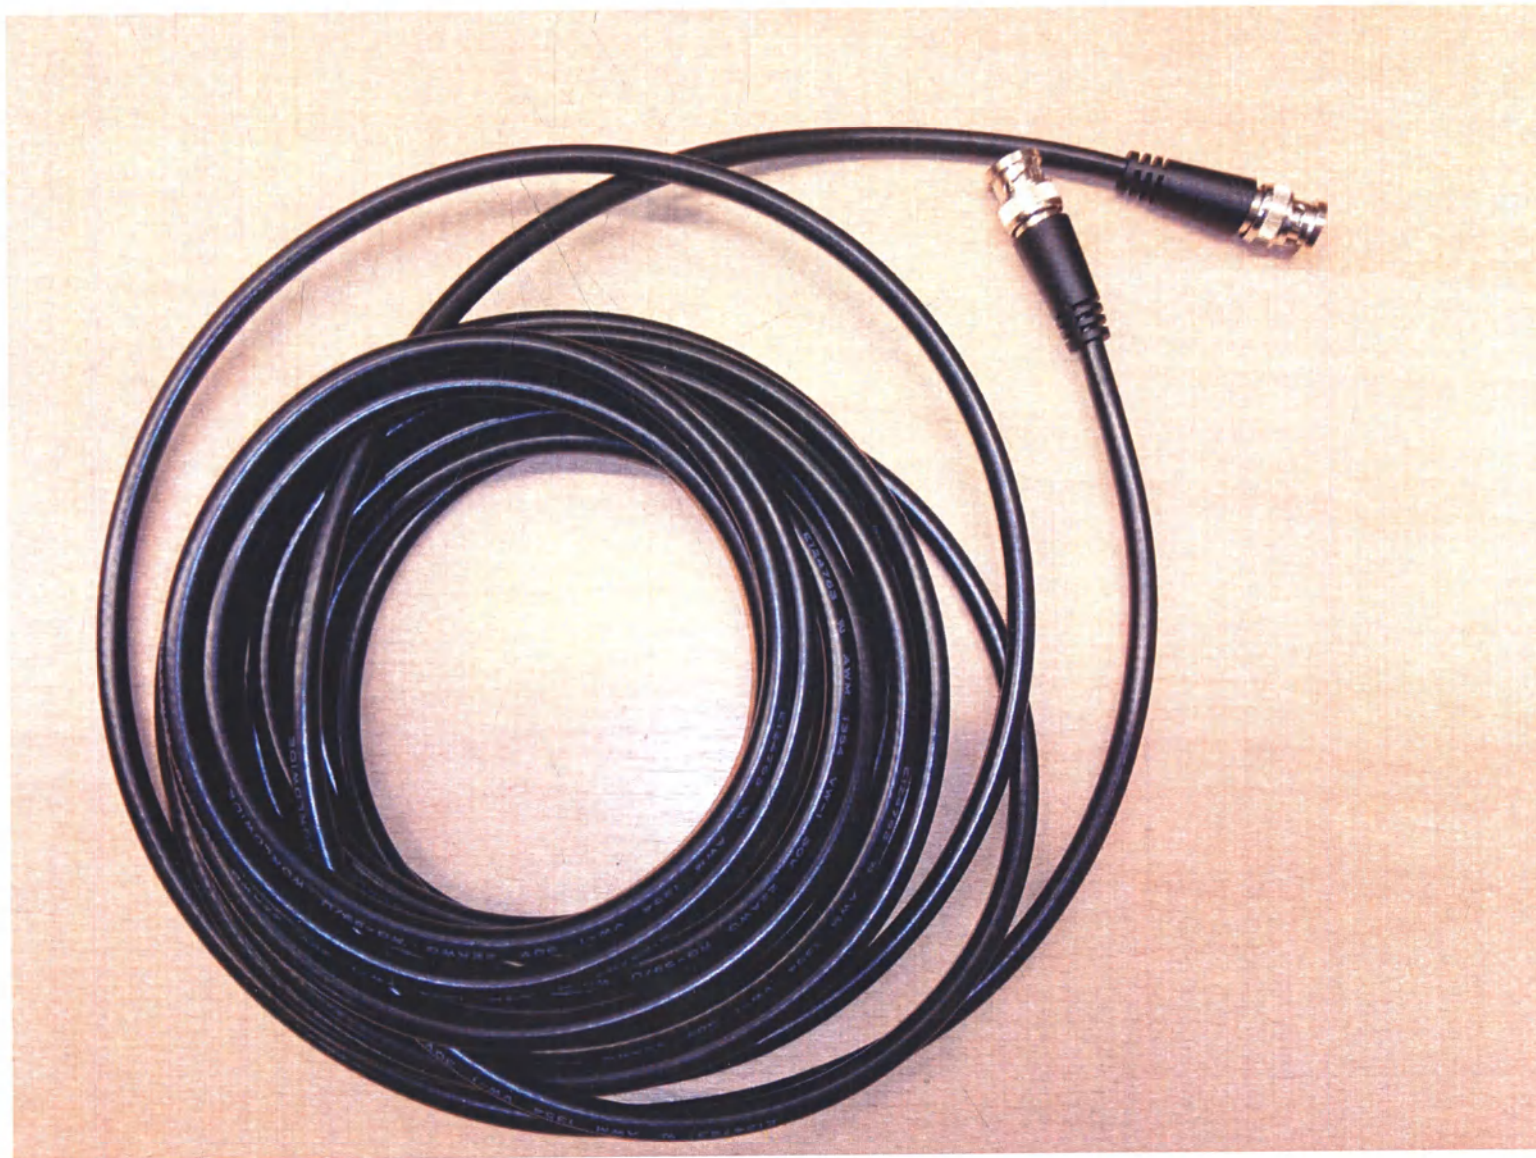

17. Лоток для лапароскопов и световодного кабеля

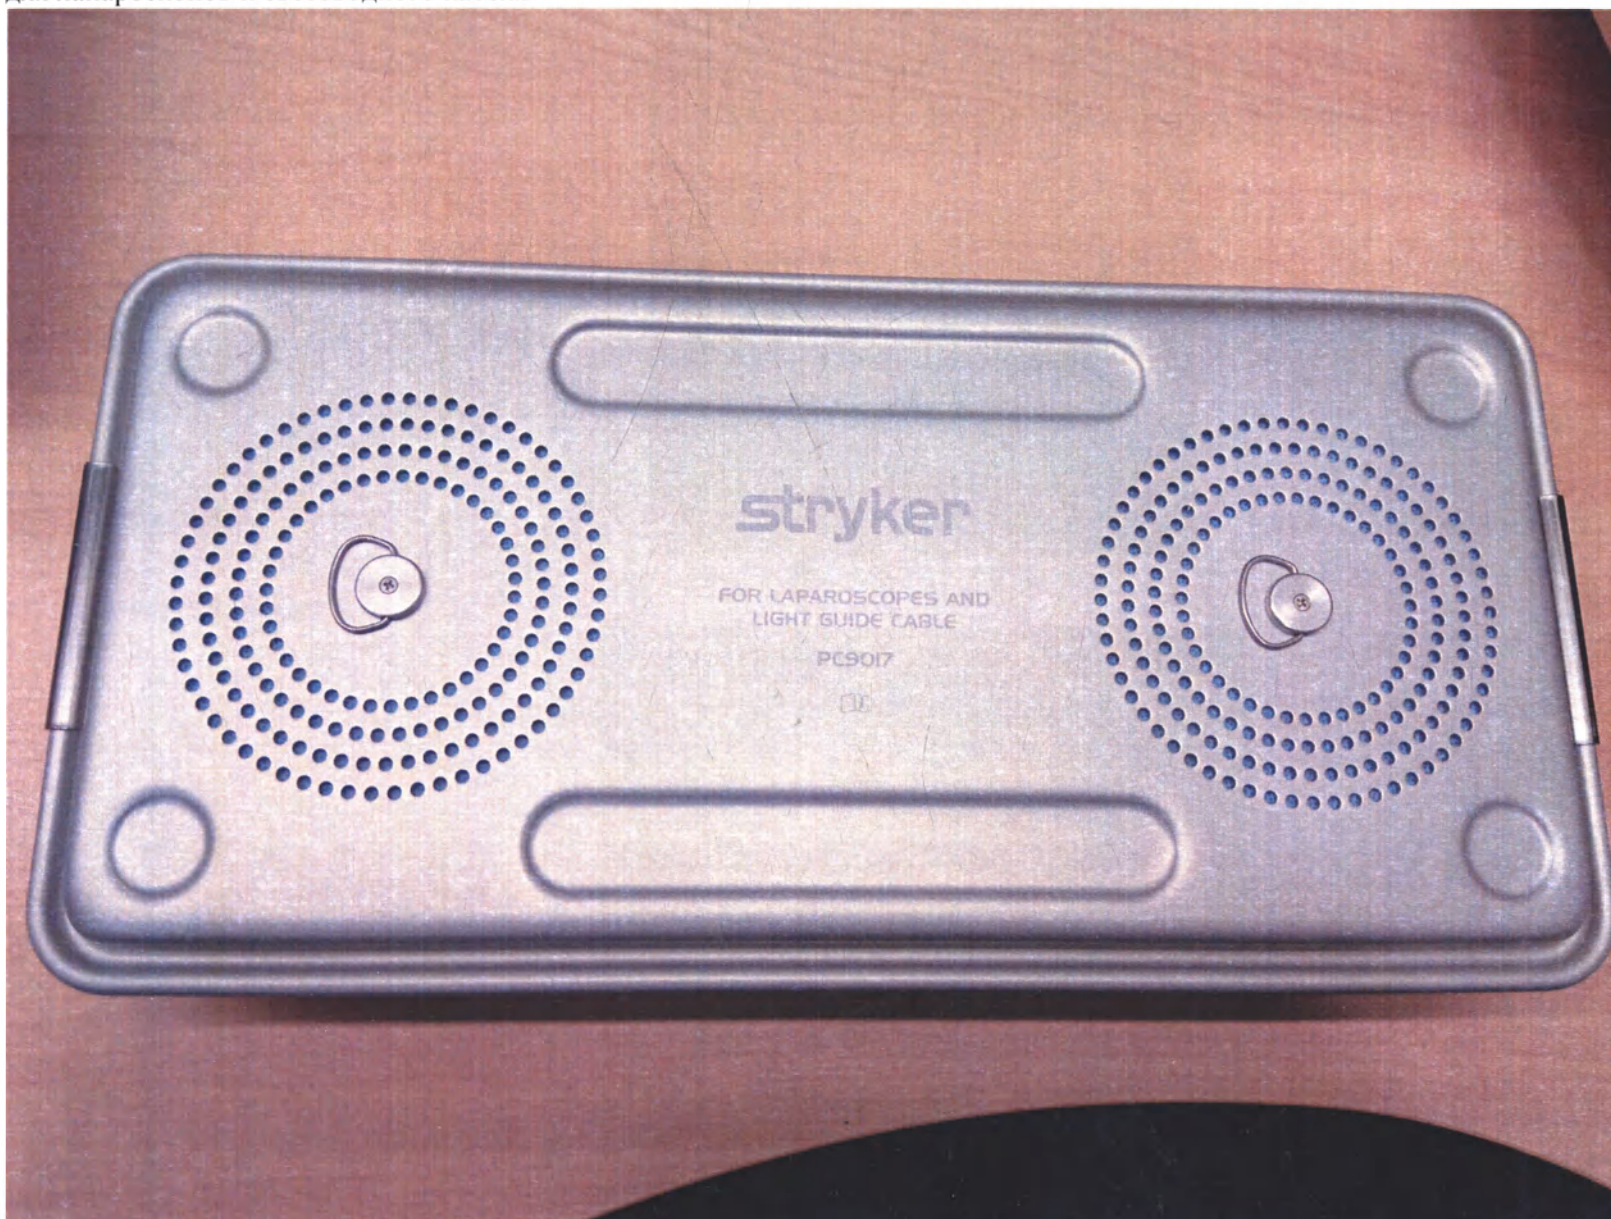

18. Пломба, STERRAD (1000 шт в упаковке)

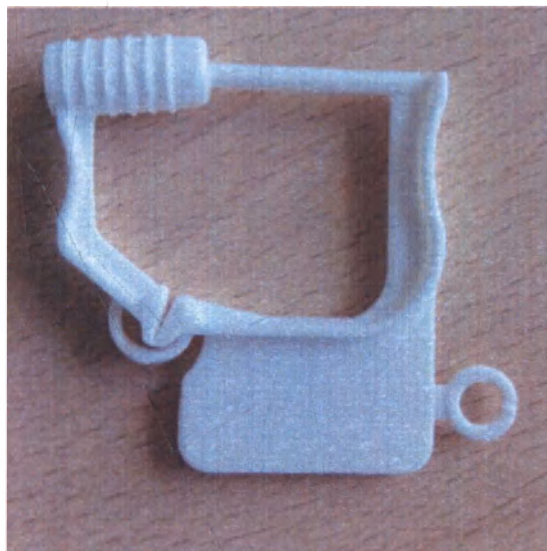


19. Пломба, пар (1000 шт в упаковке)




20. Стерилизационный лоток.




21. Фильтр, STERRAD (1000 шт в упаковке)

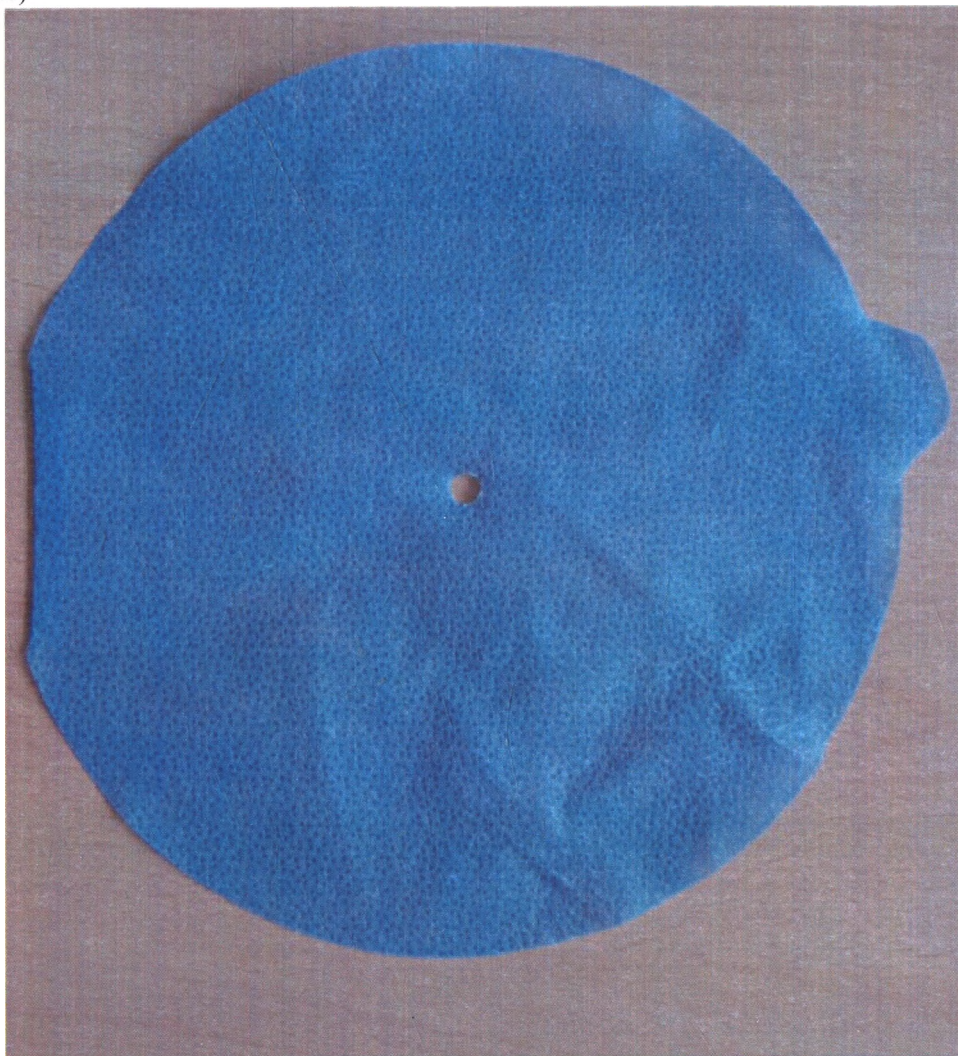

I. Вариант исполнения PINPOINT в сборе

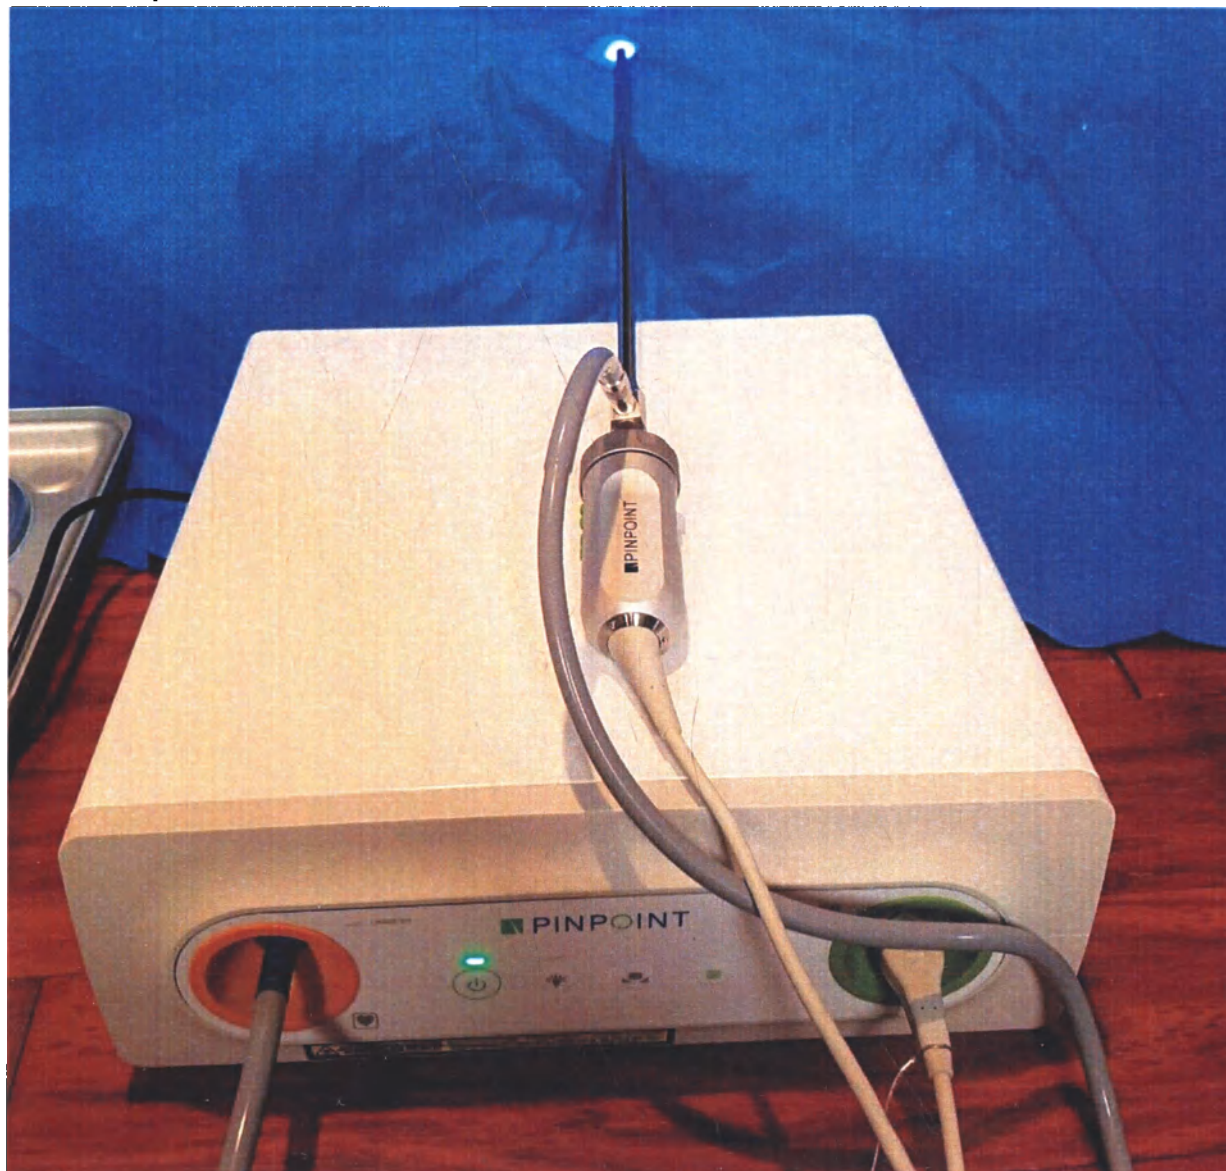

II. Вариант исполнения SPY-PHI в сборе

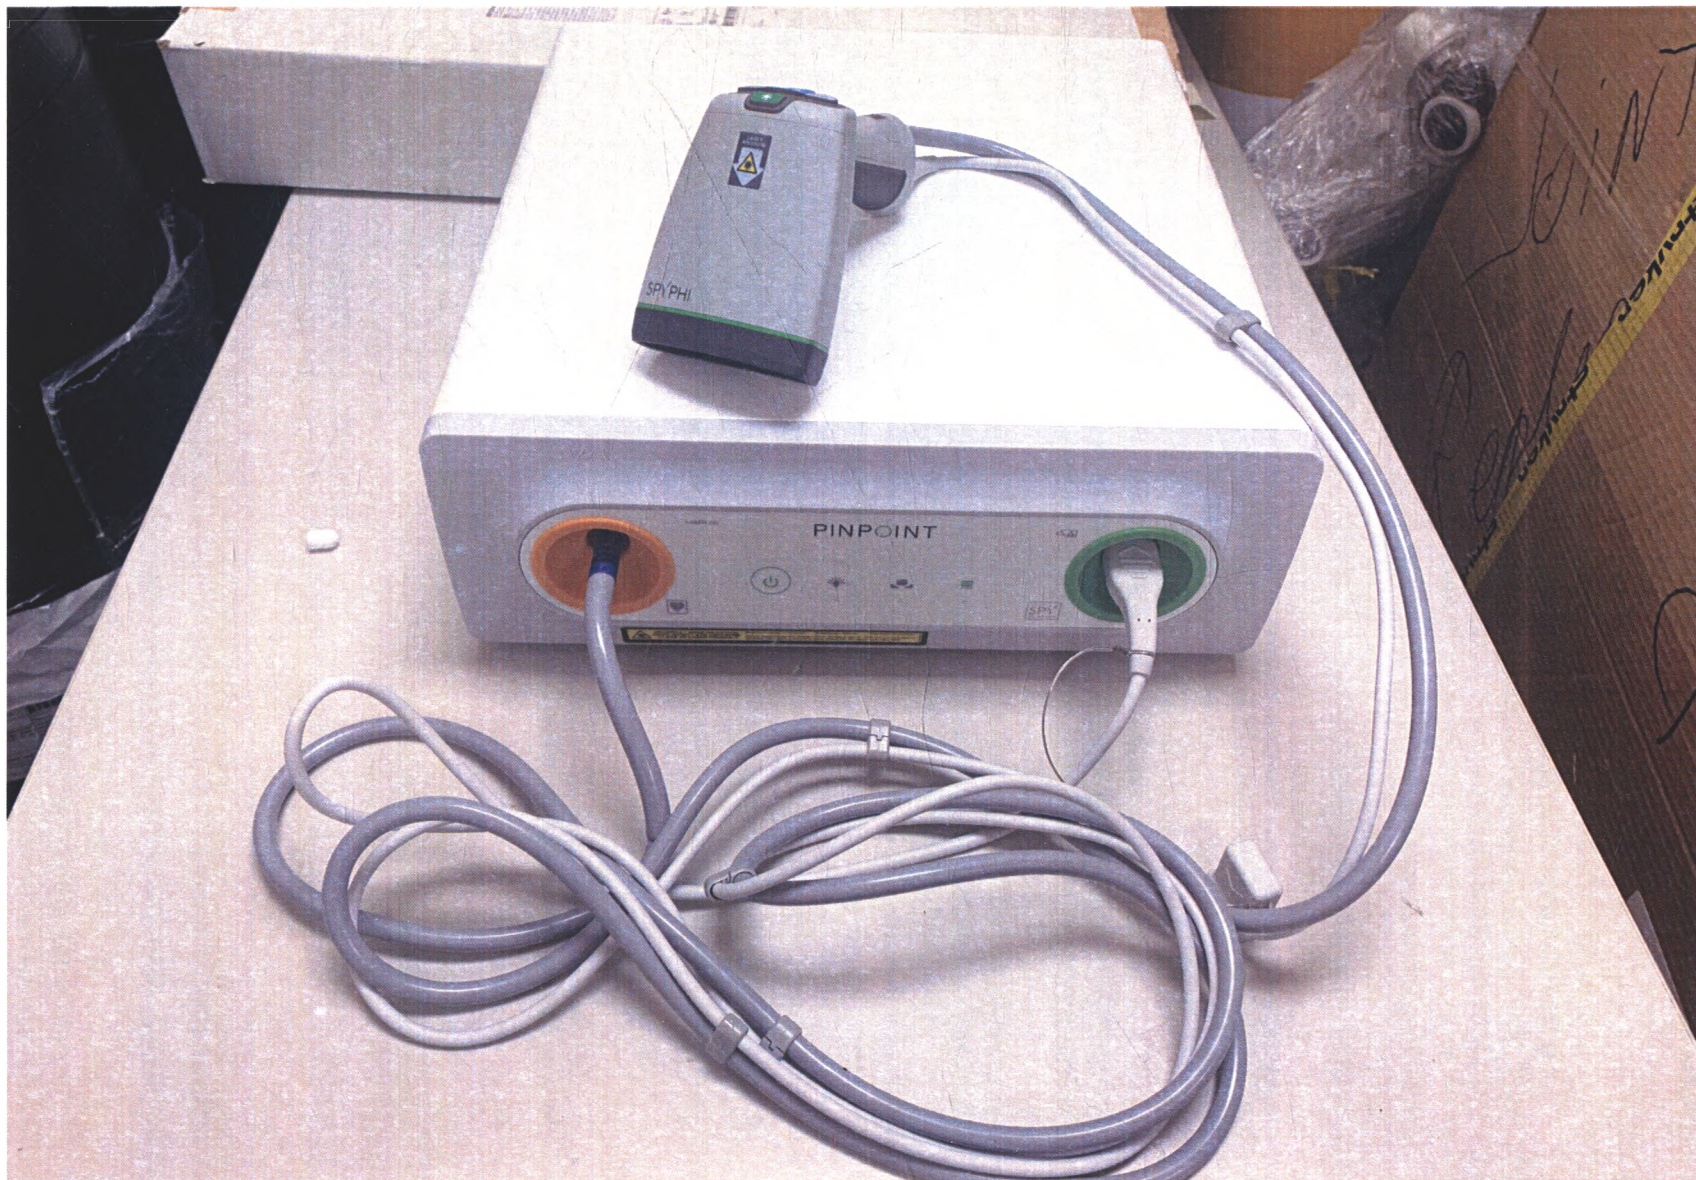

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия и упаковок на все варианты исполнения медицинского изделия:

I. Вариант исполнения PINPOINT в составе:

1. Блок обработки видеосигнала и осветитель (Video Processor / Illuminator (VPI). модель PC9001).
2. Камера PINPOINT, модель PC9002.
3. Световодный кабель модель PC9004, не более 10 шт.
4. Лапароскоп для получения флюоресцентных изображений, варианты исполнения:
 - 4.1. Модель SC9104 (диаметр 10 мм, угол обзора 0°, 32 см), (при необходимости до 10 шт.).
 - 4.2. Модель SC9134 (диаметр 10 мм, угол обзора 30°, 32 см), (при необходимости до 10 шт.).
 - 4.3. Модель SC9144 (диаметр 10 мм, угол обзора 45°, 32 см), (при необходимости до 10 шт.).
 - 4.4. Модель SC9504 (диаметр 5 мм, угол обзора 0°, 30 см), (при необходимости до 10 шт.).
 - 4.5. Модель SC9534 (диаметр 5 мм, угол обзора 30°, 30 см), (при необходимости до 10 шт.).
 - 4.6. Модель SC9544 (диаметр 5 мм, угол обзора 45°, 30 см), (при необходимости до 10 шт.).
5. Шнур питания.
6. Кабель HD-SDI (при необходимости).
7. Адаптер световода, Olympus, модель PC9022 (при необходимости до 10 шт.).
8. Адаптер световода, Storz, модель PC9021 (при необходимости до 10 шт.).
9. Адаптер эндоскопа, Storz, модель PC9023 (при необходимости до 10 шт.).
10. Адаптер эндоскопа, Wolf, модель PC9024 (при необходимости до 10 шт.).
11. Стерилизационный лоток, модель PC9018 (при необходимости).
12. Лоток для лапароскопов и световодного кабеля, модель PC9017 (при необходимости до 10 шт.).
13. Пломба, STERRAD, модель 950-00009-000 (при необходимости, 1000 шт в упаковке).
14. Фильтр, STERRAD, модель 950-00014-000 (при необходимости, 1000 шт в упаковке).
15. Пломба, пар, модель 950-00013-000 (при необходимости, 1000 шт в упаковке).
17. Руководство оператора «Система получения флуоресцентных изображений в ближнем инфракрасном диапазоне, в вариантах исполнения».

II. Вариант исполнения SPY-PHI, в составе:

1. Блок обработки видеосигнала и осветитель (Video Processor / Illuminator (VPI) модель PC9001).
2. Головка визуализации SPY-PHI (SPY Portable Handheld Imager (SPY-PHI) Модель HH9030).
3. Шнур питания.
4. Кабель HD-SDI(при необходимости).
5. Держатель головки визуализации SPY-PHI, модель HH1003 (при необходимости).
6. Драпировка SPY-PHI, модель HH2020 (20 шт. в уп., при необходимости до 100 уп.).
7. Штатив SPY-PHI, модель HH1001 (при необходимости).
8. Зажим для штатива SPY-PHI, модель HH1002 (при необходимости).
9. Стерилизационный лоток, модель PC9018 (при необходимости).
10. Руководство оператора «Система получения флуоресцентных изображений в ближнем инфракрасном диапазоне, в вариантах исполнения. Головка визуализации SPY-PHI (SPY Portable Handheld Imager (SPY-PHI) Модель HH9030».
11. Инструкция по применению «Штатив SPY-PHI». (при необходимости)

III. Вариант исполнения PINPOINT/SPY-PHI, в составе.

1. Блок обработки видеосигнала и осветитель (Video Processor / Illuminator (VPI) модель PC9001).
2. Камера PINPOINT модель PC9002.
3. Световодный кабель модель PC9004, не более 10 шт.
4. Лапароскоп для получения флюоресцентных изображений, варианты исполнения:
 - 4.1. Модель SC9104 (диаметр 10 мм, угол обзора 0°, 32 см), (при необходимости до 10 шт.).

- 4.2. Модель SC9134 (диаметр 10 мм, угол обзора 30°, 32 см), (при необходимости до 10 шт.).
- 4.3. Модель SC9144 (диаметр 10 мм, угол обзора 45°, 32 см), (при необходимости до 10 шт.).
- 4.4. Модель SC9504 (диаметр 5 мм, угол обзора 0°, 30 см), (при необходимости до 10 шт.).
- 4.5. Модель SC9534 (диаметр 5 мм, угол обзора 30°, 30 см), (при необходимости до 10 шт.).
- 4.6. Модель SC9544 (диаметр 5 мм, угол обзора 45°, 30 см), (при необходимости до 10 шт.).
5. Шнур питания.
6. Кабель HD-SDI (при необходимости).
7. Головка визуализации SPY-PHI (SPY Portable Handheld Imager (SPY-PHI) Модель HH9030).
8. Адаптер световода, Olympus, модель PC9022 (при необходимости до 10 шт.).
9. Адаптер световода, Storz, модель PC9021 (при необходимости до 10 шт.).
10. Адаптер эндоскопа, Storz, модель PC9023 (при необходимости до 10 шт.).
11. Адаптер эндоскопа, Wolf, модель PC9024 (при необходимости до 10 шт.).
12. Стерилизационный лоток, модель PC9018 (при необходимости).
13. Лоток для лапароскопов и световодного кабеля, модель PC9017 (до 10 шт при необходимости).
14. Пломба, STERRAD, модель 950-00009-000 (при необходимости, 1000 шт в упаковке).
15. Фильтр, STERRAD, модель 950-00014-000 (при необходимости, 1000 шт в упаковке).
16. Пломба, пар, модель 950-00013-000 (при необходимости, 1000 шт в упаковке).
18. Держатель головки визуализации SPY-PHI, модель HH1003 (при необходимости).
19. Драпировка SPY-PHI, модель HH2020 (20 шт. в уп., при необходимости до 100 уп.).
20. Штатив SPY-PHI, модель HH1001 (при необходимости).
21. Зажим для штатива SPY-PHI, модель HH1002 (при необходимости).
22. Руководство оператора «Система получения флуоресцентных изображений в ближнем инфракрасном диапазоне, в вариантах исполнения».
23. Руководство оператора «Система получения флуоресцентных изображений в ближнем инфракрасном диапазоне, в вариантах исполнения. Головка визуализации SPY-PHI (SPY Portable Handheld Imager (SPY-PHI) Модель HH9030».
24. Инструкция по применению «Штатив SPY-PHI». (при необходимости)

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 22 листа (ов)
Старший специалист по регистрации
ООО «Страйкер»

А.В. Моисеева
По доверенности б/н от 4.07.2019 г