



Фотографические изображения медицинского изделия:


**«Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов
Nanozoomer с принадлежностями, в вариантах исполнения»**

Вариант исполнения:
Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов
Nanozoomer S60 C13210-01







Диск 1 с руководством по эксплуатации C13210-01 (PDF)

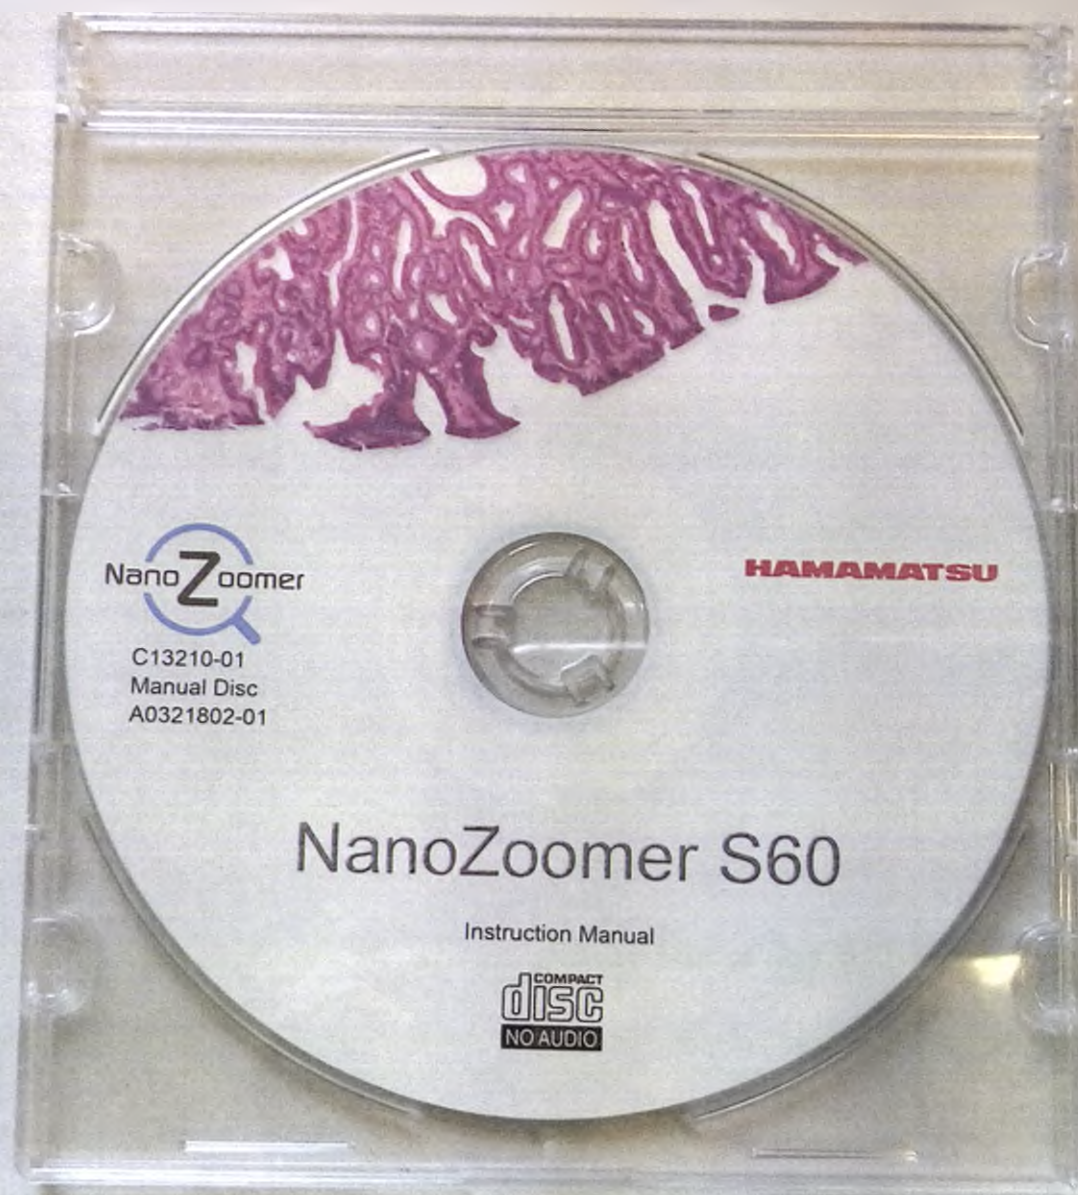


Диск программным обеспечением VMS.AutoCopy

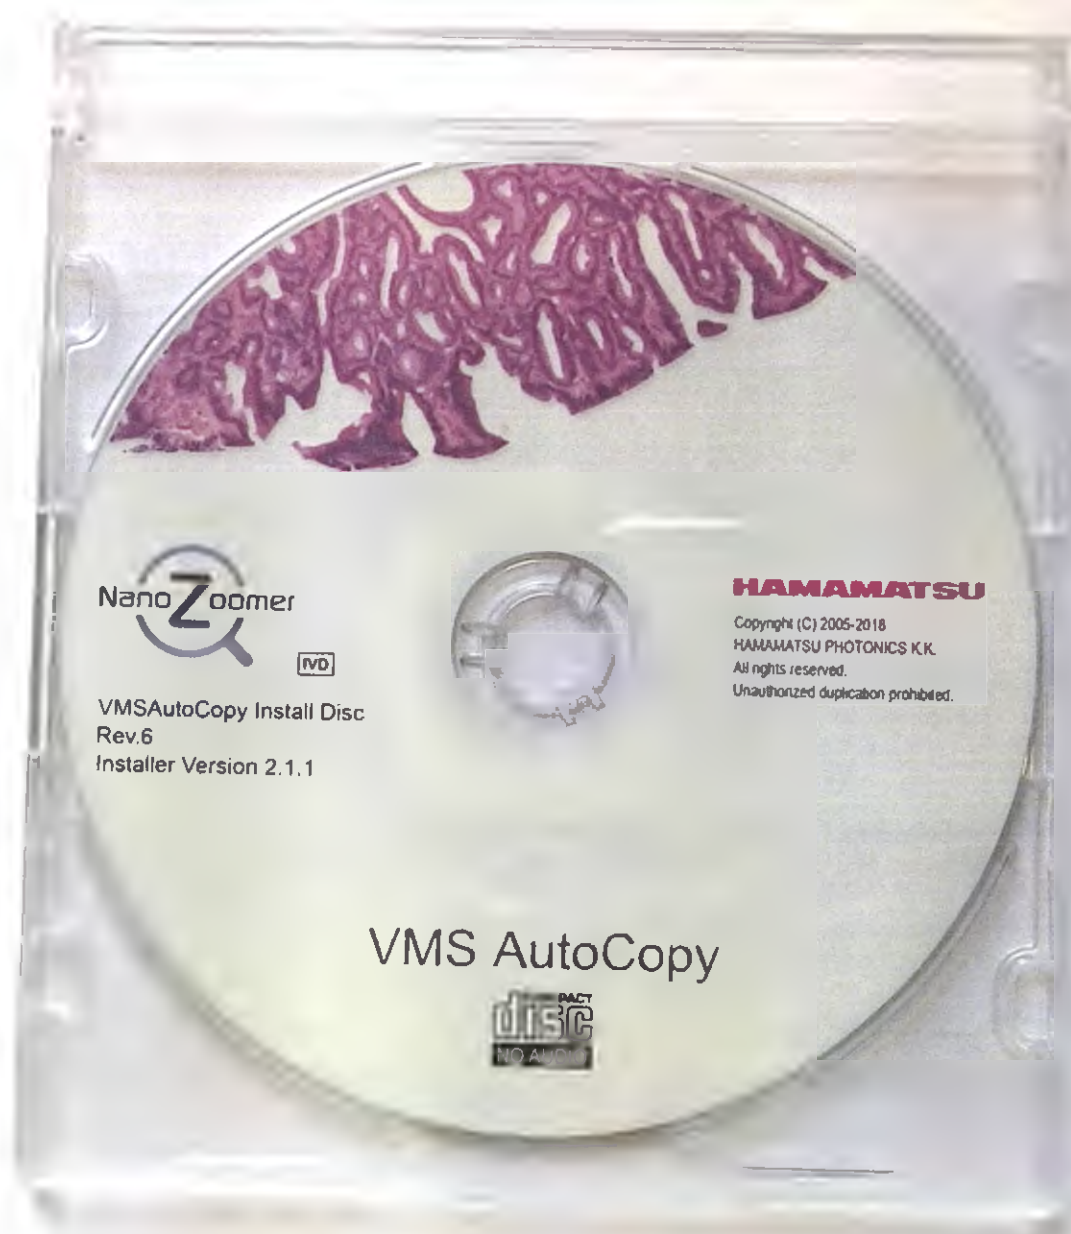


Диск 3 с программным обеспечением NDP.scan и с программным обеспечением NDP.calibrationFluo

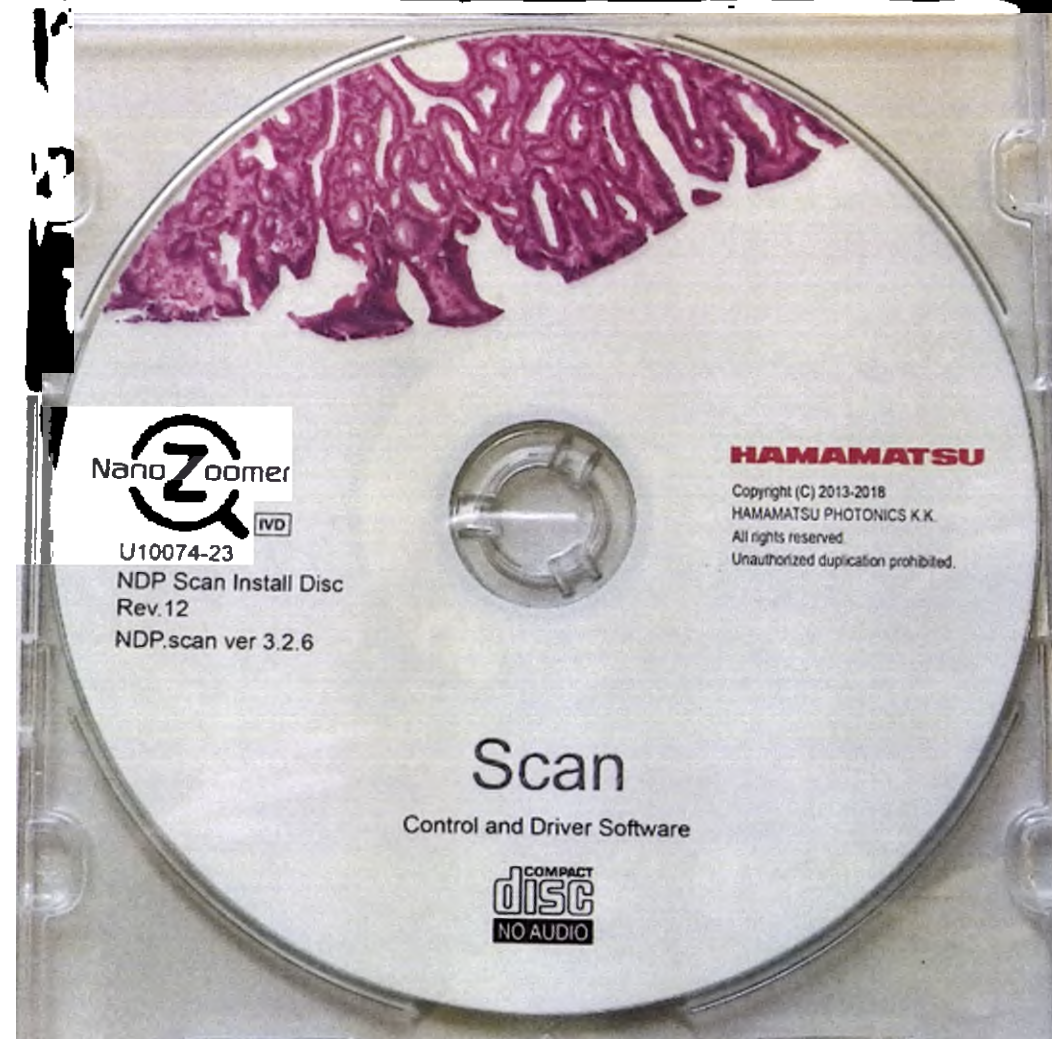


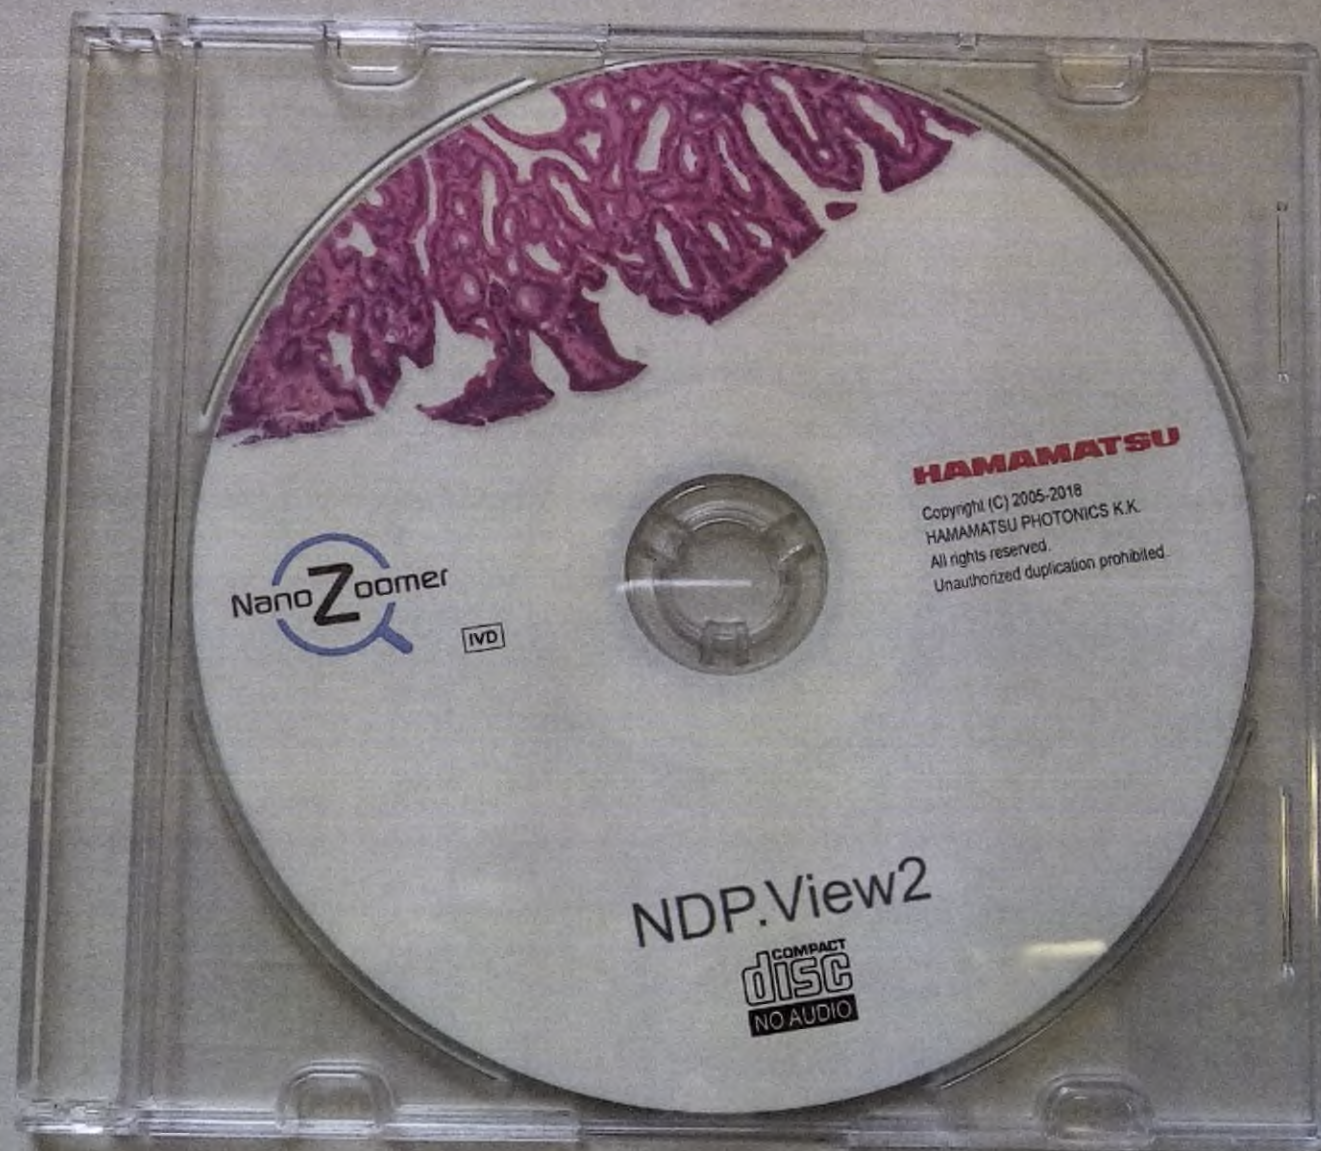


иск для адаптеров светофильтров Ex

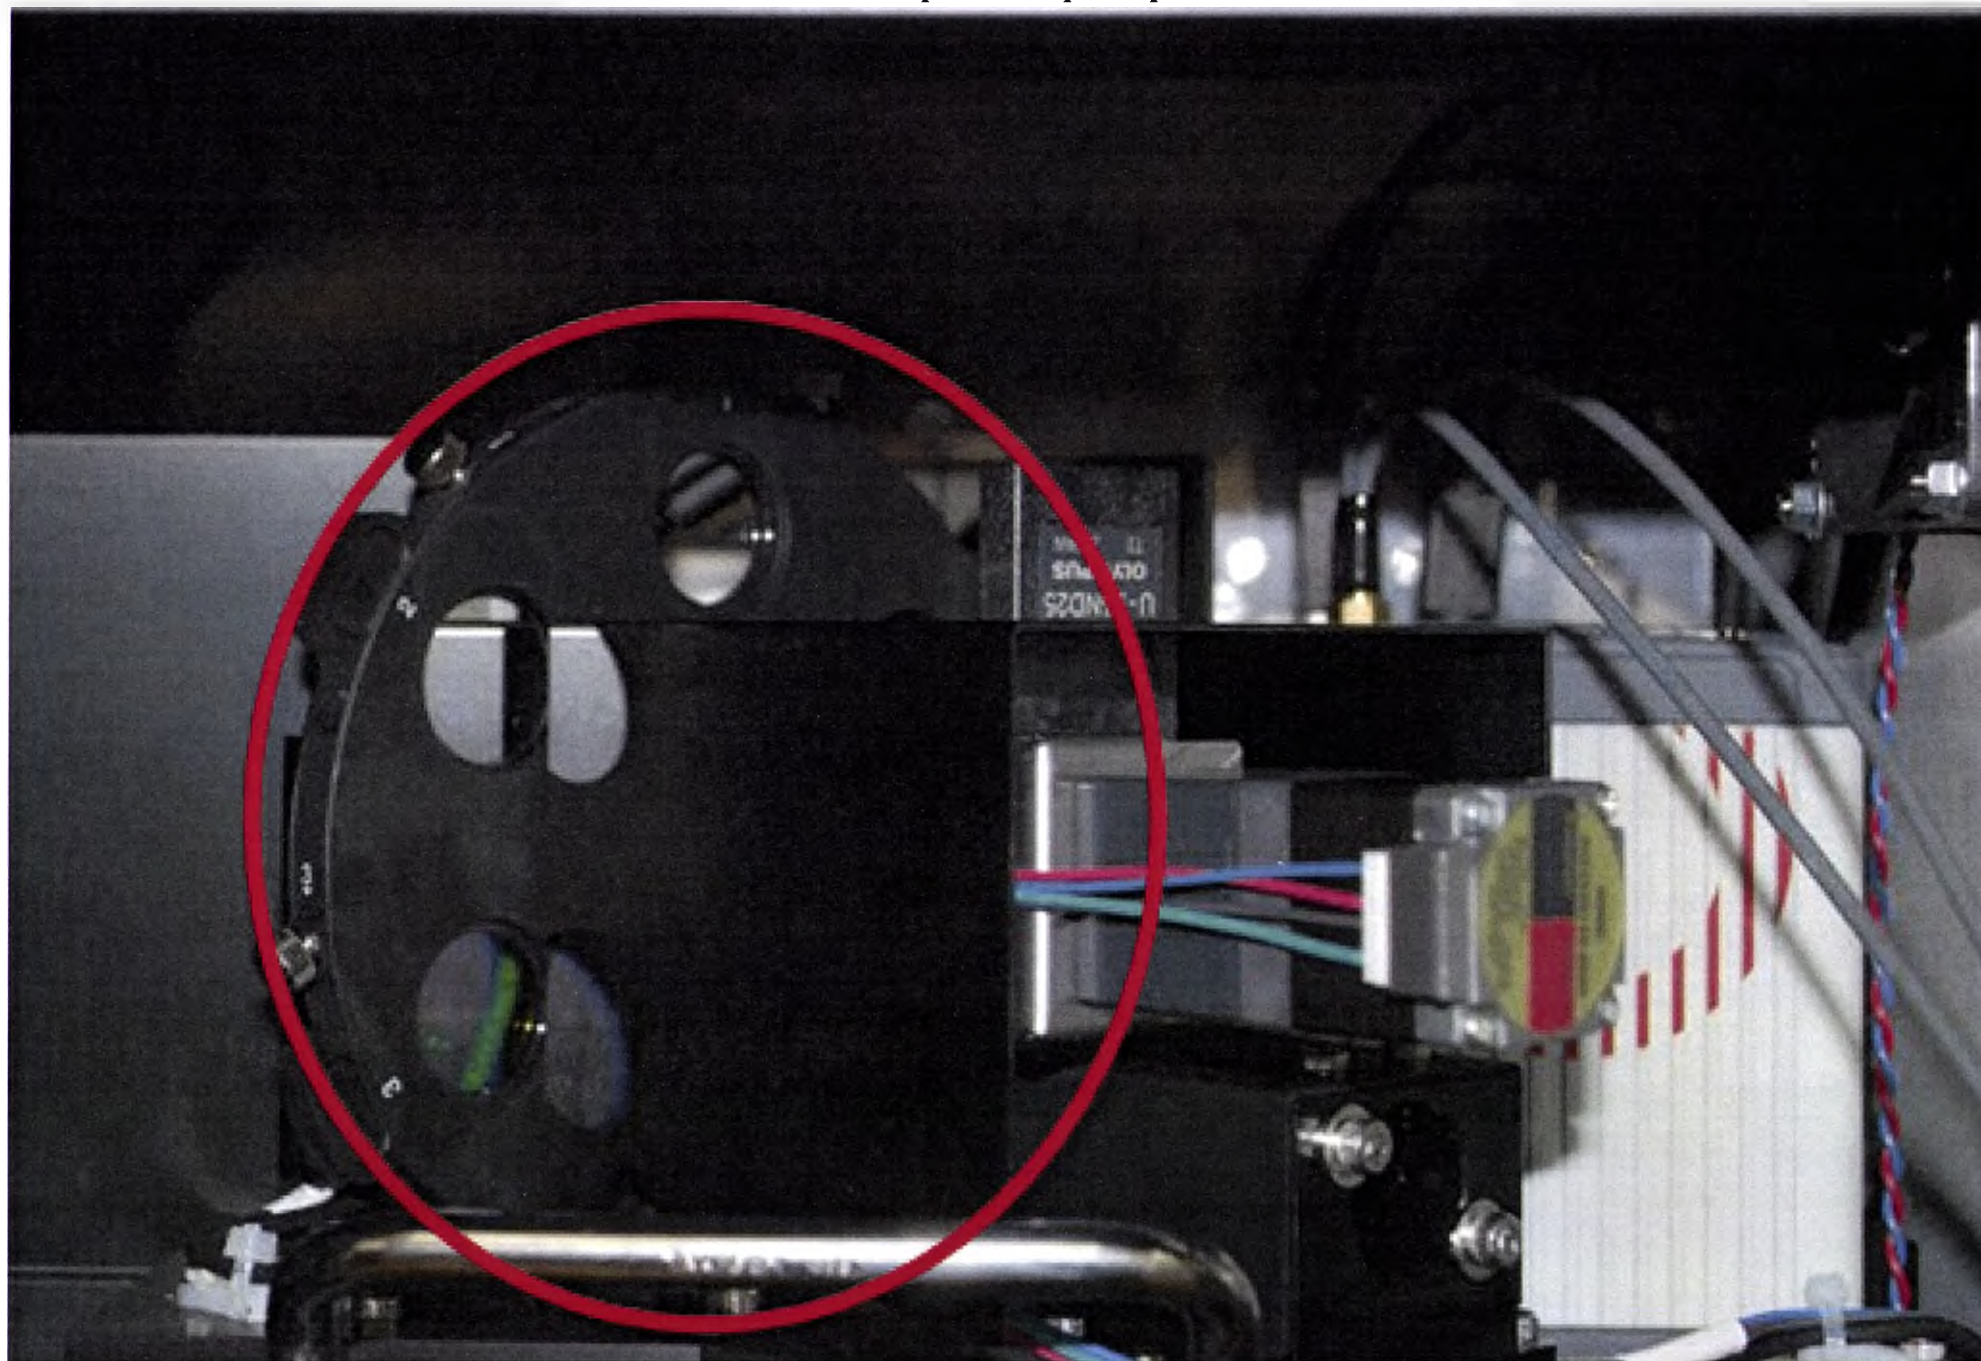

иск для адаптеров светофильтров Em

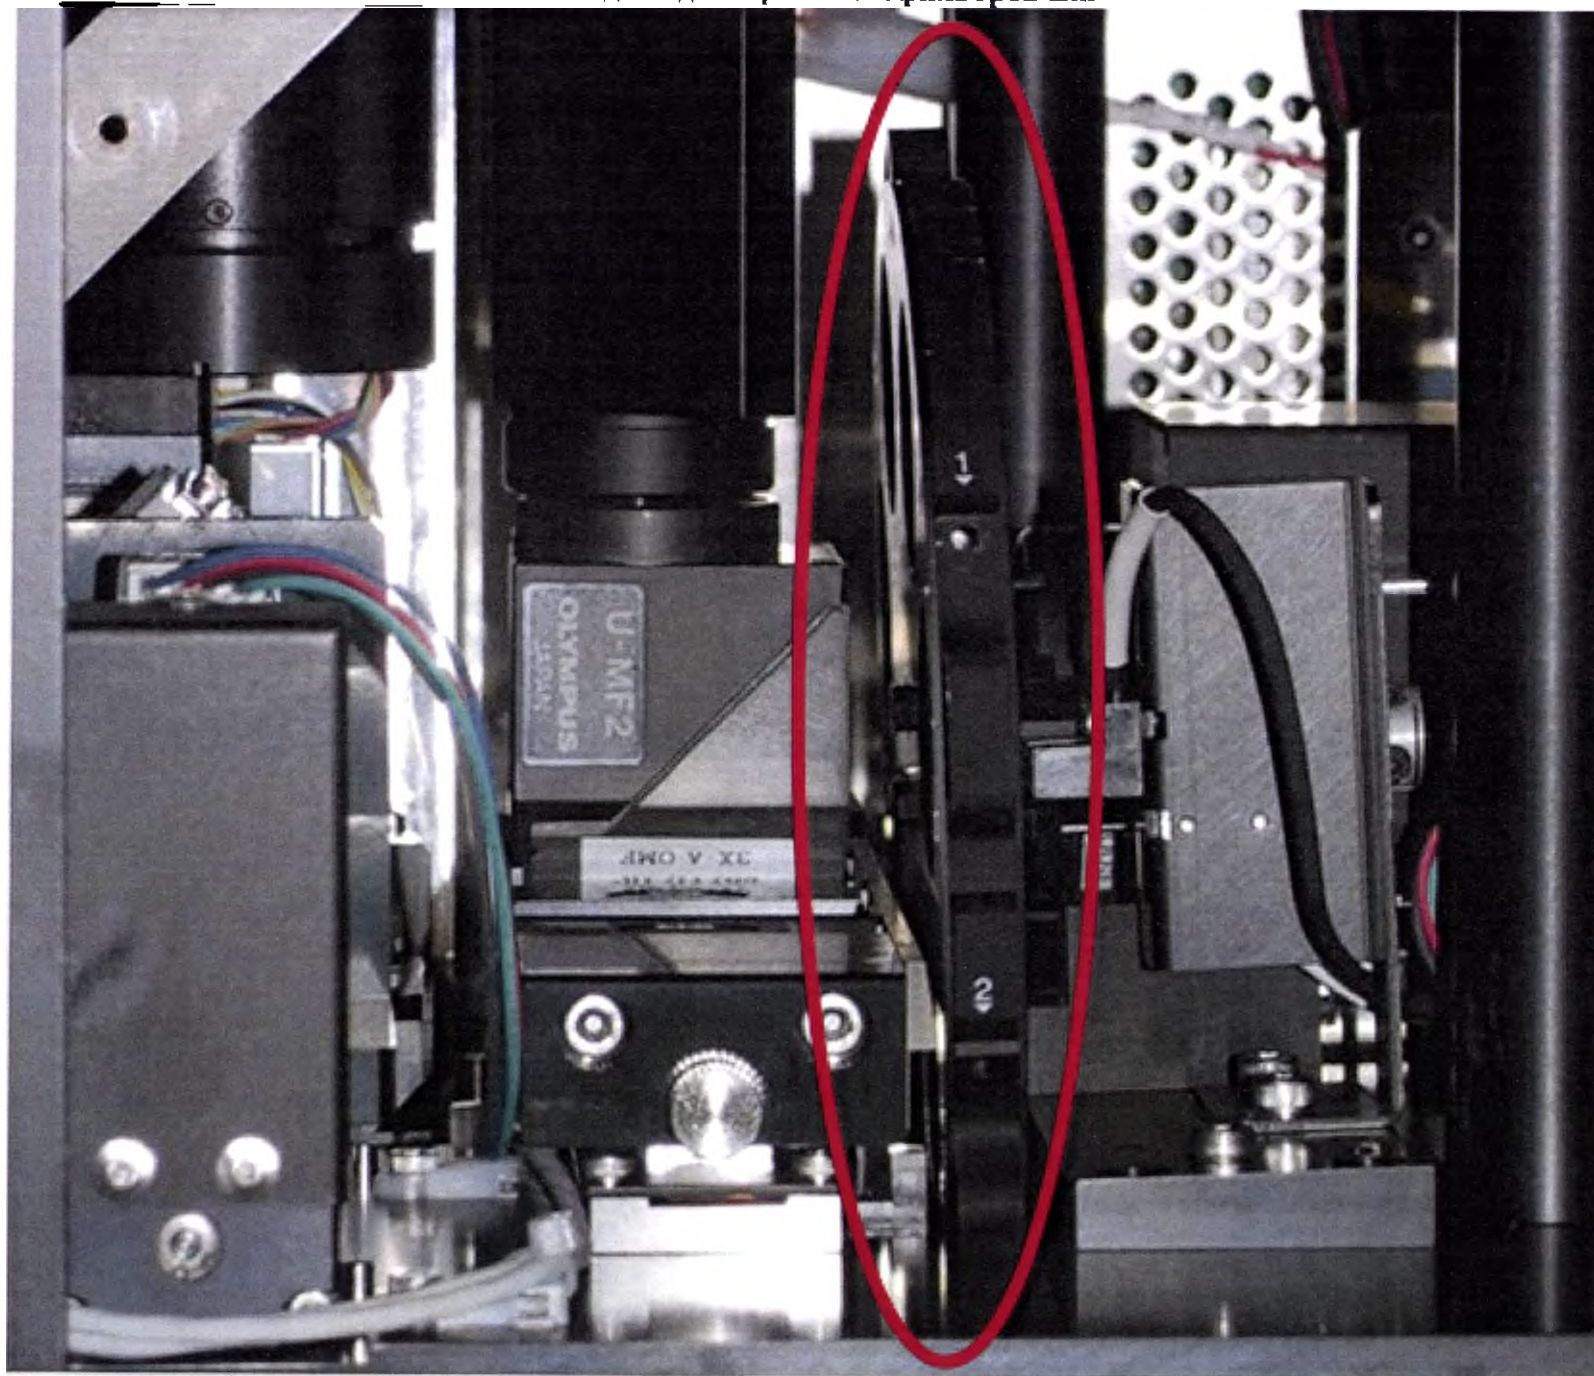


Модуль формирования флуоресцентных изображений

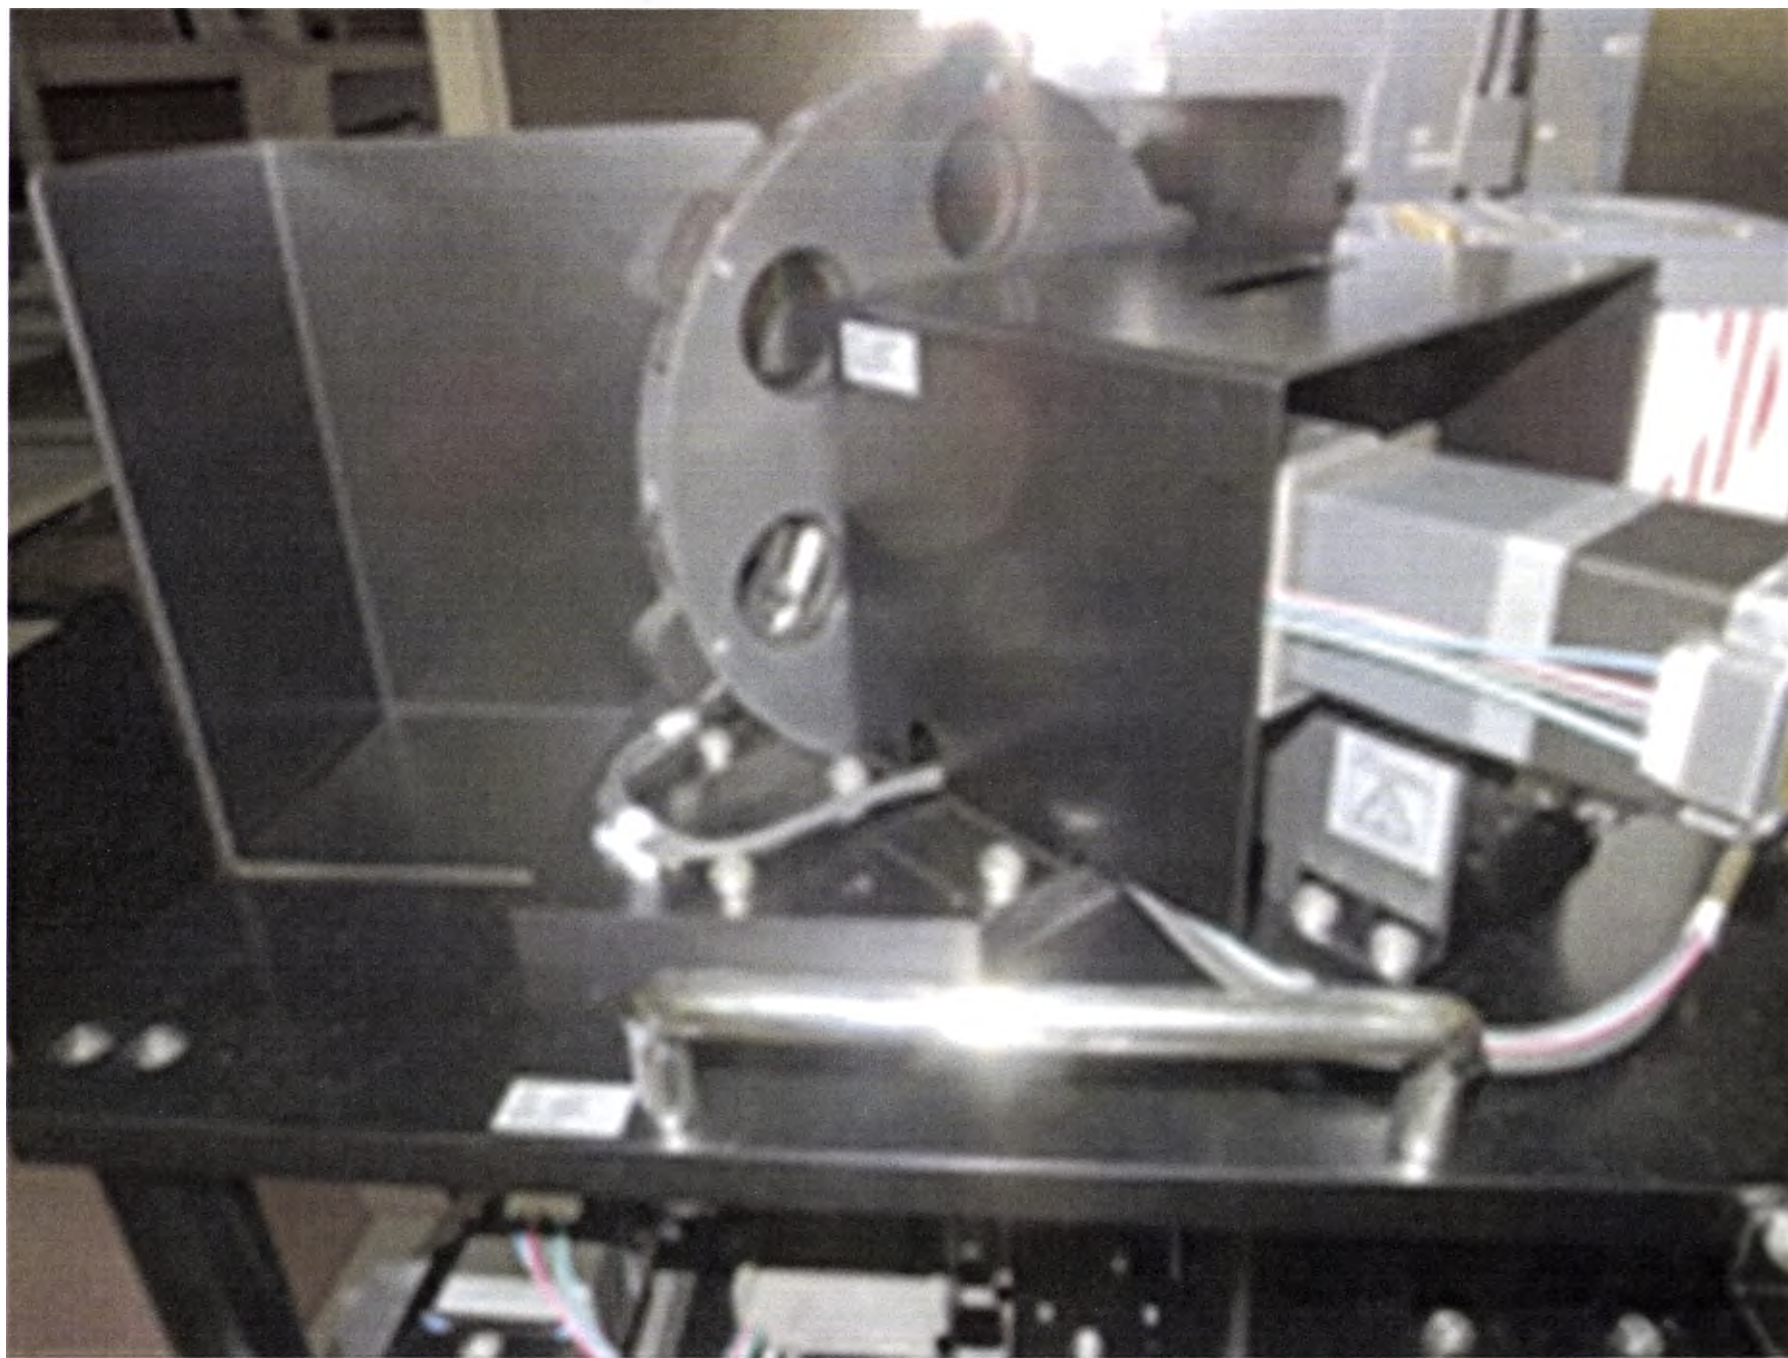

Диск 5 с руководством по эксплуата и модуля формирования флуоресцент с изображений L13820-01 (PDF)




Оптоволоконный кабель (представлен на фотографическом изображении с защитными колпачками)

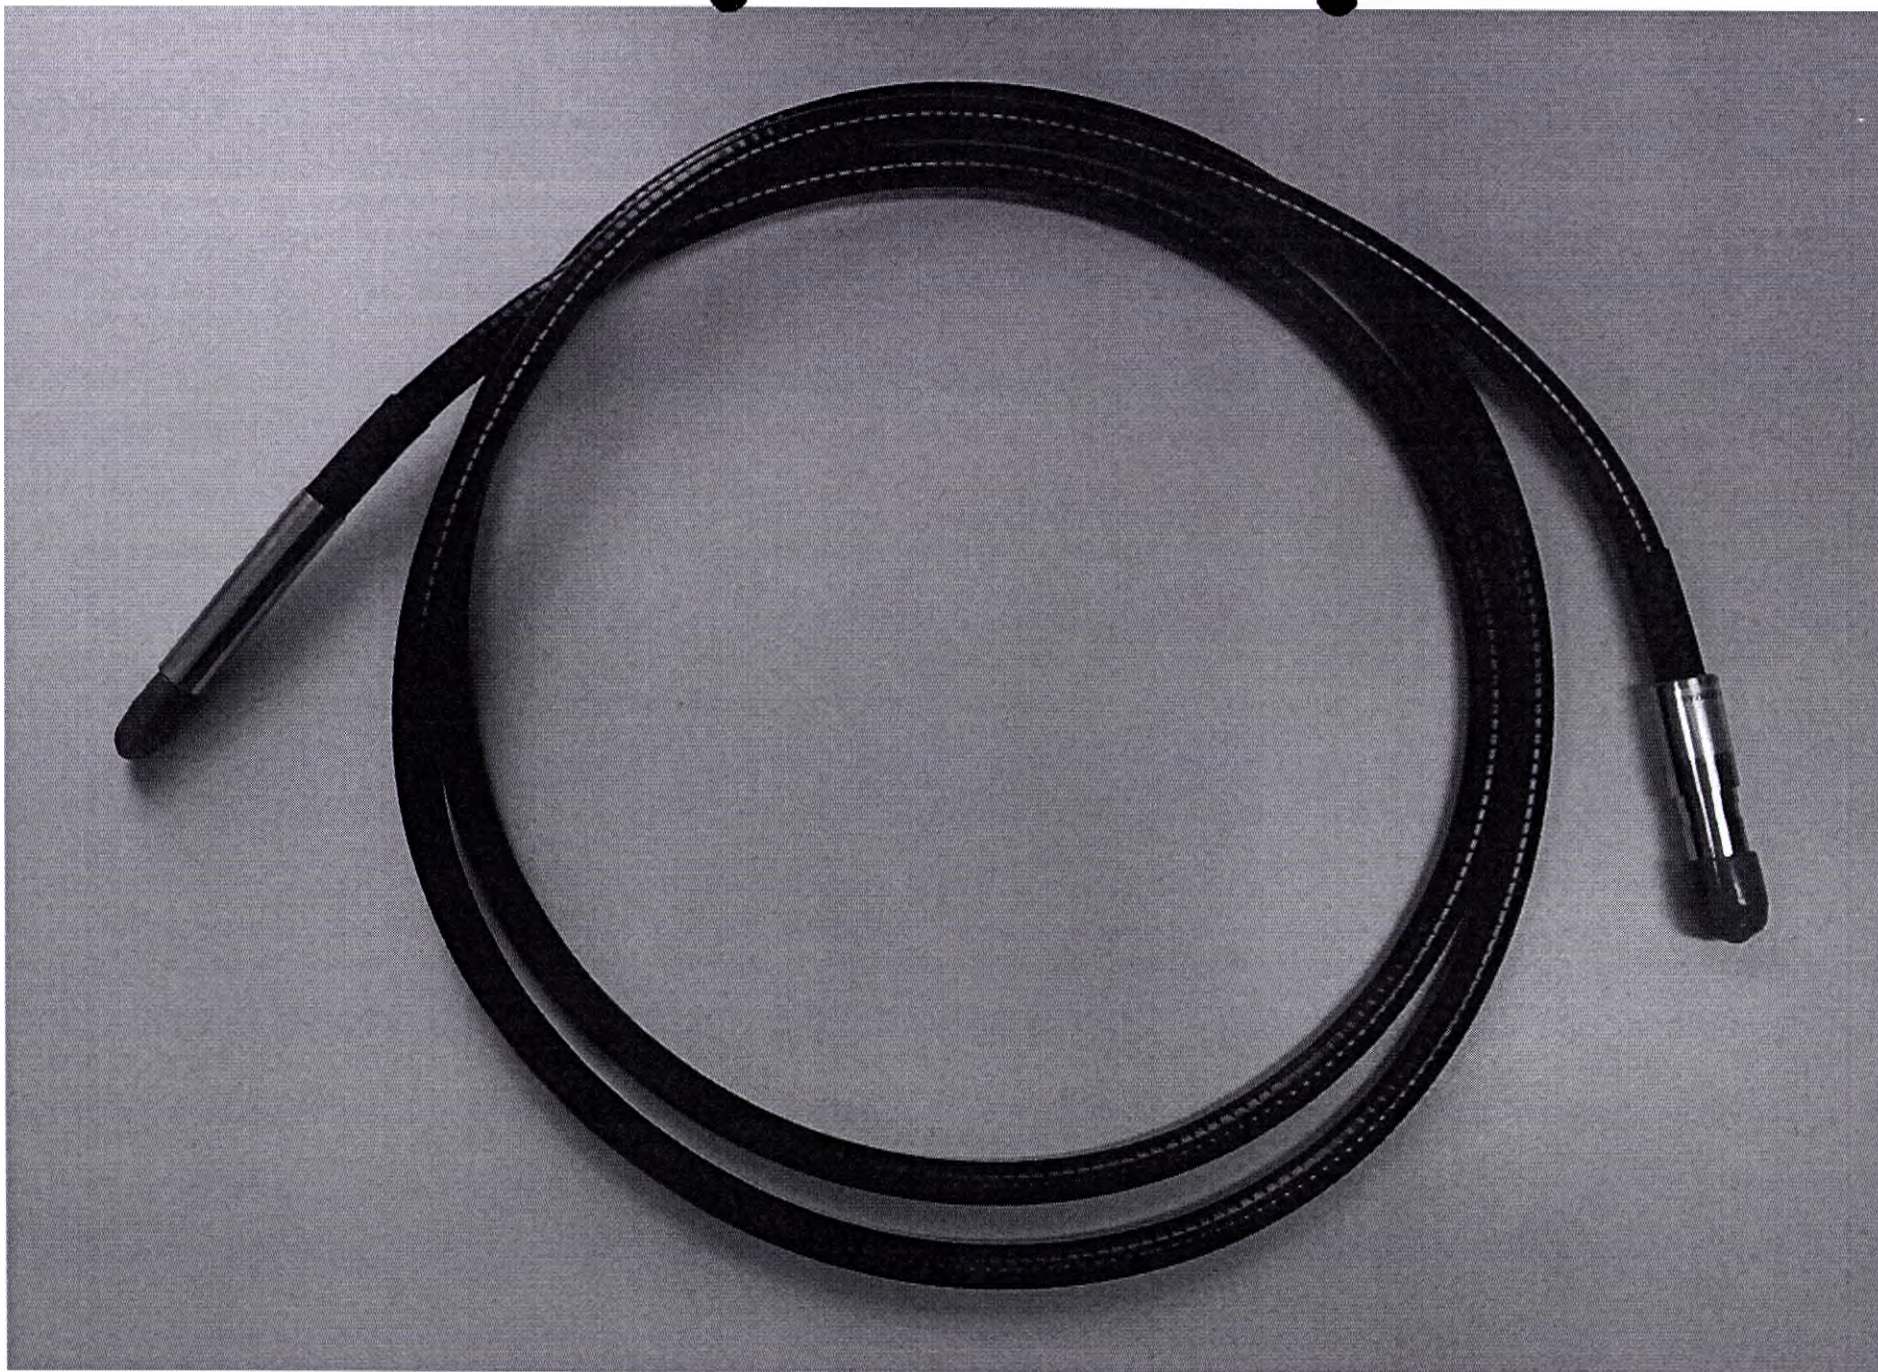


евой шнур для сканера Nanozoomer S60



ервный предохранитель: Т 4,0 А 250 В

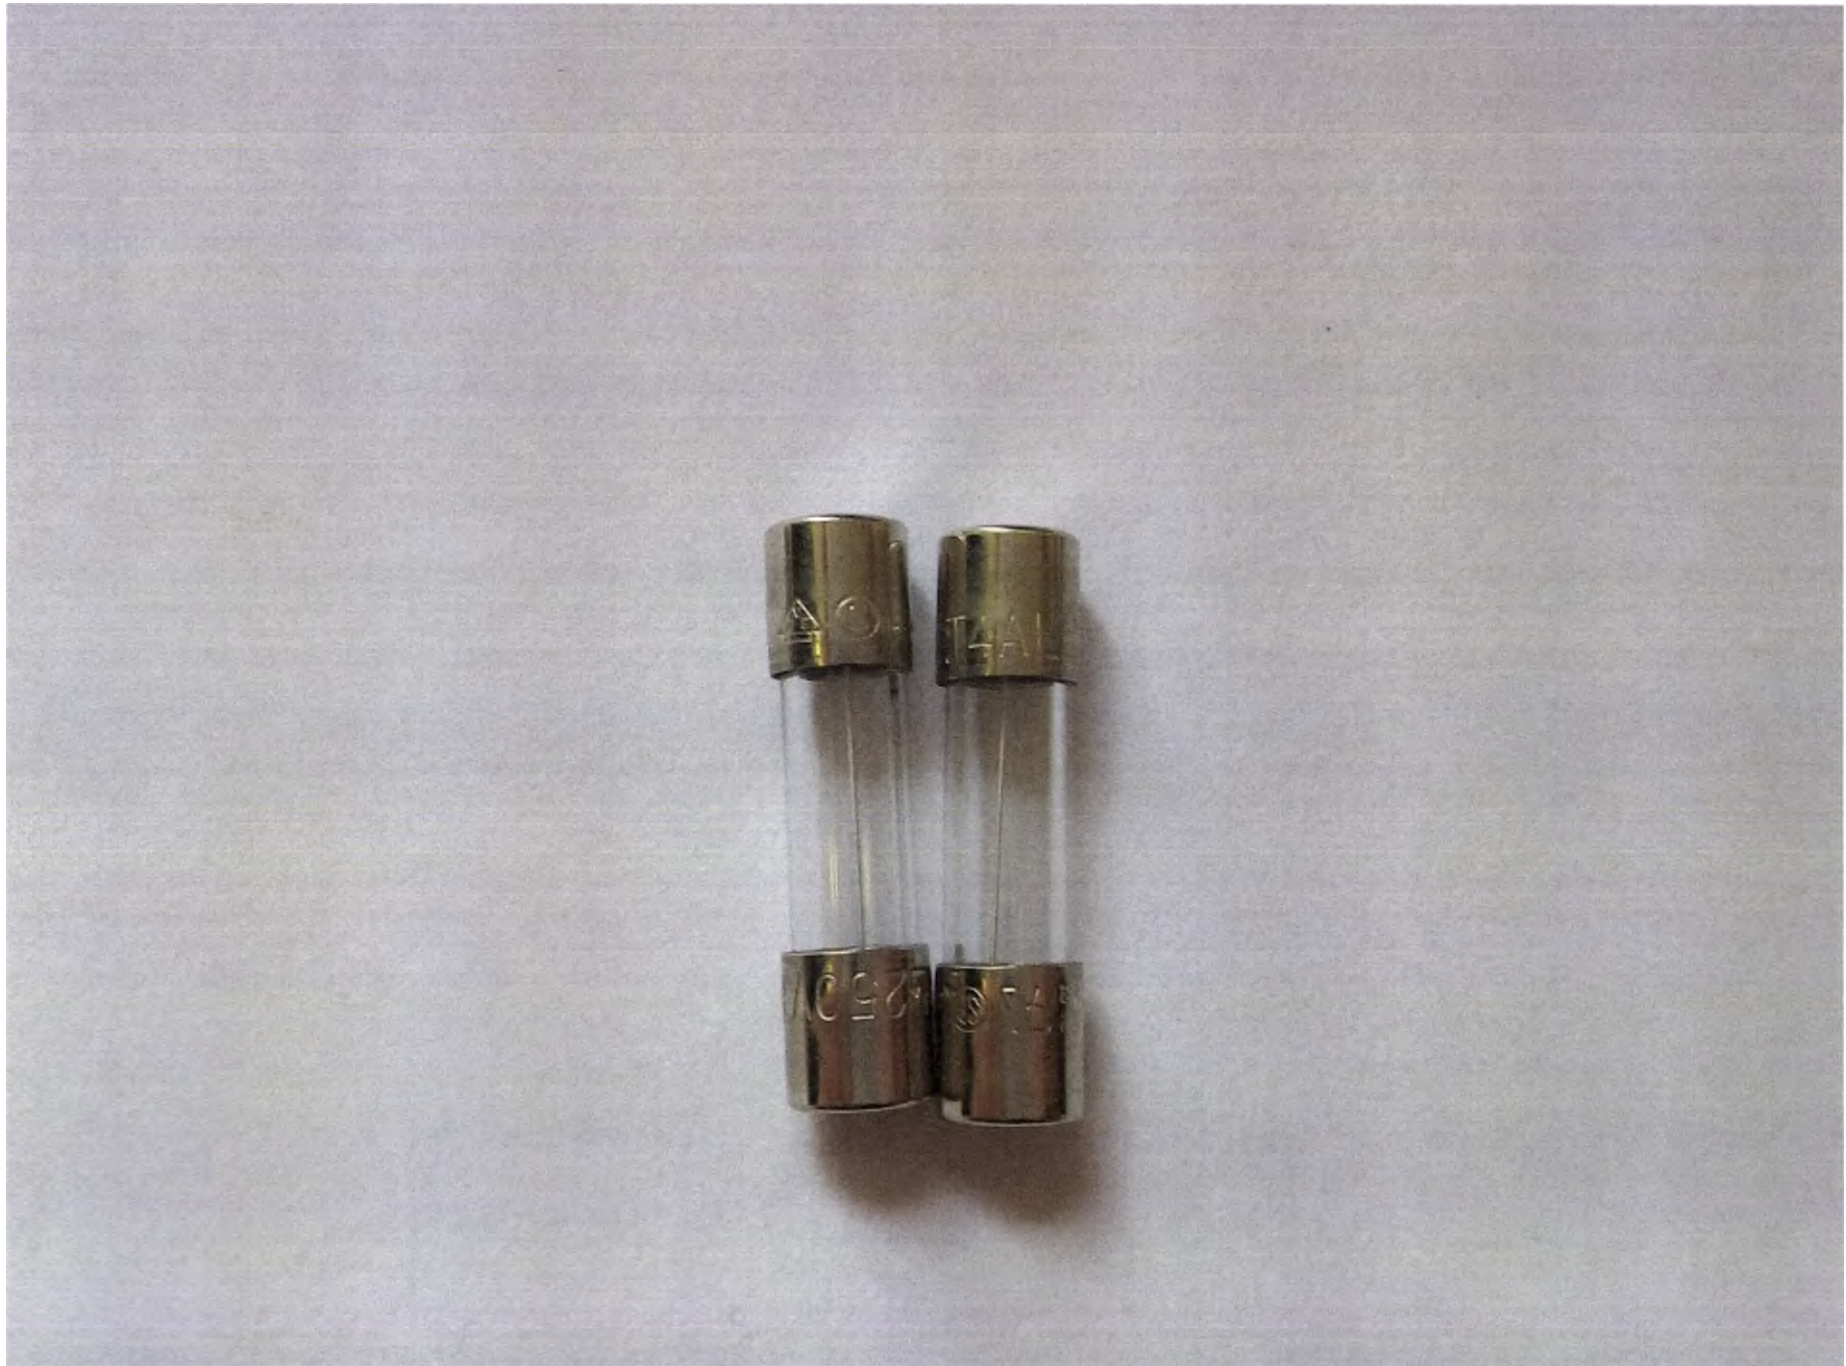


Диск 6 с резервными параметрами

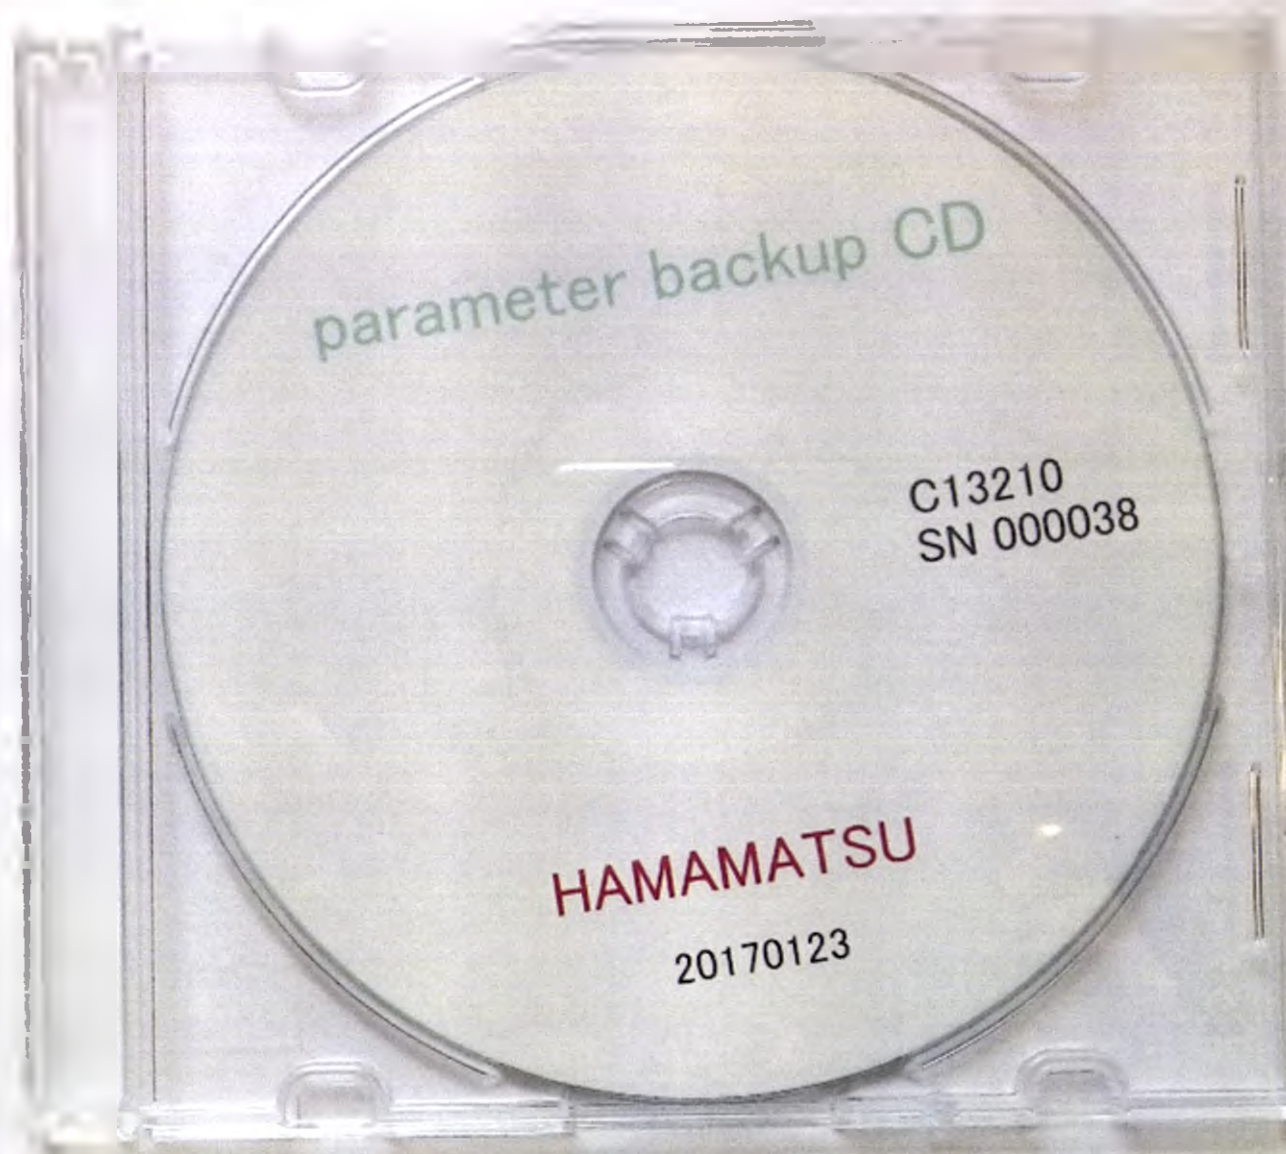

Конденсор A13891-01 NA0.2, Конденсор A13891-02 NA0.33, Конденсор A13891-03 NA0.5, Конденсор A13891-04 NA0.7 имеют схожий общий вид и отличаются только надписью на боковом ребре с обозначением апертуры конденсора NA (NA 0.2 - для Конденсора A13891-01 NA0.2, NA0.33 - для Конденсора A13891-02 NA0.33, NA 0.5 – для Конденсора A13891-03 NA0.5, NA 0.7 - Конденсор A13891-04 NA0.7).



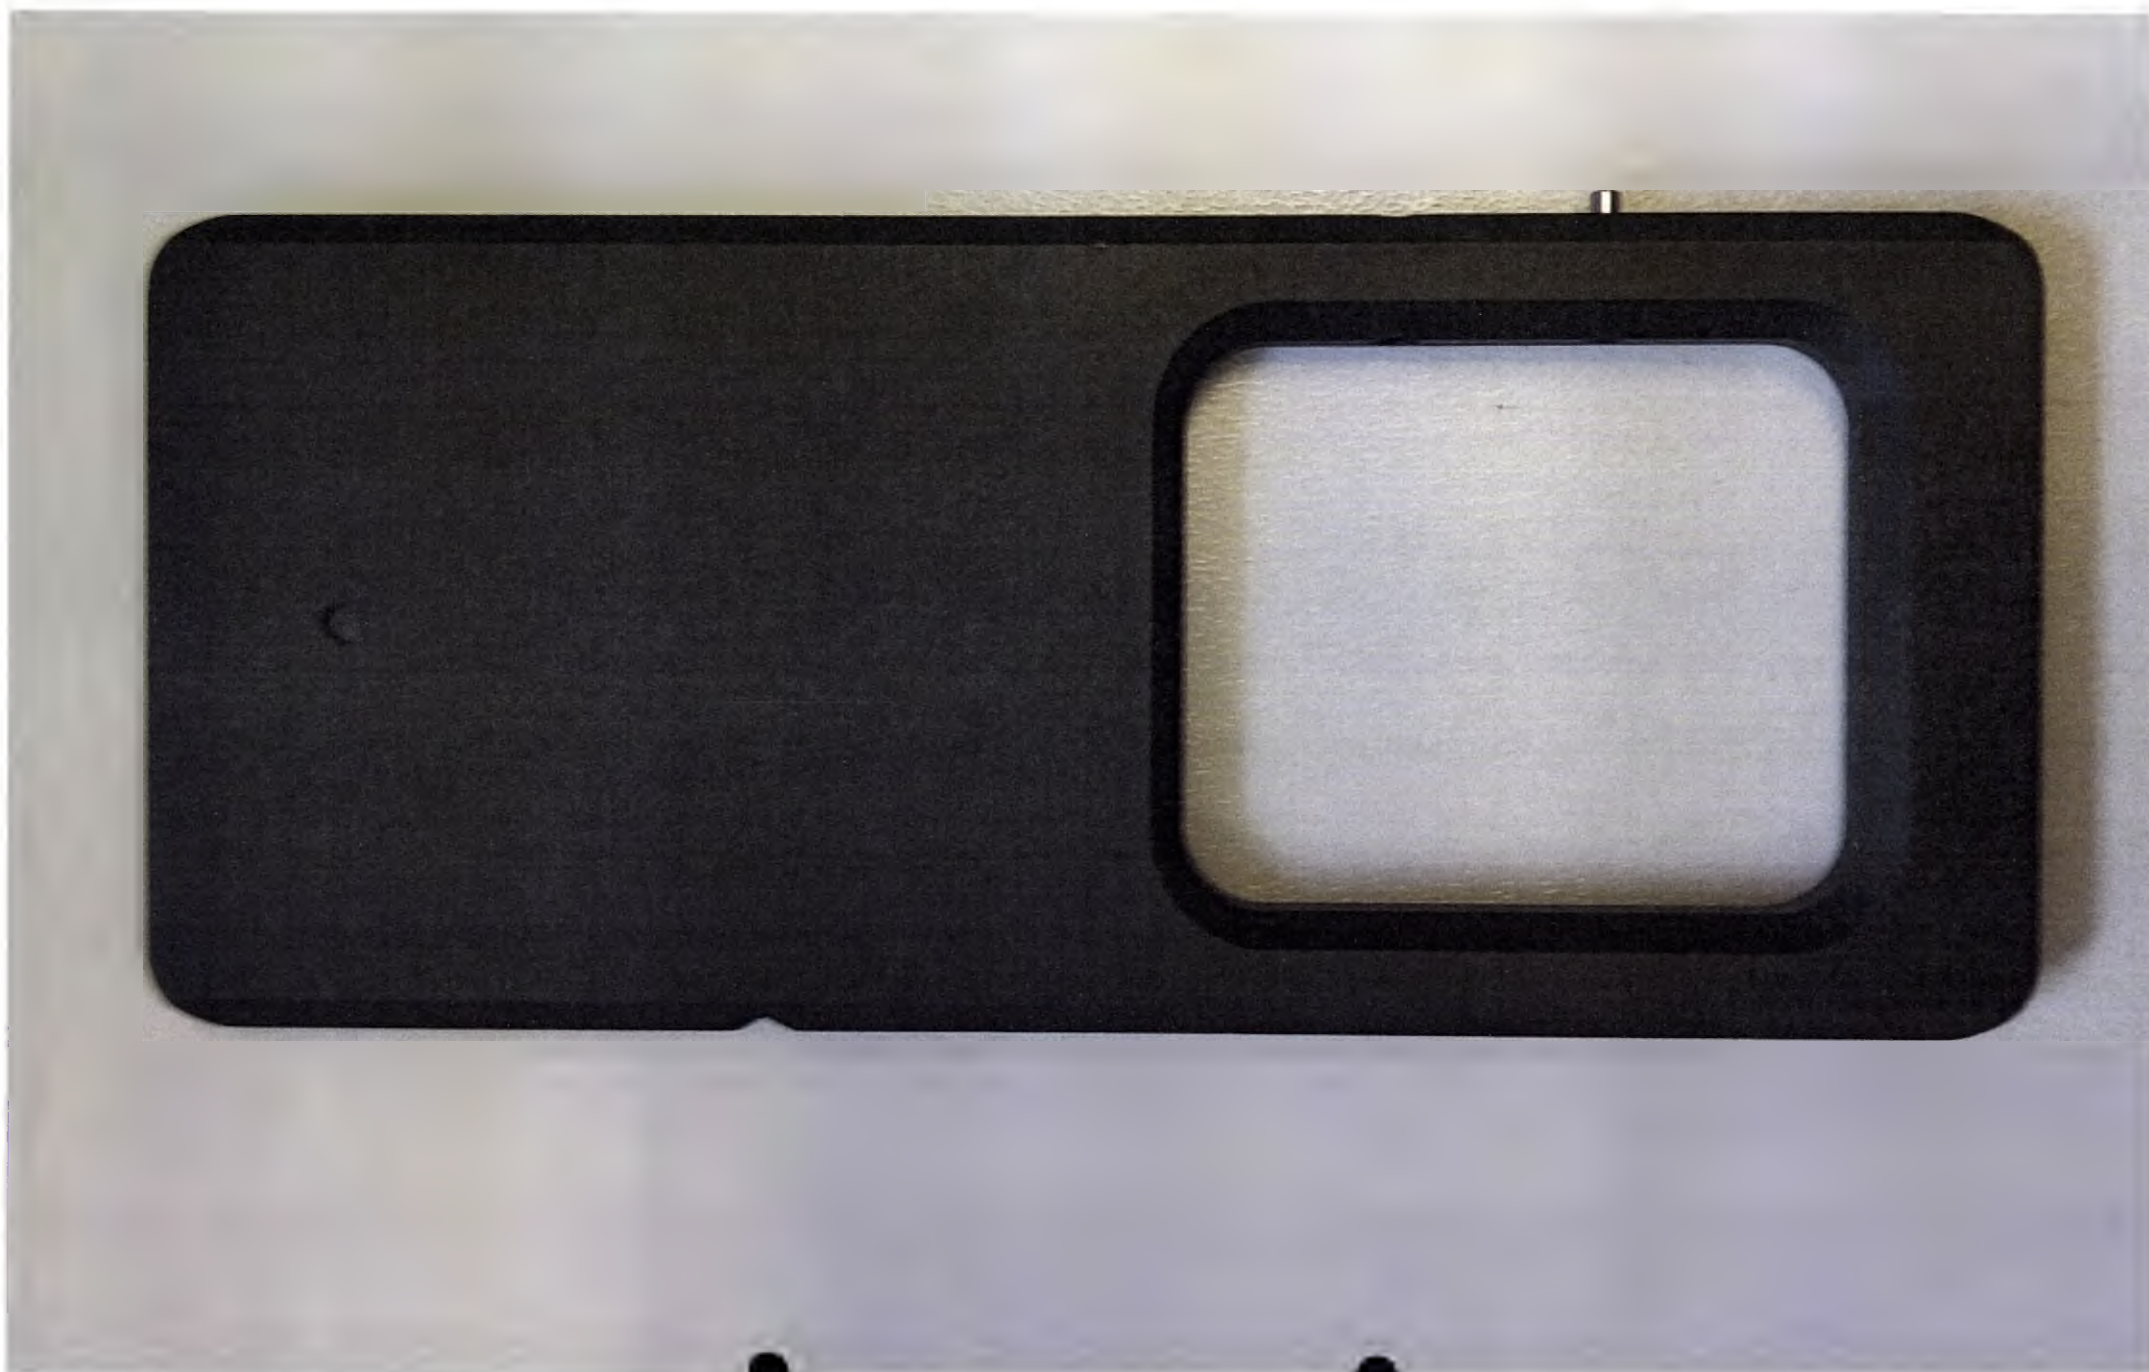






Объектив NA0.75: CFI PL... Apo Lambda 20x (показан на примере у...новленного в прибор)




Специальное калибровочное стекло

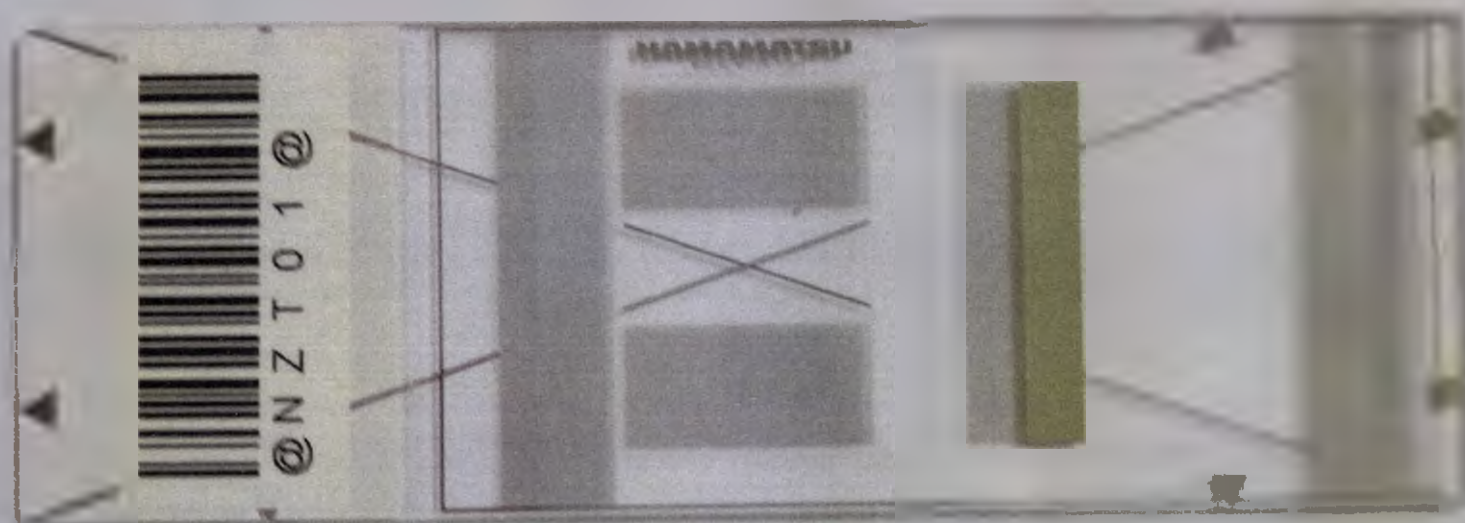


Калибровочное стекло флуоресценции синее А13056-01, Калибровочное стекло флуоресценции красное А13056-01,
Калибровочное стекло флуоресценции зеленое А13056-01

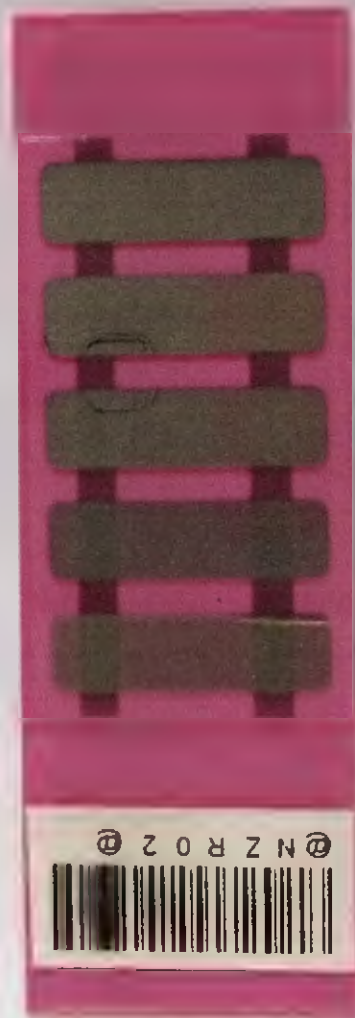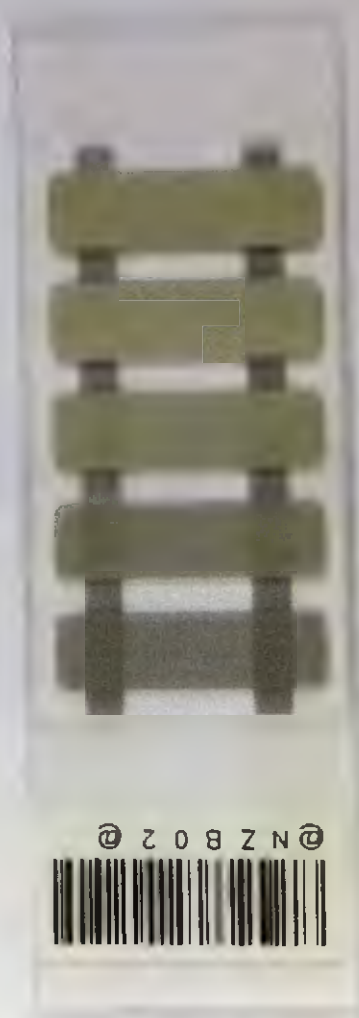

Приемник п[...]
метных стекол A13798-01 26 мм х 76 мм для S60

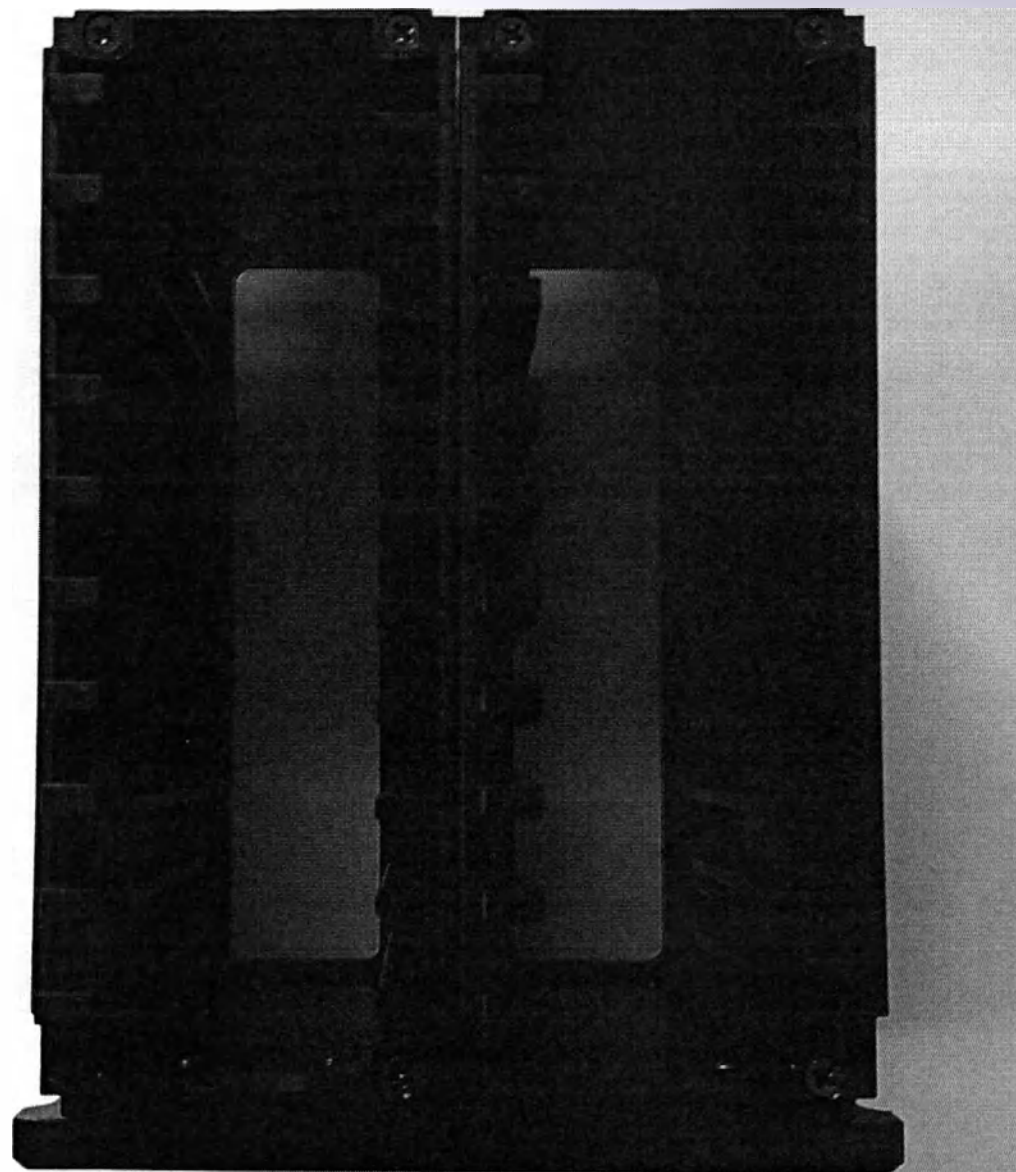

Приемник L-металлических стекол A13798-02 52 мм х 76 мм для S60

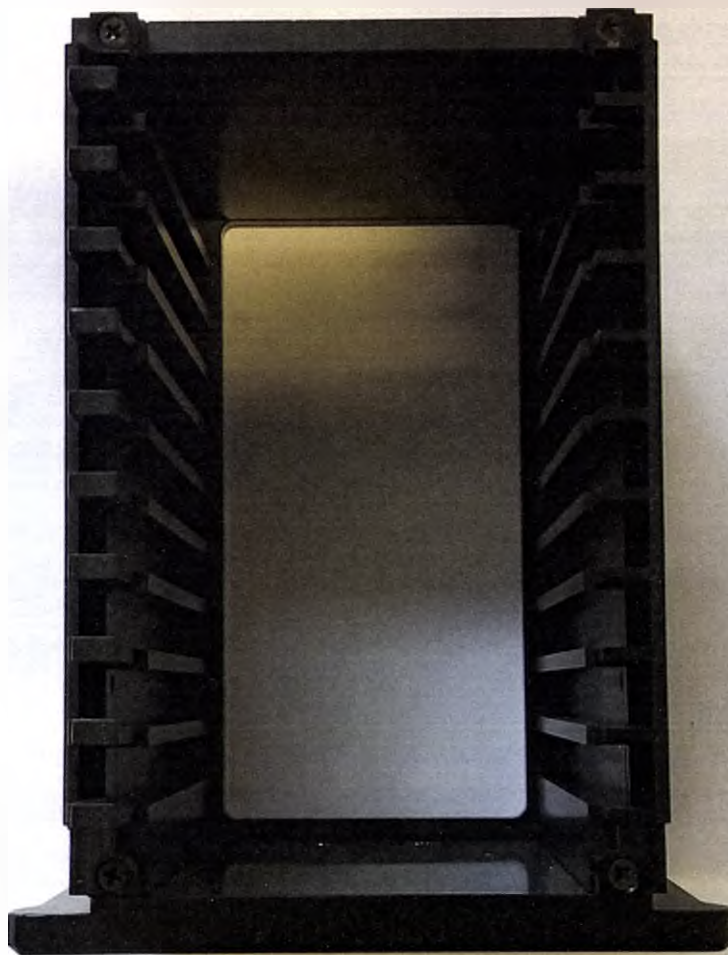

Соединительный кабель USB A-B: 3 м



Соединительный кабель Digital Interface cab



Плата USB



Плата видеозахвата



ржатель фильтра А13846-01 для ф25



Держатель фильтра А13846-02 для ф32



Лампа для модуля формирования флуоресцентных изображений




Блок осветителя для модуля формирования флуоресцентных изображений LX2000




евый шнур блока осветителя LX2000



Диск 7 с драйвером для подключения о тителя модуля формирования флуоресцентных изображений к компьютеру

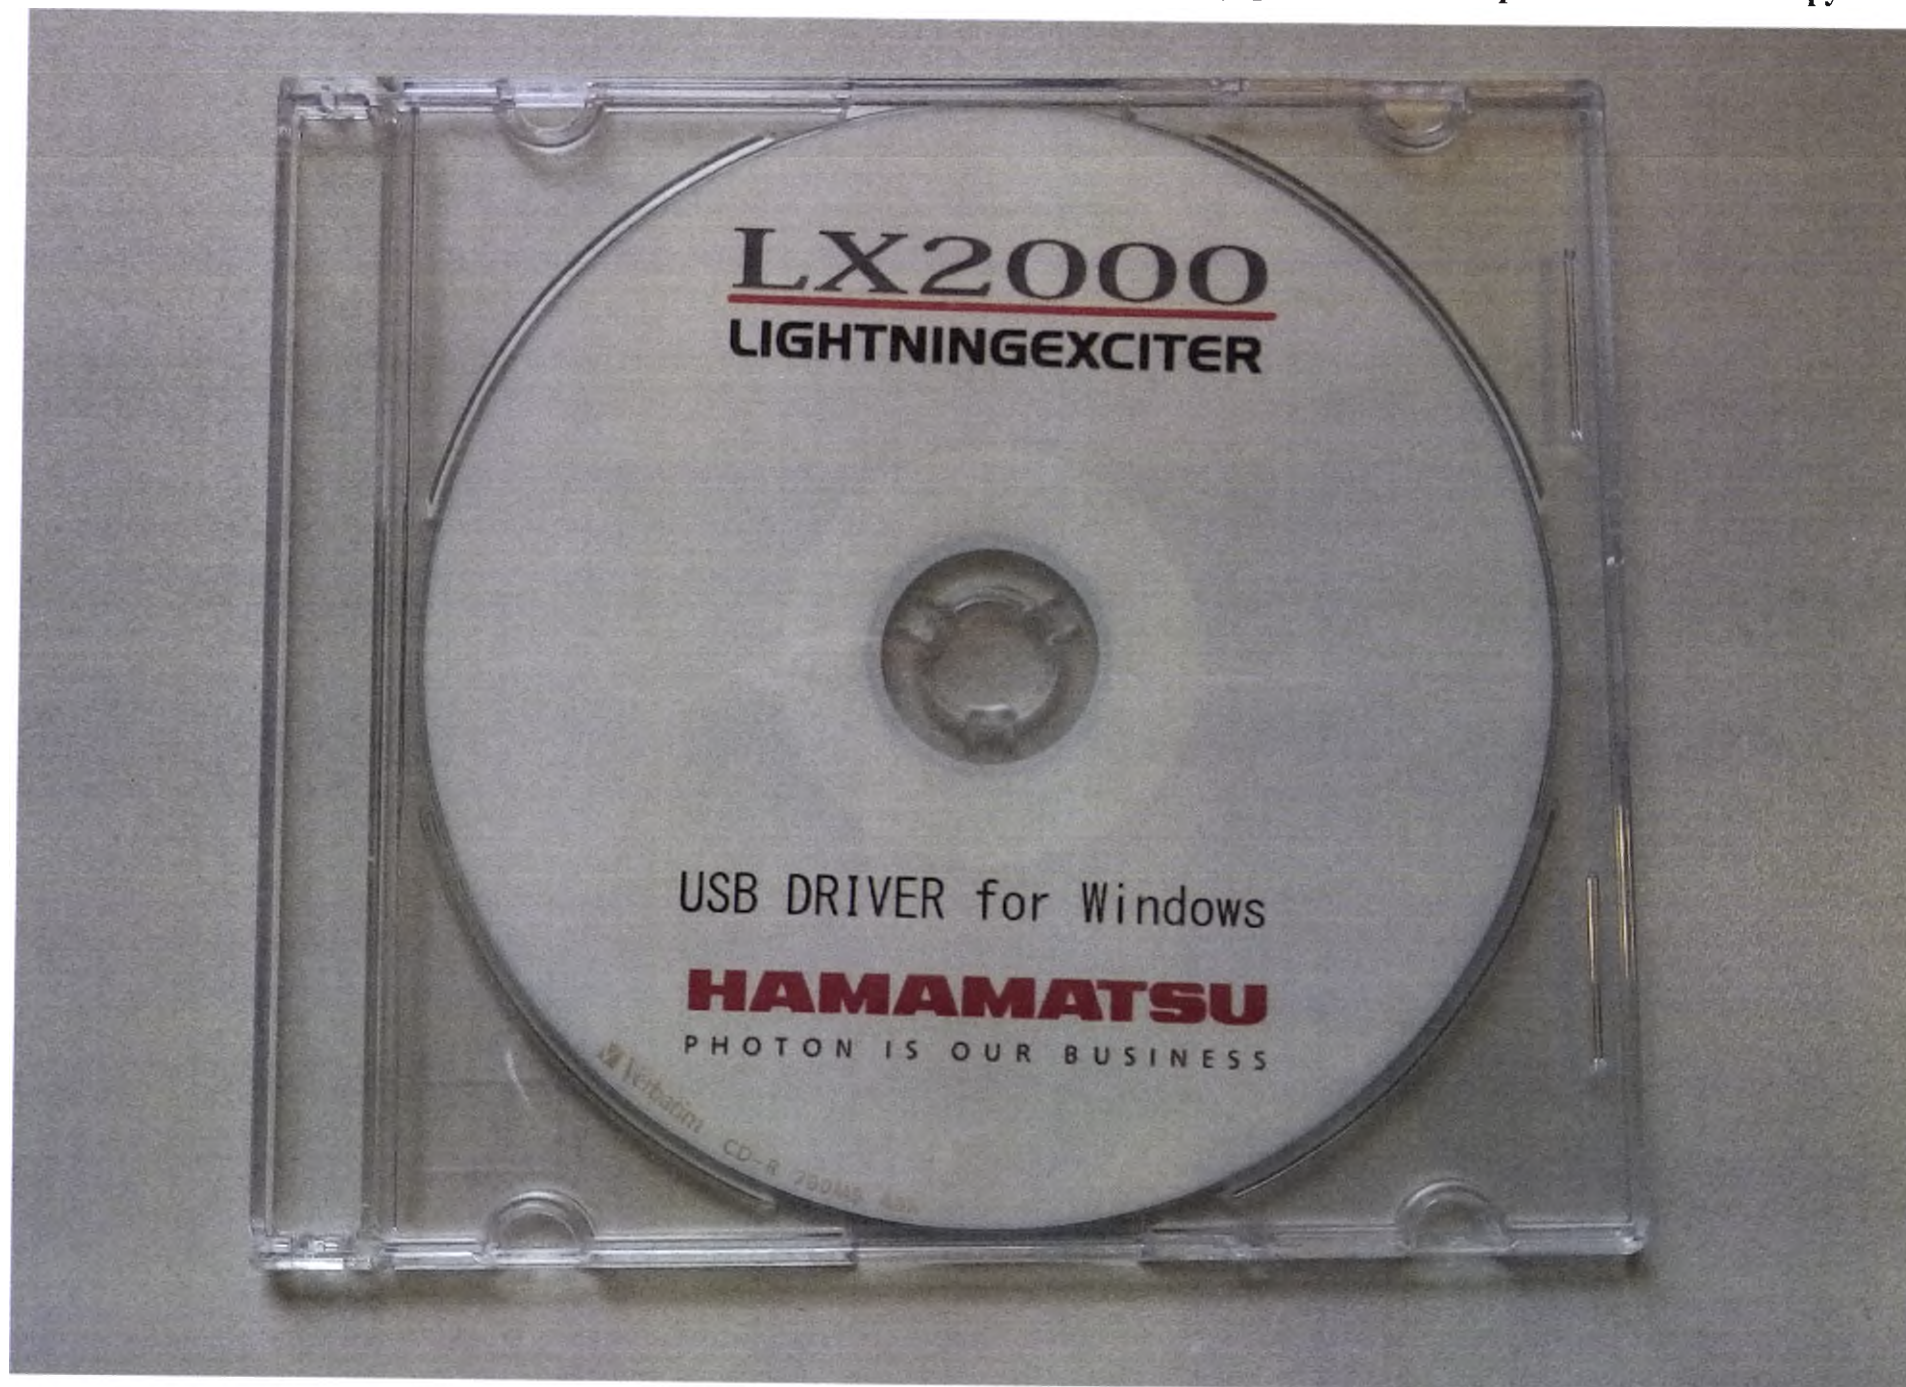


держатель флуоресцентных кубиков

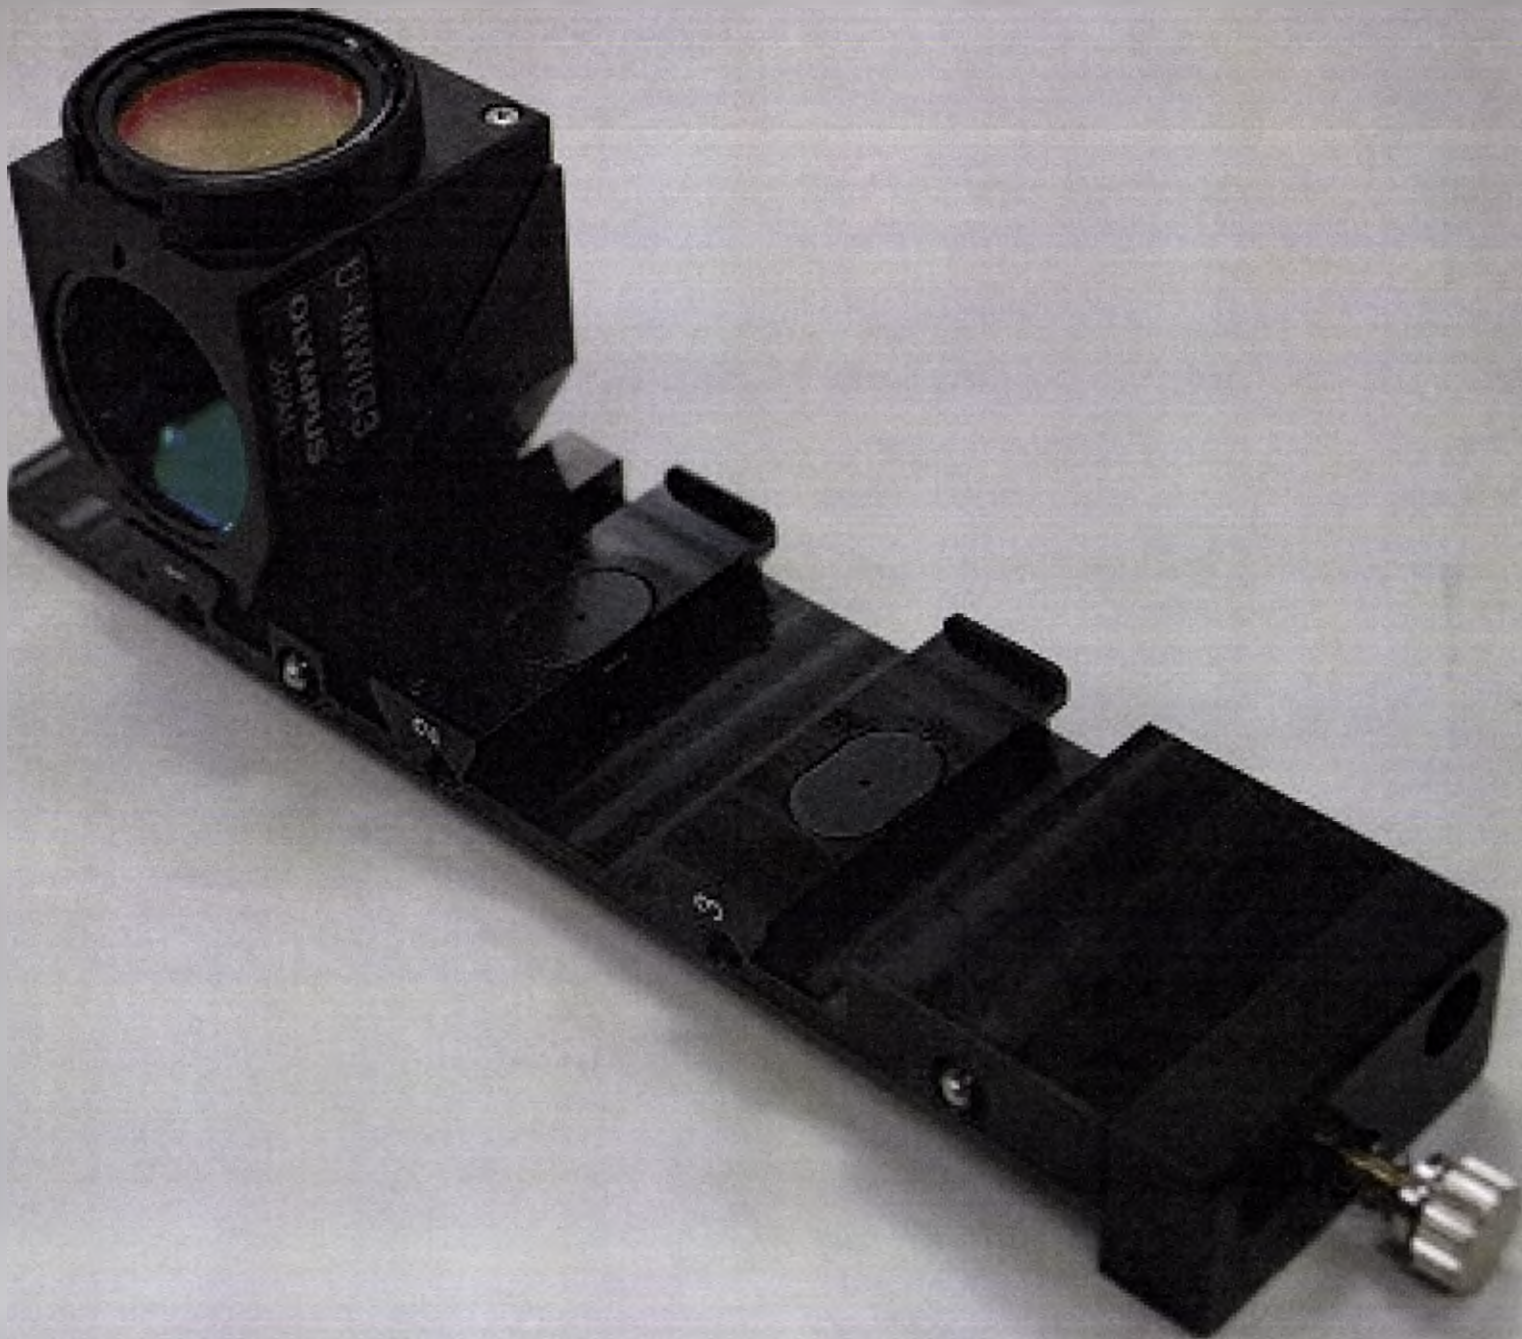


Вариант исполнения:
Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов Nanozoomer S210 C13239-01




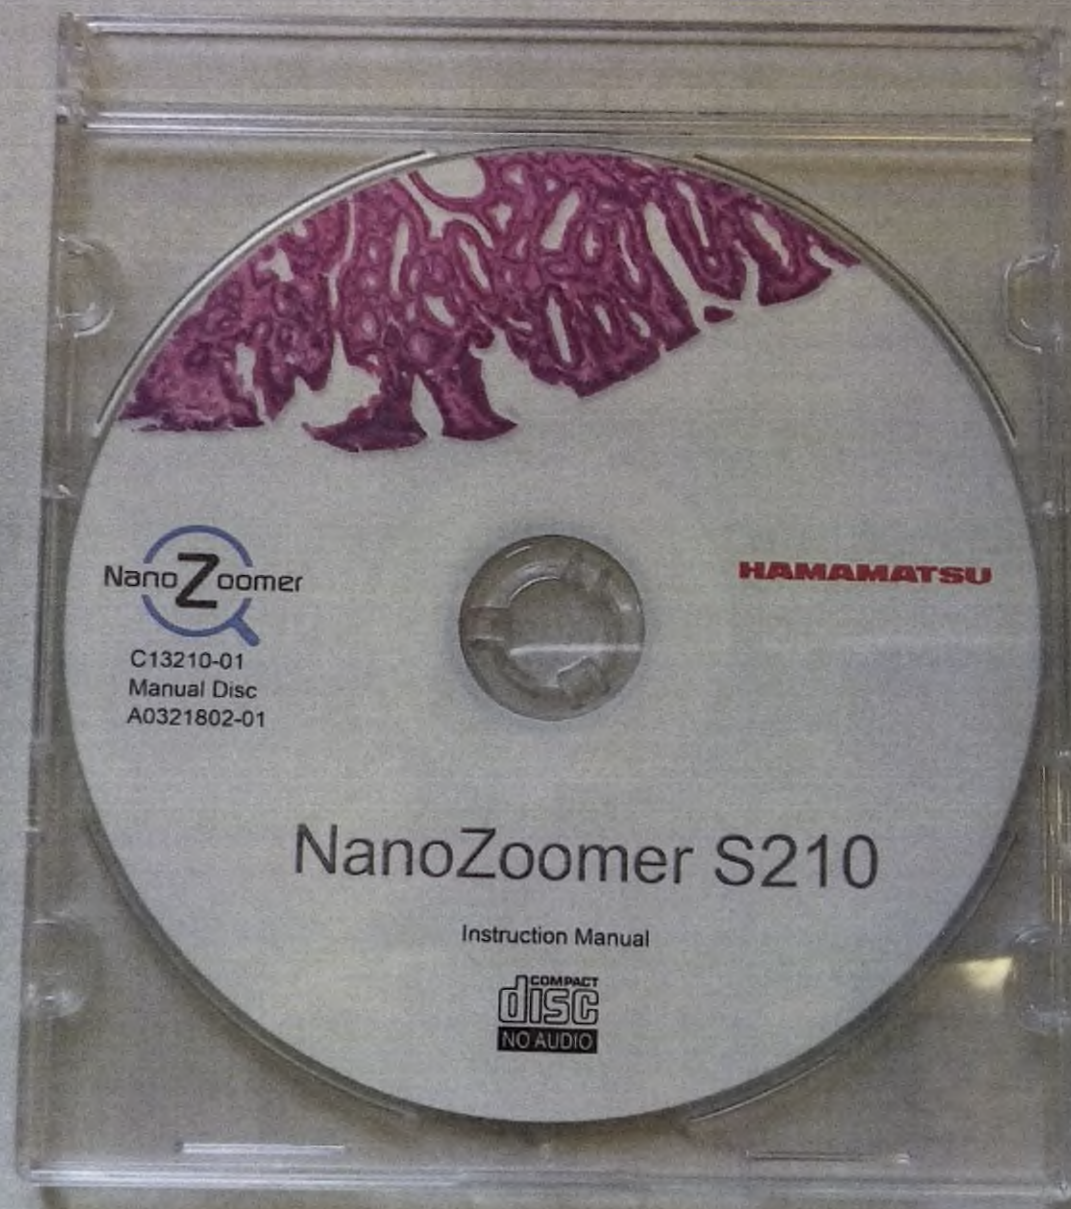


Диск 2 - программным обеспечением VMSAutoCopy

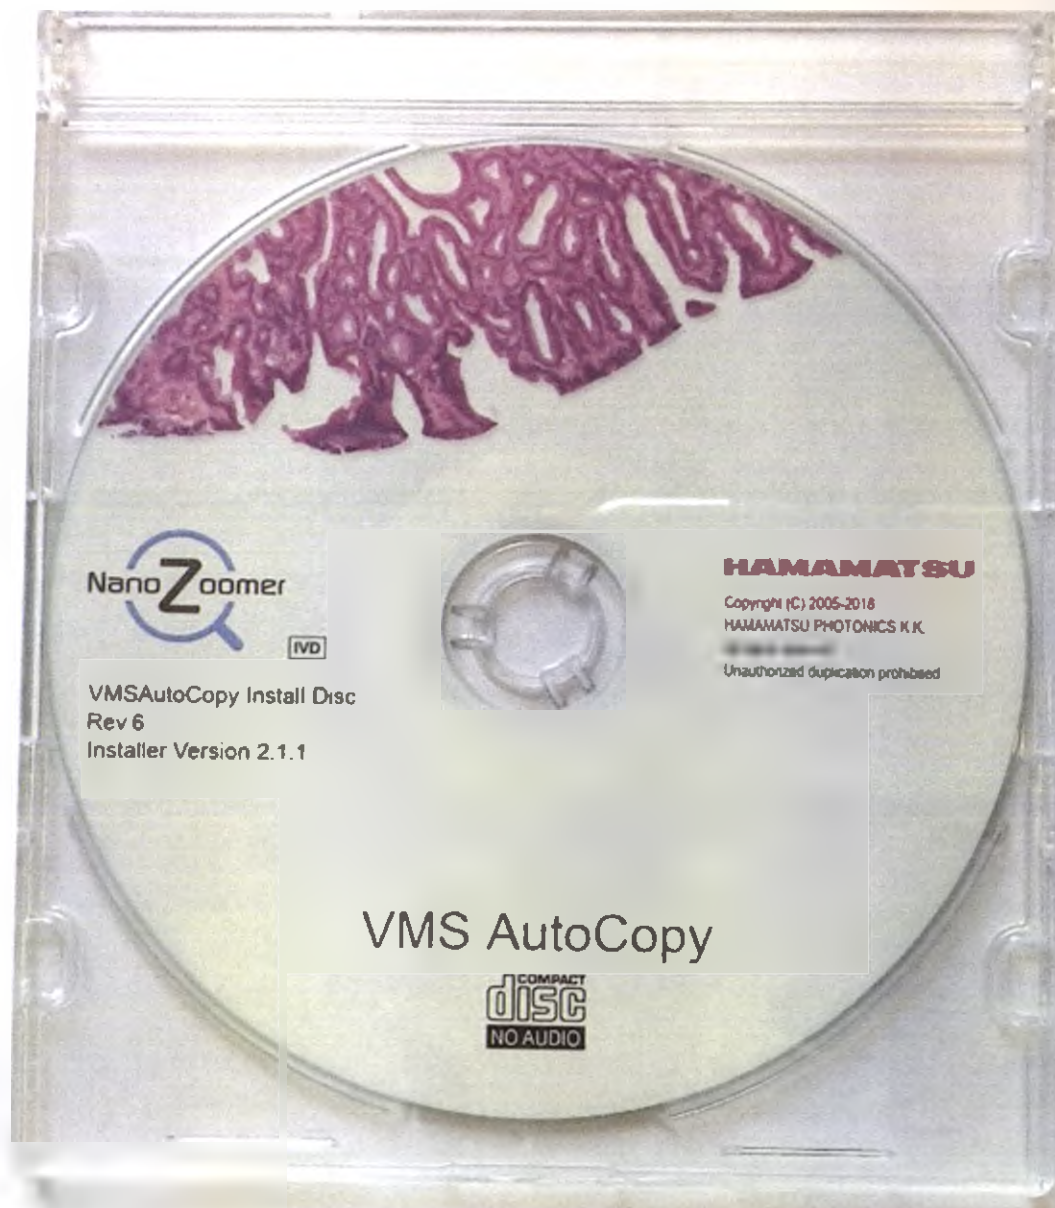

Диск с программным обеспечением NDP.sca

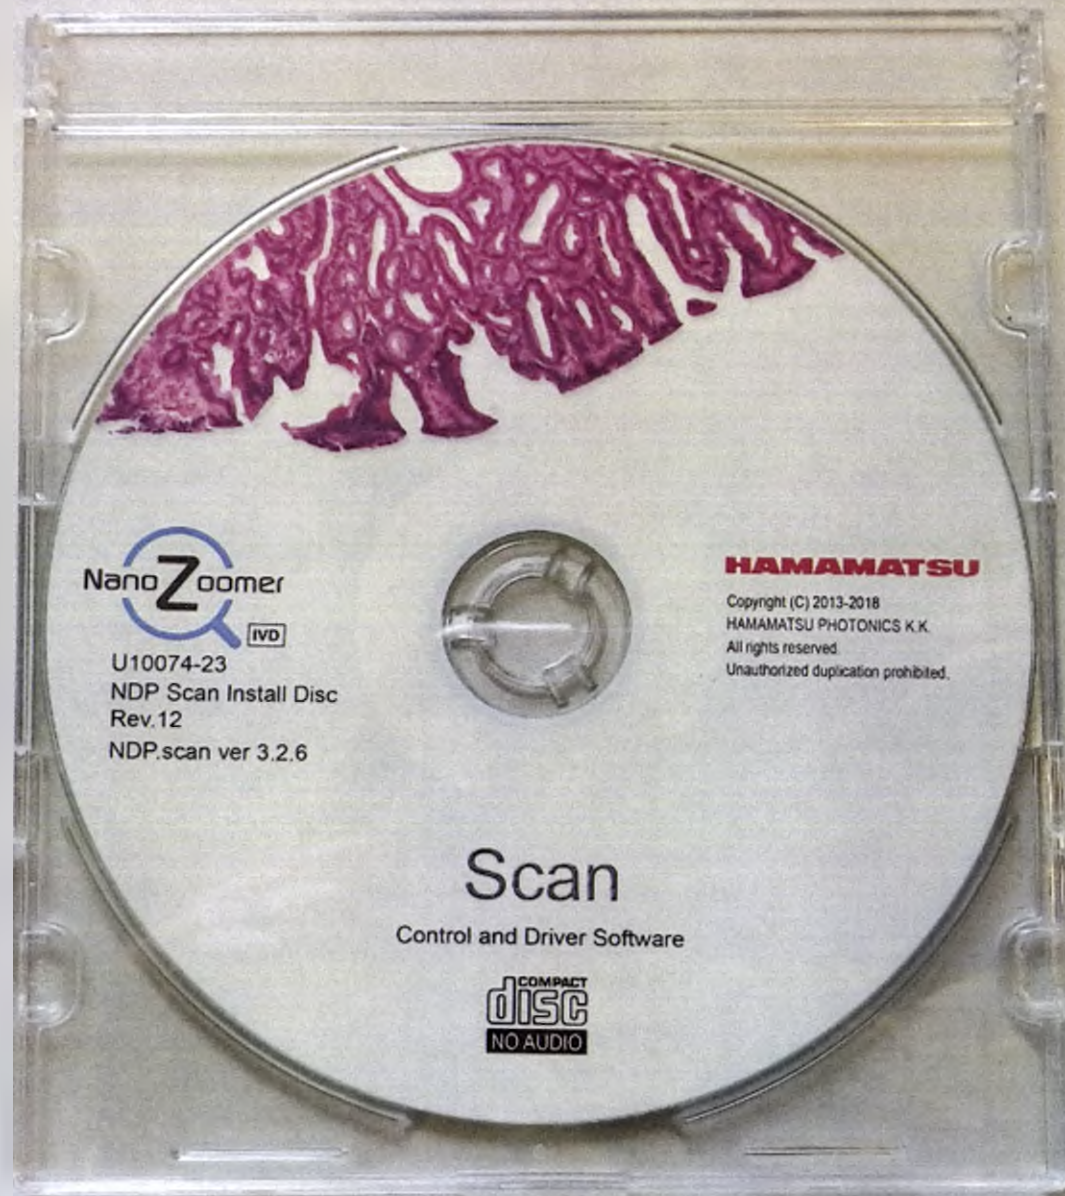


Диск с программным обеспечением NDP.view

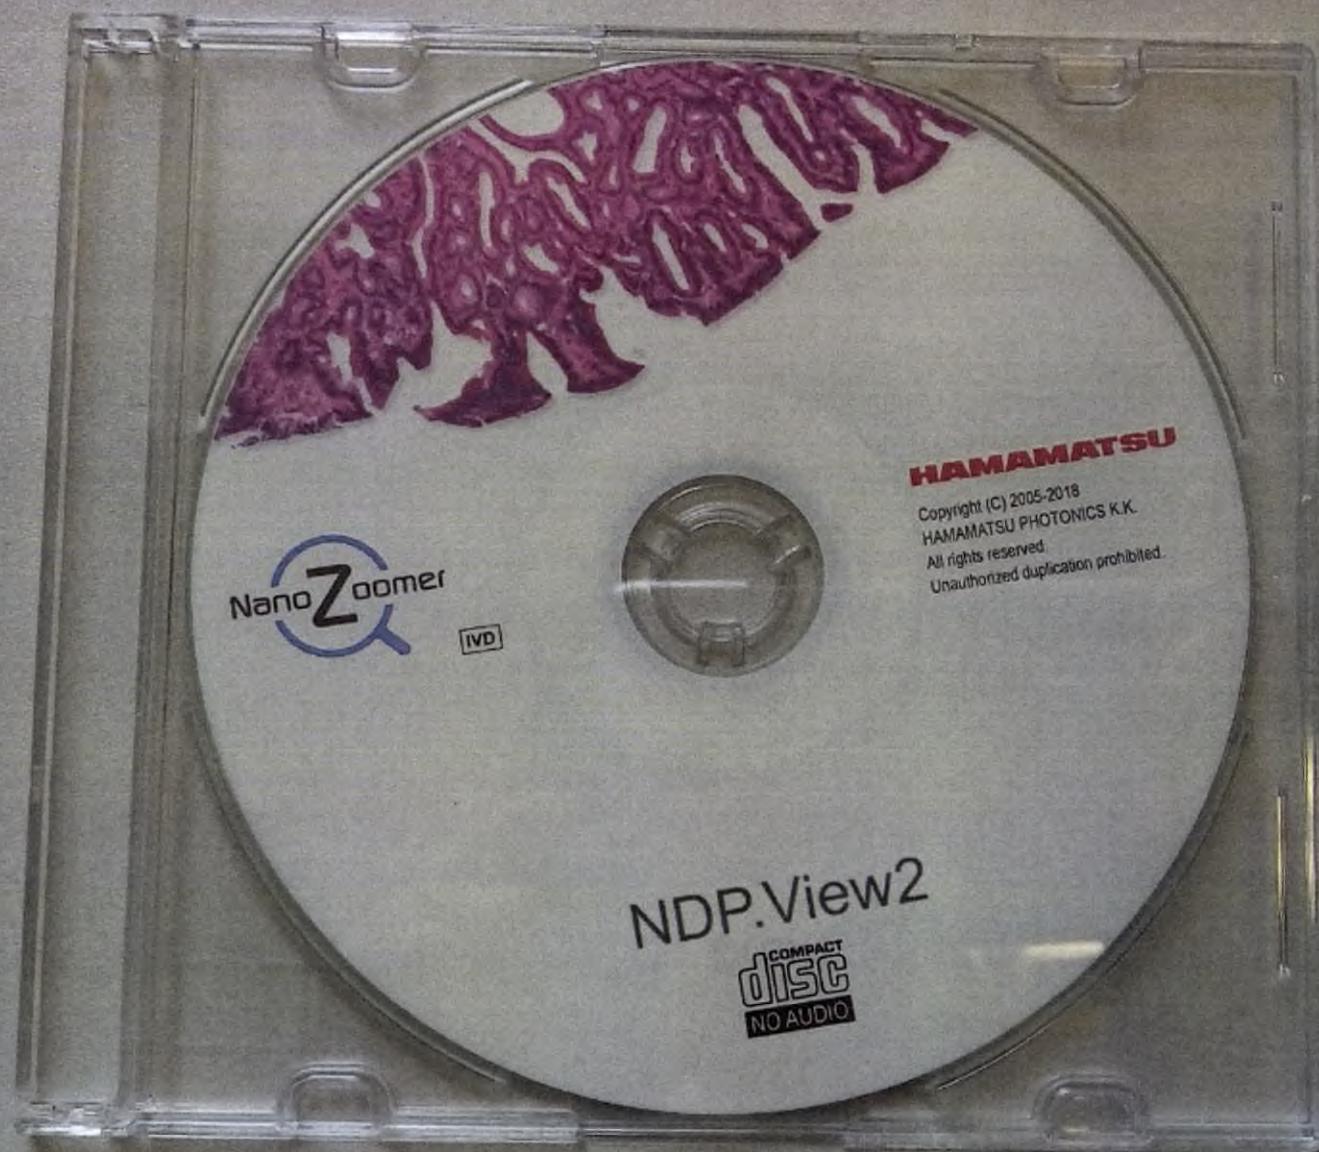

Свой шнур для сканера Nanozoomer S210



Соединительный кабель USB A-B: 5 м

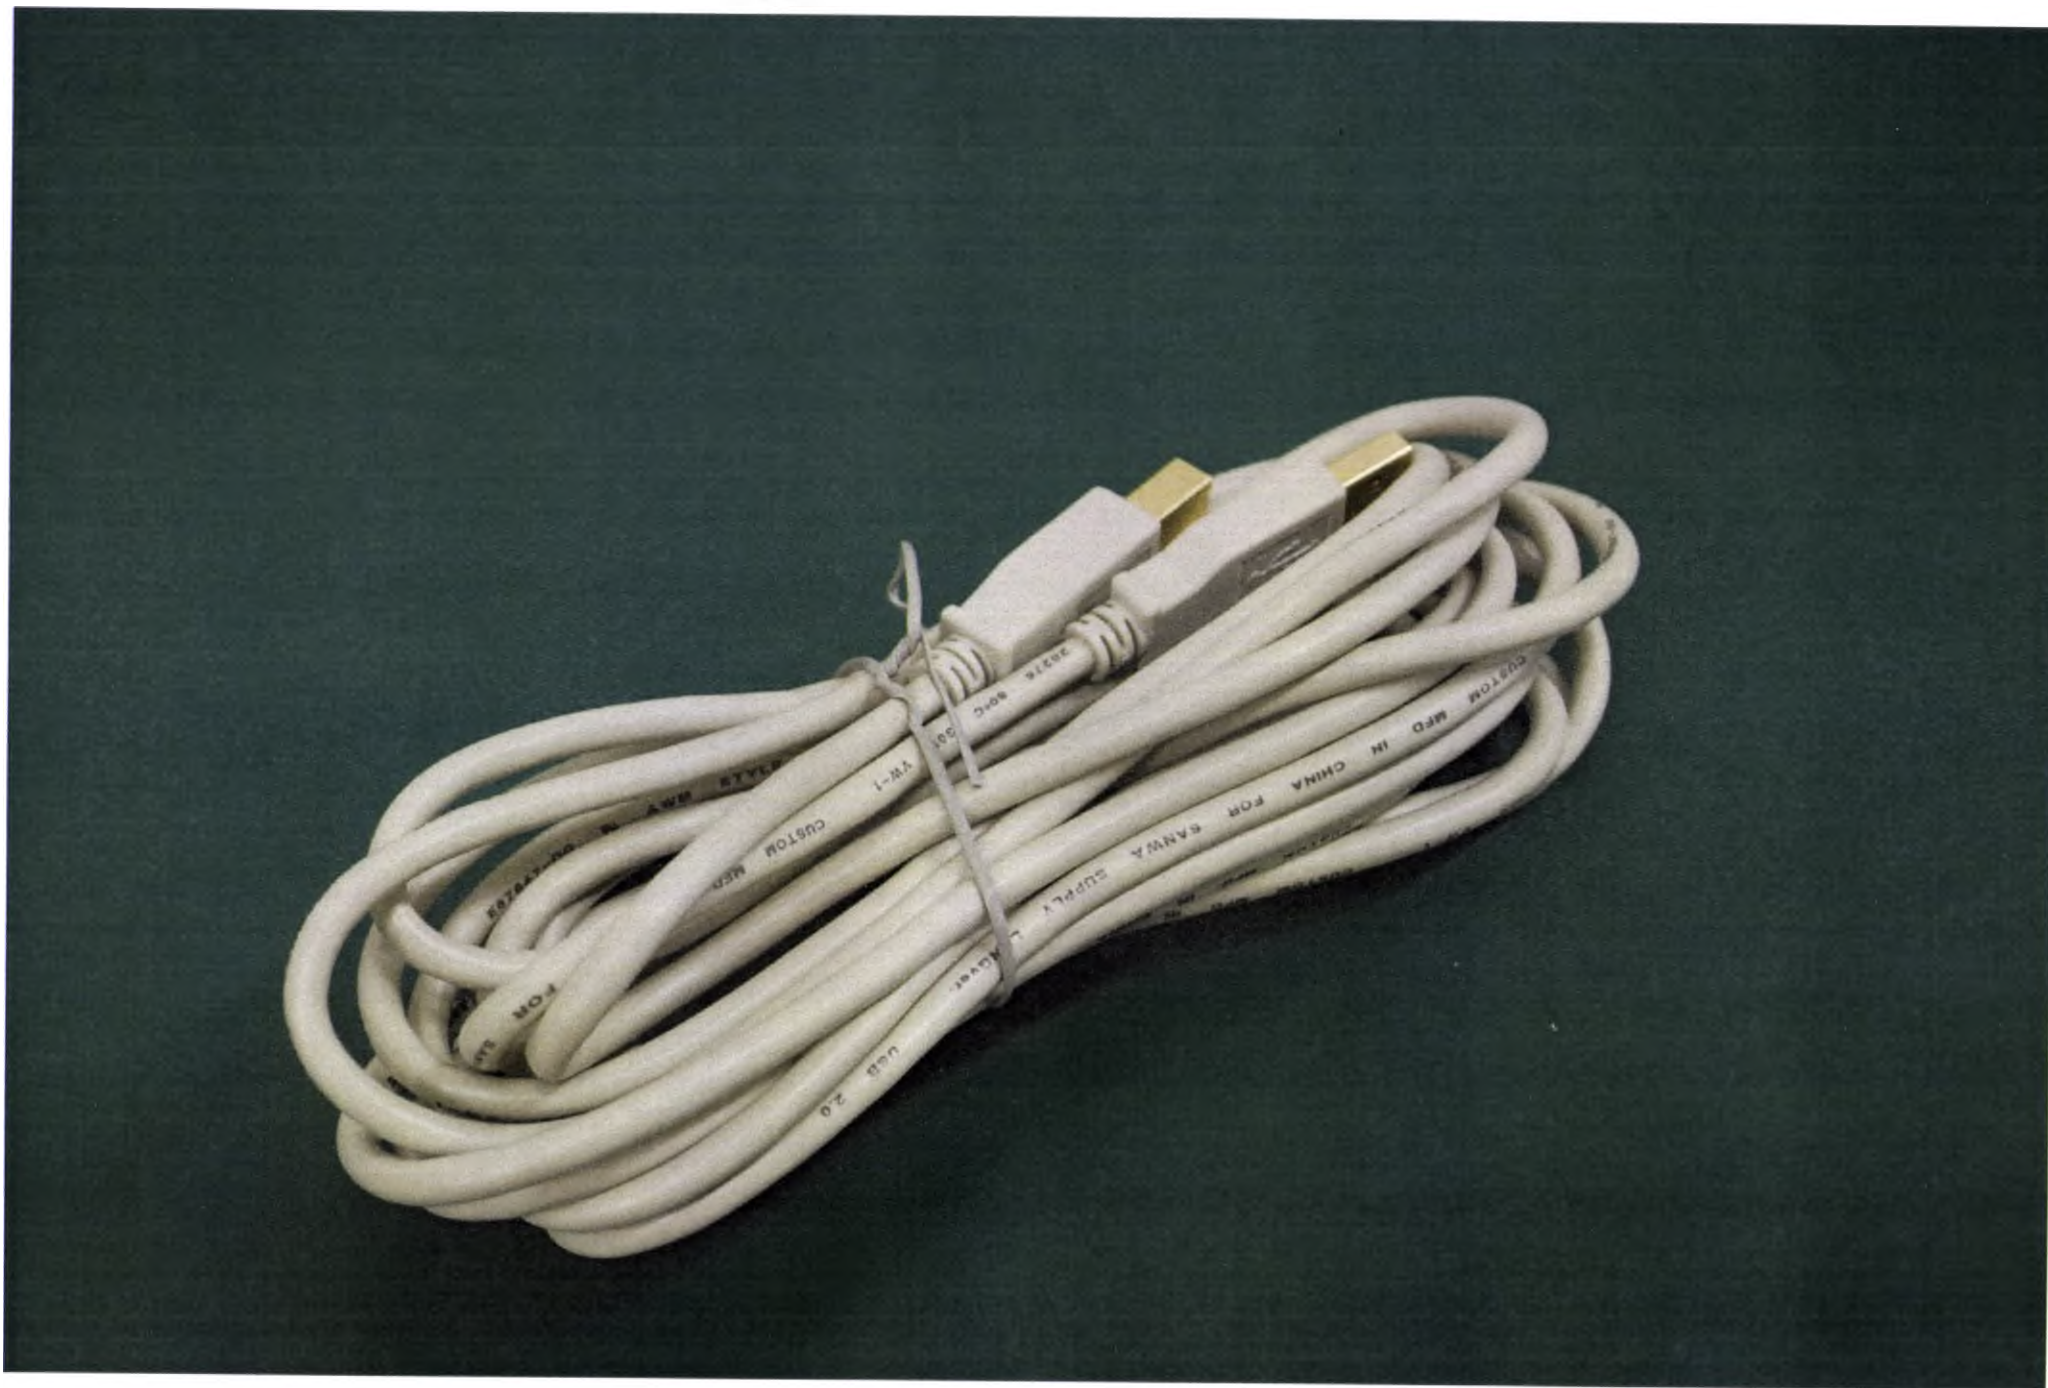

Соединительный кабель Digital Interface cab




Плата видеозахвата



Резервный предохранитель: Т3.15А 250 В



...емник предметных стекол: А10294

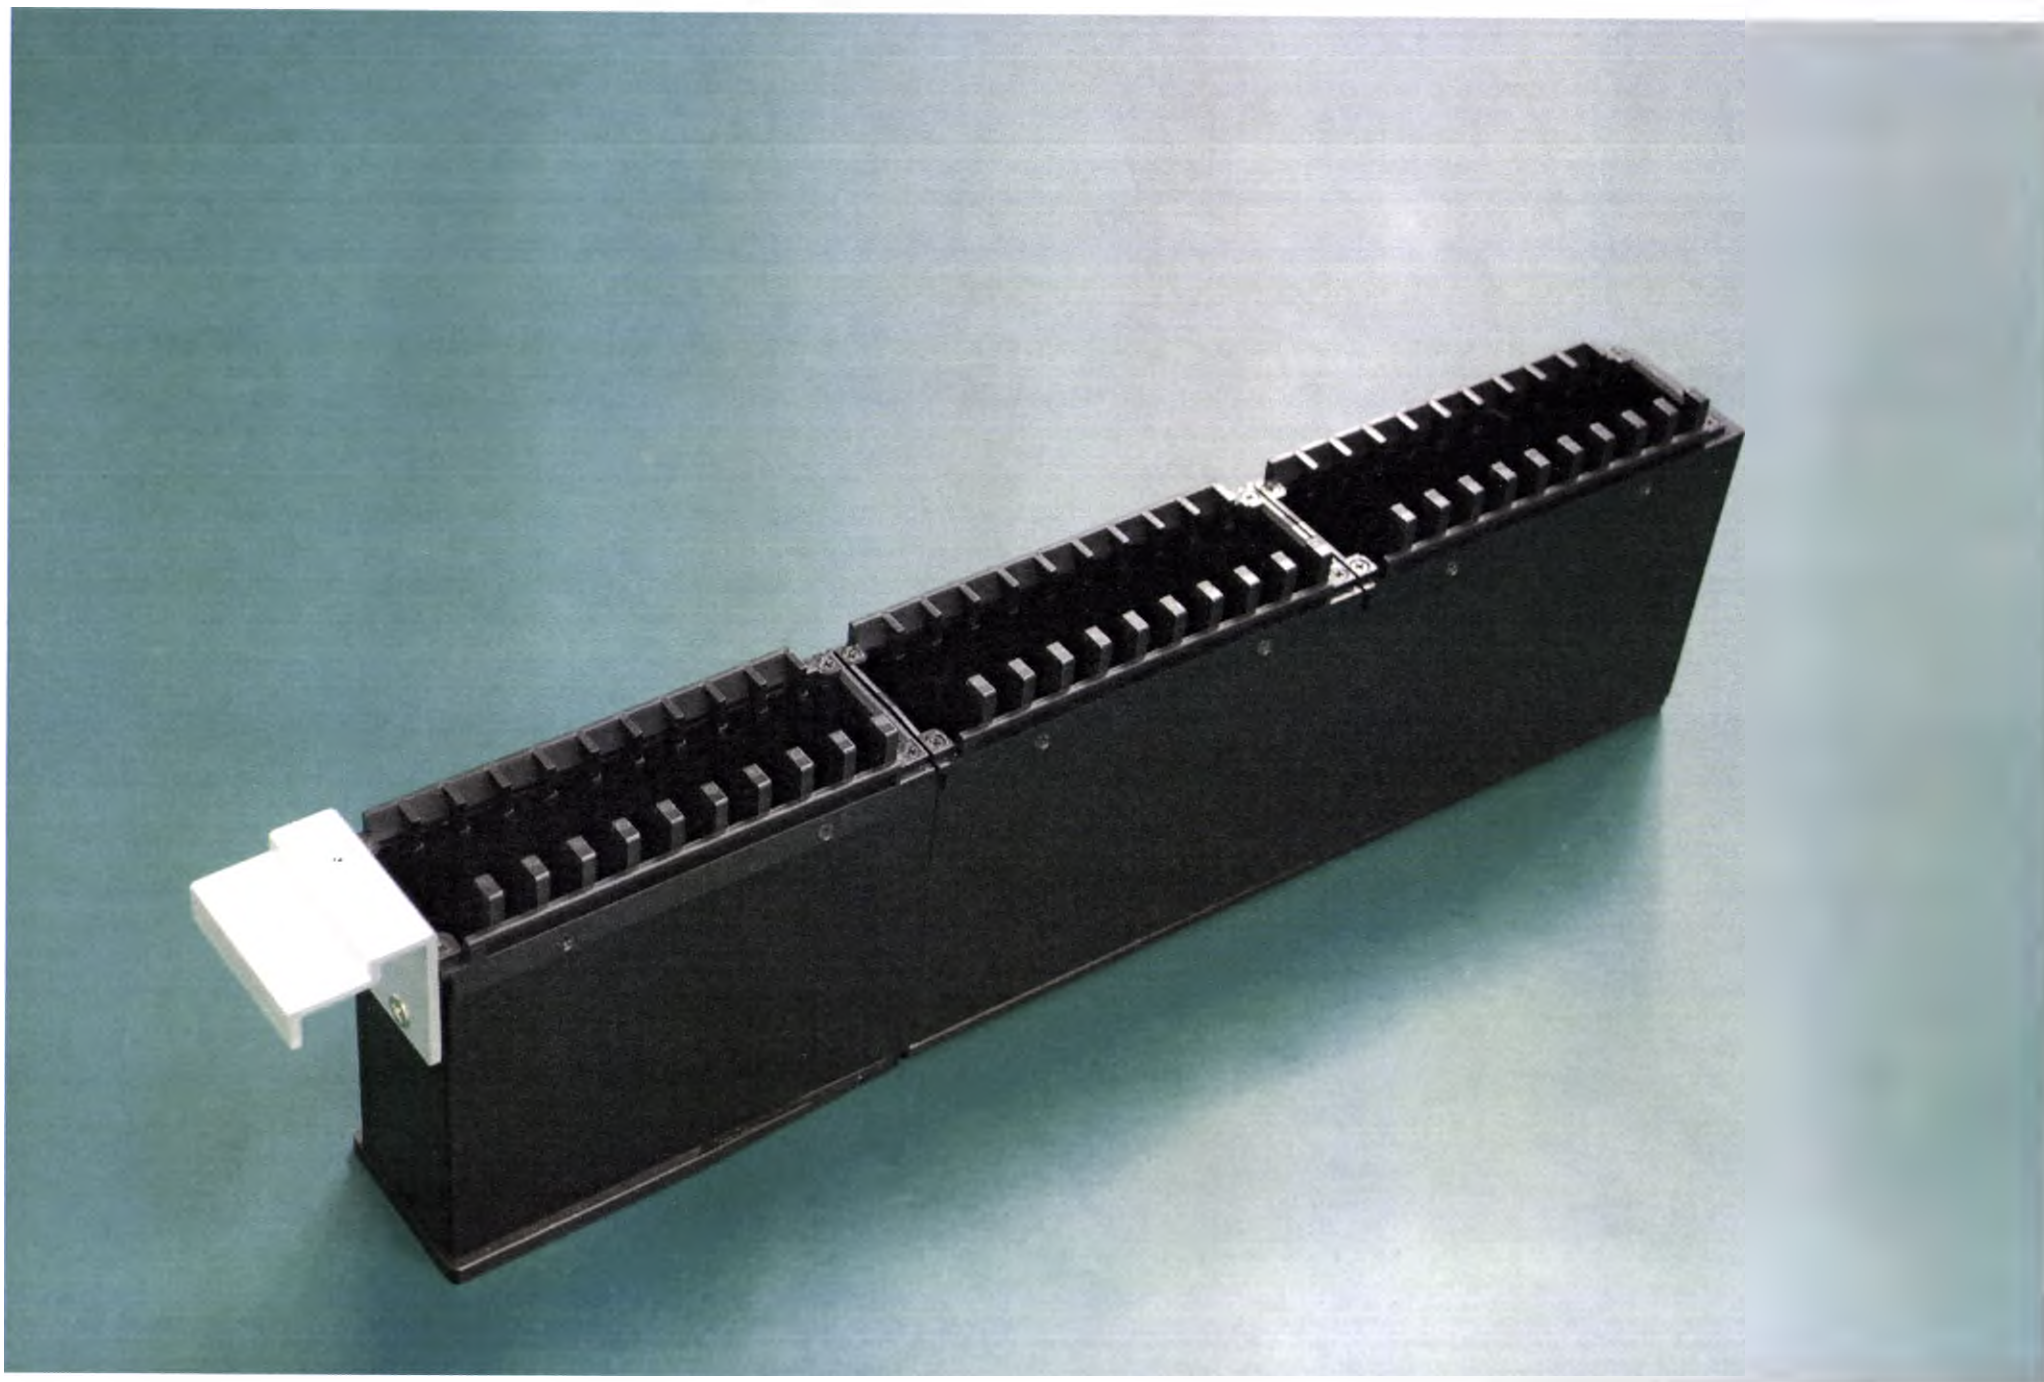


Объектив CFI Plan Apo Lambda 20x (Nikon)




Трещёточный ключ PRW-1



Специальное калибровочное стекло

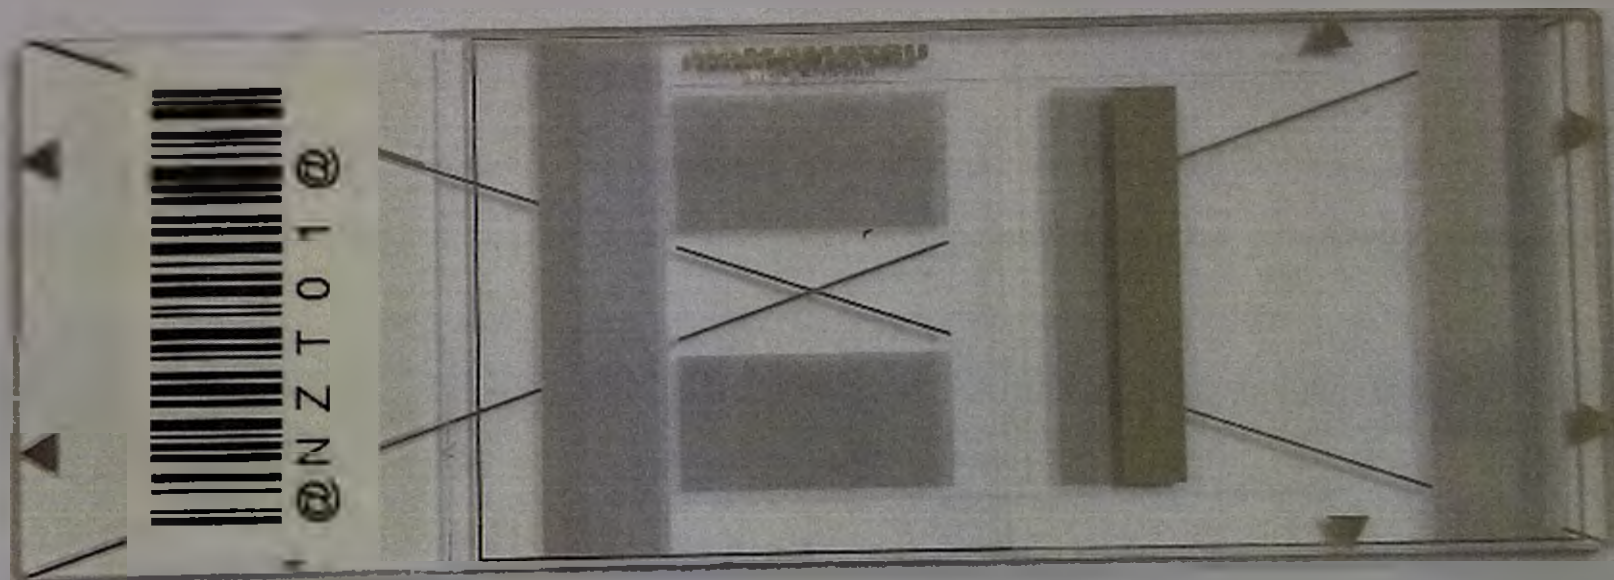

Диск 5 с резервными параметрами

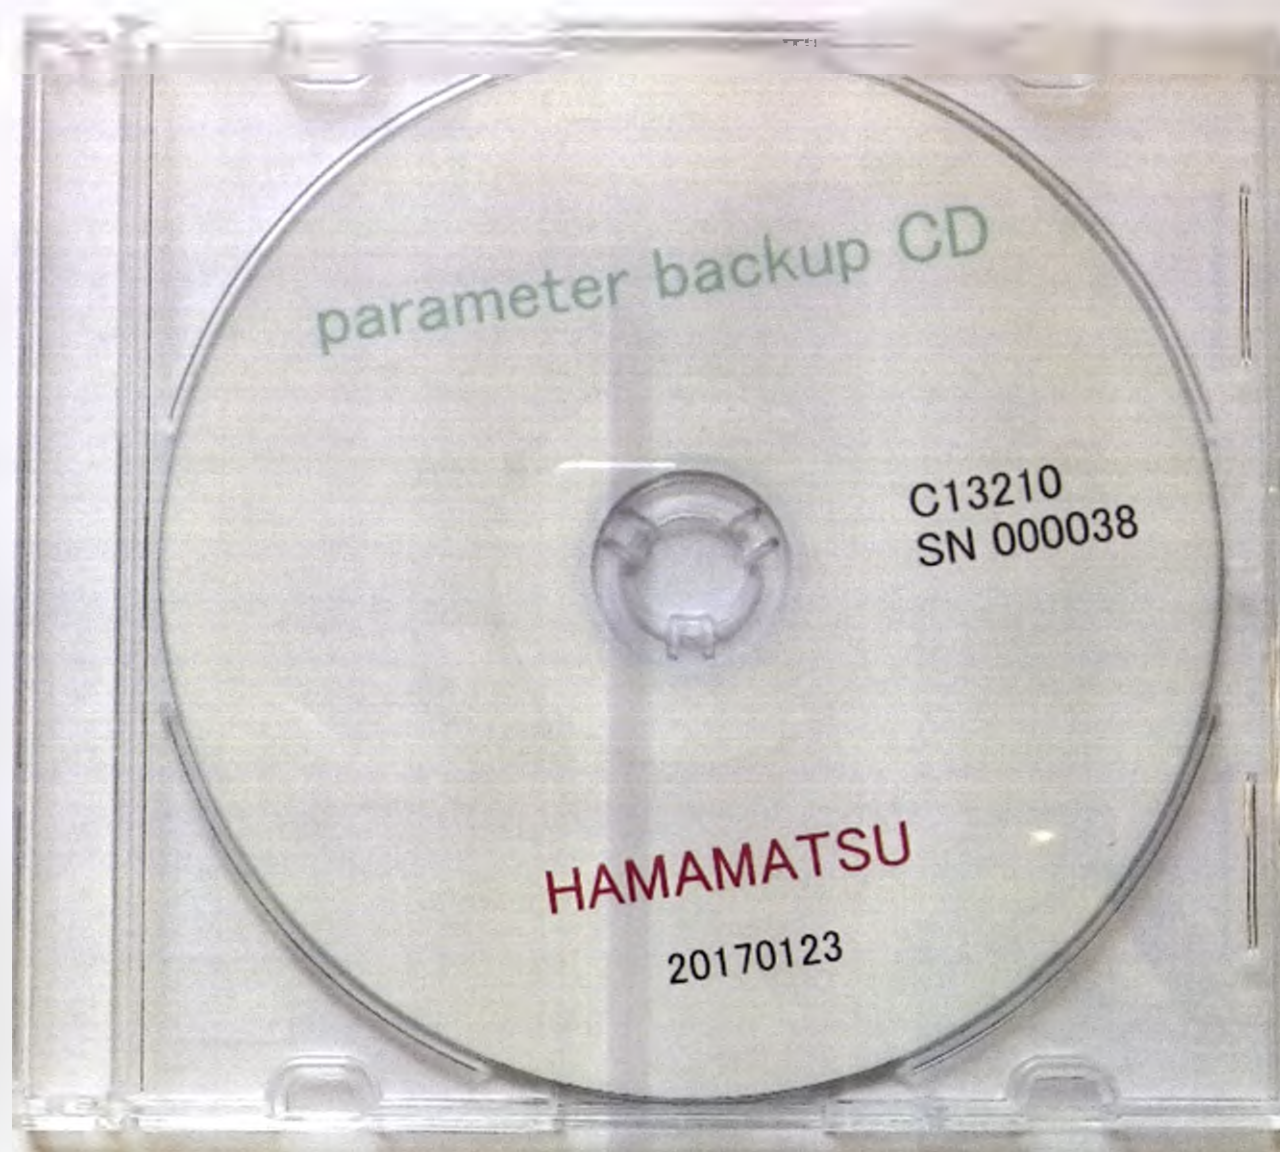

Пример 6
качество 49 мот.

