



Фотографические изображения медицинского изделия
«Инструменты стоматологические в наборах Service Set»


1. Набор инструментов Service Set базовый

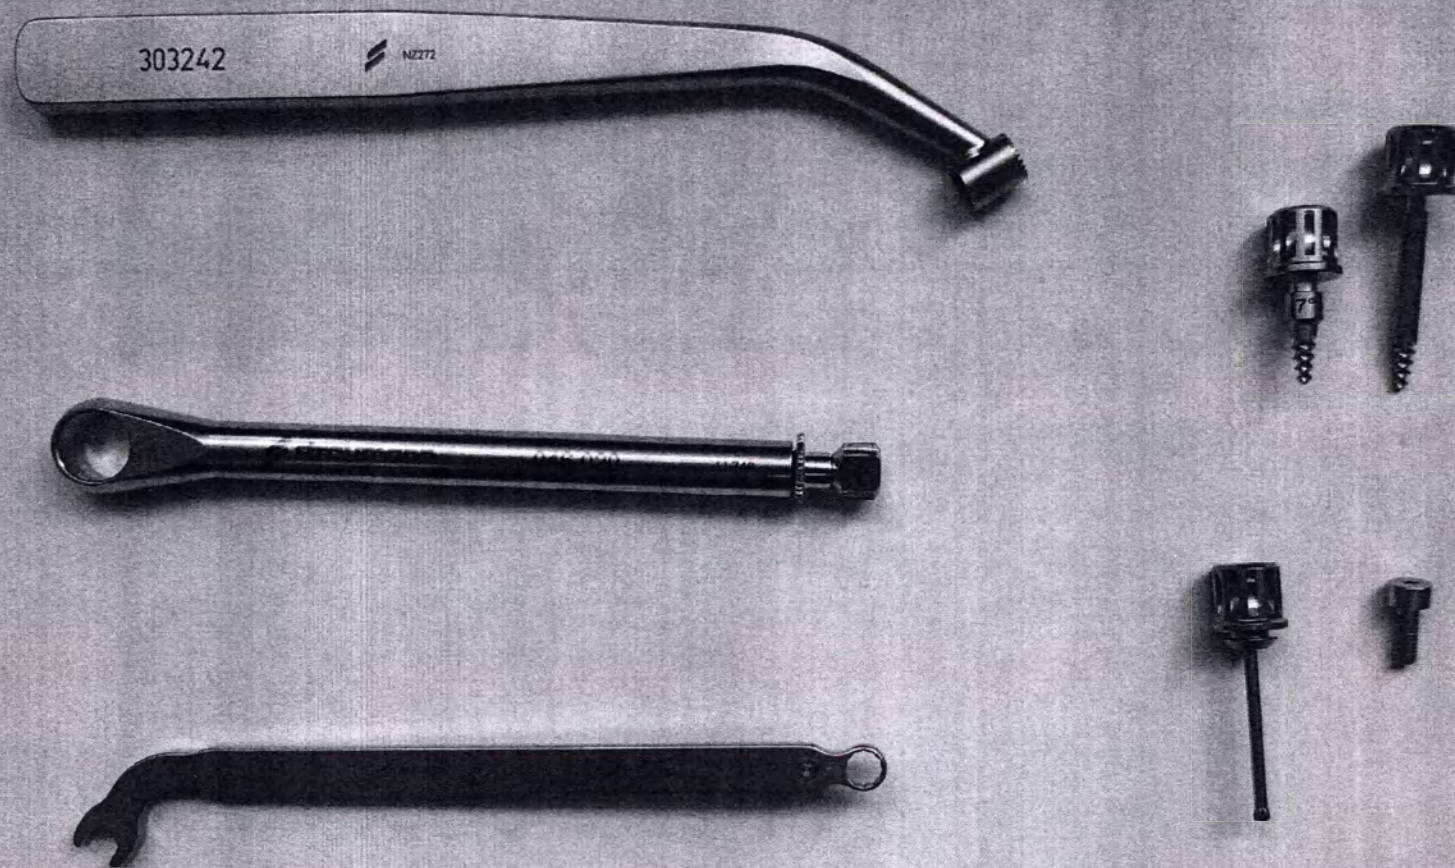

1.1. Ключ удерживающий

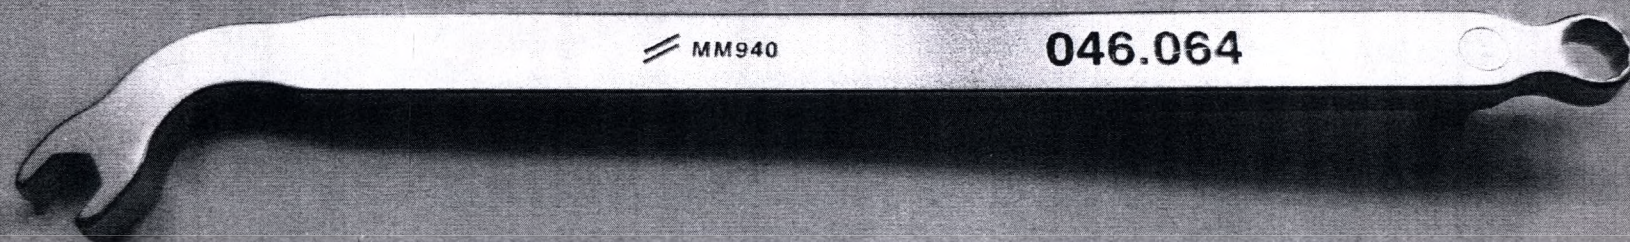


1.2. Ключ реверсивный, L 84 мм

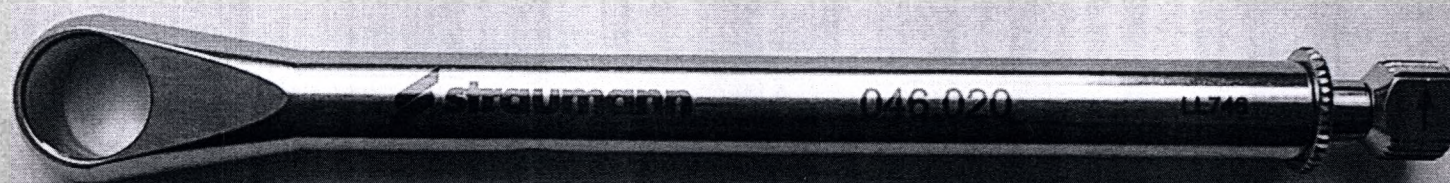


1.3. Держатель позиционера



1.4. Винт SCS M2.5x6.5



1.5. Отвертка SCS, L 27 мм

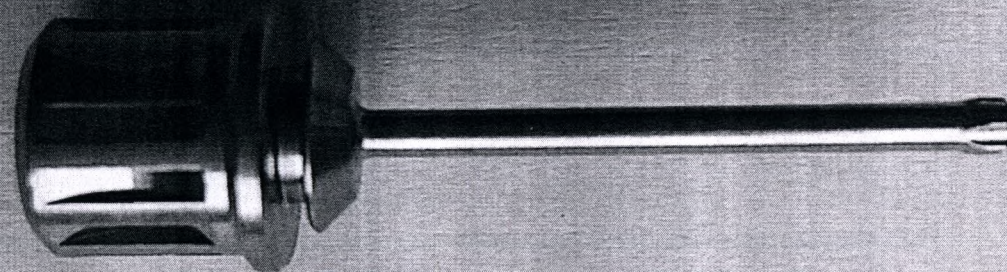




1.7. Экстрактор 7^{го}, длинный



2. Набор инструментов Service Set для соединения synOcta®

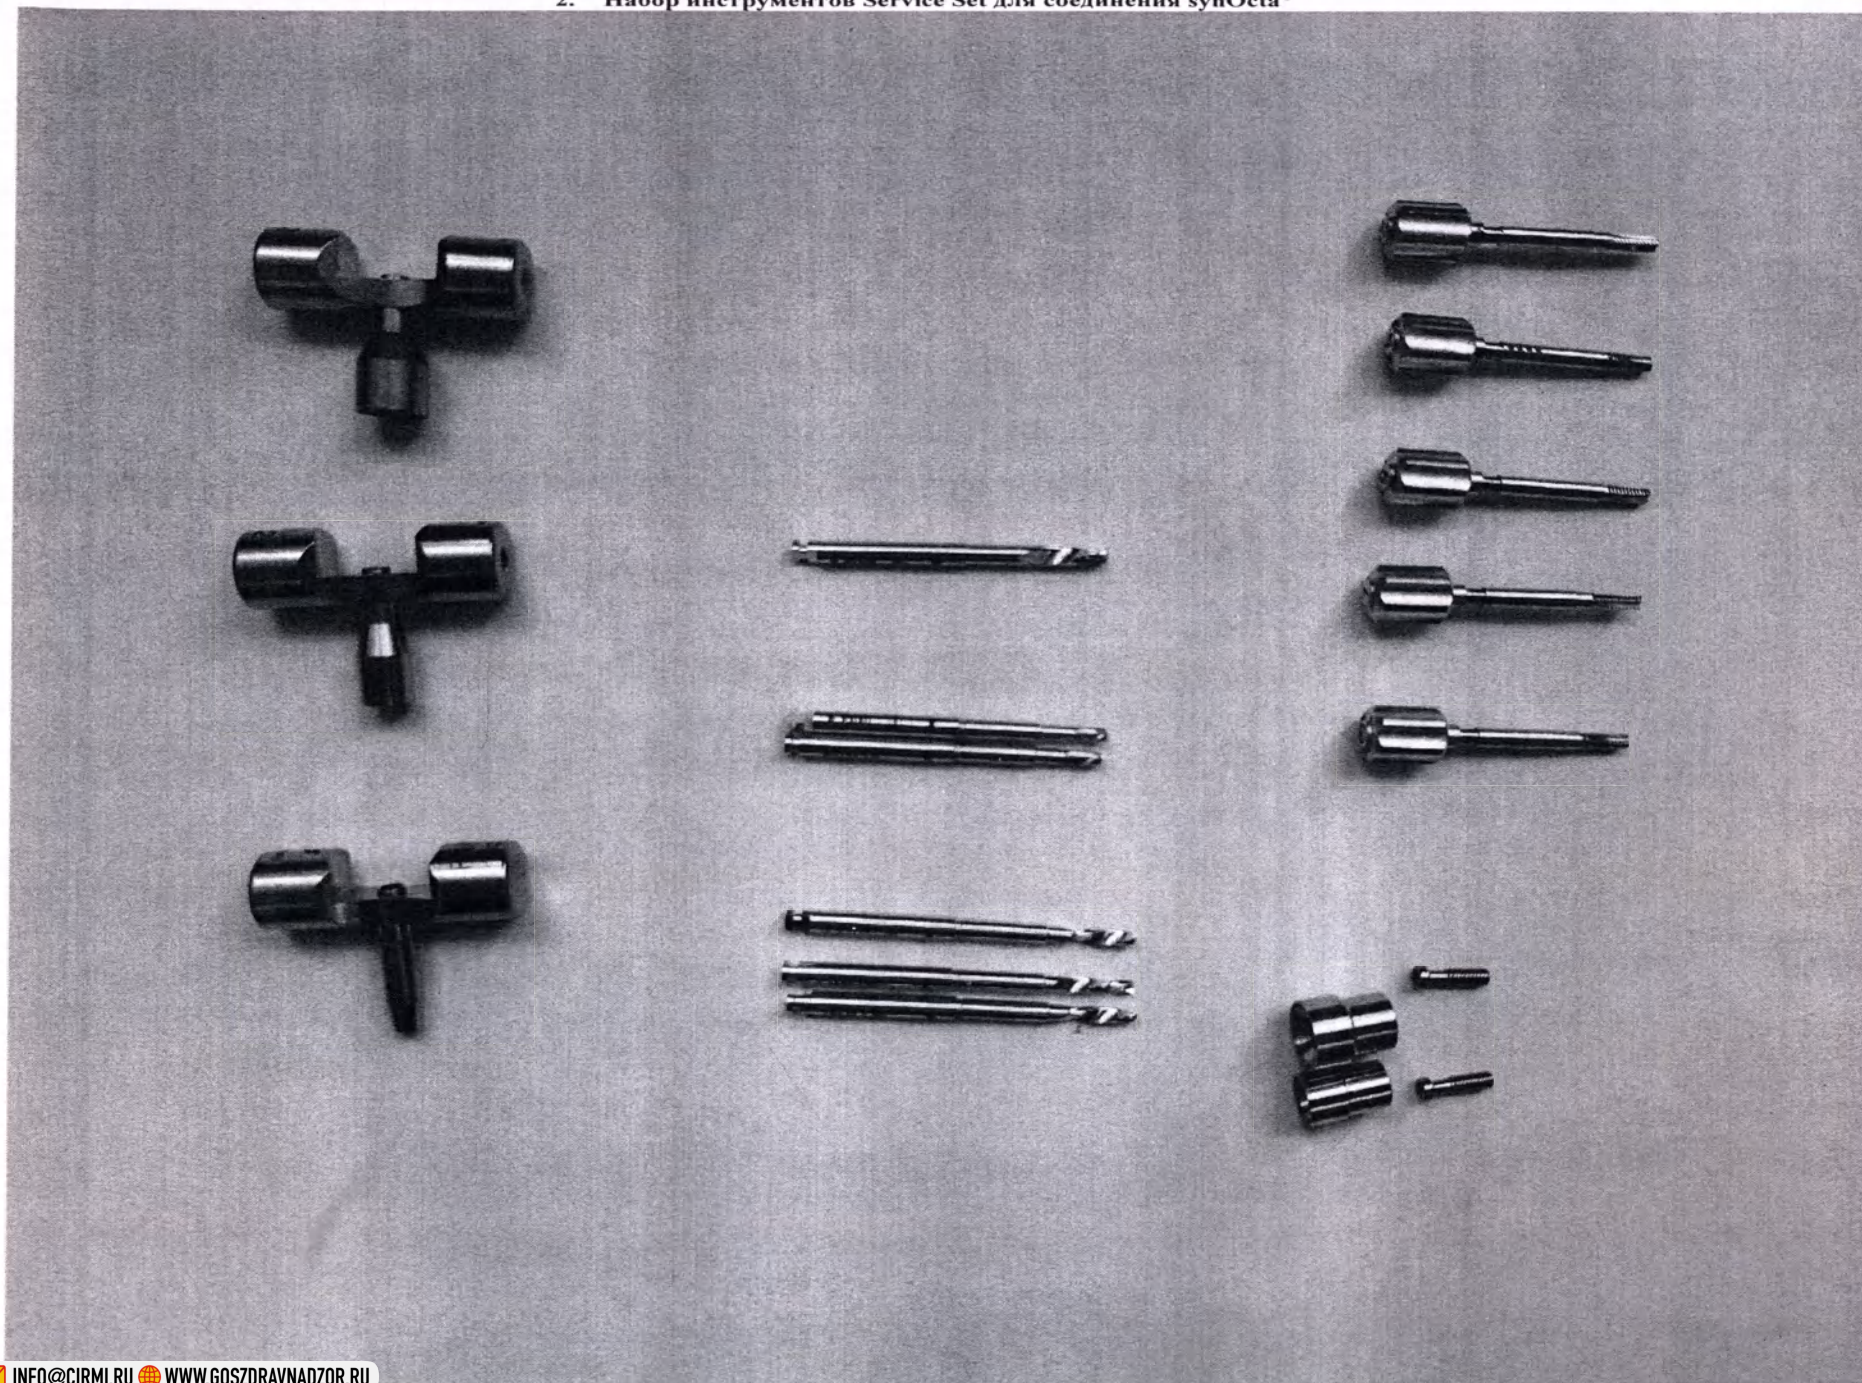

2.1. Сверло ведущее "HD Ø 2.1", с левосторонней резьбой




2.2. Фреза "МС Ø 1.6", с левосторонней резьбой



2.3. Зенкер "CD Ø 1.65", с левосторонней резьбой



2.4. Метчик "RN/WN 1", 2.5. Метчик "RN/WN 2", 2.6. Метчик "RN/WN 3", 2.7. Метчик "RN/WN 4", 2.8. Метчик "RN/WN 5"

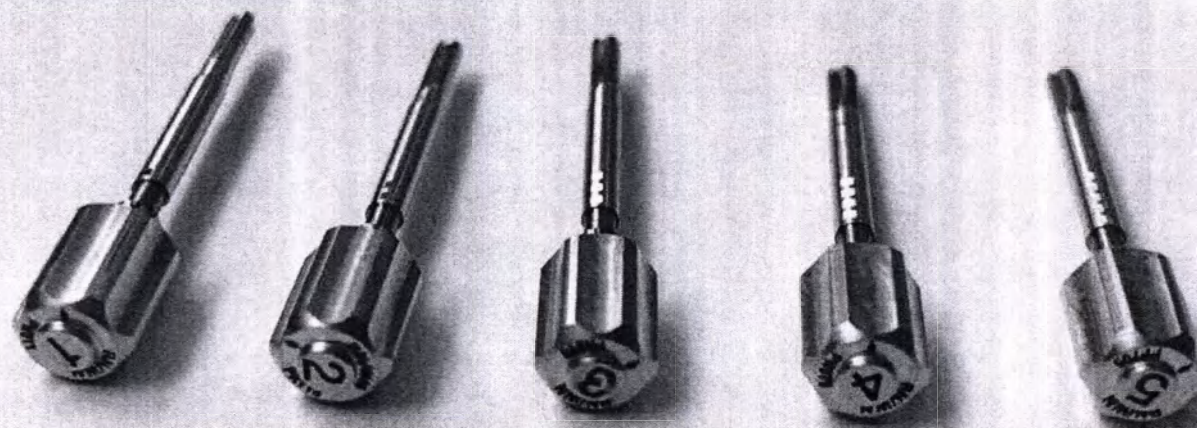

2.9. Винт окклюзионный SCS M2




2.10. Втулка экстрактора, RN




2.11. Втулка экстрактора, WN




2.12. Позиционер "RN/WN 1" для сверла/ метчика

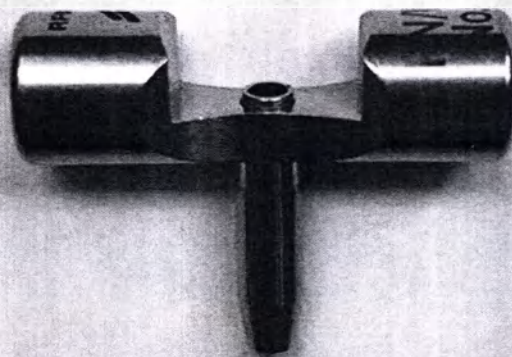




2.13. Позиционер "RN 2" для сверла/метчика

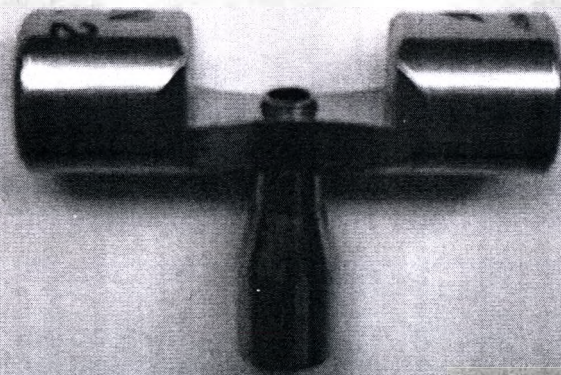

2.14. Позиционер "WN 2" для сверла/метчика

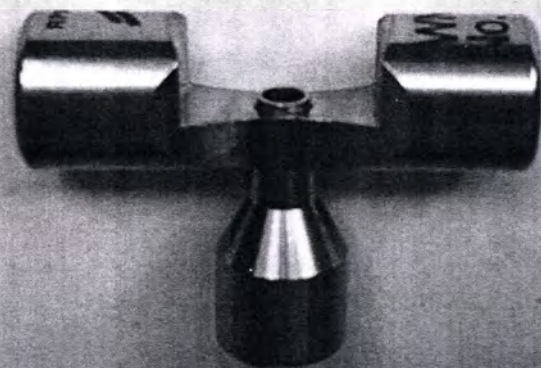

3. Набор инструментов Service Set для соединения CrossFit®




3.1. Сверло ведущее "HD Ø 2.1", с левосторонней резьбой




3.2. Фреза "МС Ø 1.6", с левосторонней резьбой




3.3. Зенкер "CD Ø 1.3", с левосторонней резьбой




3.4. Метчик "NNC/NC/RC 1", 3.5. Метчик "NNC/NC/RC 2", 3.6. Метчик "NNC/NC/RC 3", 3.7. Метчик "NNC/NC/RC 4"

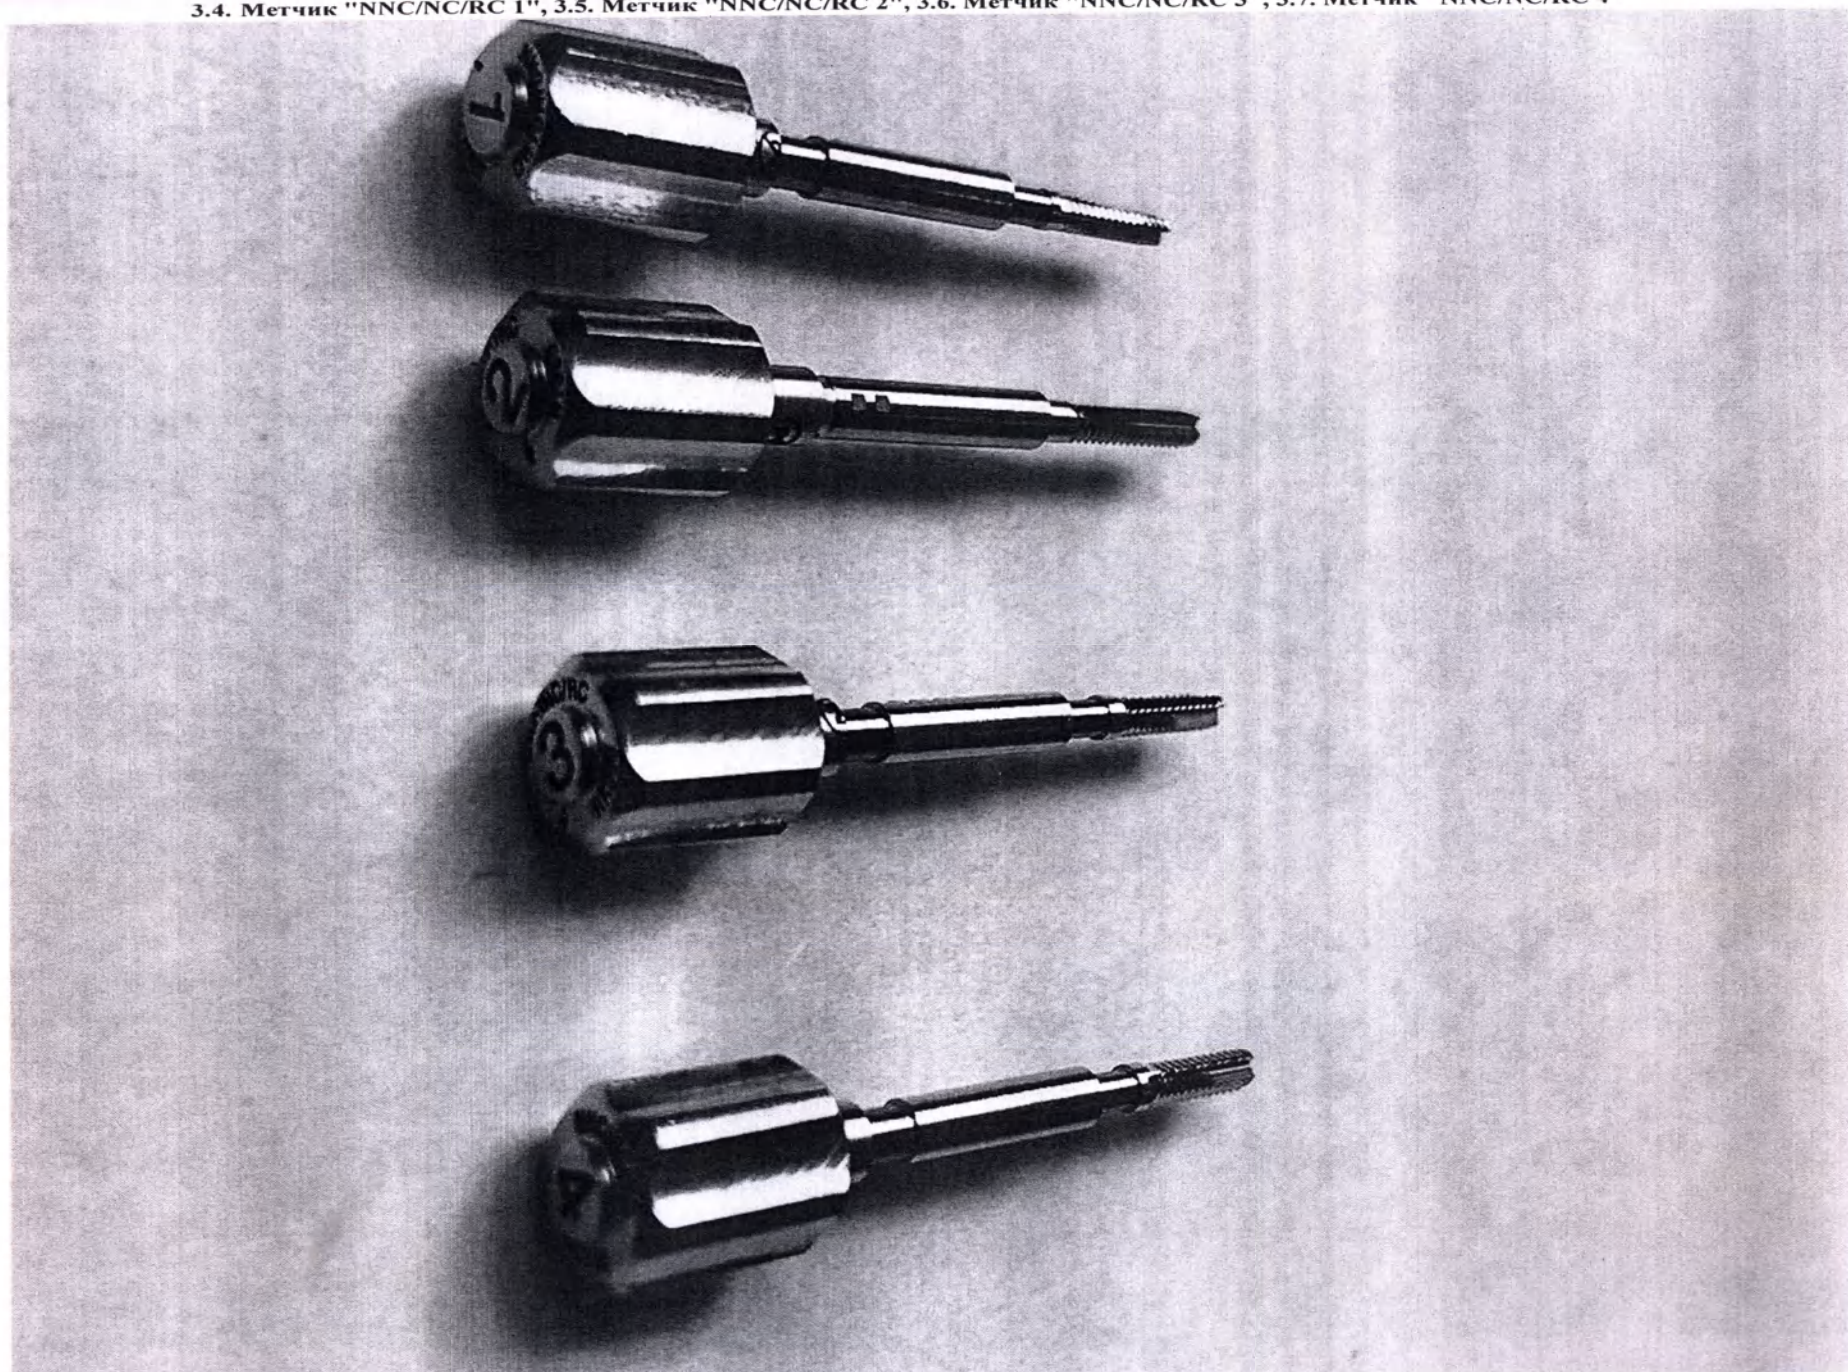


3.8. Позиционер "NNC/NC 1" для сверла

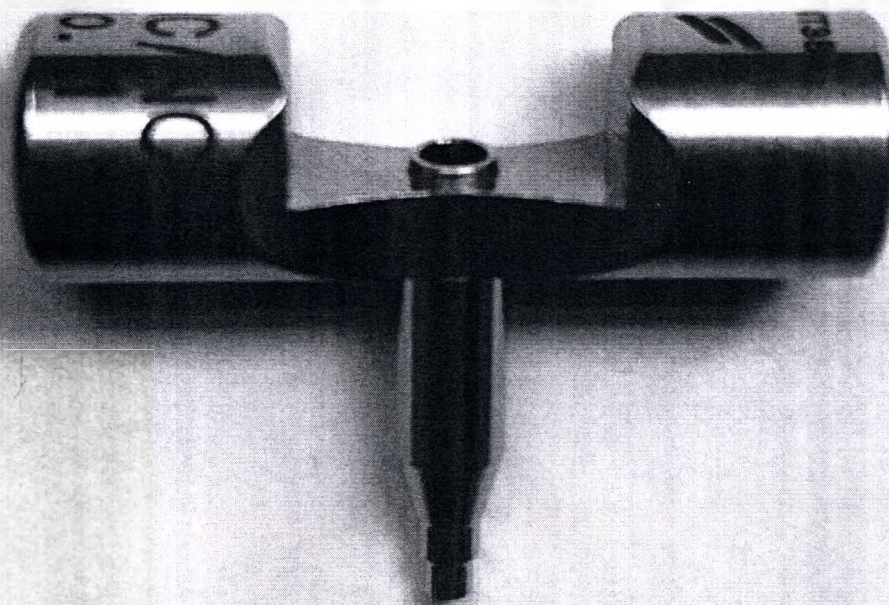


3.9. Позиционер "NNC/NC 2" для метчика

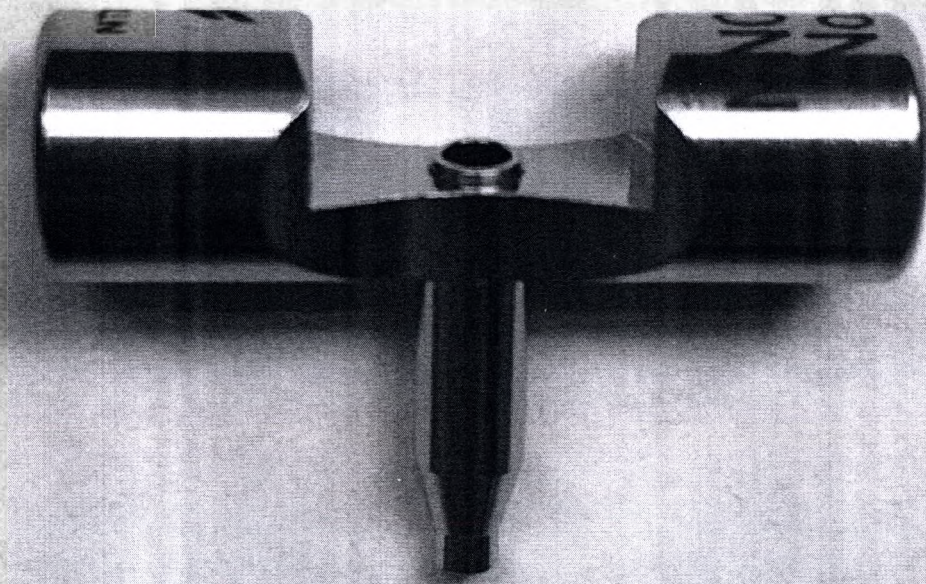

3.10. Позиционер "RC 1" для сверла/метчика

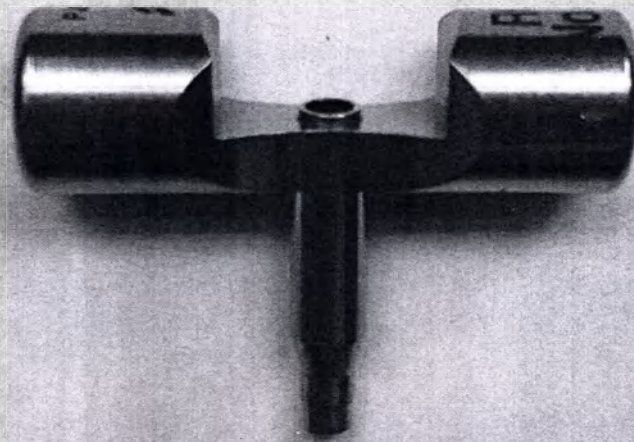

4. Набор инструментов Service Set для имплантатов NN

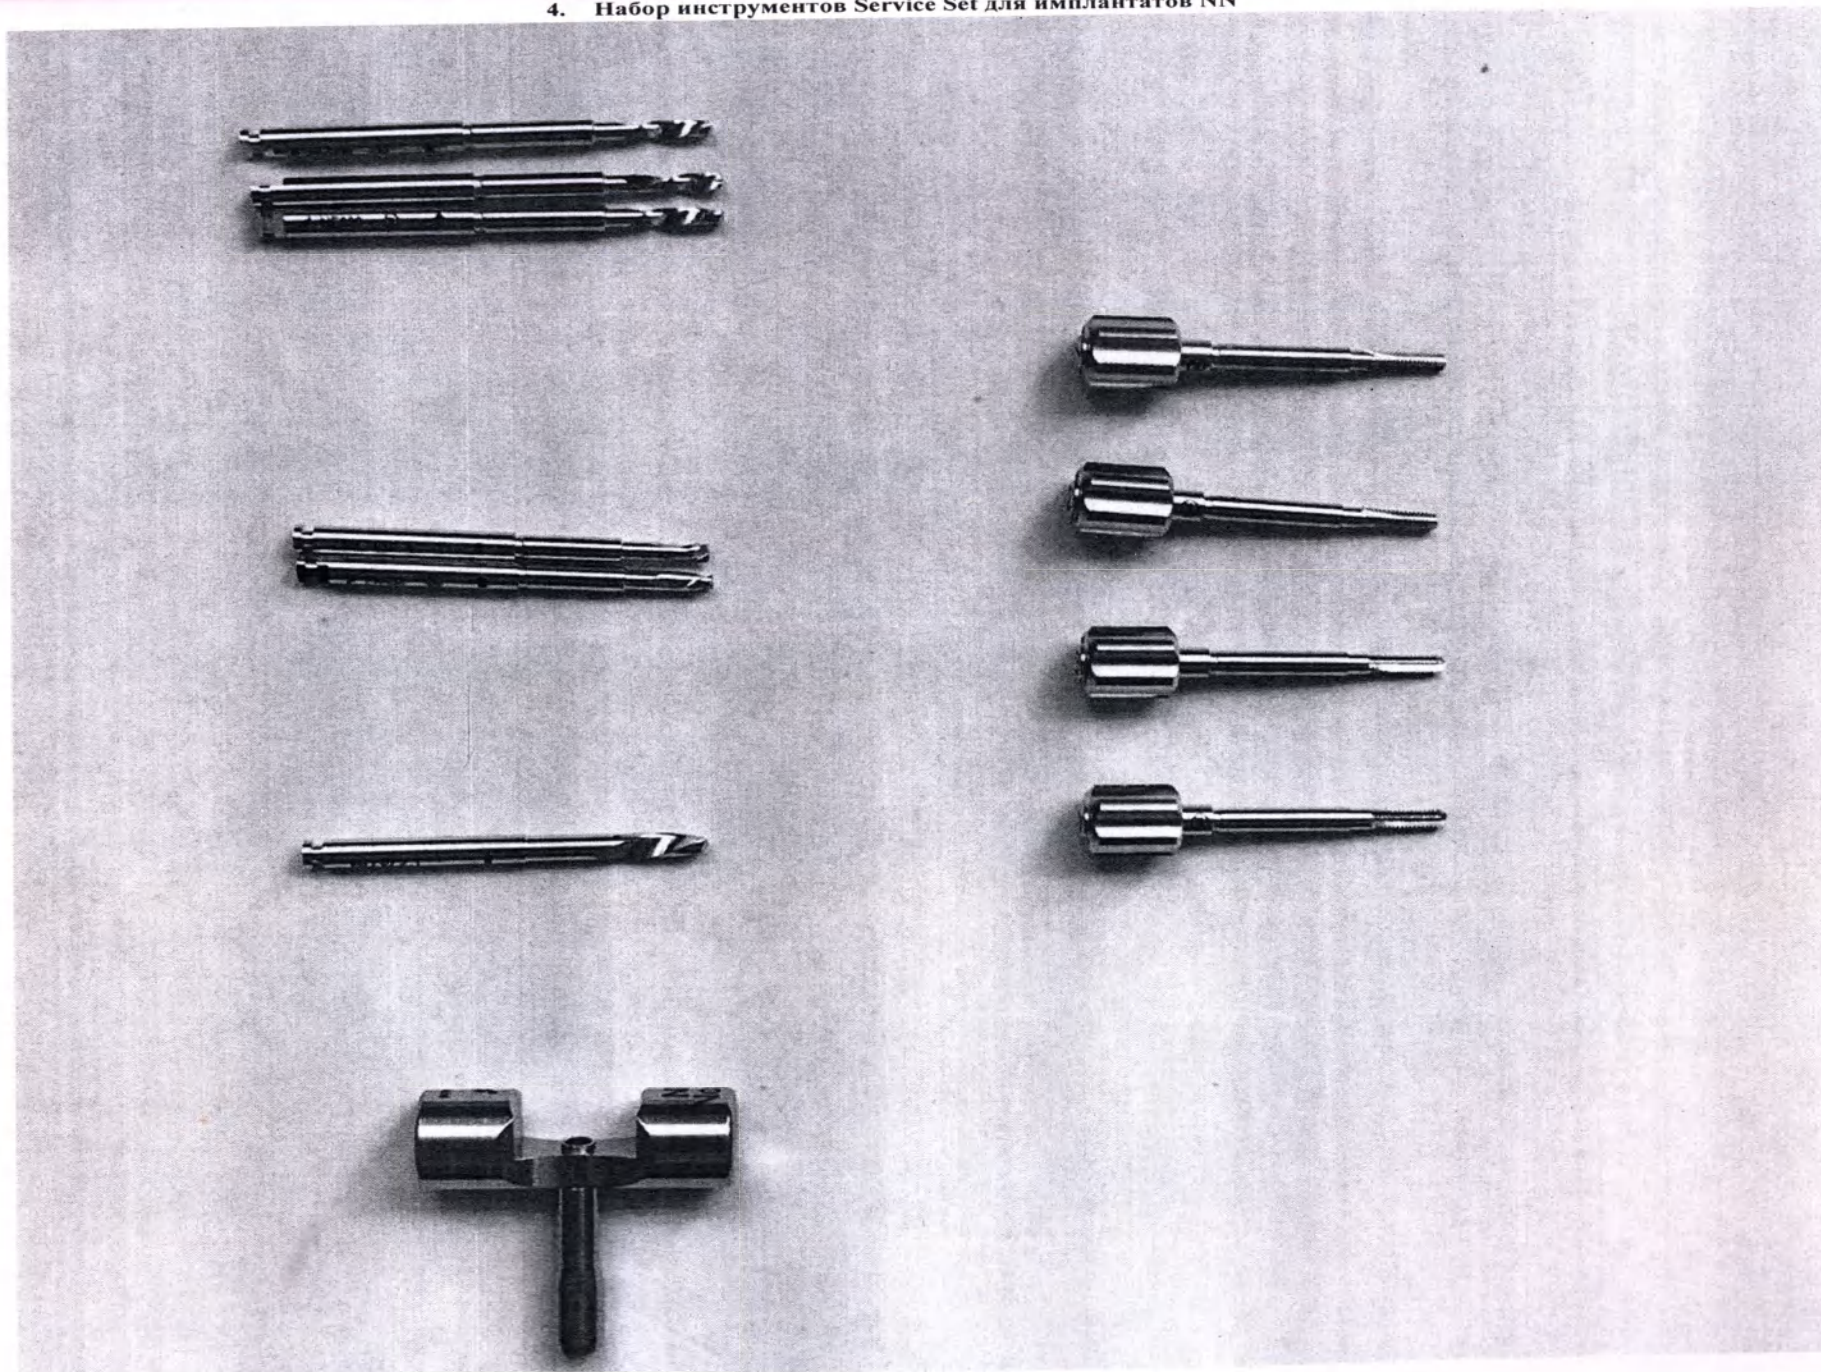

4.1. Сверло ведущее "HD Ø 2.1", с левосторонней резьбой




4.2. Фреза "МС Ø 1.6", с левосторонней резьбой




4.3. Зенкер "CD Ø 1.45", с левосторонней резьбой





4.4. Метчик "NN 1", 4.5. Метчик "NN 2", 4.6. Метчик "NN 3", 4.7. Метчик "NN 4"

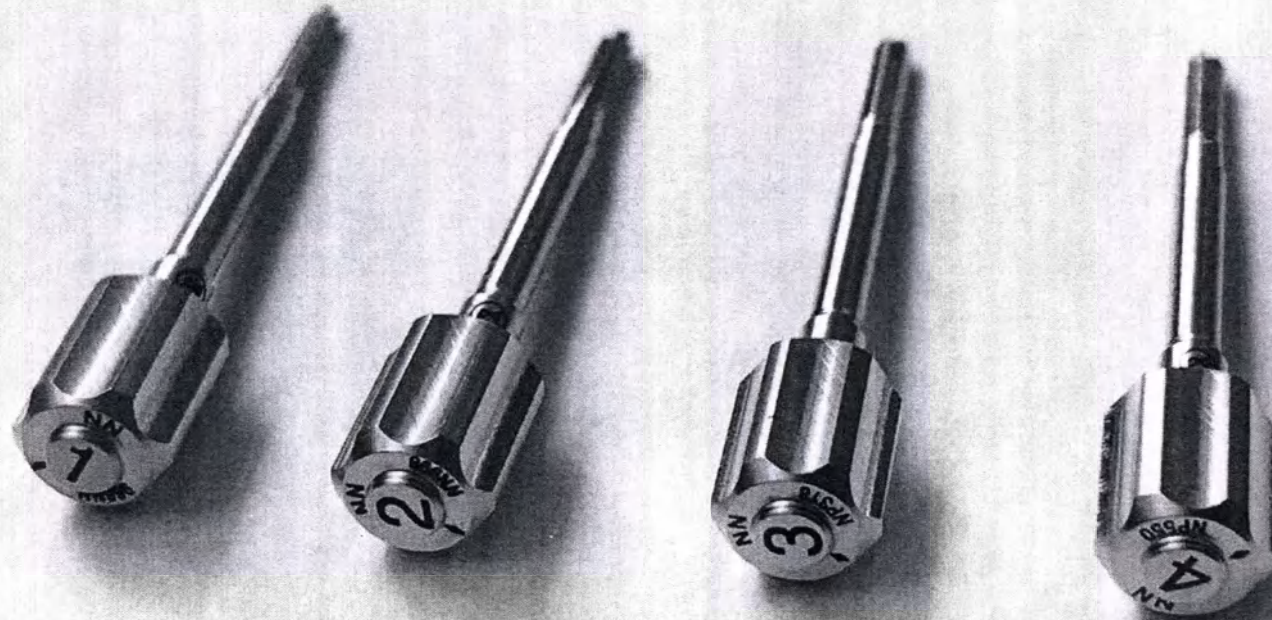


4.8. Позиционер "NN 1" для сверла/метчика

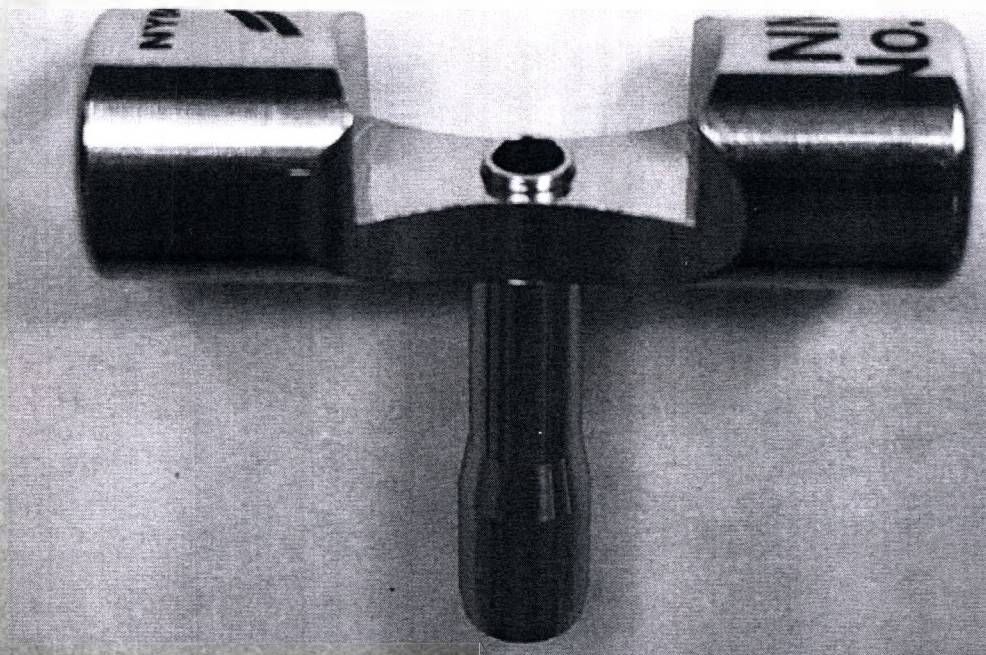

5. Набор инструментов Service Set дополнительный для керамических имплантатов RD

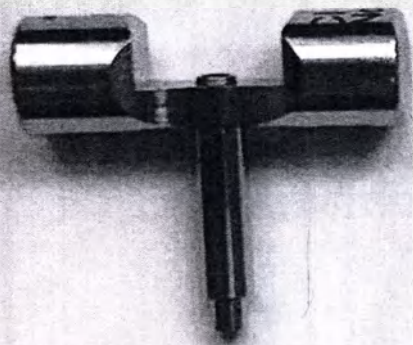

5.1. Позиционер "CI No.1" для сверла

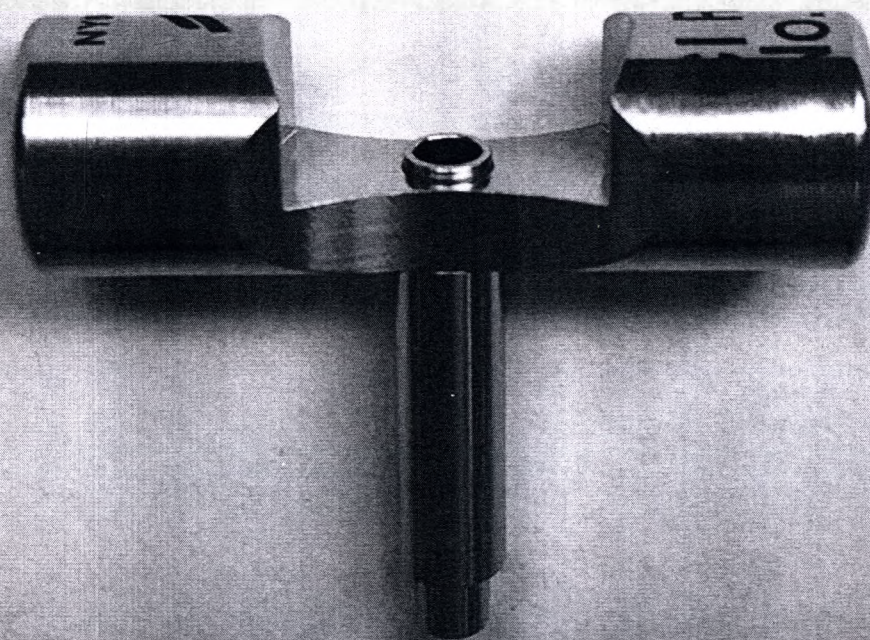

5.2. Зенкер "CD Ø 1.65", с левосторонней резьбой




5.3. Сверло ведущее "HD Ø 2.1", с левосторонней резьбой



5.4. Фреза "МС Ø 1.6", с левосторонней резьбой



6. Набор инструментов Service Set дополнительный для соединения SC

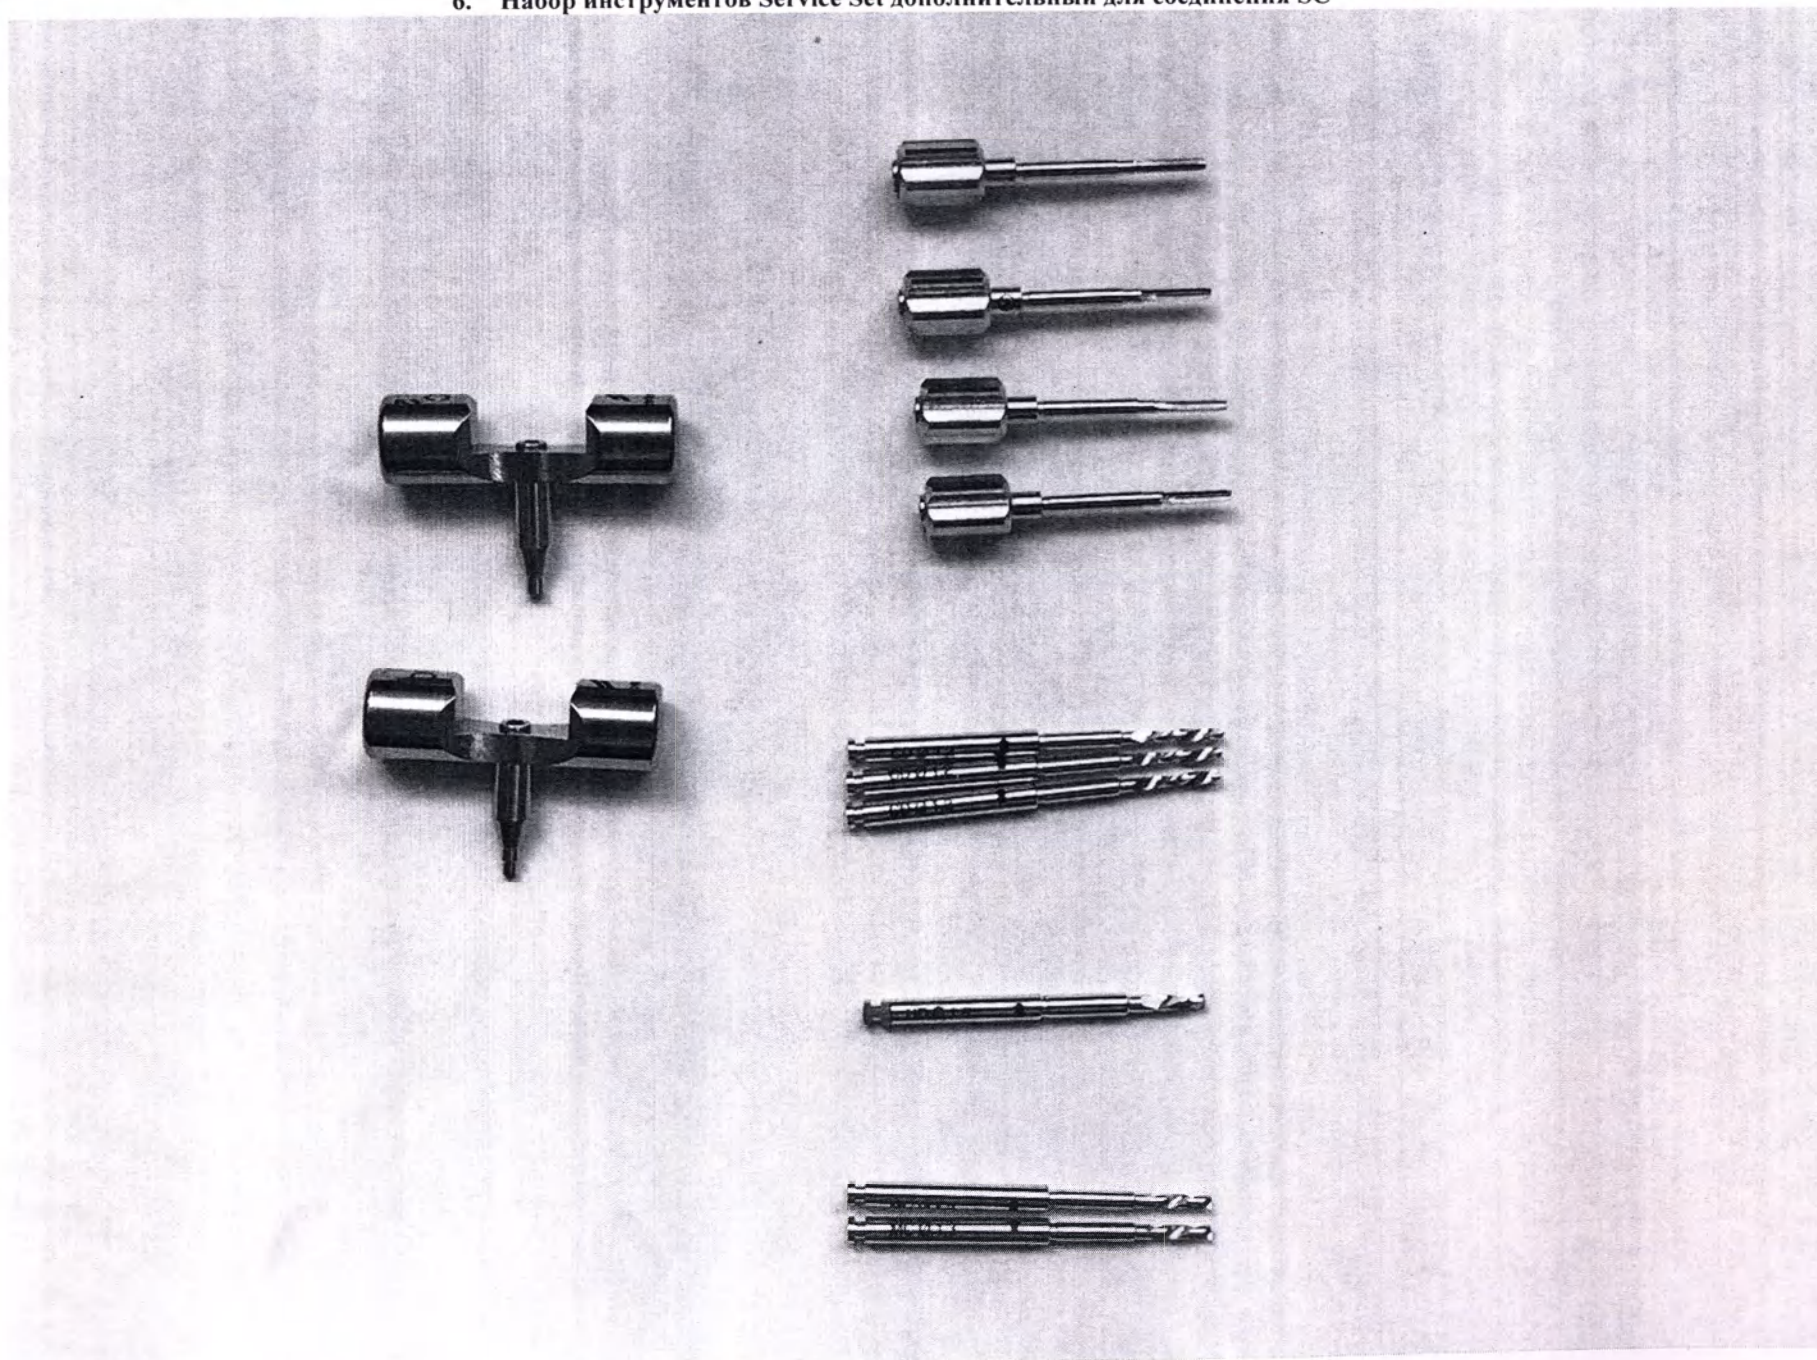

6.1. Сверло ведущее "HD Ø 1.6", с левосторонней резьбой




6.2. Фреза "МС Ø 1.3", с левосторонней резьбой




6.3. Зенкер "CD Ø 1.2", с левосторонней резьбой



6.4. Метчик "SC 1", 6.5. Метчик "SC 2", 6.6. Метчик "SC 3", 6.7. Метчик "SC 4"

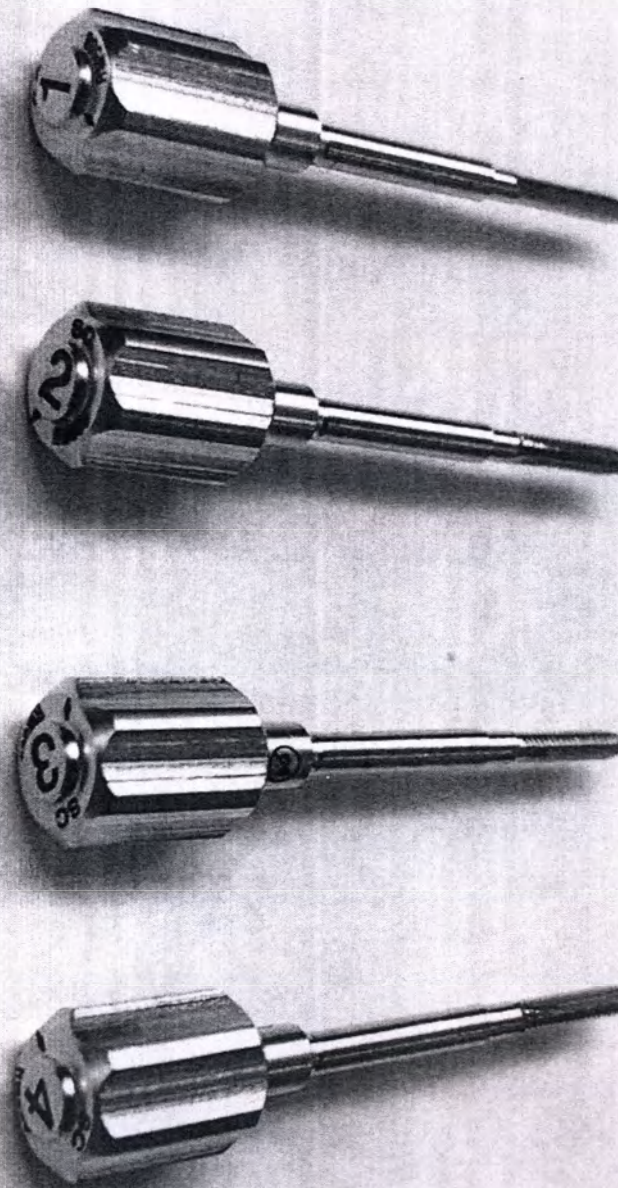


6.8. Позиционер "SC 1" для сверла

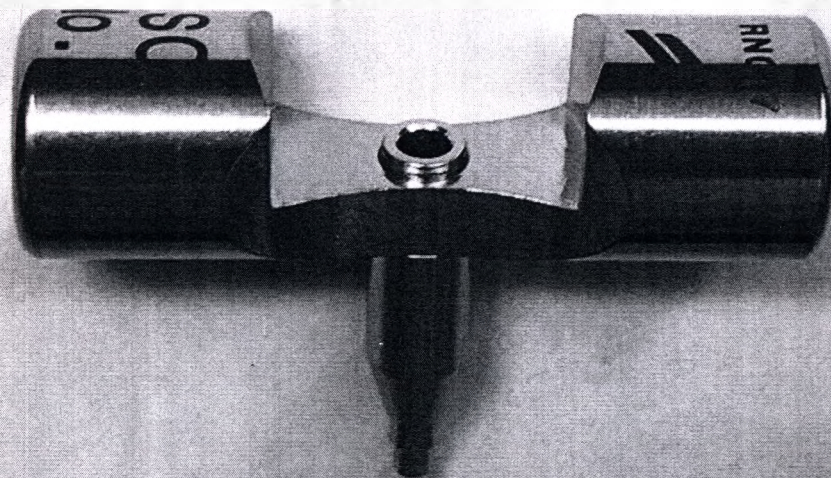

PCL XL Error
Subsystem:
Error:
Operator:
Position:

I/O
InputReadError
ReadImage
94671

6.9. Позиционер "SC 2" для метчика

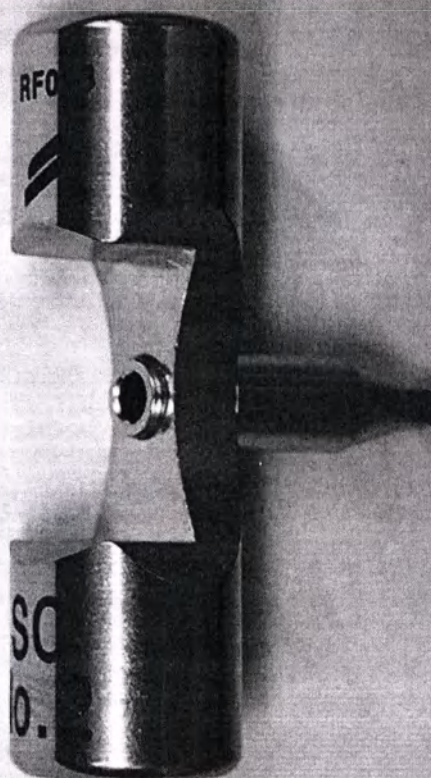

Примено
46 листов