

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО "Медэксперт Консалтинг"

Плотников Д.А.



Фотографические изображения Медицинского Изделия:

«Тимпанометр Amplivox Otowave (Аудиометр импедансный)»

производства

Amplivox limited

Адреса мест производства медицинского изделия:

1) Amplivox limited:


3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, West Midlands B37 7YG, United Kingdom;


2) DGS Diagnostics Sp.z o.o:

ul. Zeusa 2, 72-006 Mierzyn, POLAND

Вариант исполнения: I (II) - Тимпанометр Amplivox Otowave 202(202-H) (Аудиометр импедансный):

1. Базовый блок Otowave 202(202-H) (Вид спереди)

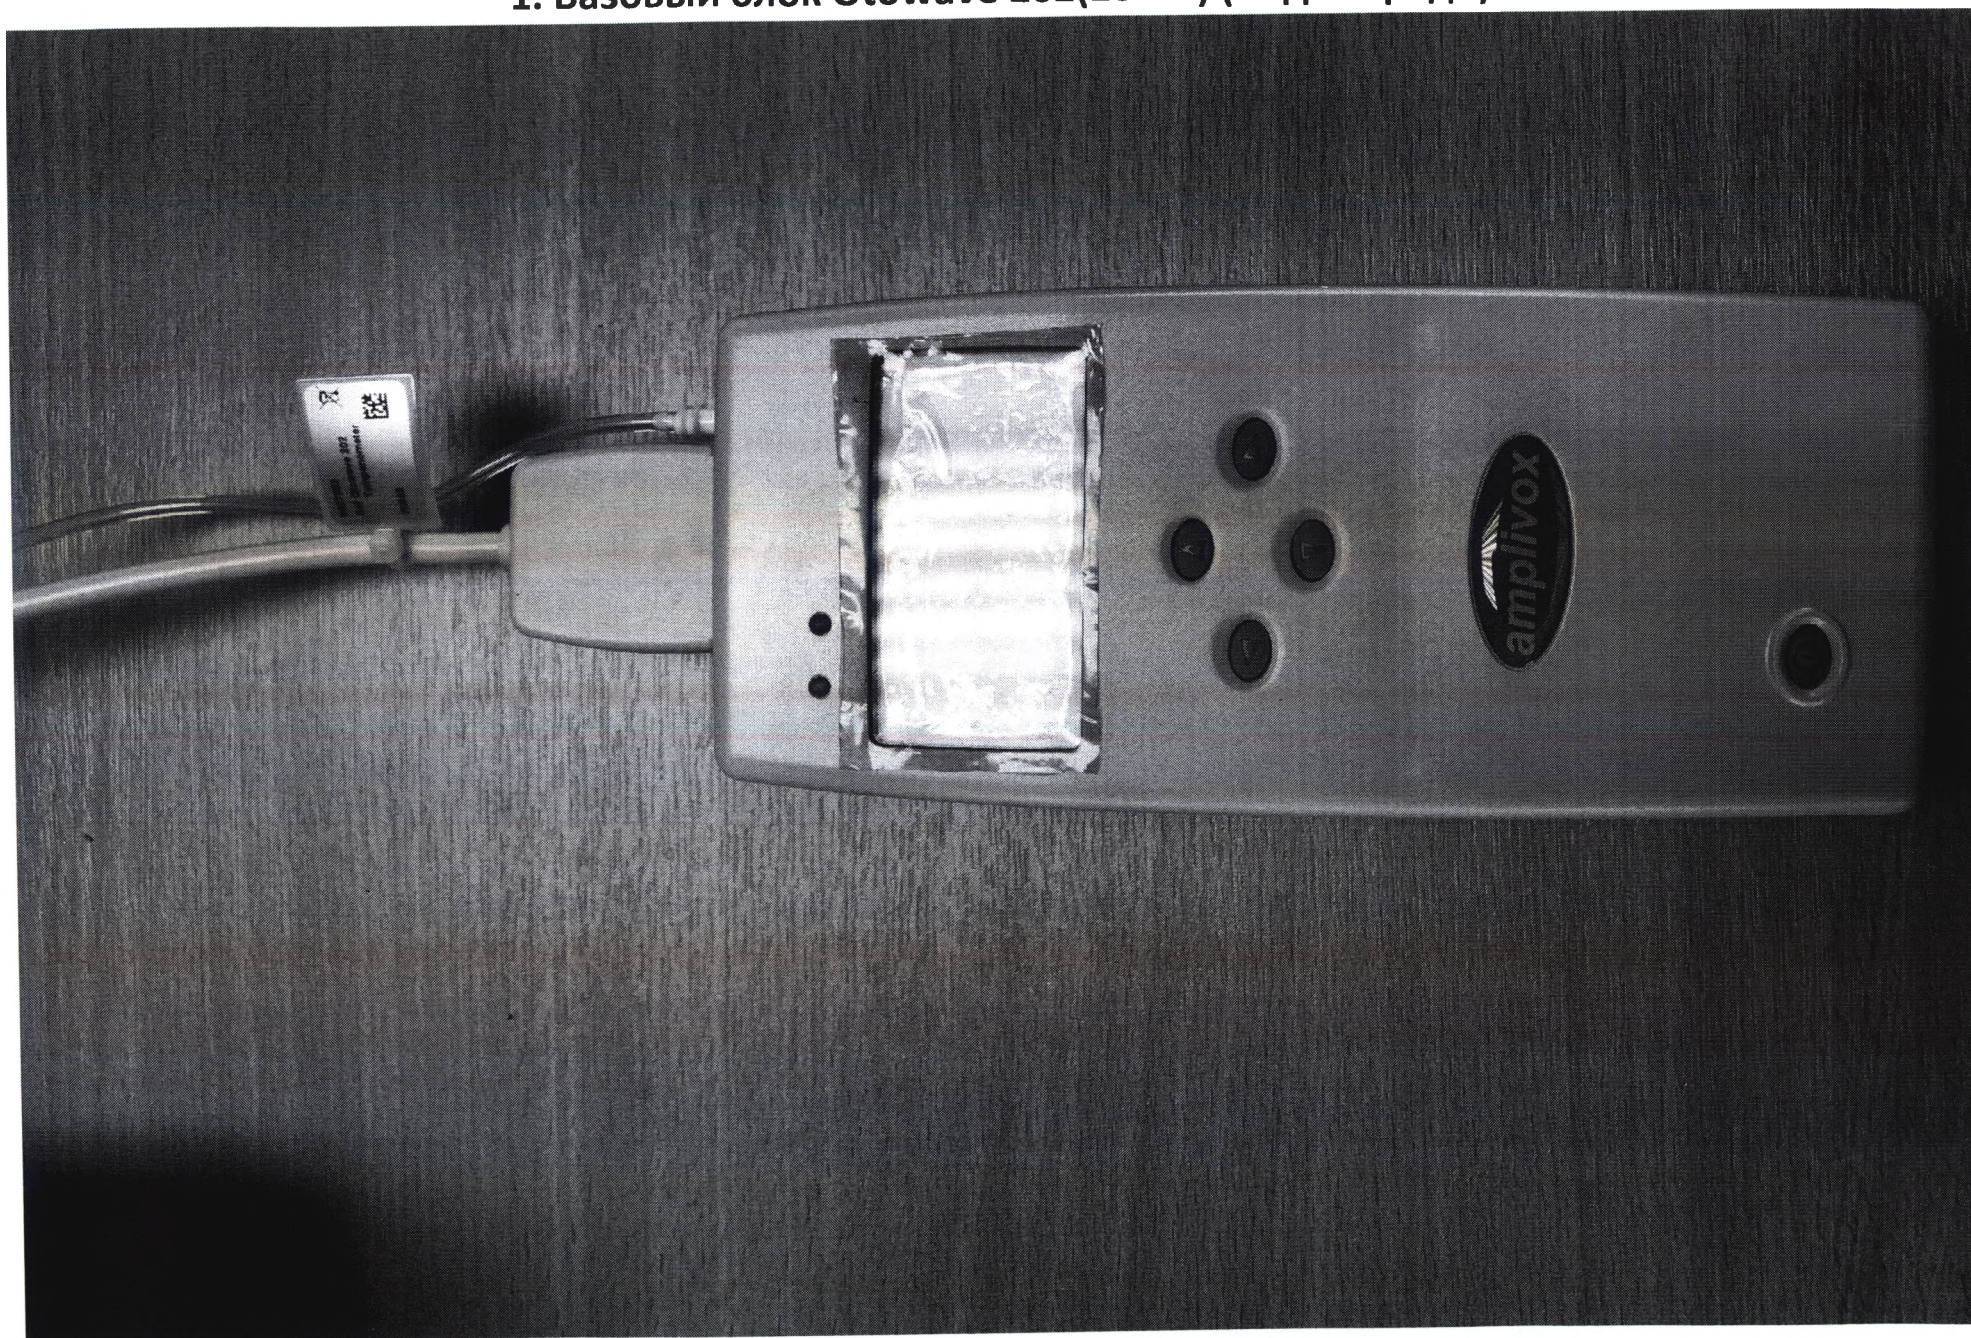

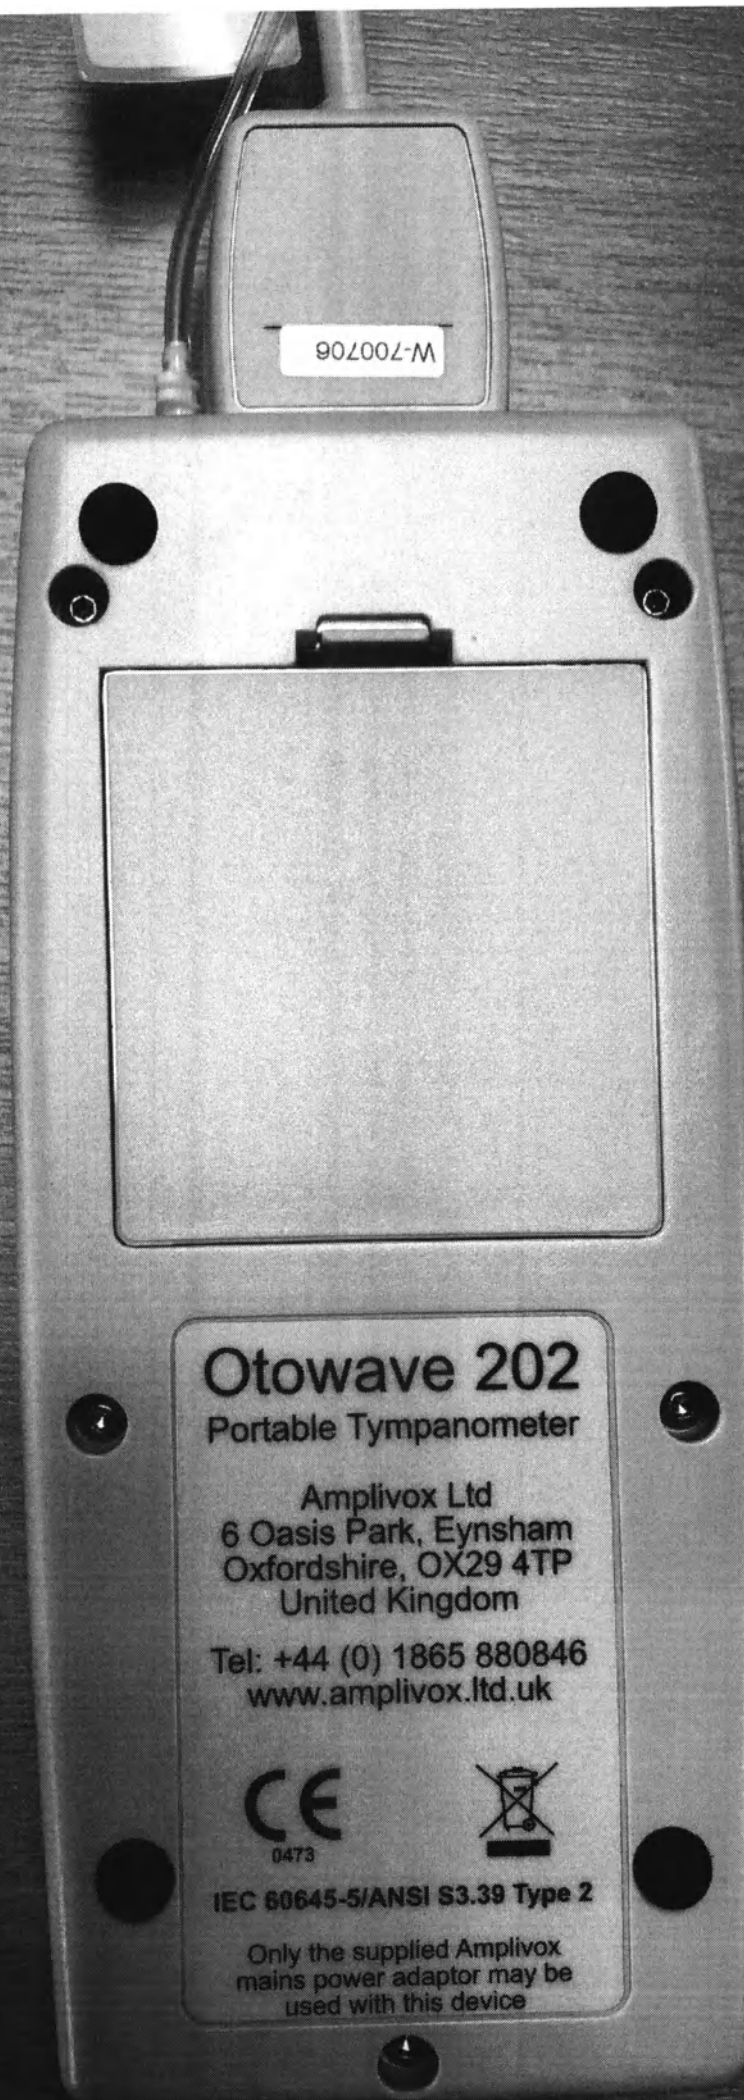

Вариант исполнения: III (IV) - Тимпанометр Amplivox Otowave 302(302-H) (Аудиометр импедансный)

1.Базовый блок Otowave 302(302-H) (Вид спереди)



Базовый блок Otowave 302(302-H) (Вид АДИ)

Amplivox Ltd
Tympanometer 2017
+ 5V DC
Serial No:
80155


CE 0473




Instrument Calibration Dates.
Calibrated: 14.06.2018
Next calibration due: 14.06.2019

Amplivox Ltd, 6 Oasis Park, Eynsham,
Oxfordshire OX29 4TP UK.
01865 880846

2. Земный датчик в сборе Otoway

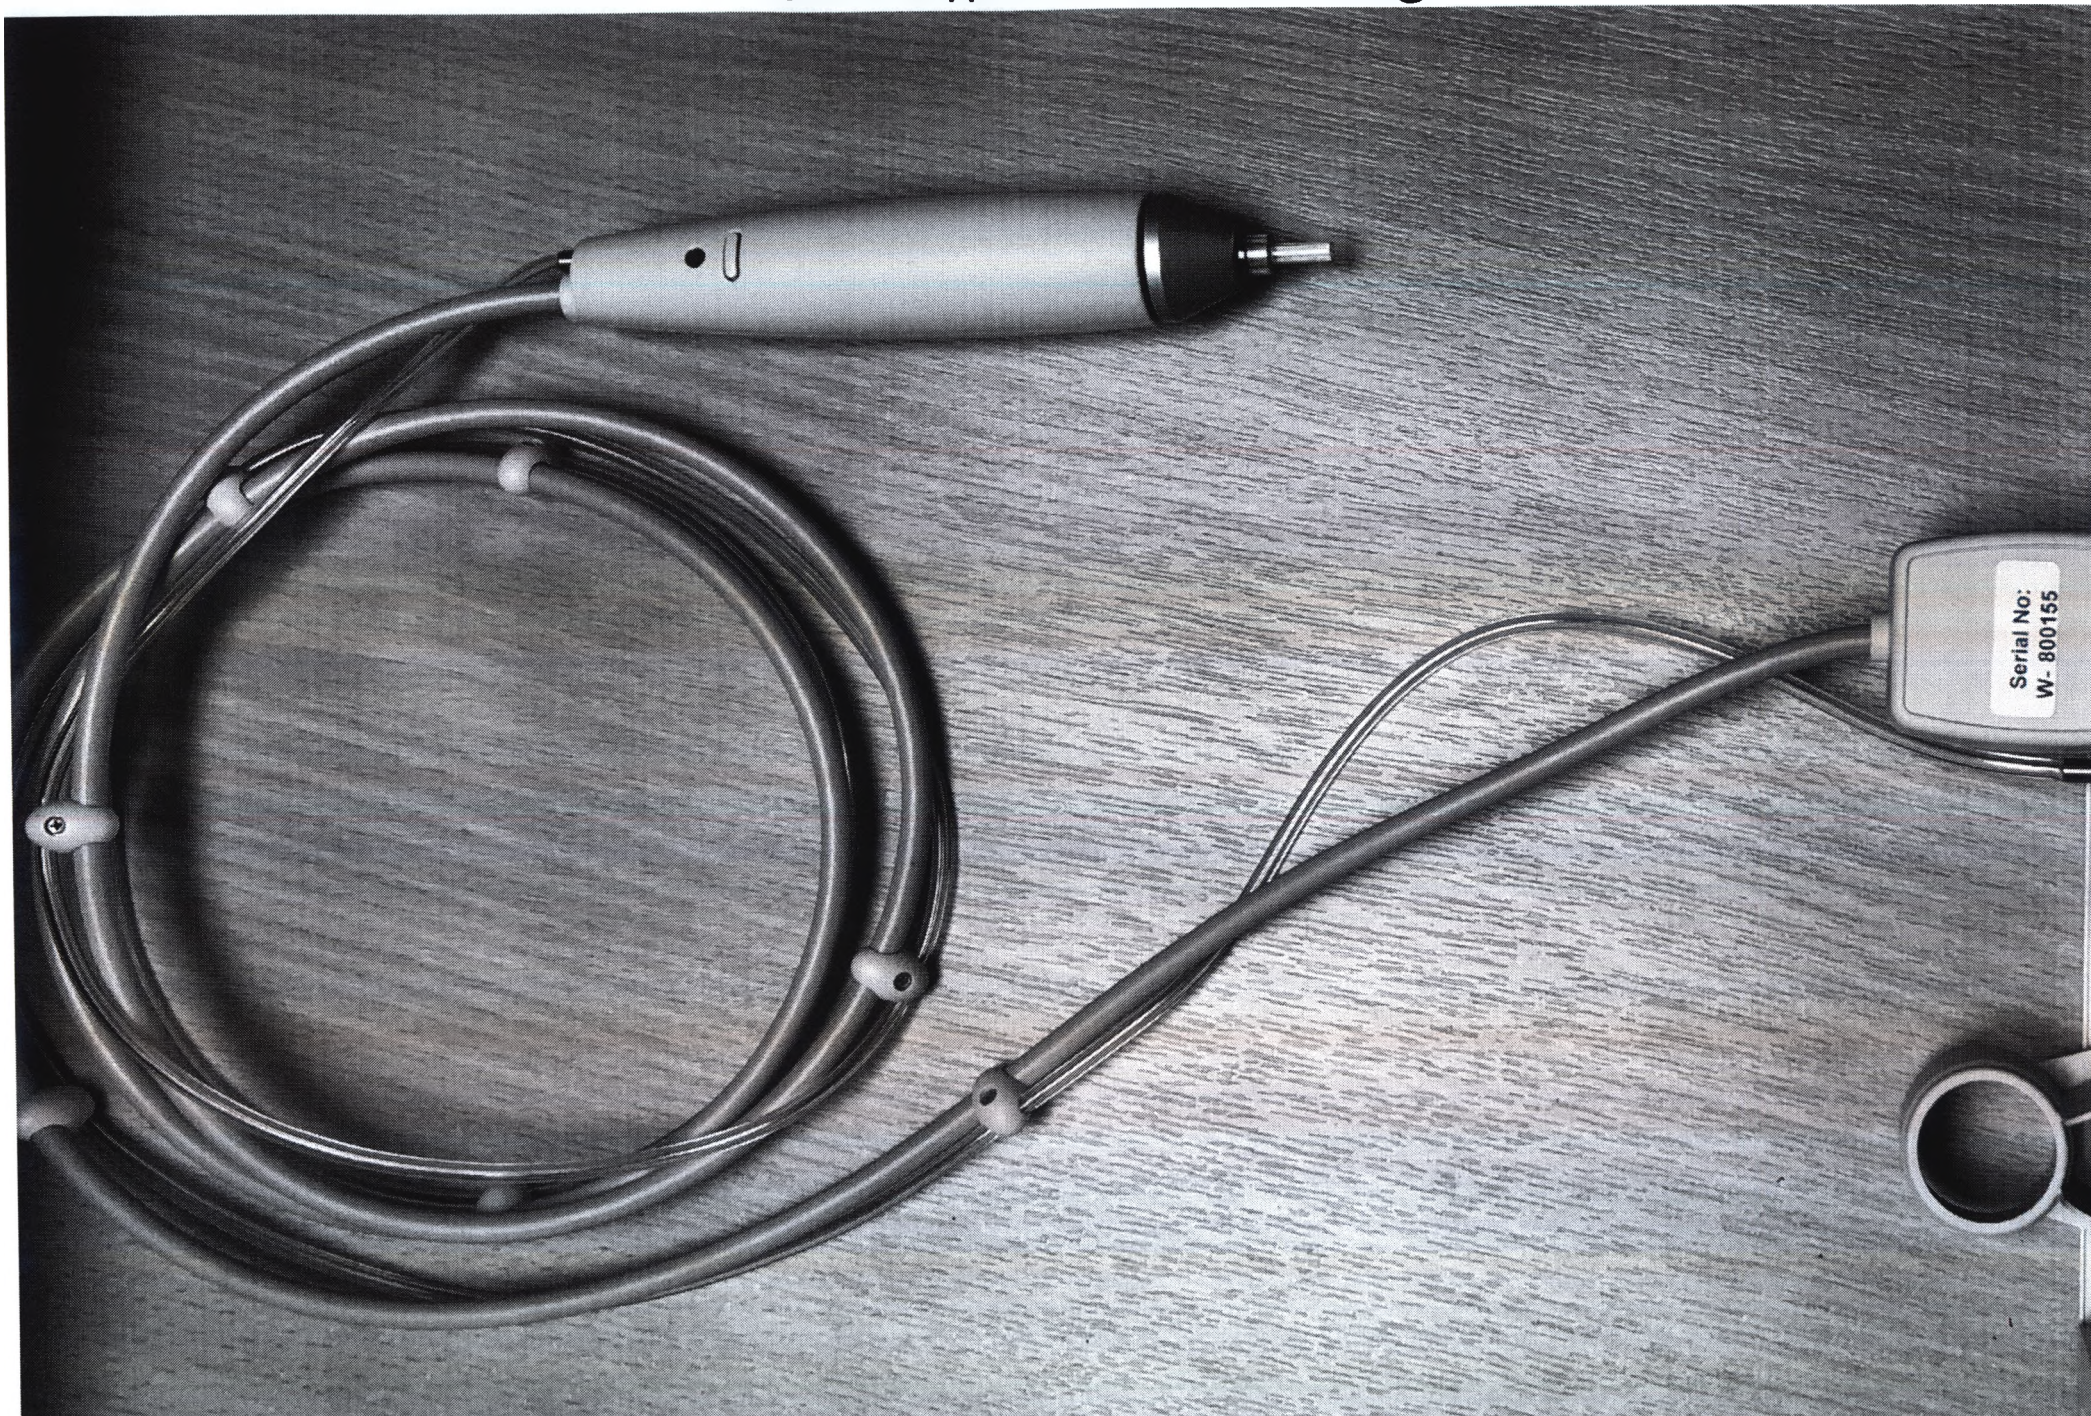


3.Сетевой адаптер




4. Контралатеральный преобразователь




5. Делочная батарея «АА» - 4 шт.

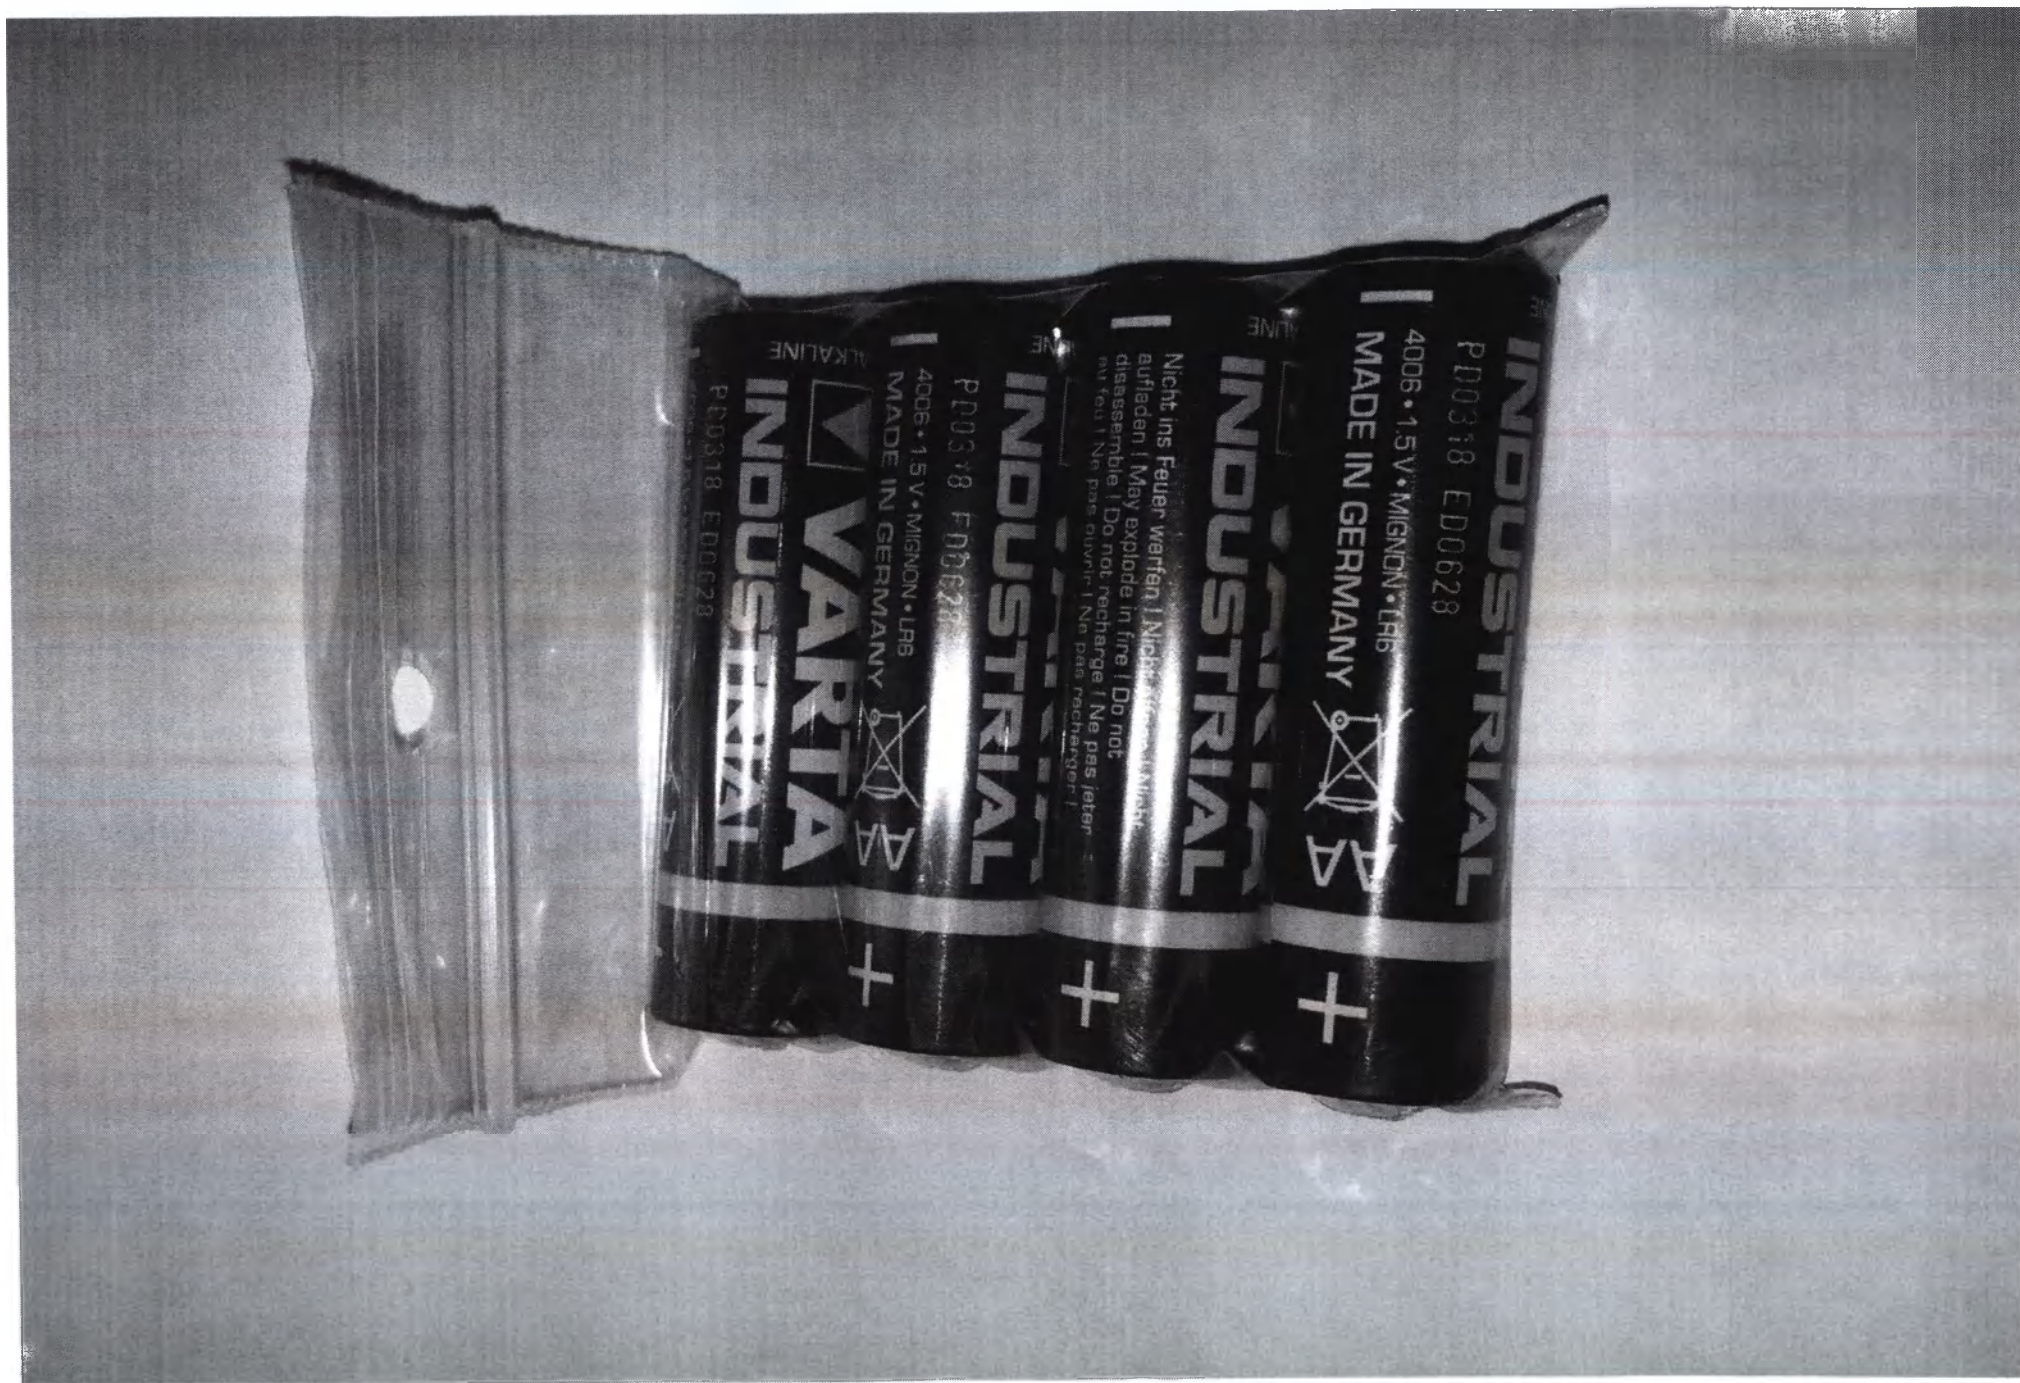

● 4 в 1 тестовые полости T030 ●

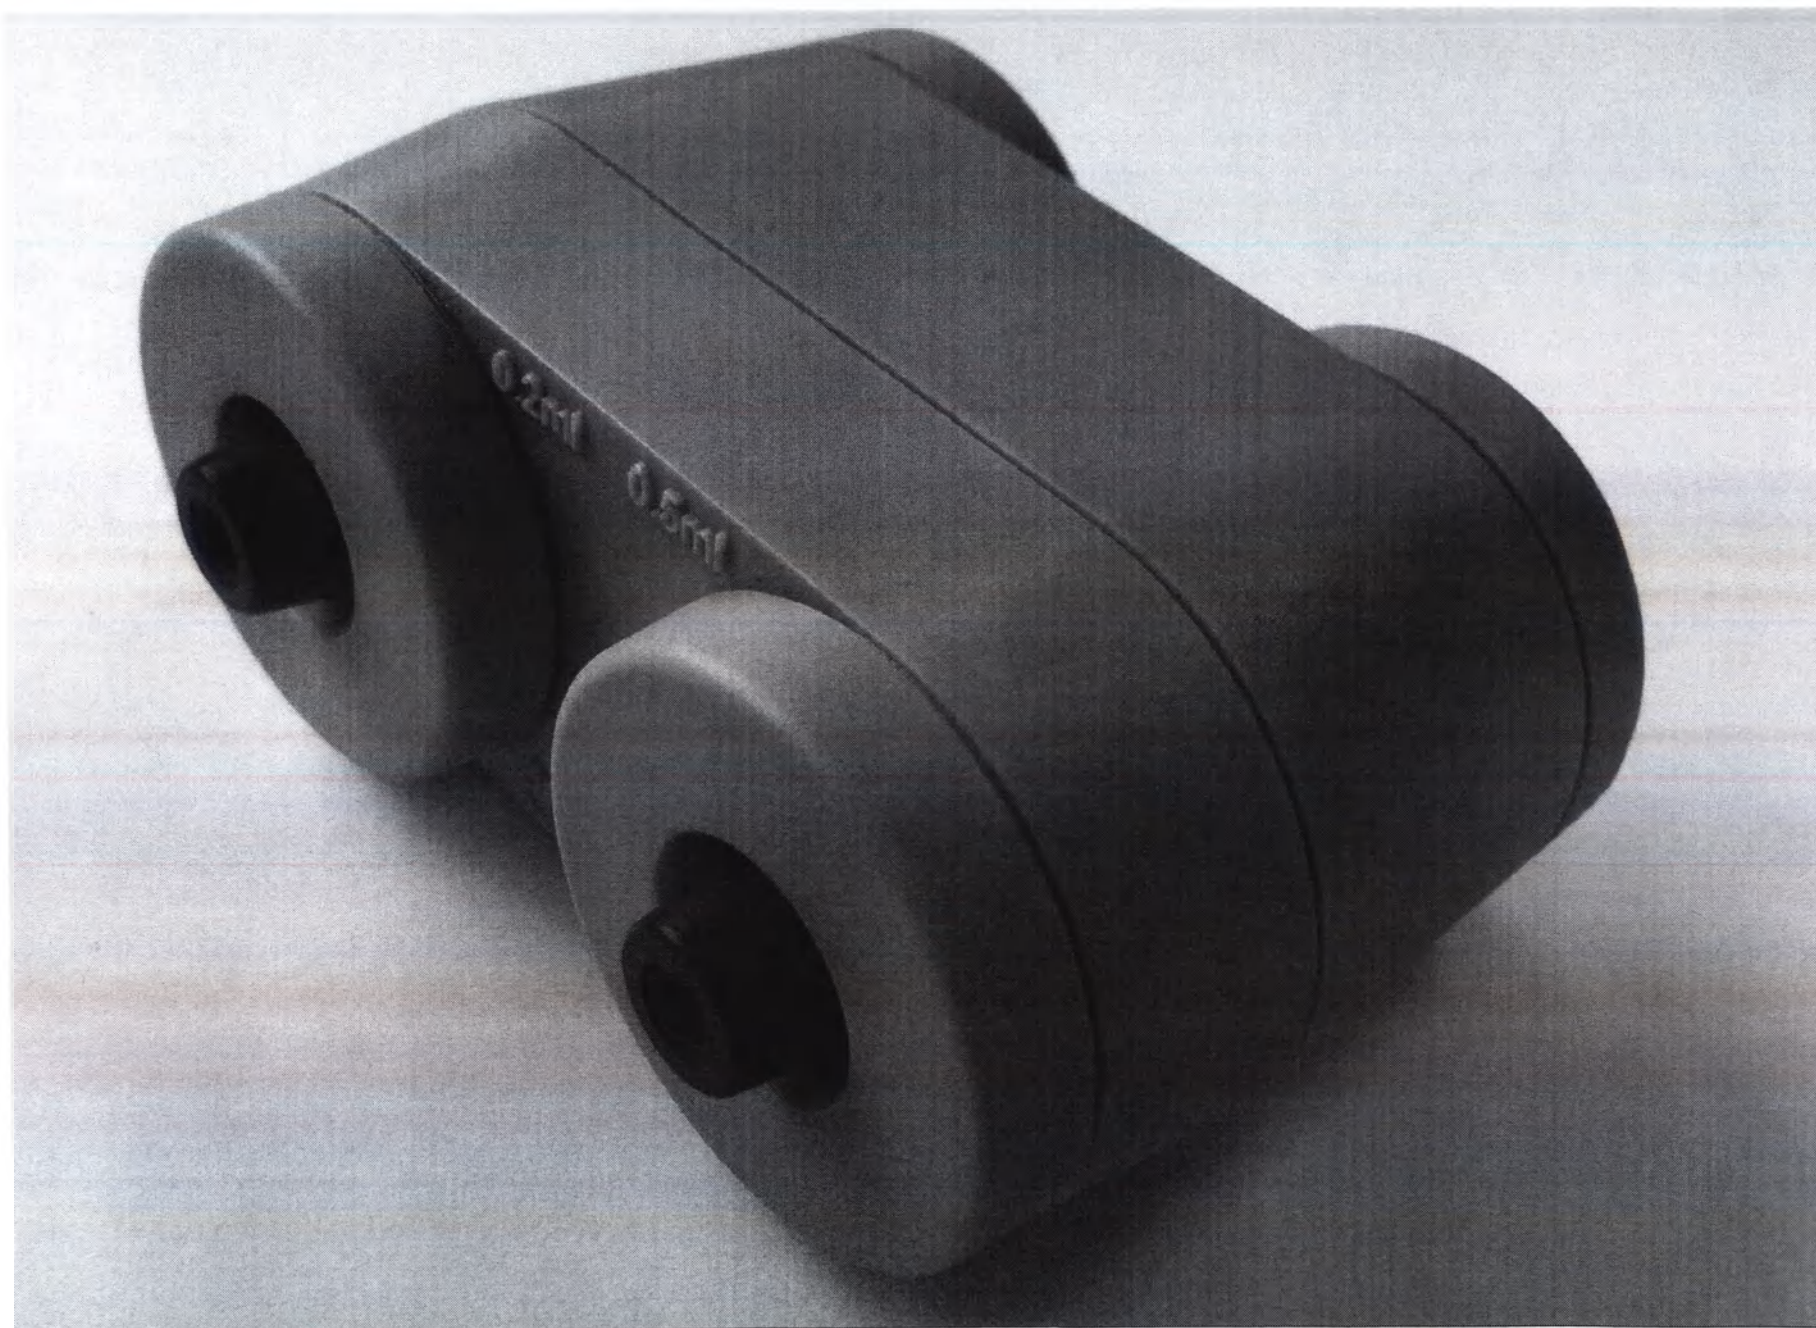


7. Комплект одноразовых ушных вкладок

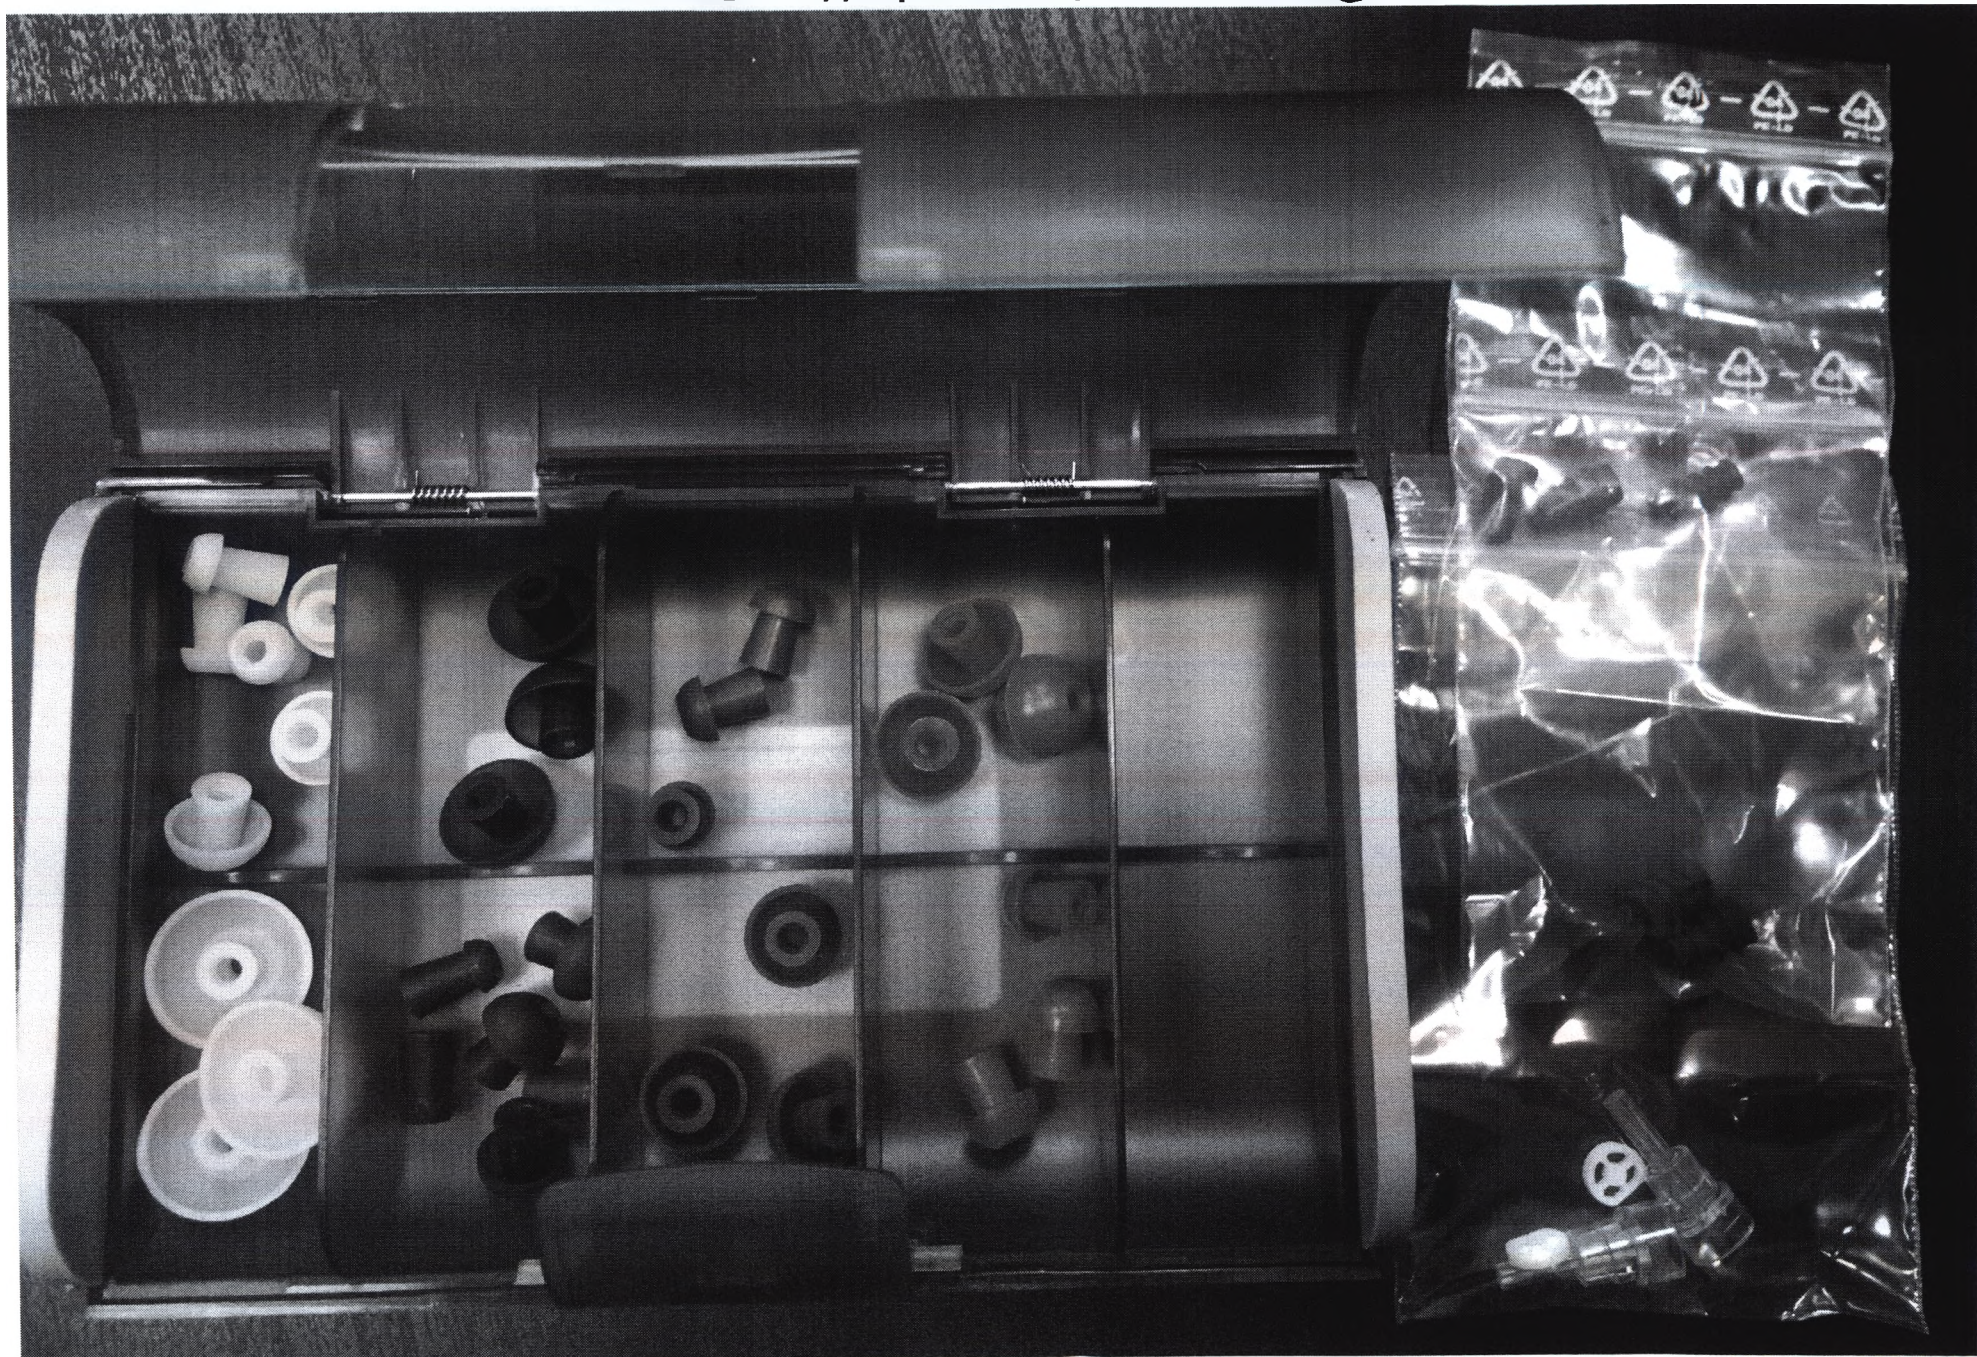

8. Кейс для переноски и хранения



9. Руководство по эксплуатации и TympView на компакт-диске,

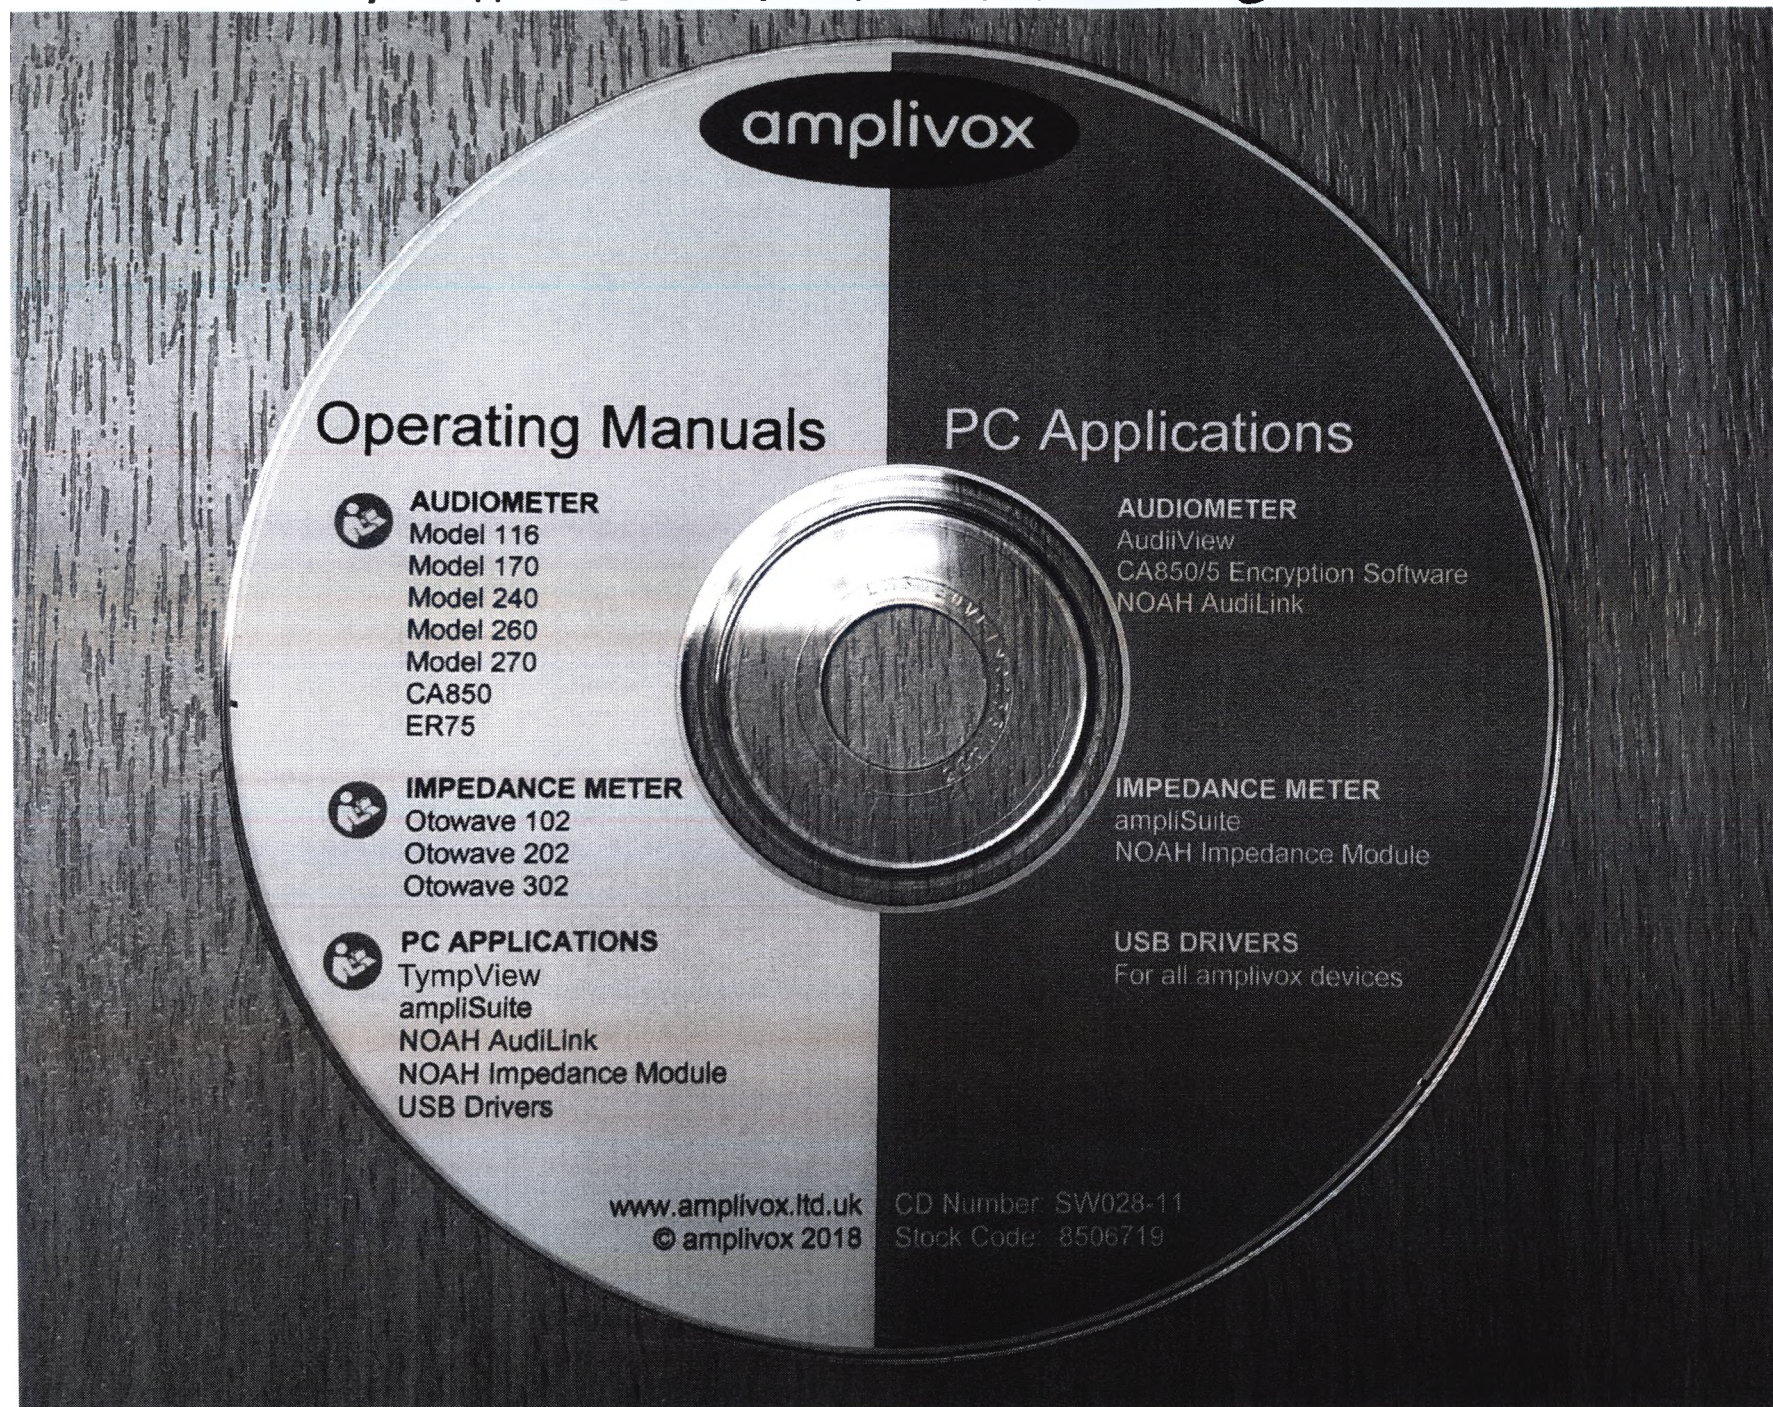

amplivox

Certificate of Calibration

PRODUCT TYPE: Tympanometer

PRODUCT NAME: Otowave 302 (H Option)

MAIN BODY SERIAL NO: 80155

Ipsilateral Serial No: W-800155

Contralateral Serial No: 11503

CALIBRATED BY: T SZANIEC

DATE: 14/06/2018

CALIBRATED IN ACCORDANCE WITH:

BS EN 60645-5: 2005

BS EN ISO 389-2: 1997

ANSI S3.39-1987 (Reaffirmed by ANSI 2012)

ANSI S3.6-2010

Amplivox

6 Oasis Park

Eynsham

Oxford OX29 4TP

Tel: +44 (0)1865 880846

Email: info@amplivox.ltd.uk

Website: www.amplivox.ltd.uk

amplivox

0. Сертификат калибровки



amplivox

Warranty

Amplivox warrants

Model : 302-H

Serial No. : 80155

Amplivox Limited
6 Oasis Park
Eynsham, Oxfordshire
OX29 4TP
UK

Tel: +44 (0)1865 880846
Fax: +44 (0)1865 880426
www.amplivox.ltd.uk

has been submitted to rigorous and comprehensive electrical and mechanical test and inspection. Furthermore the instrument settings were adjusted strictly within the tolerances set out in the relevant Medical Standards.

Amplivox therefore gives the purchaser the following Warranty;

If within twenty-four months from the date of dispatch, any defect in respect of material or workmanship within our control is discovered, we will make good the defect without charge, subject to the following conditions;

1. Notice of the fault is given to Amplivox within the Warranty period.
2. The instrument is forwarded, carriage paid, to Amplivox Limited at the above address or as otherwise directed.
3. The responsibility of Amplivox under this Warranty is strictly limited to making good the defect in the instrument itself.
4. No attempt has been made to effect a repair or adjust the calibration or alter the instrument from the original build standard.
5. Defects caused by abnormal conditions of use, accident or neglect are expressly excluded.

Notes;

The calibration of Amplivox Instruments requires detailed knowledge and the use of specialist measuring equipment.


The life of cables is dependent upon the conditions of use.

Earphones and other transducers may become out of calibration due to rough handling.


All instruments in transit to and from Amplivox Limited are at the owner's risk and cost. Insurance against loss or damage must be effected by the owner.

This warranty does not affect the purchaser's statutory rights.


12. USB-кабель

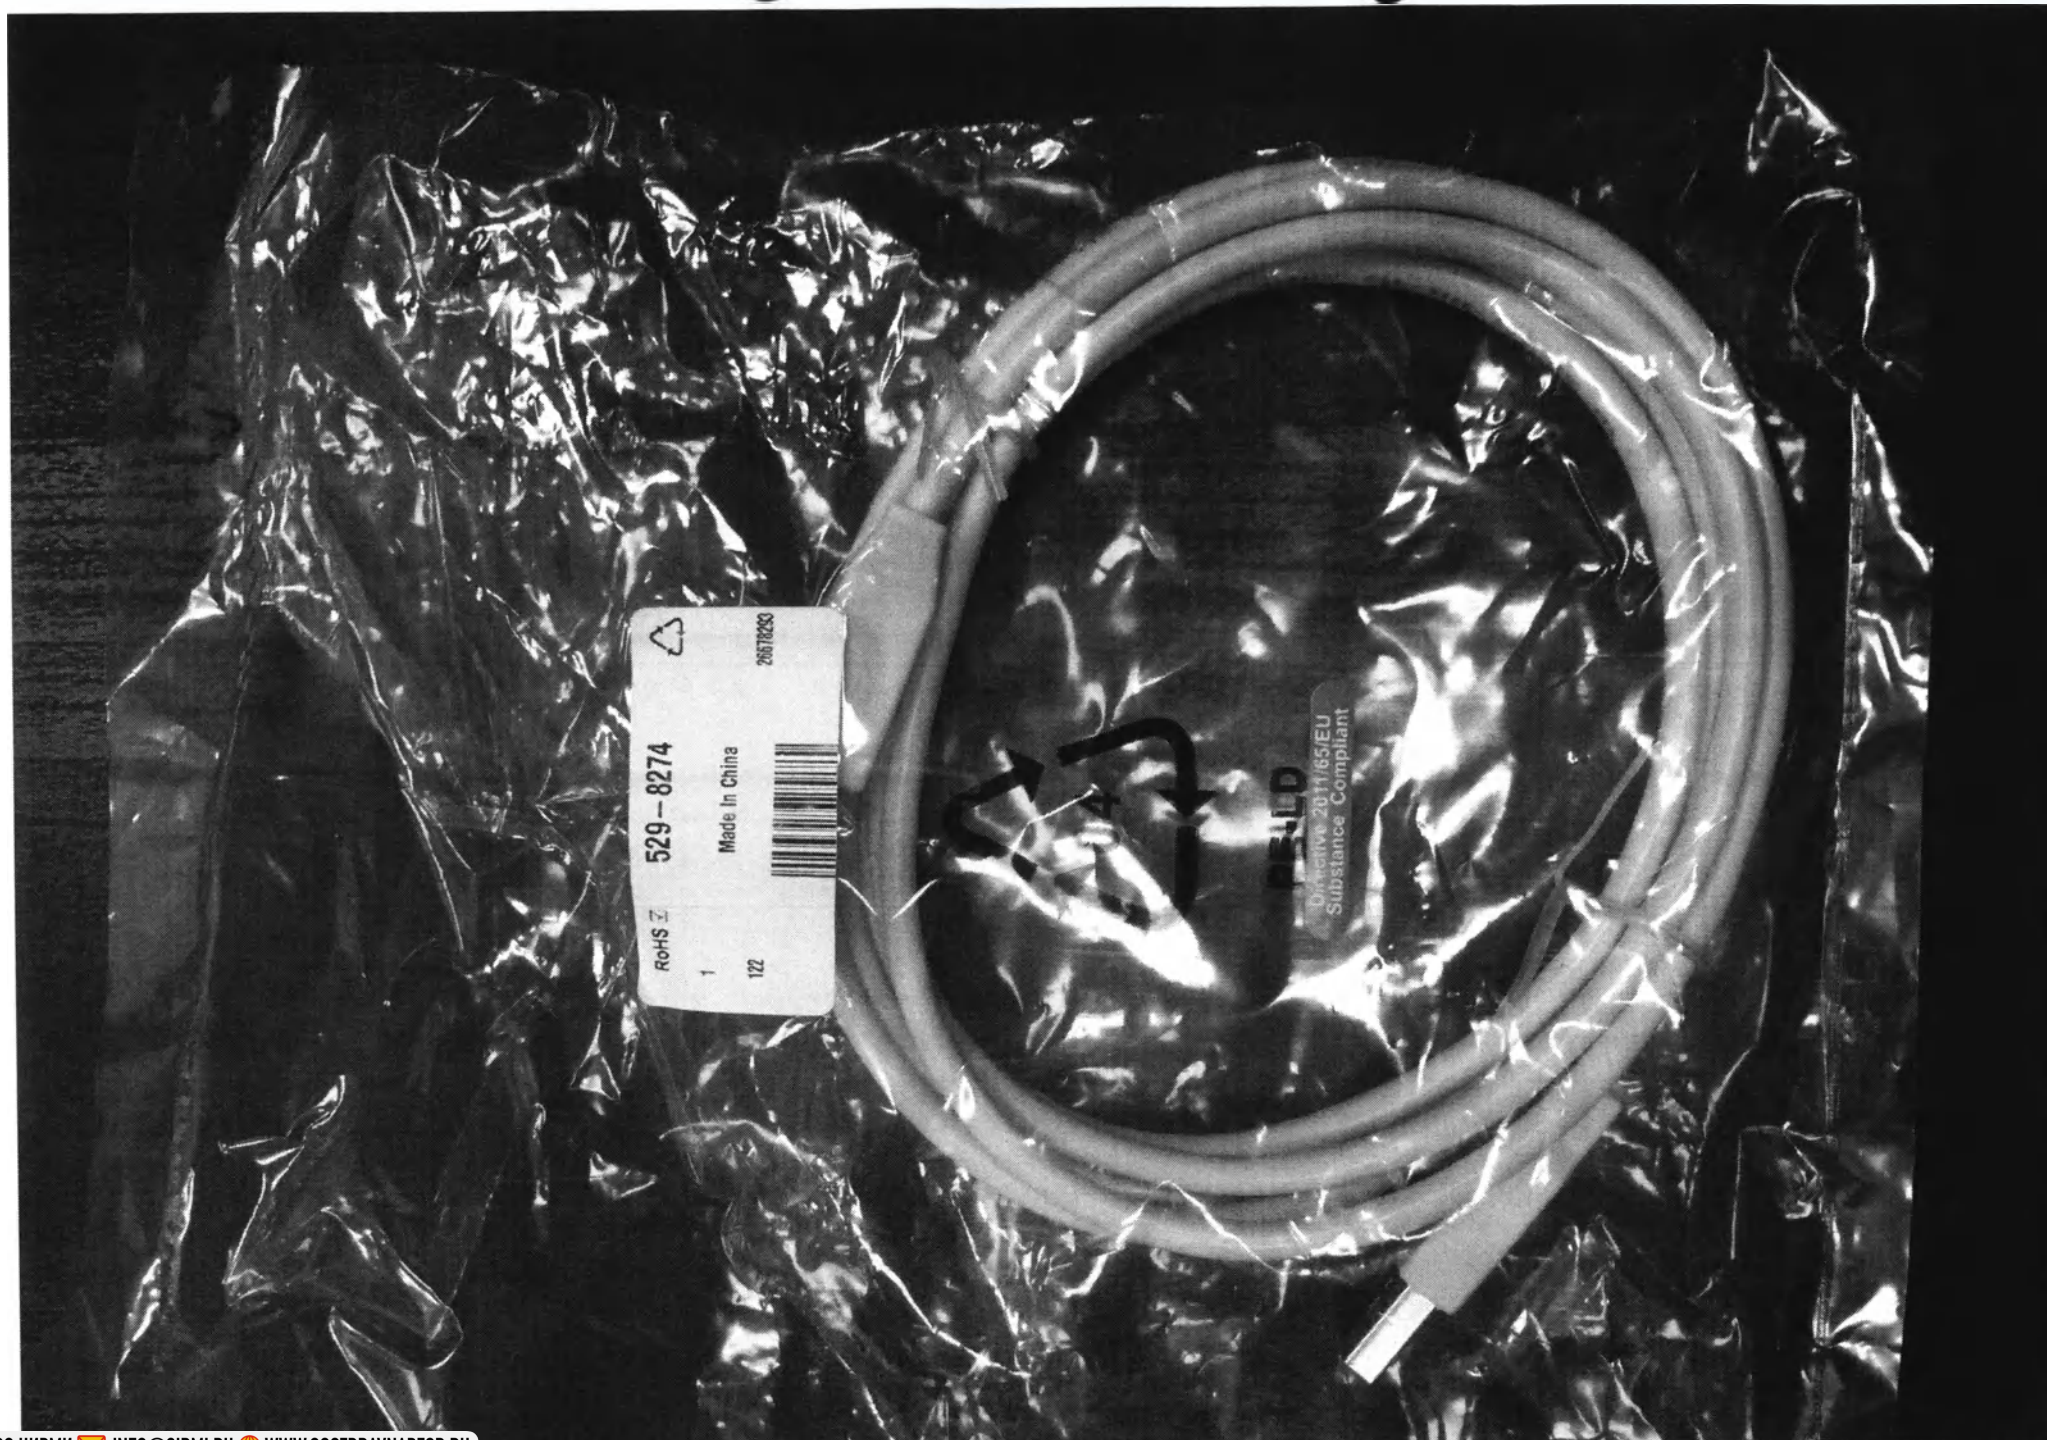

13. Amplivox NOAH модуль импедансный на компакт-диске

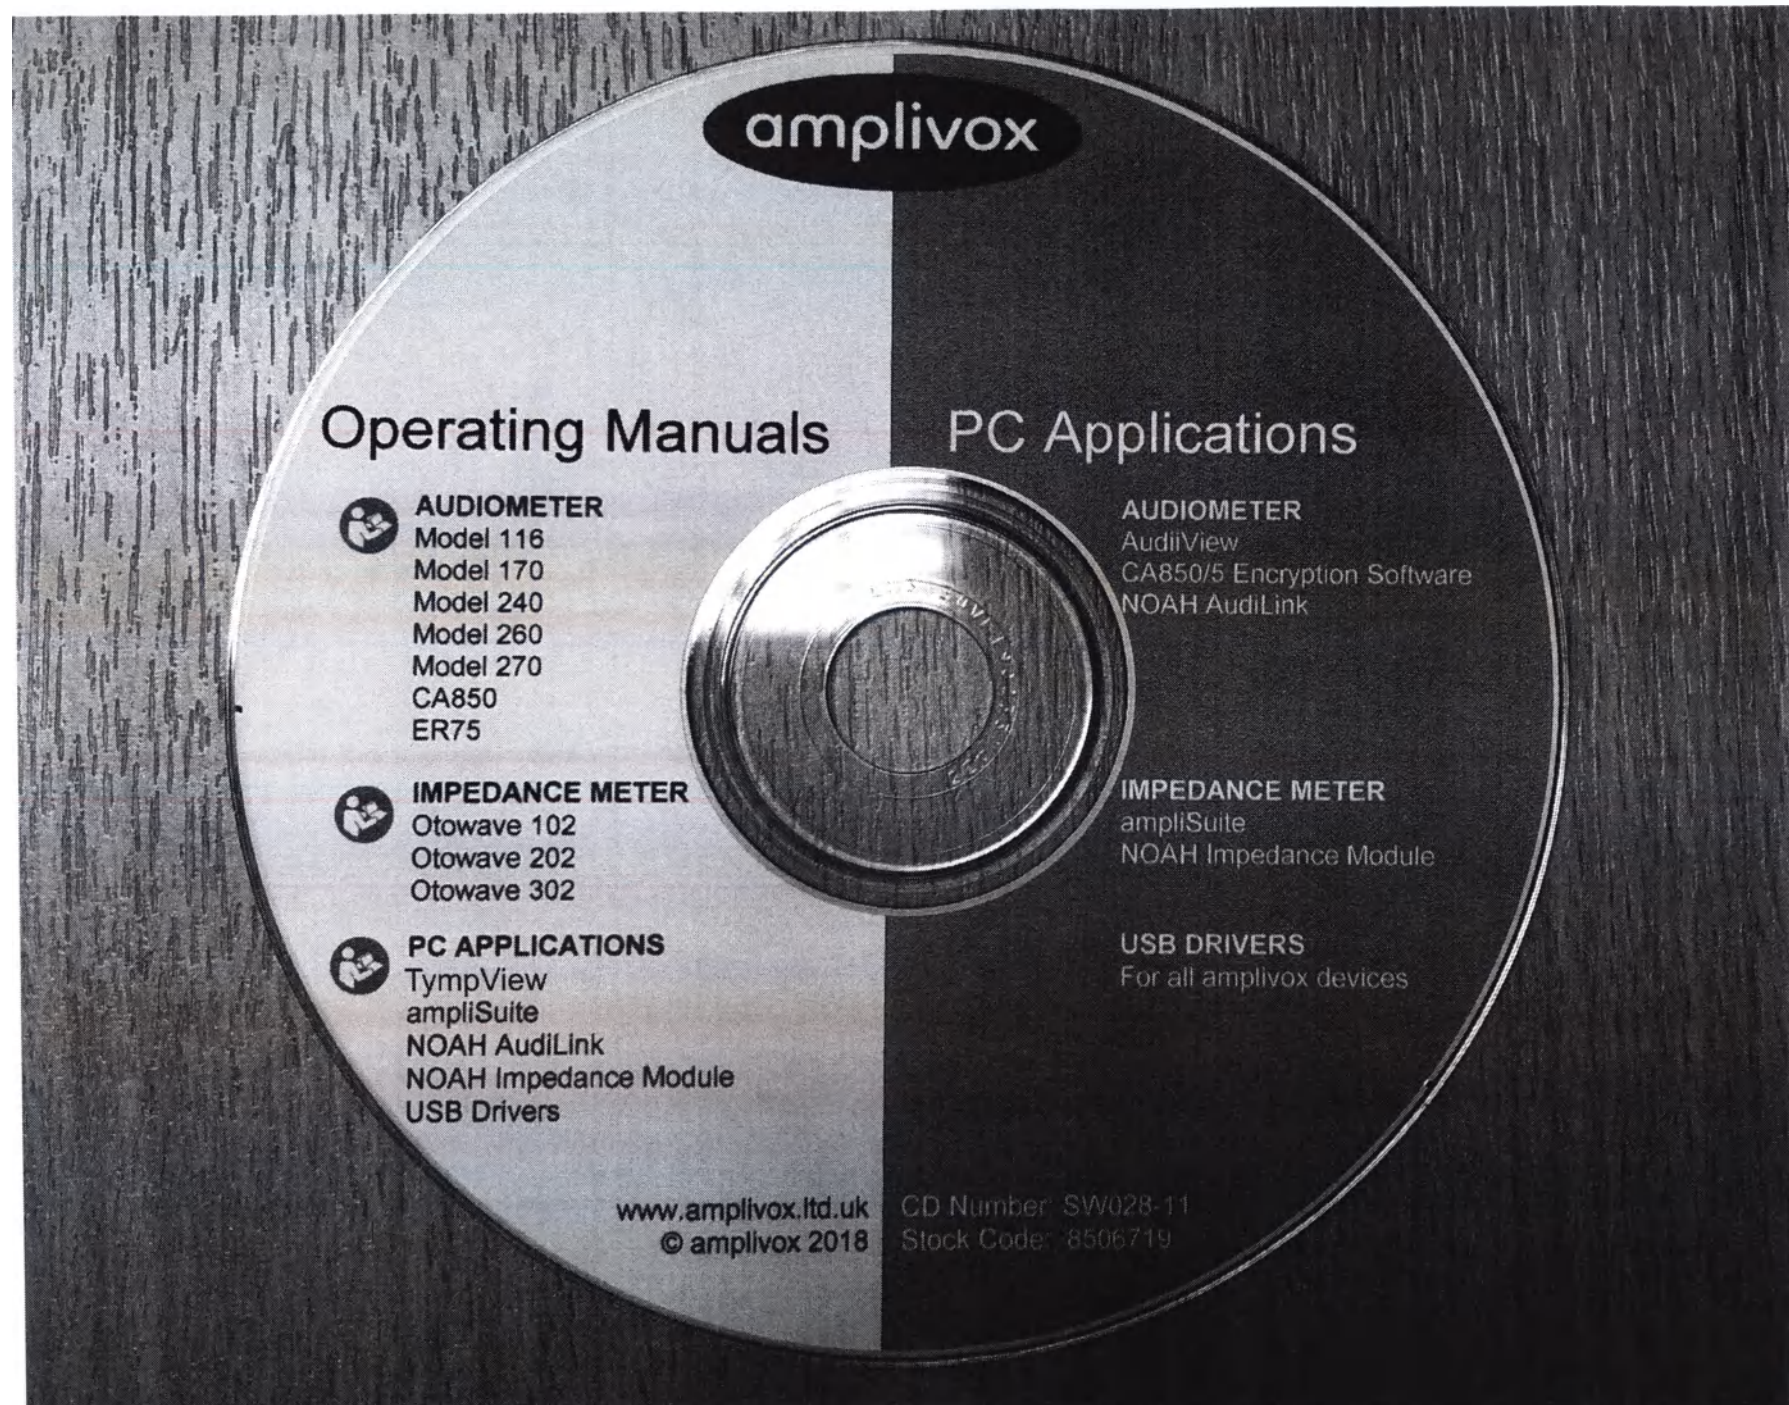

14. Программное обеспечение ampliSuite на компакт-диске

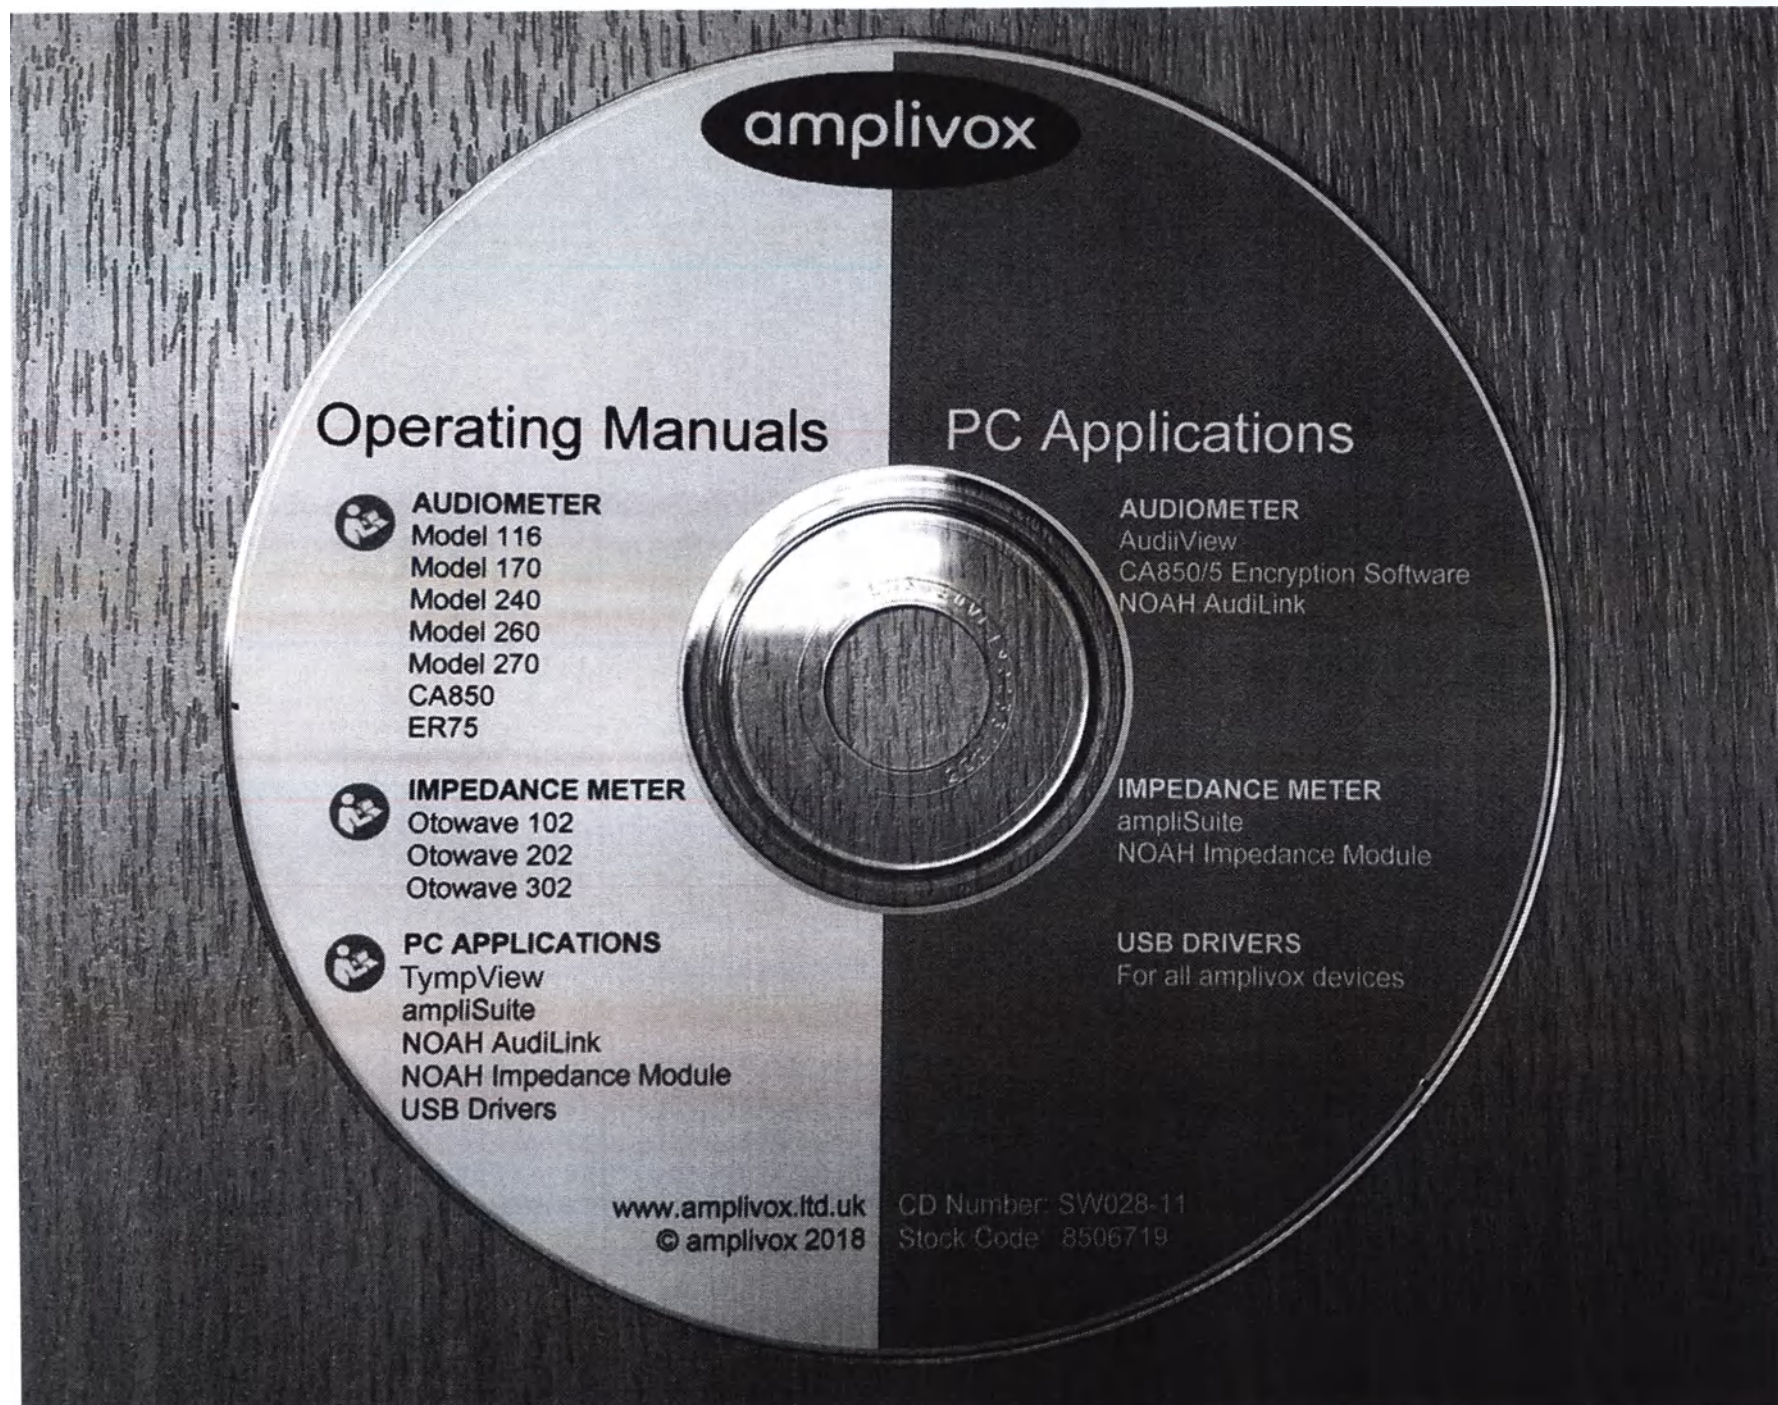


15. Портативный термостатический принтер Able AP1300, зарядное устройство и бумага



16. Портативный термометр Sanibel MPT-II, зарядное устройство




17. T205 ушной вкладыш

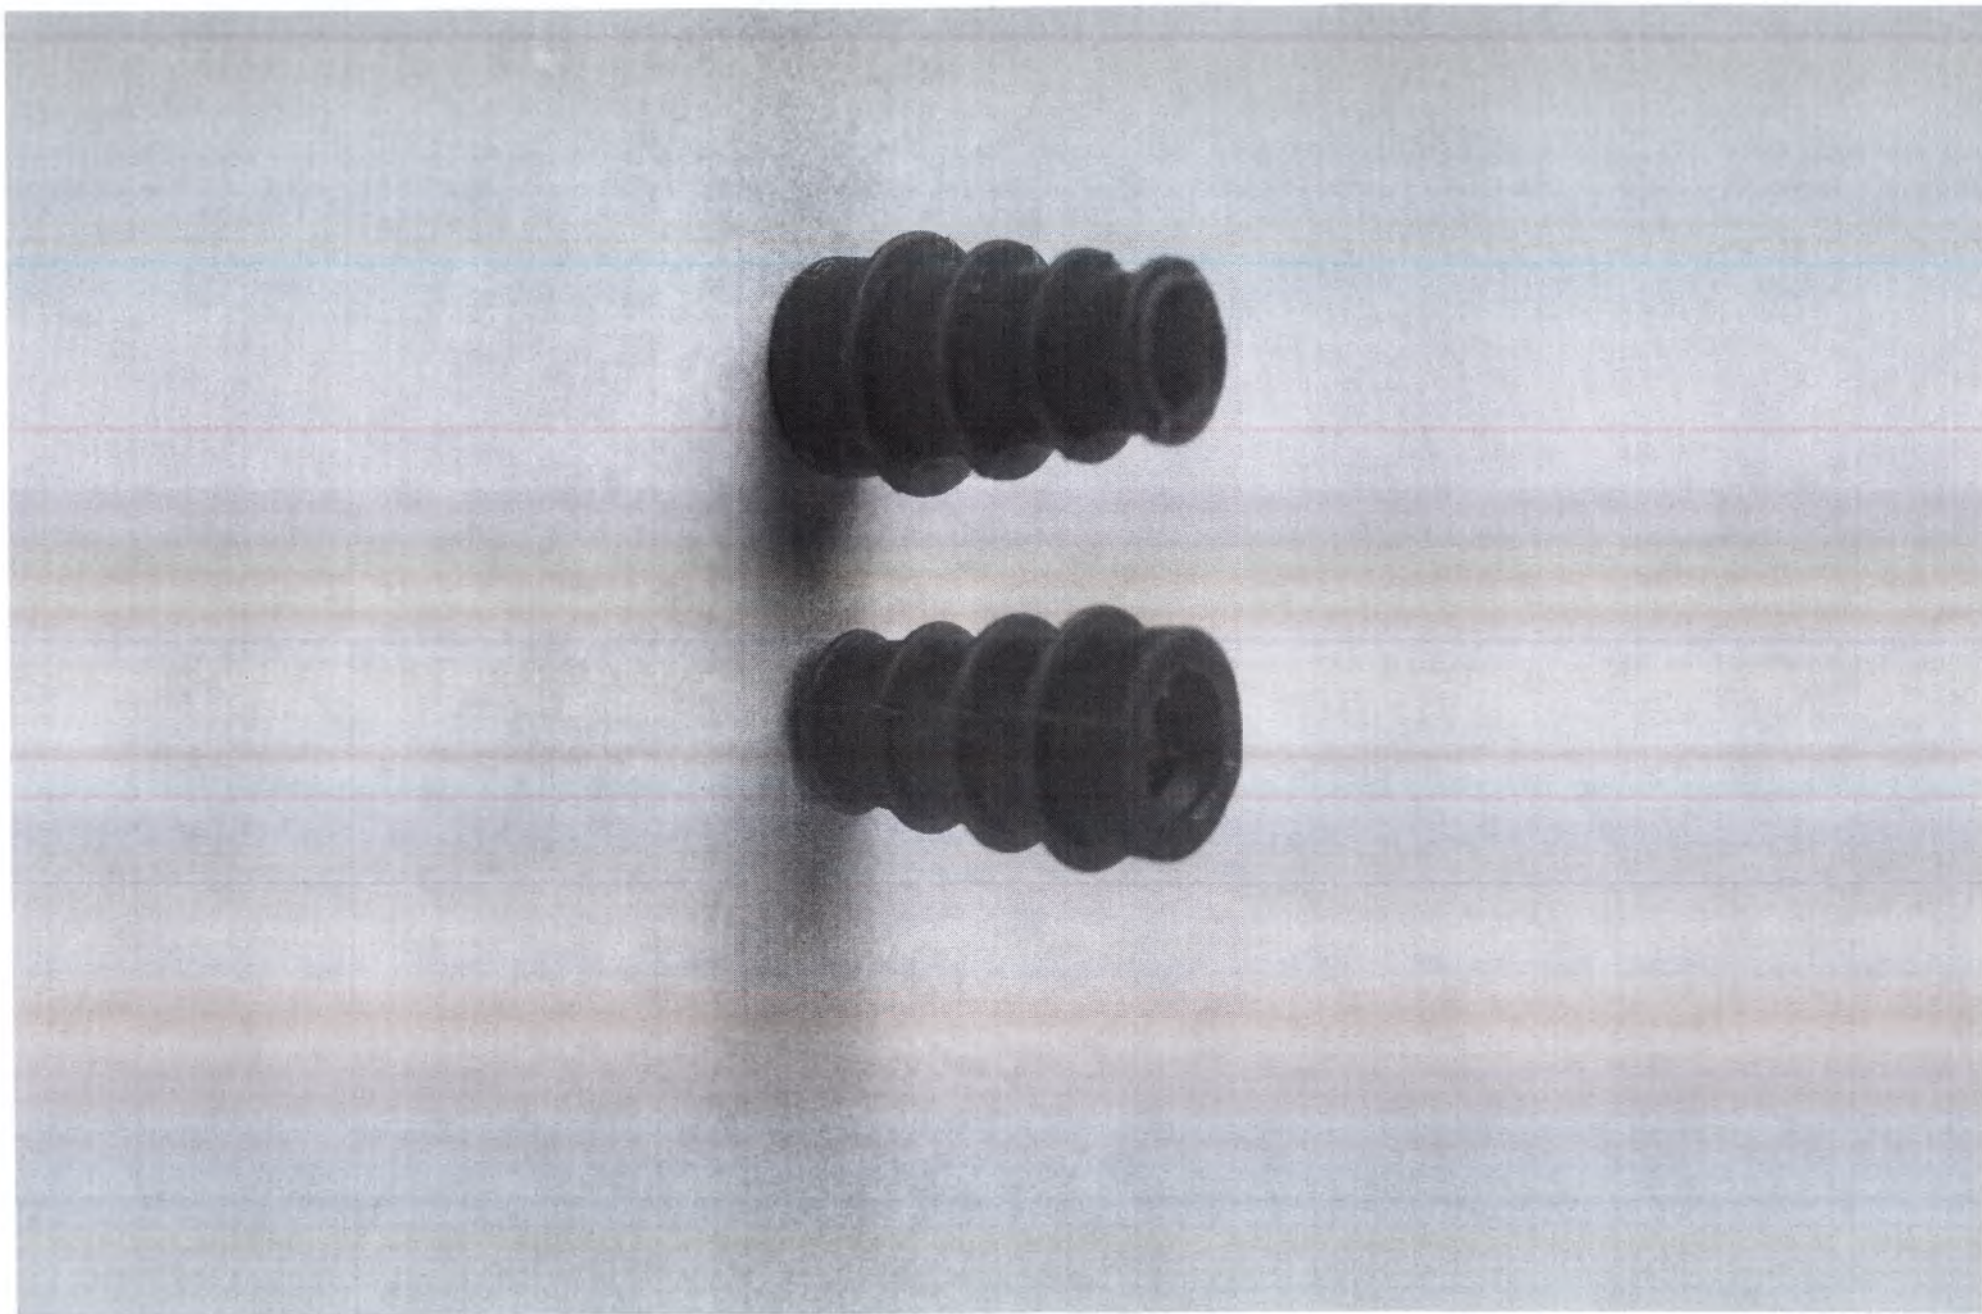


18. T206 ушной вкладыш




19. T207 ушной вкладыш

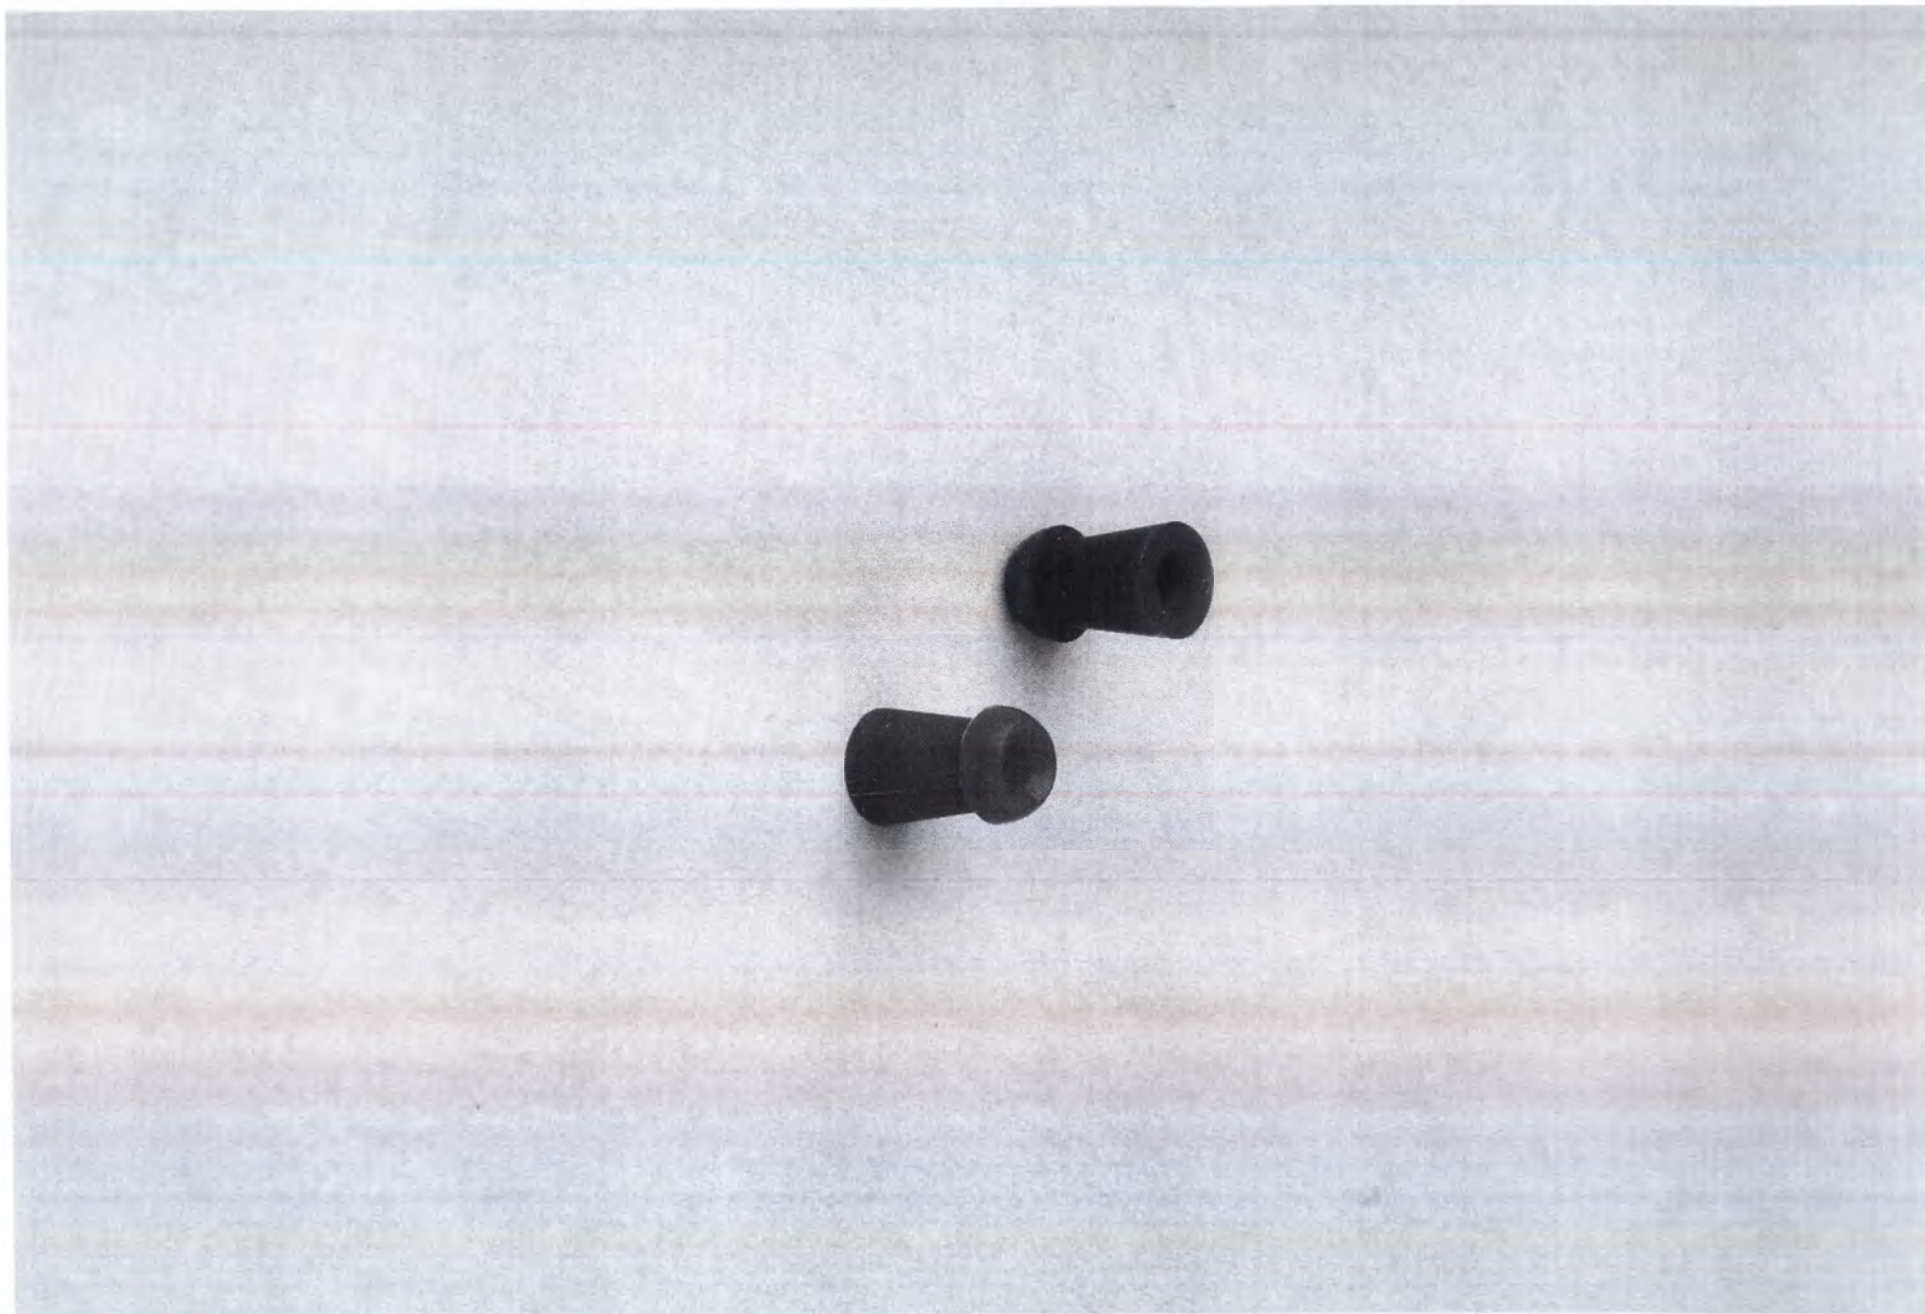


20. T208 ушной вкладыш

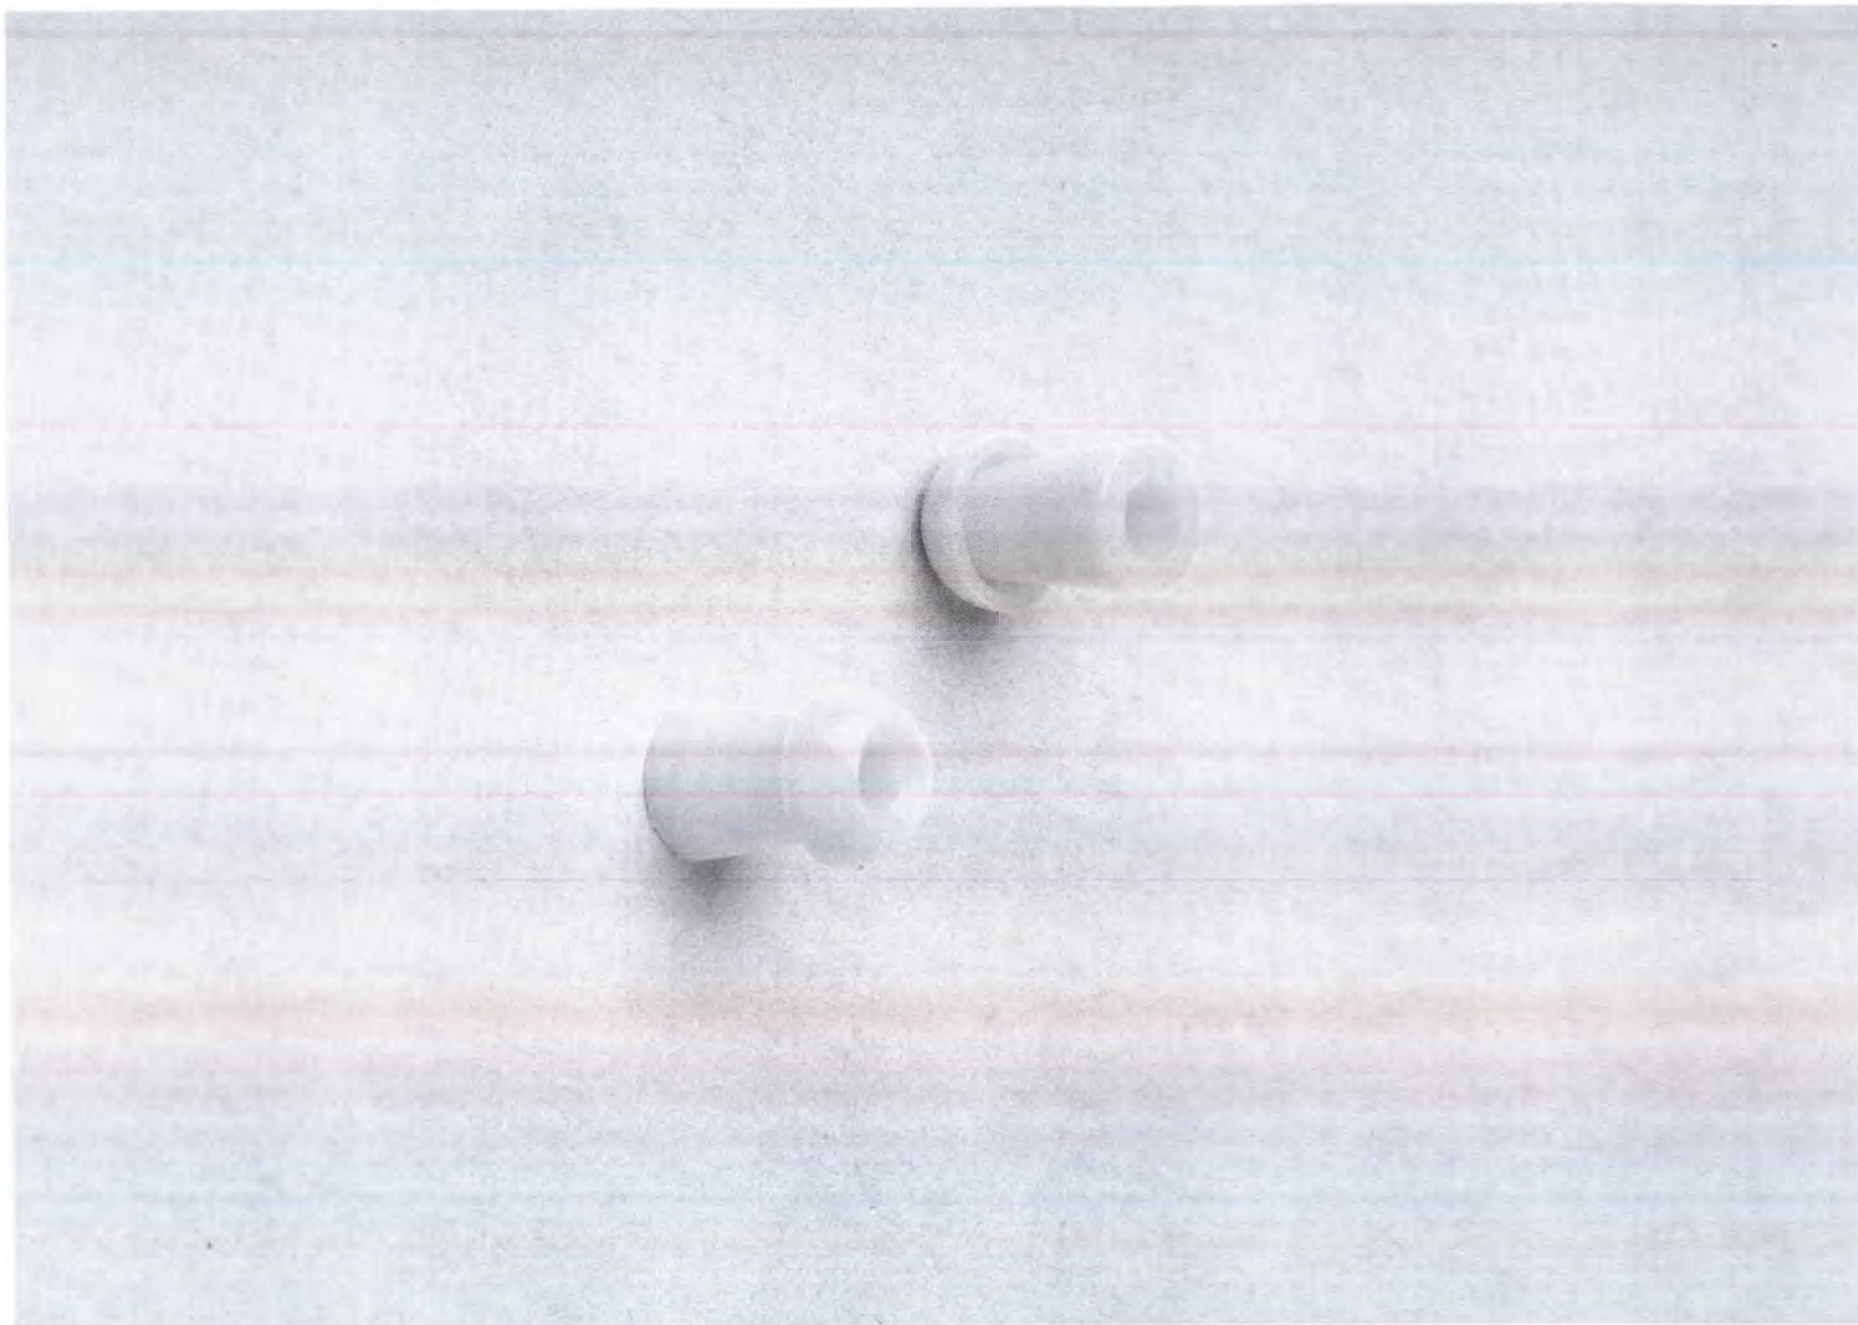


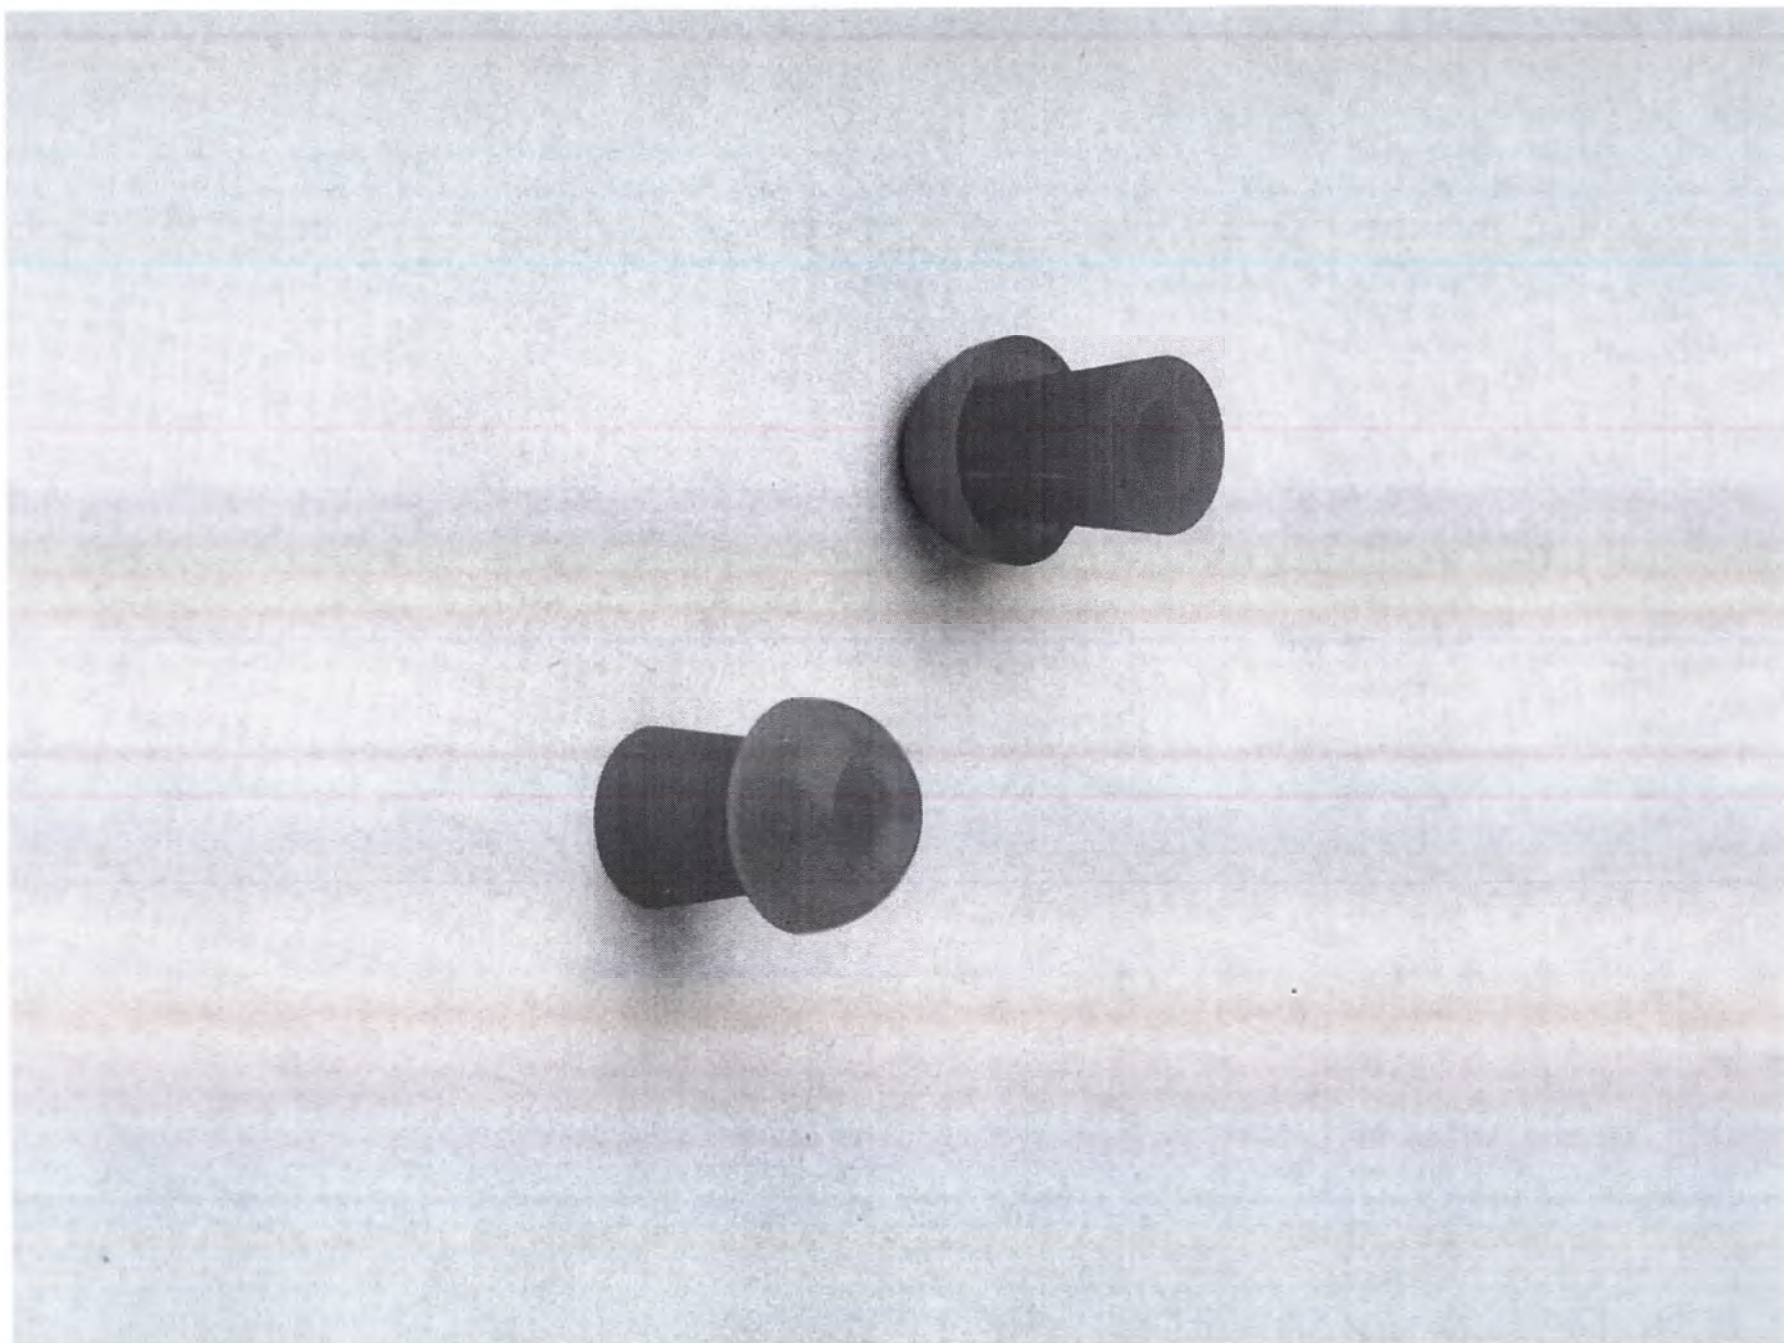


22. T210 ушной вкладыш

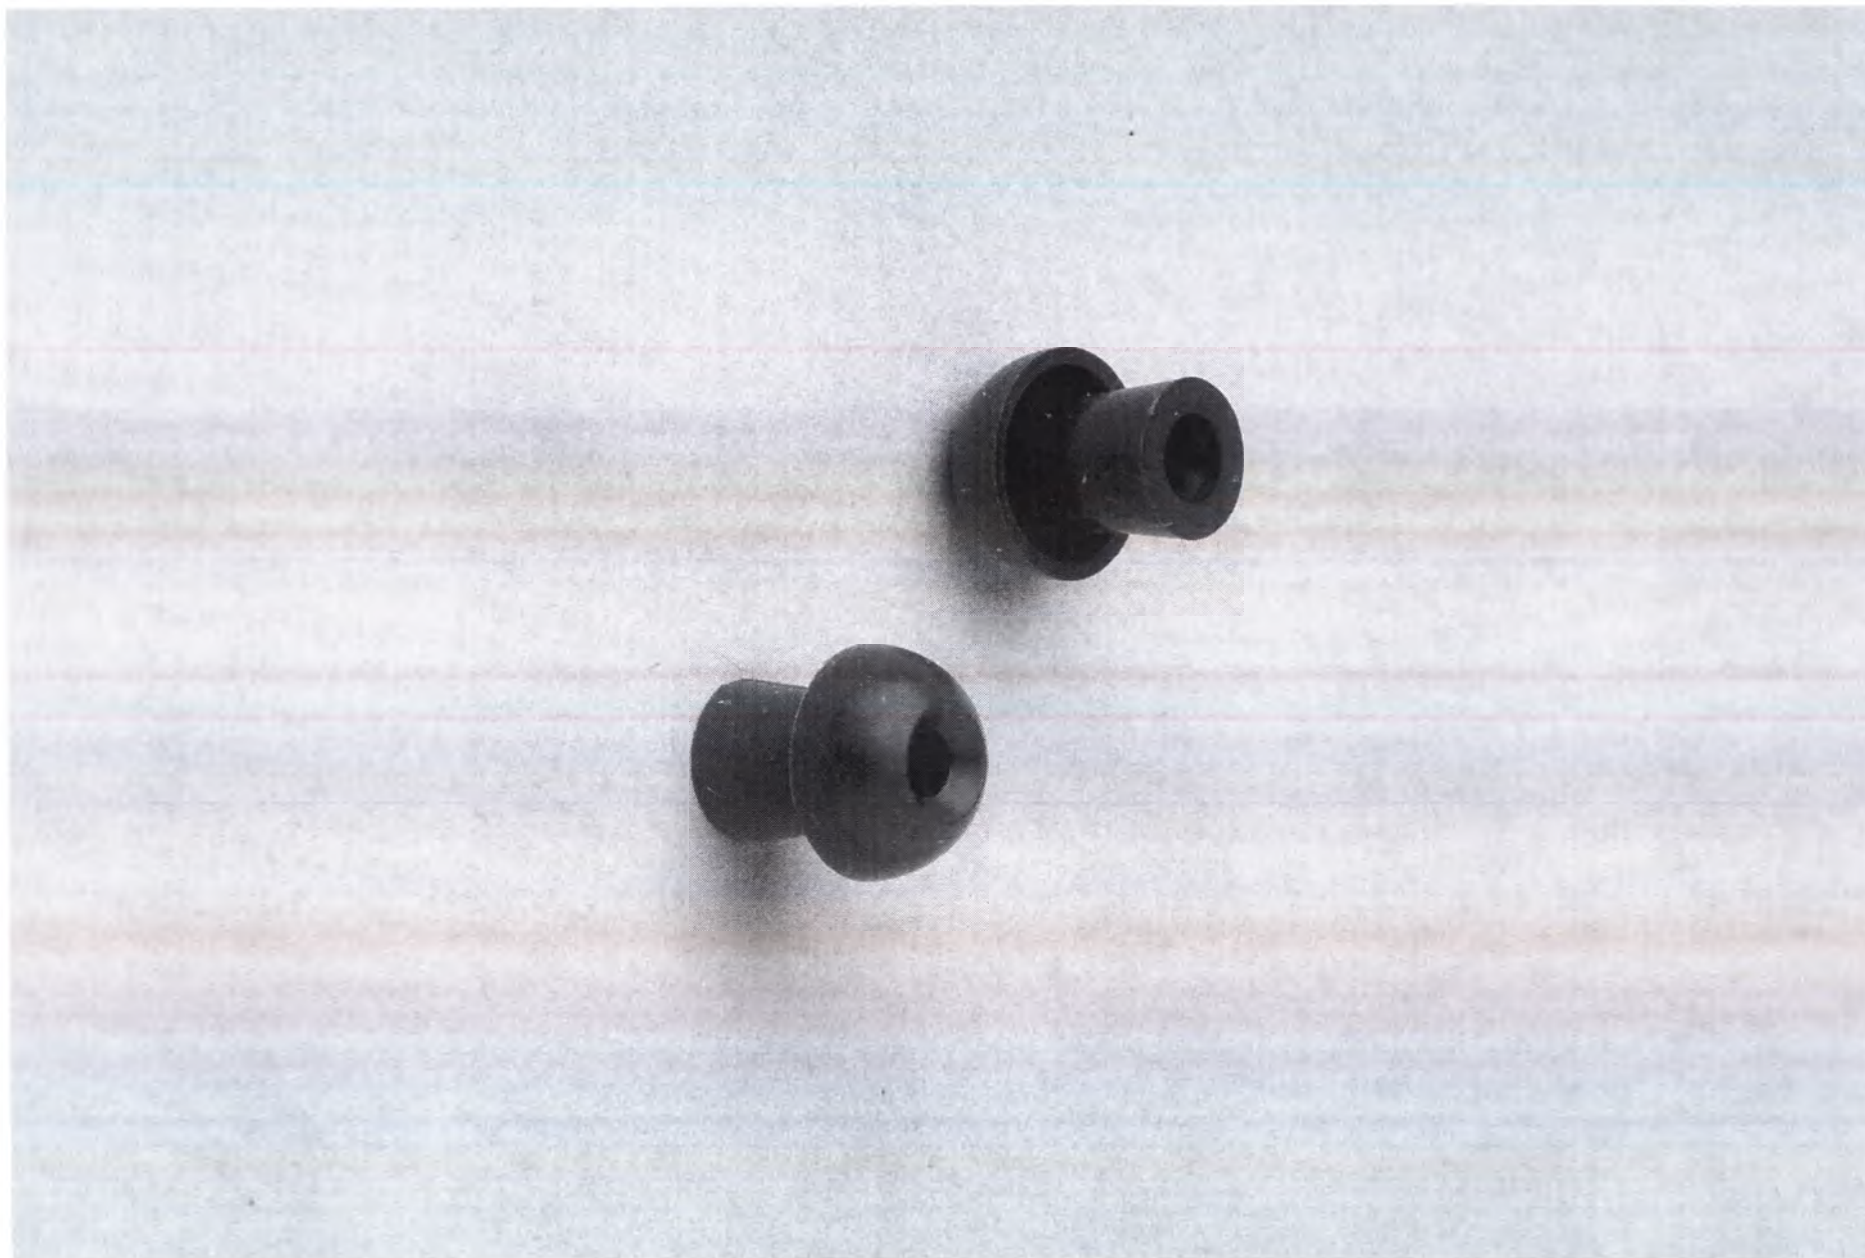


23. T211 ушной вкладыш

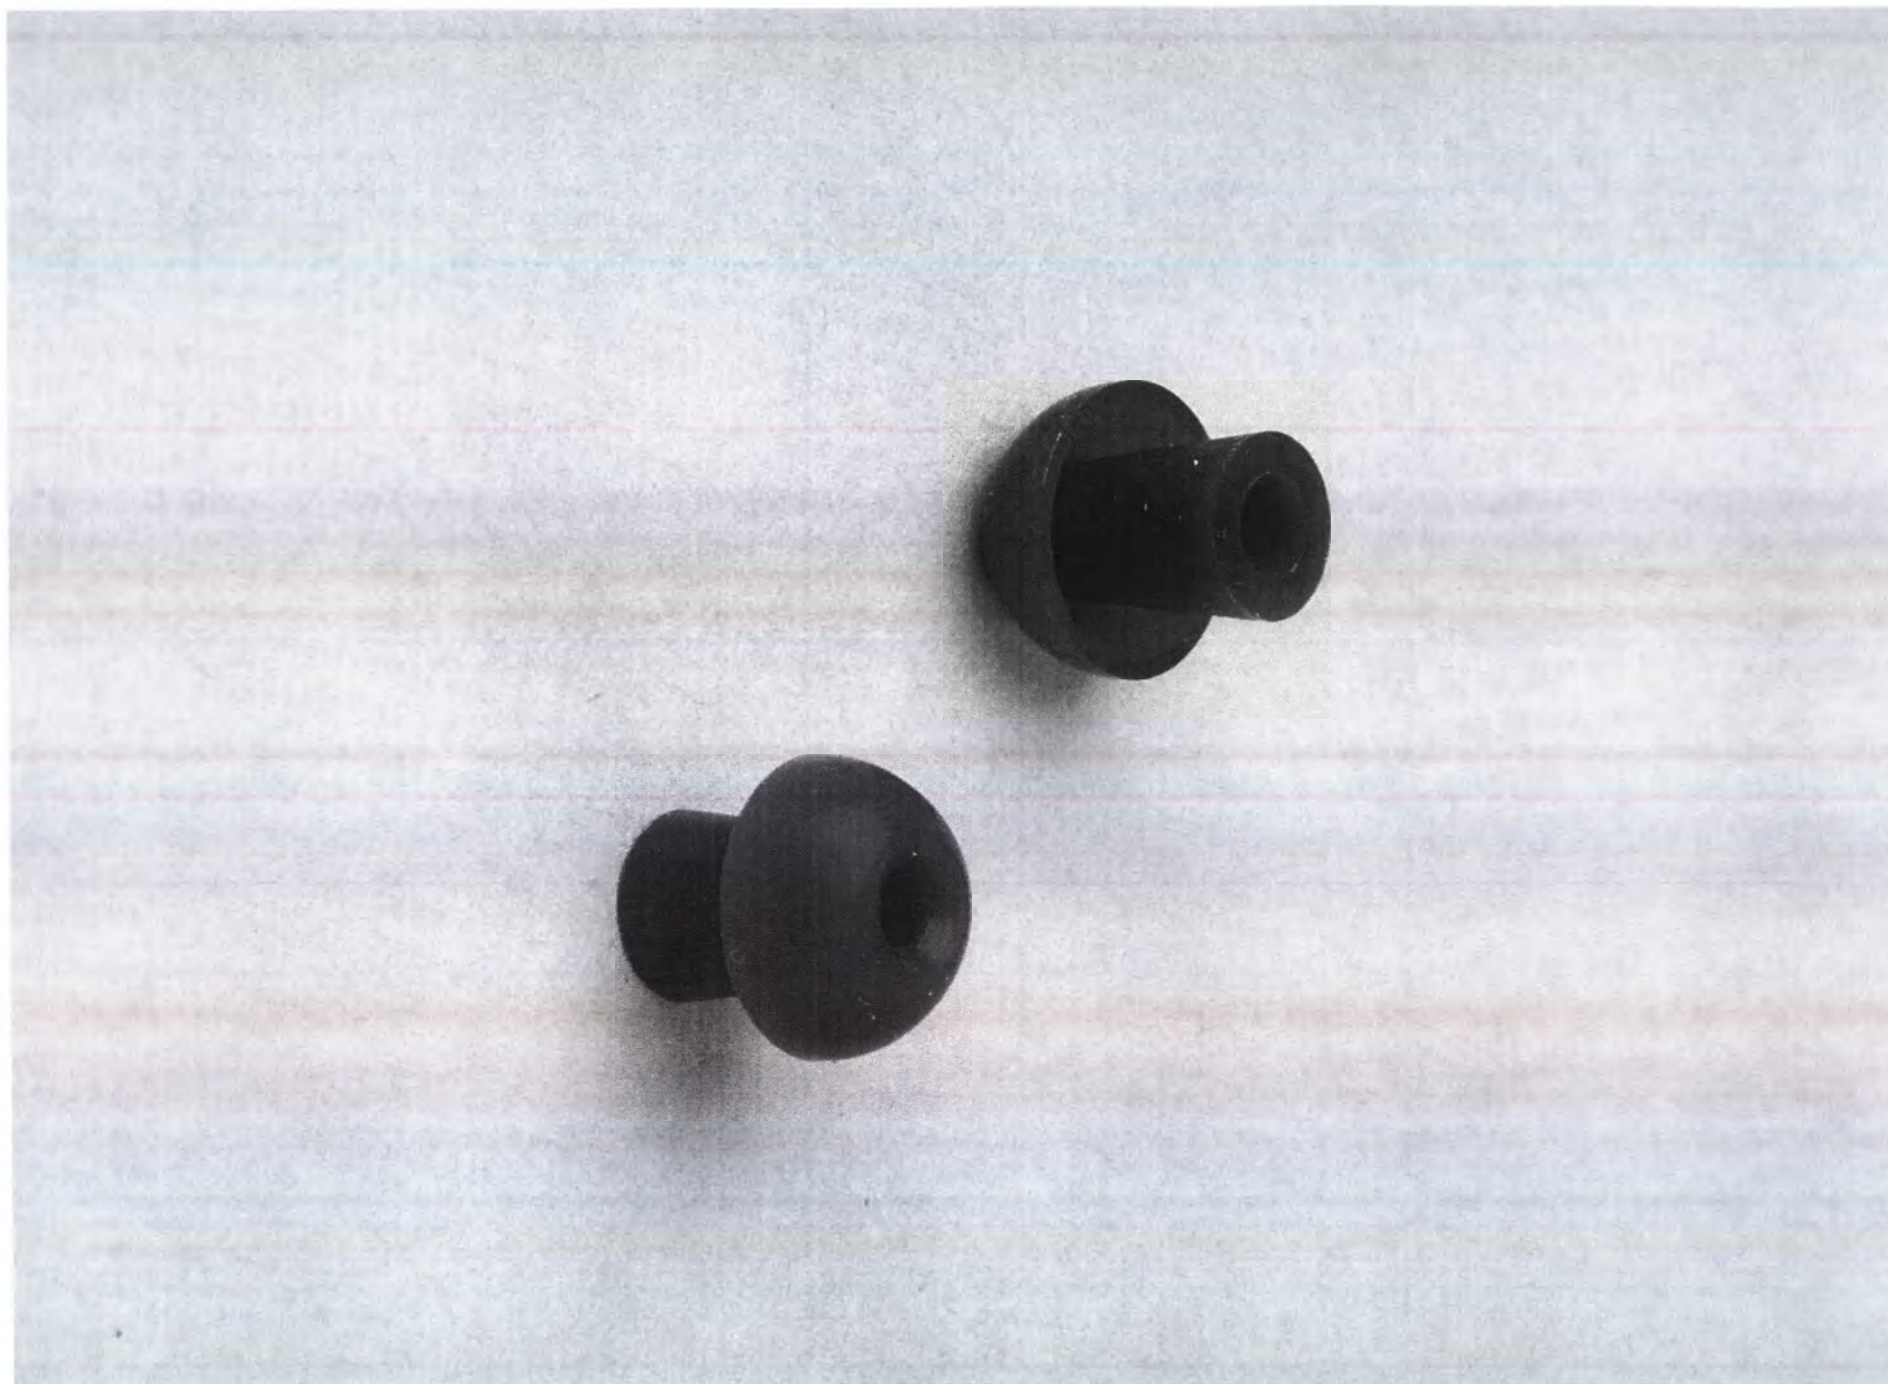


24. T212 ушной вкладыш

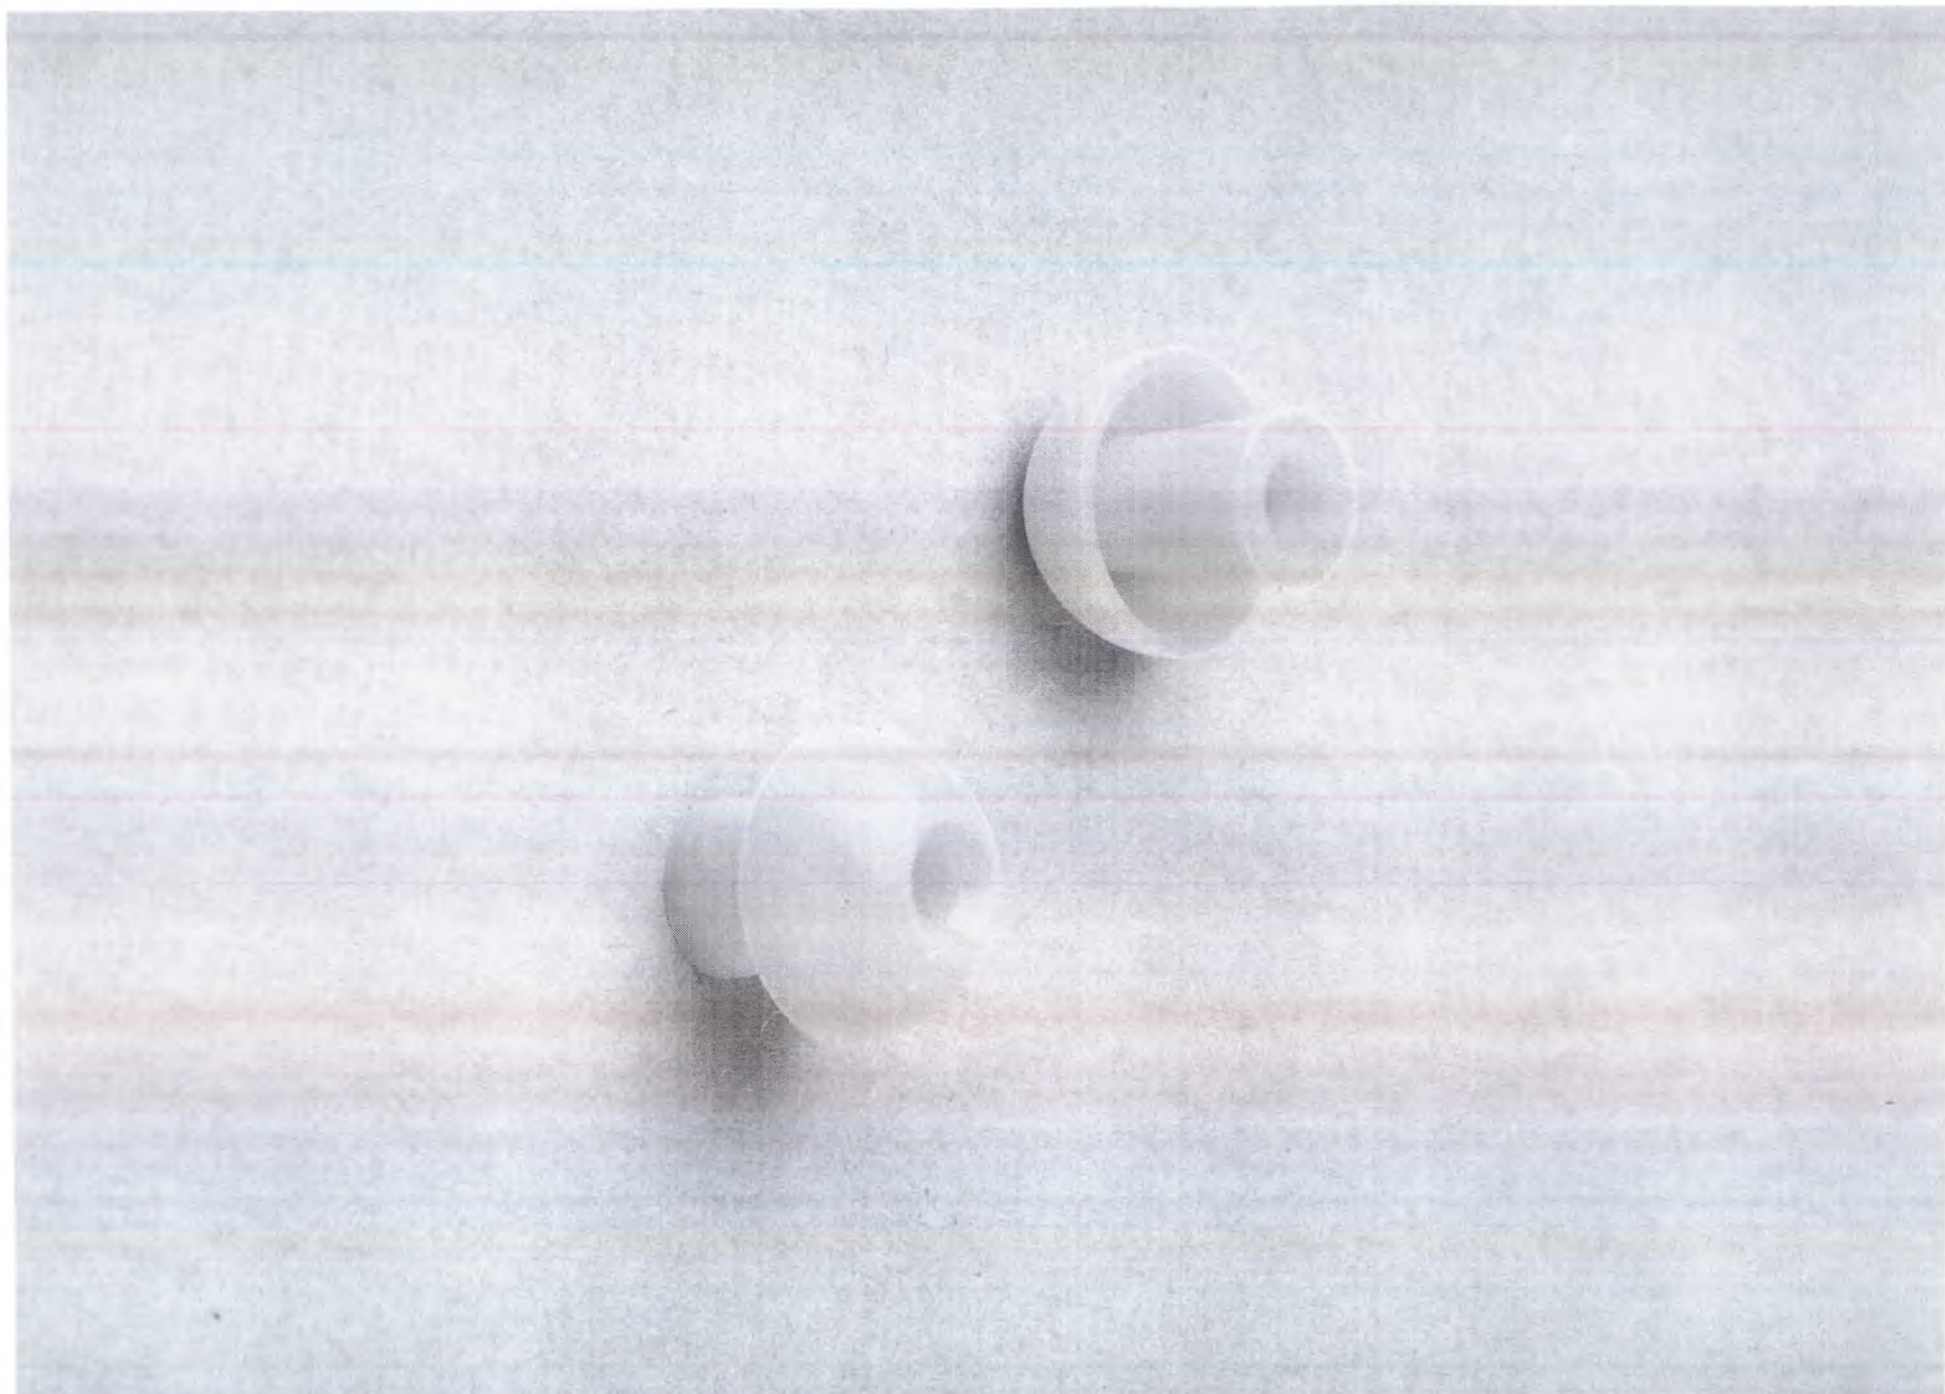


25. T213 ушной вкладыш

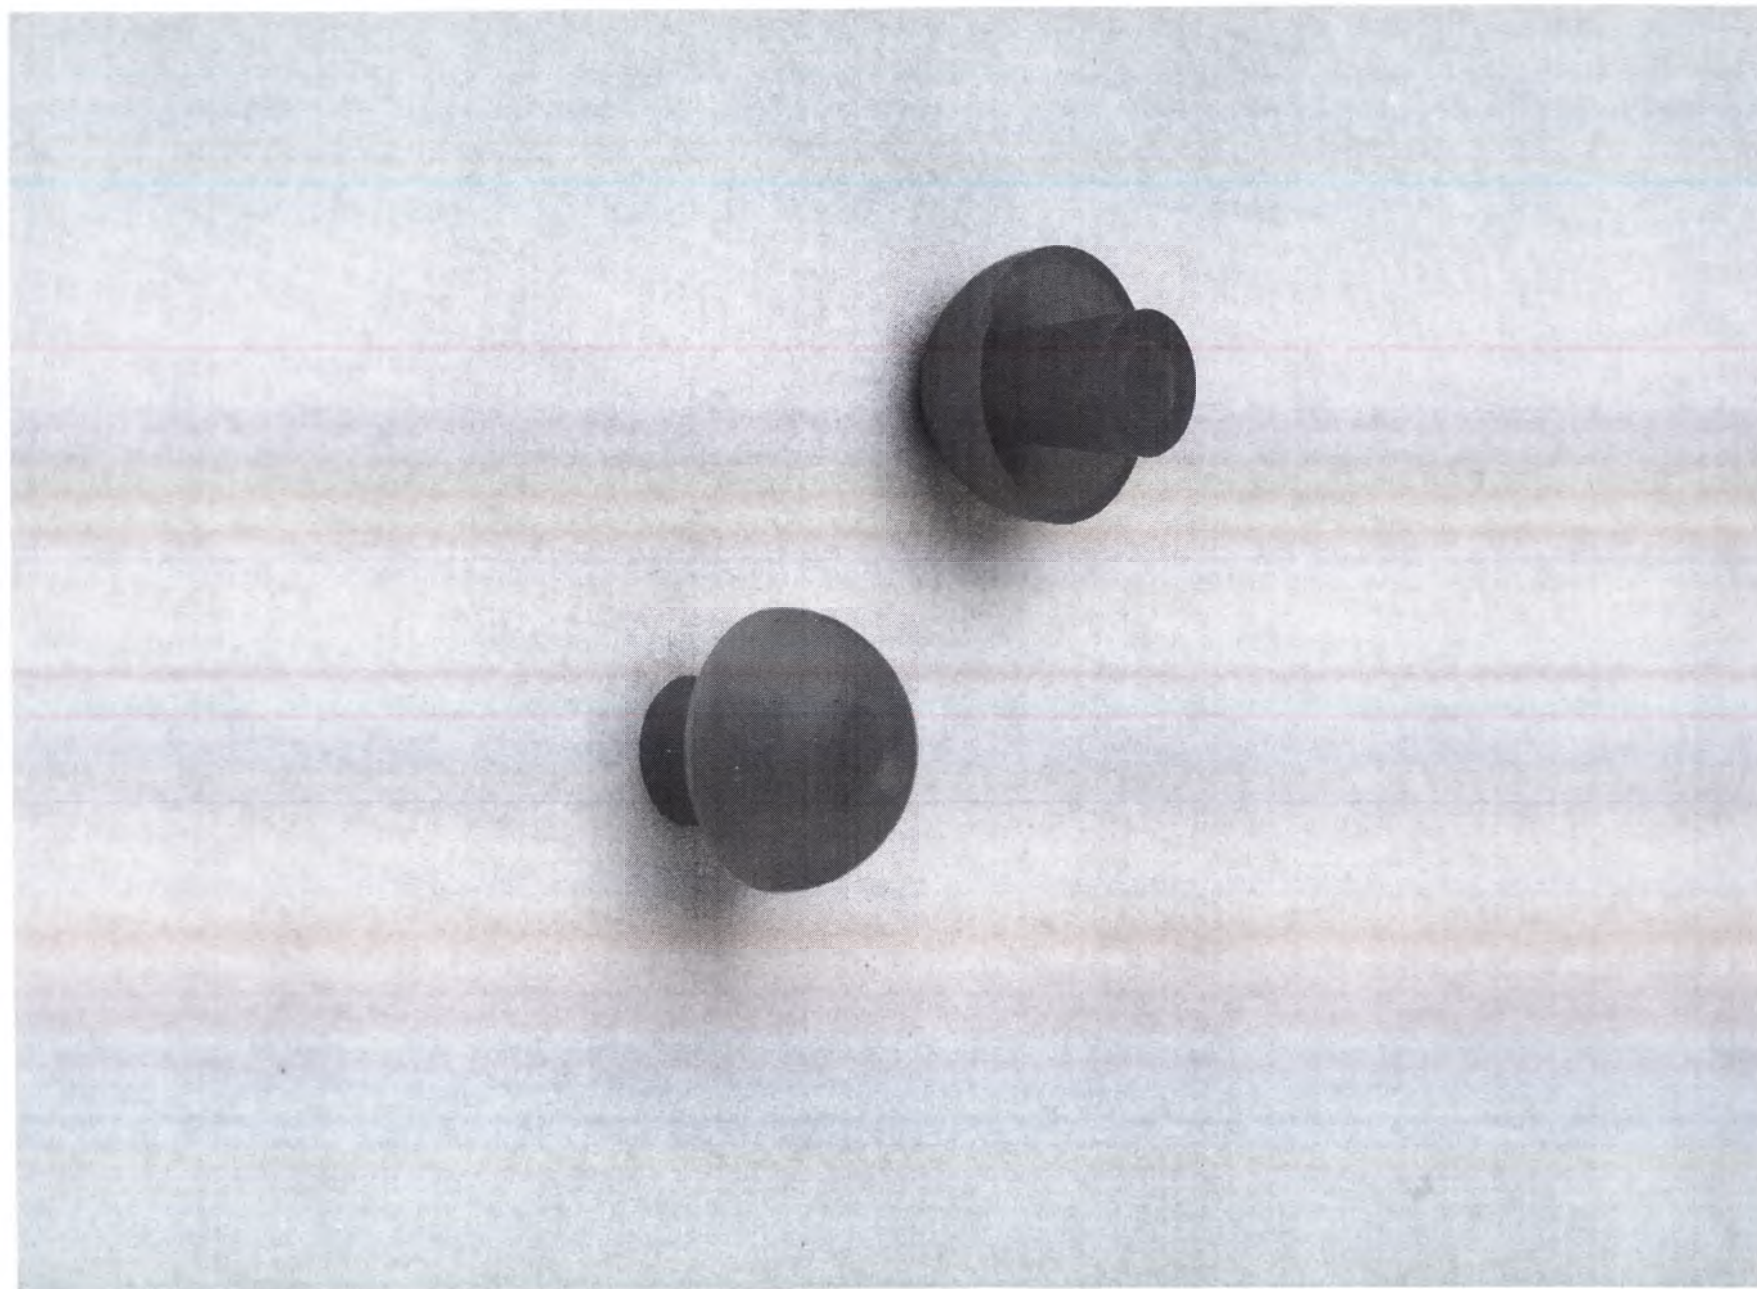


26. T214 ушной вкладыш

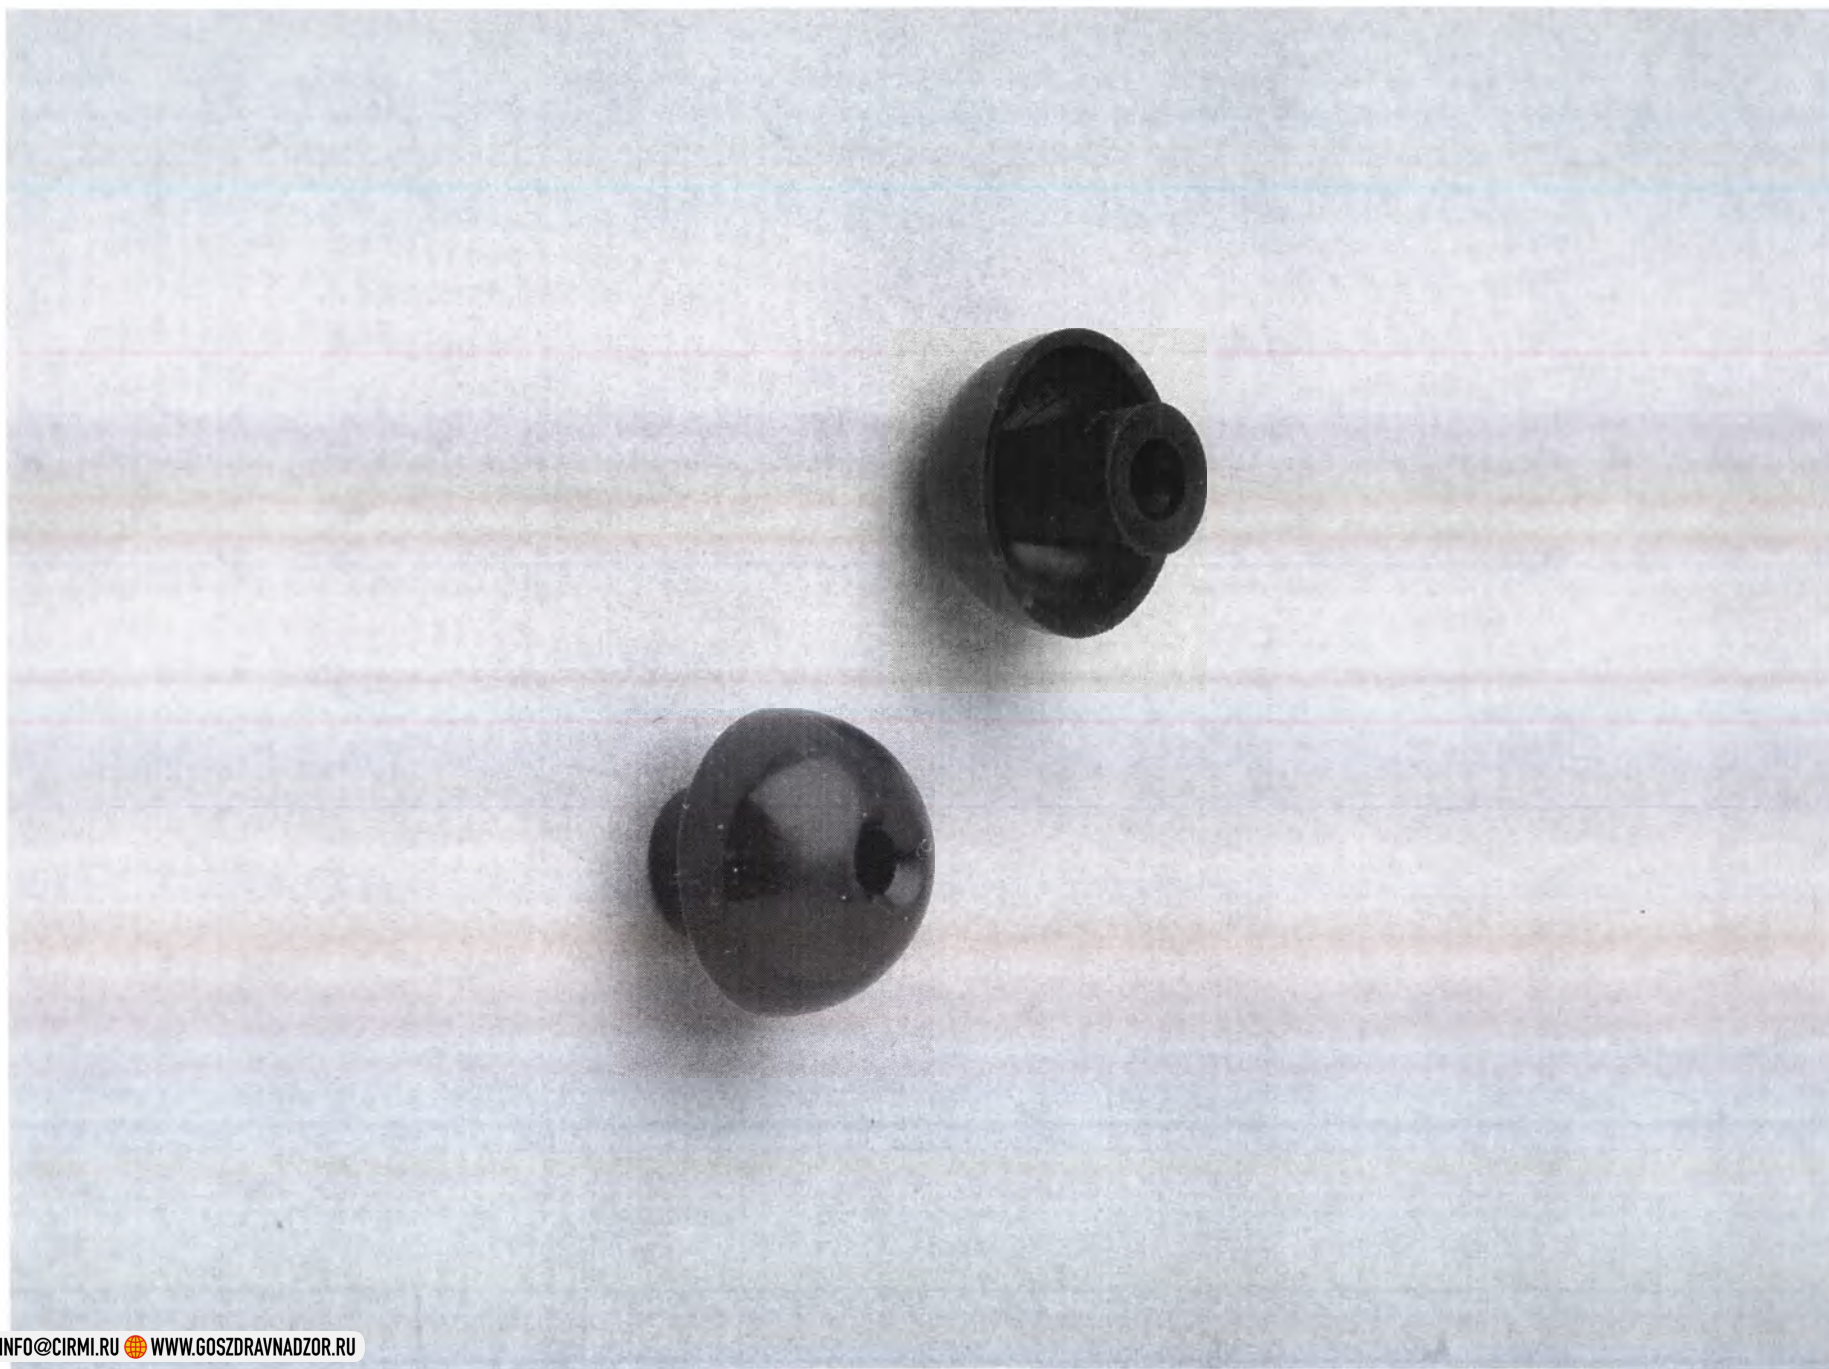


27. T215 ушной вкладыш

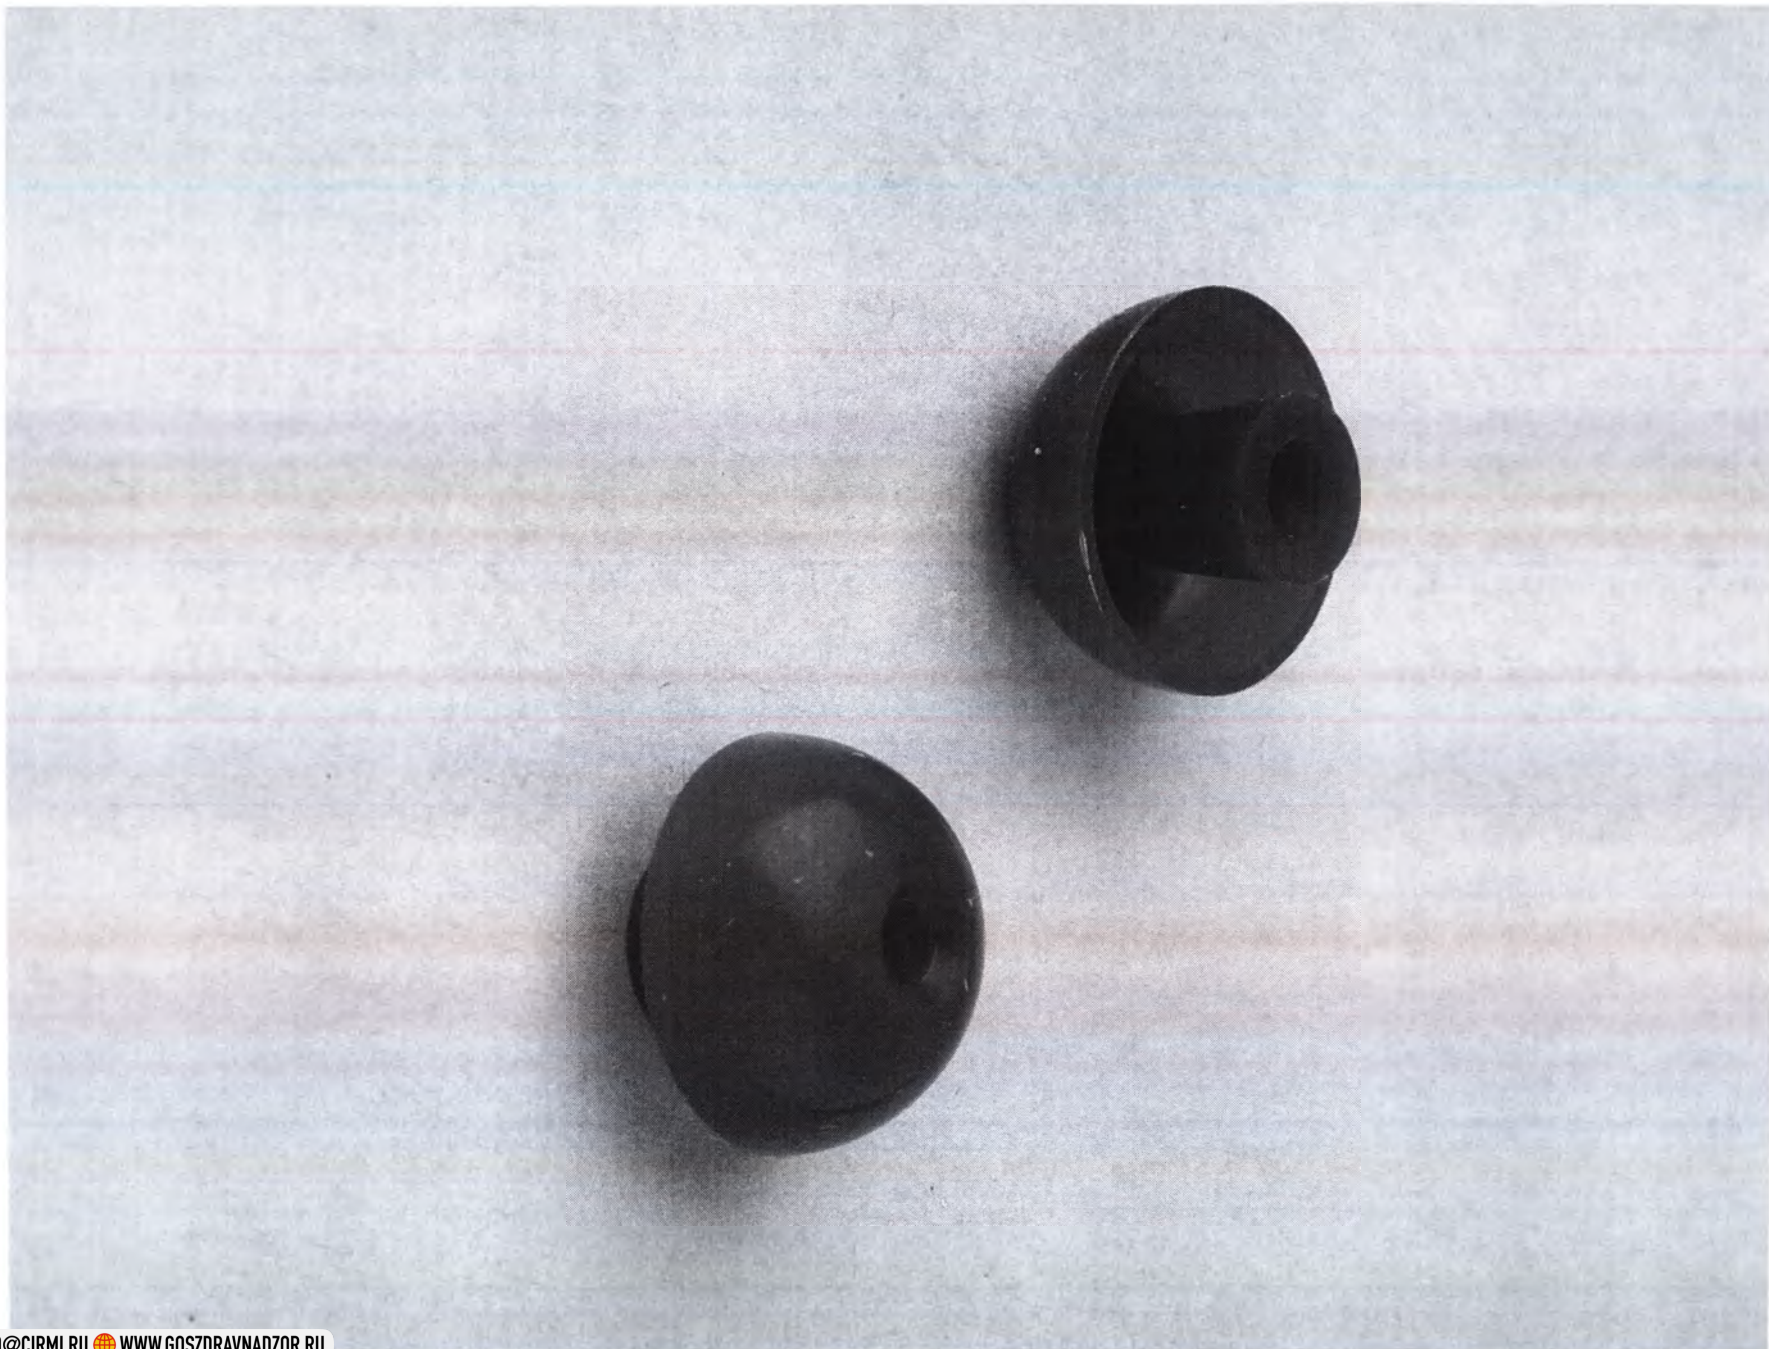

28. T219 ушной вкладыш

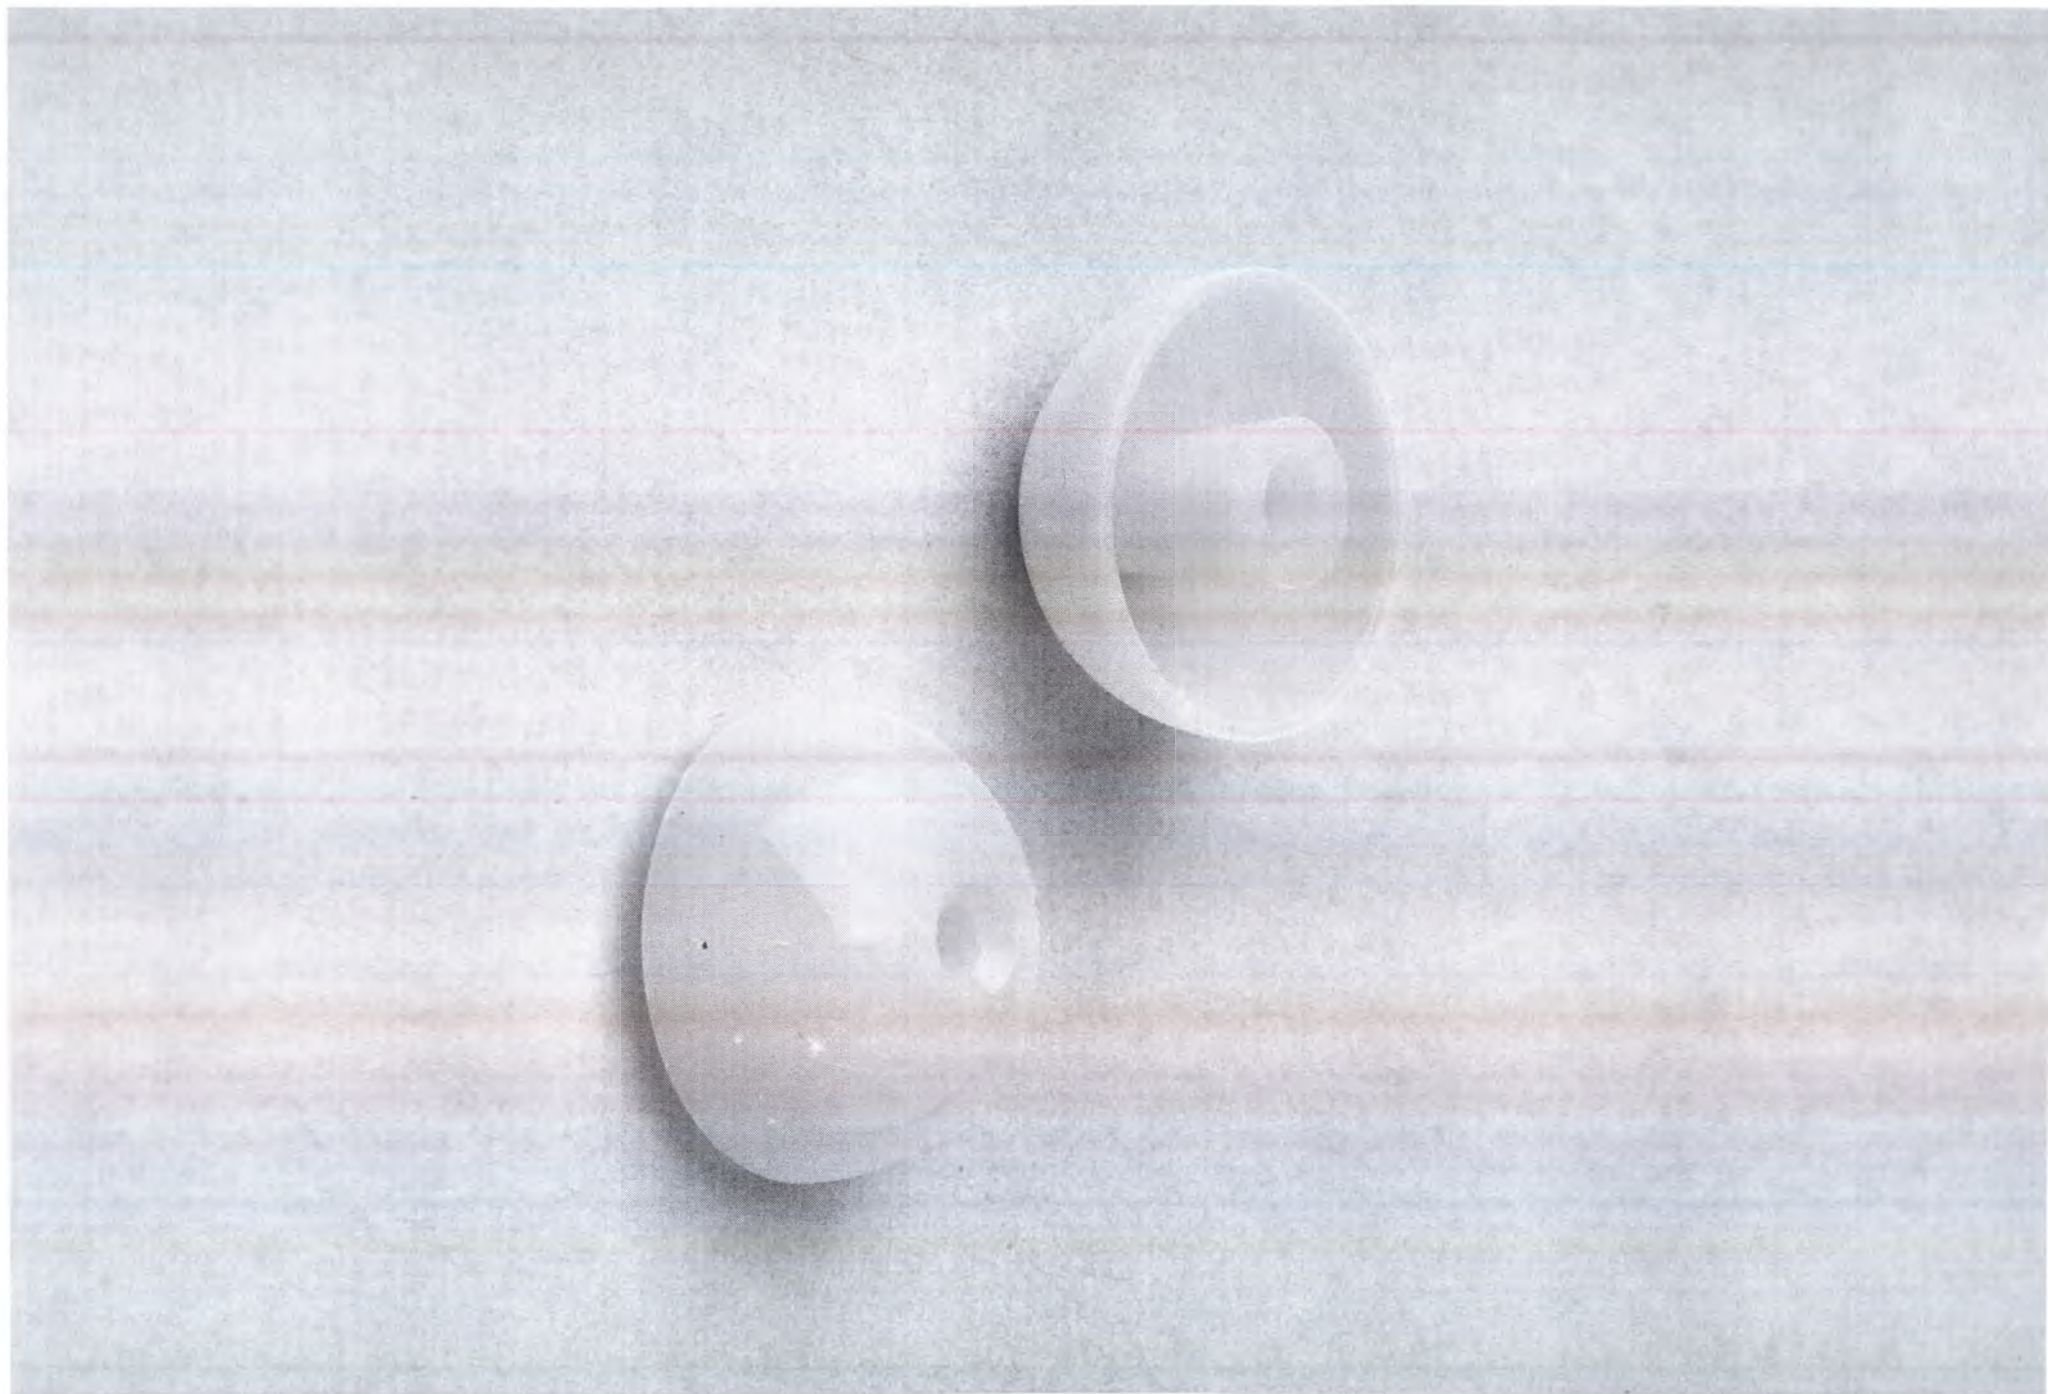

29. Т527 дополнительные наконечники для зонда

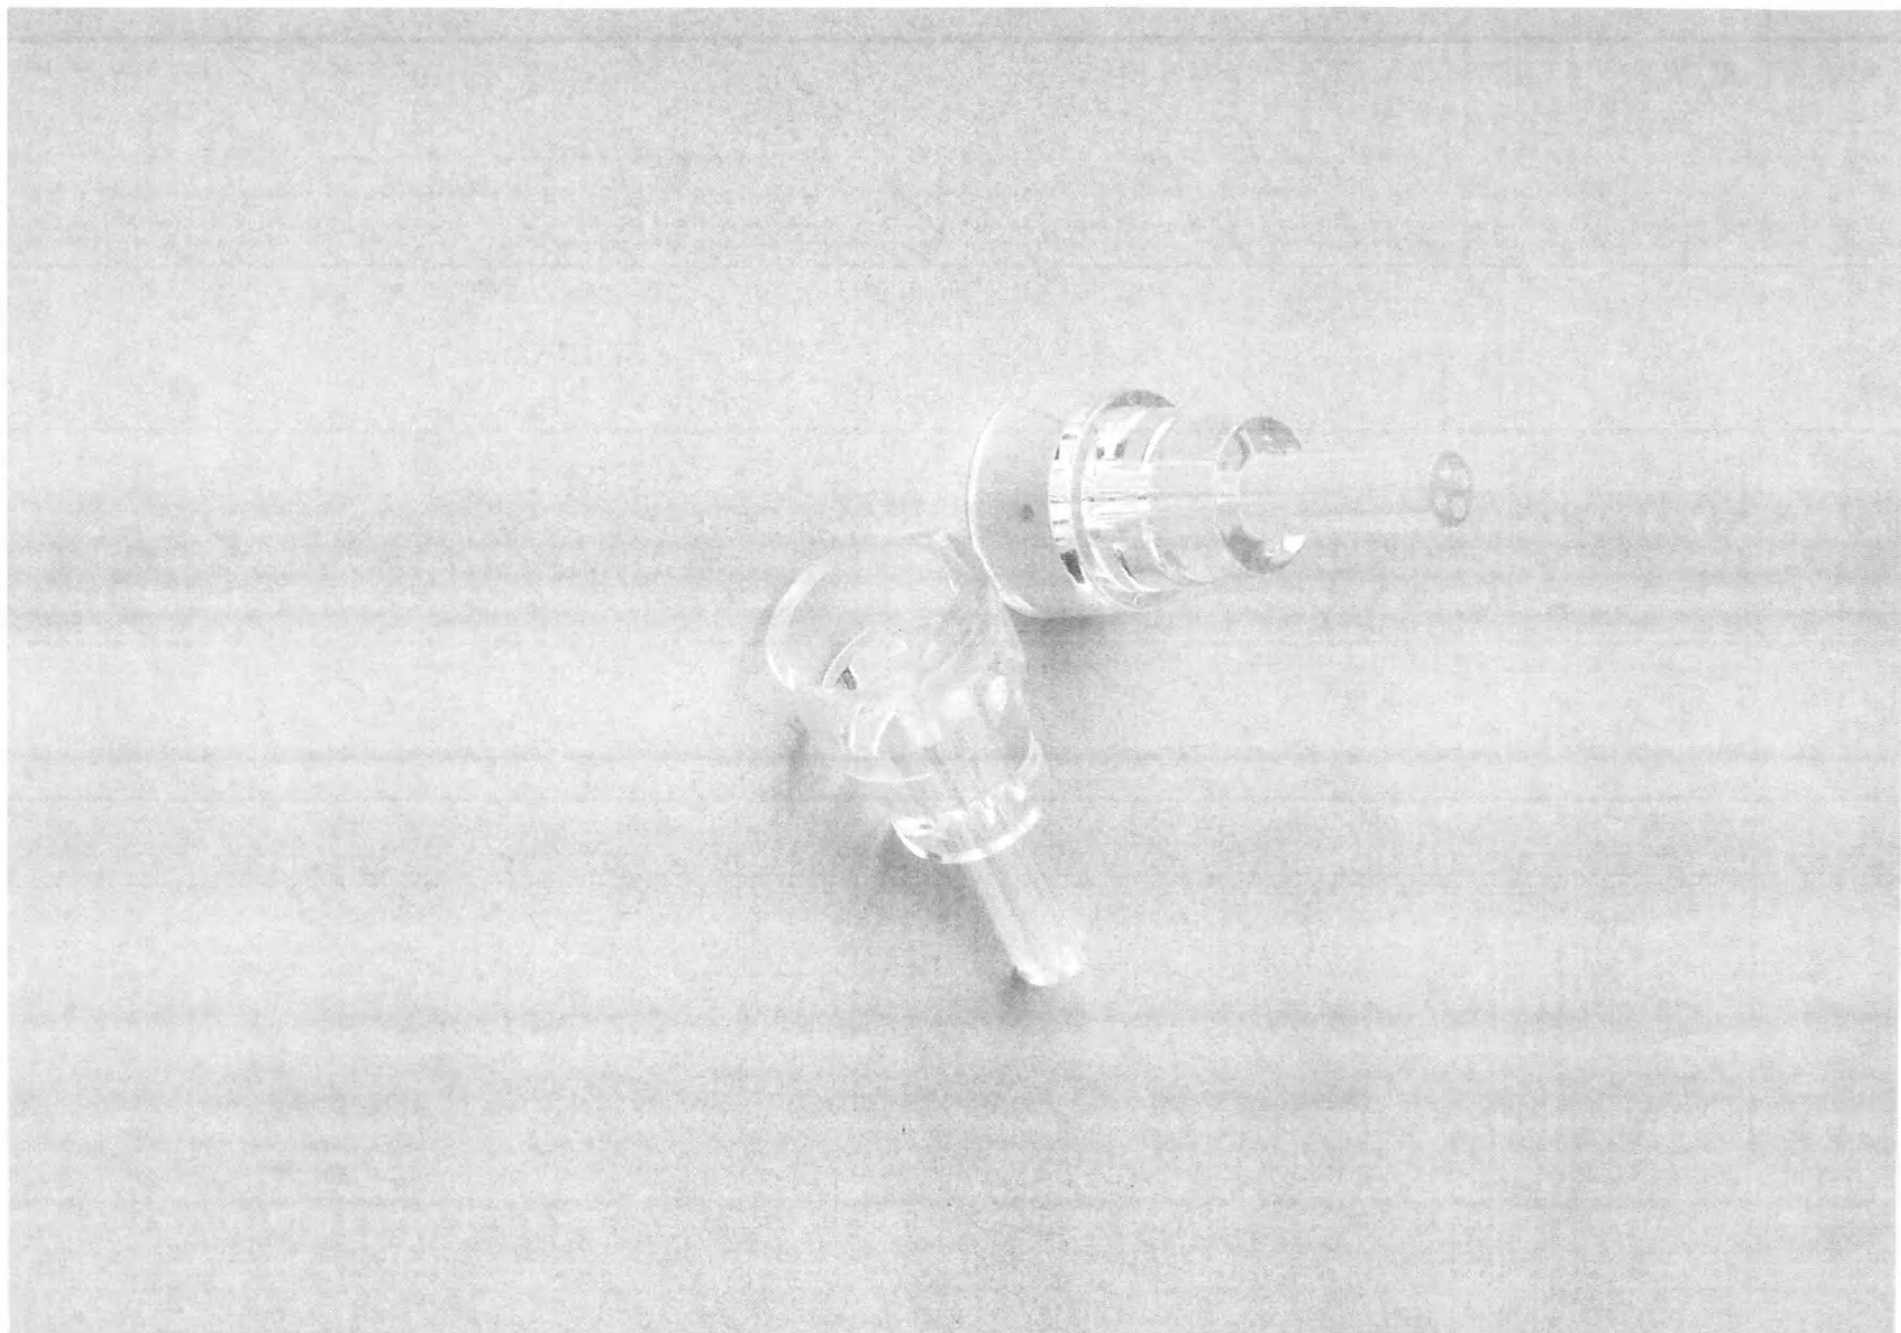


30. Т518 дополнительные уплотнительные прокладки



● Т030 4 в 1 тестовые полости ●



32. C0103 дополнительная термобумага для Apple AP1300

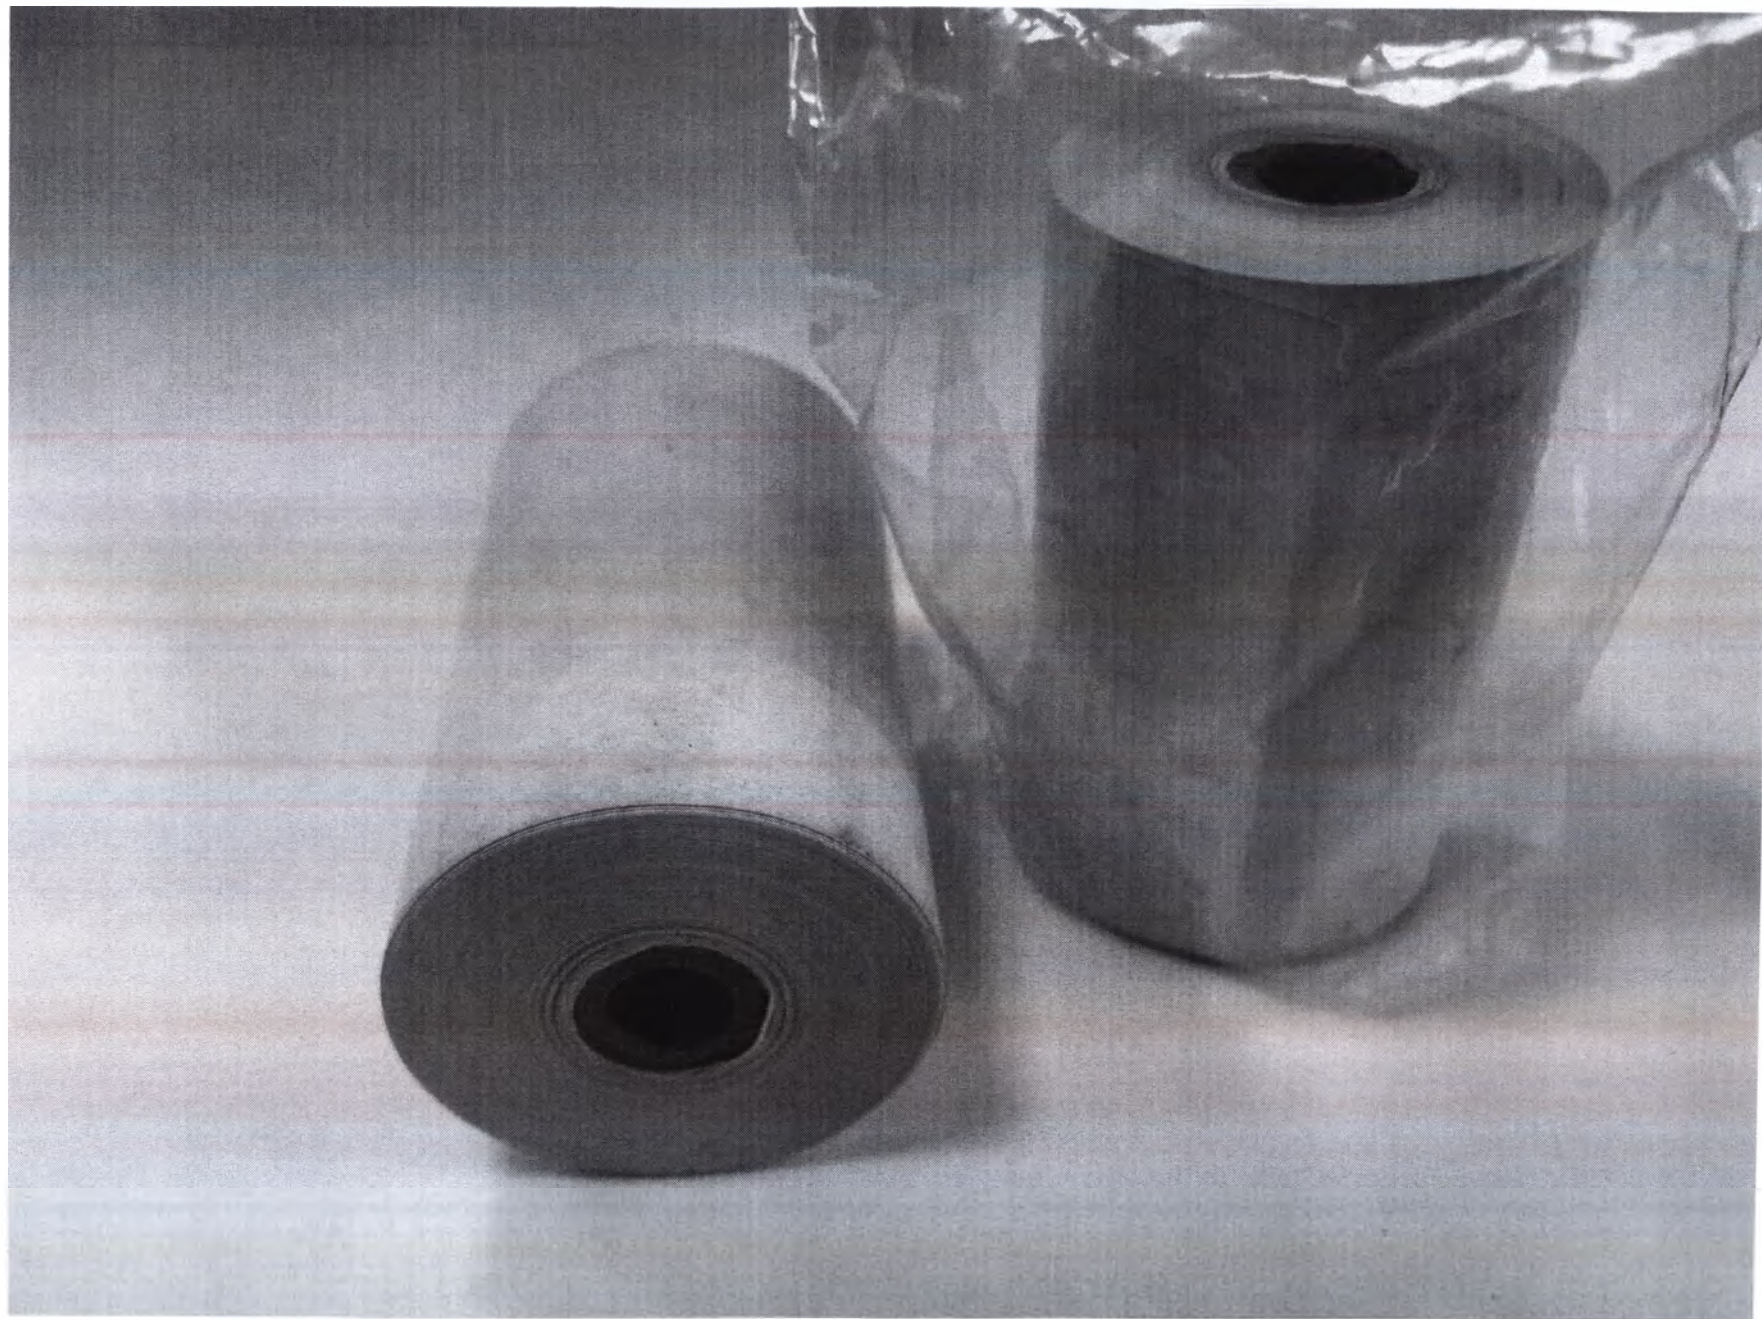

33. С104 дополнительная термобумага для Saabel MPT-II



●. A102 Кабель для принтера ●



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 38 лист(ов)

Руководитель организации

