

Фотографические изображения общего вида МИ вместе с принадлежностями

Детектор рентгеновский плоскпанельный серии
FDX с принадлежностями


Производства

Toshiba Electron Tubes & Devices Co., Ltd


Тошиба Электрон Тьюбз энд Девайсиз Ко., Лтд.


1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-8550,


Japan (Япония)

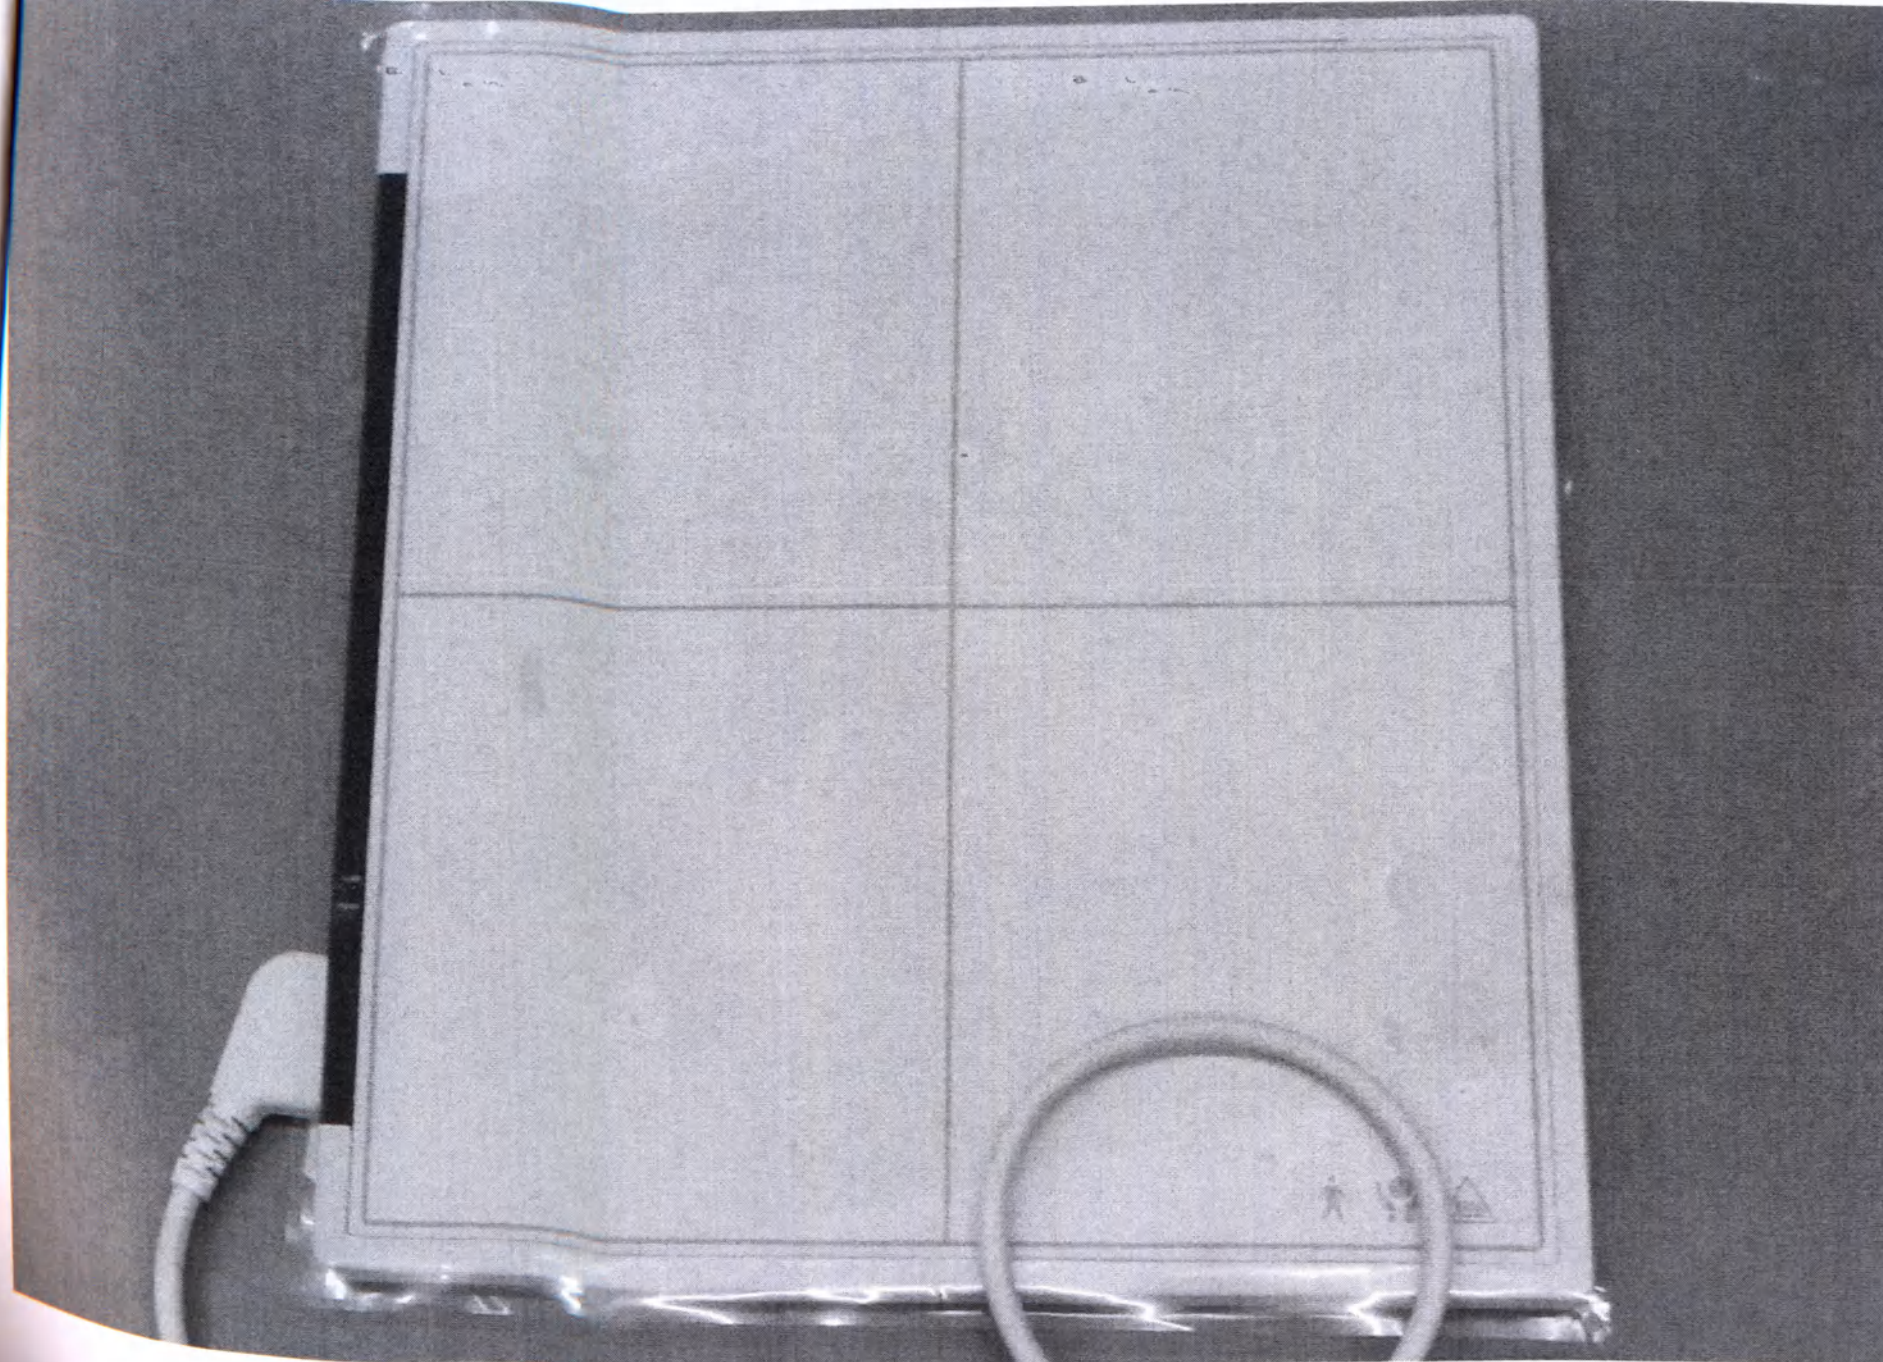


Детектор рентгеновский плоскпанельный модель FDX3543RP

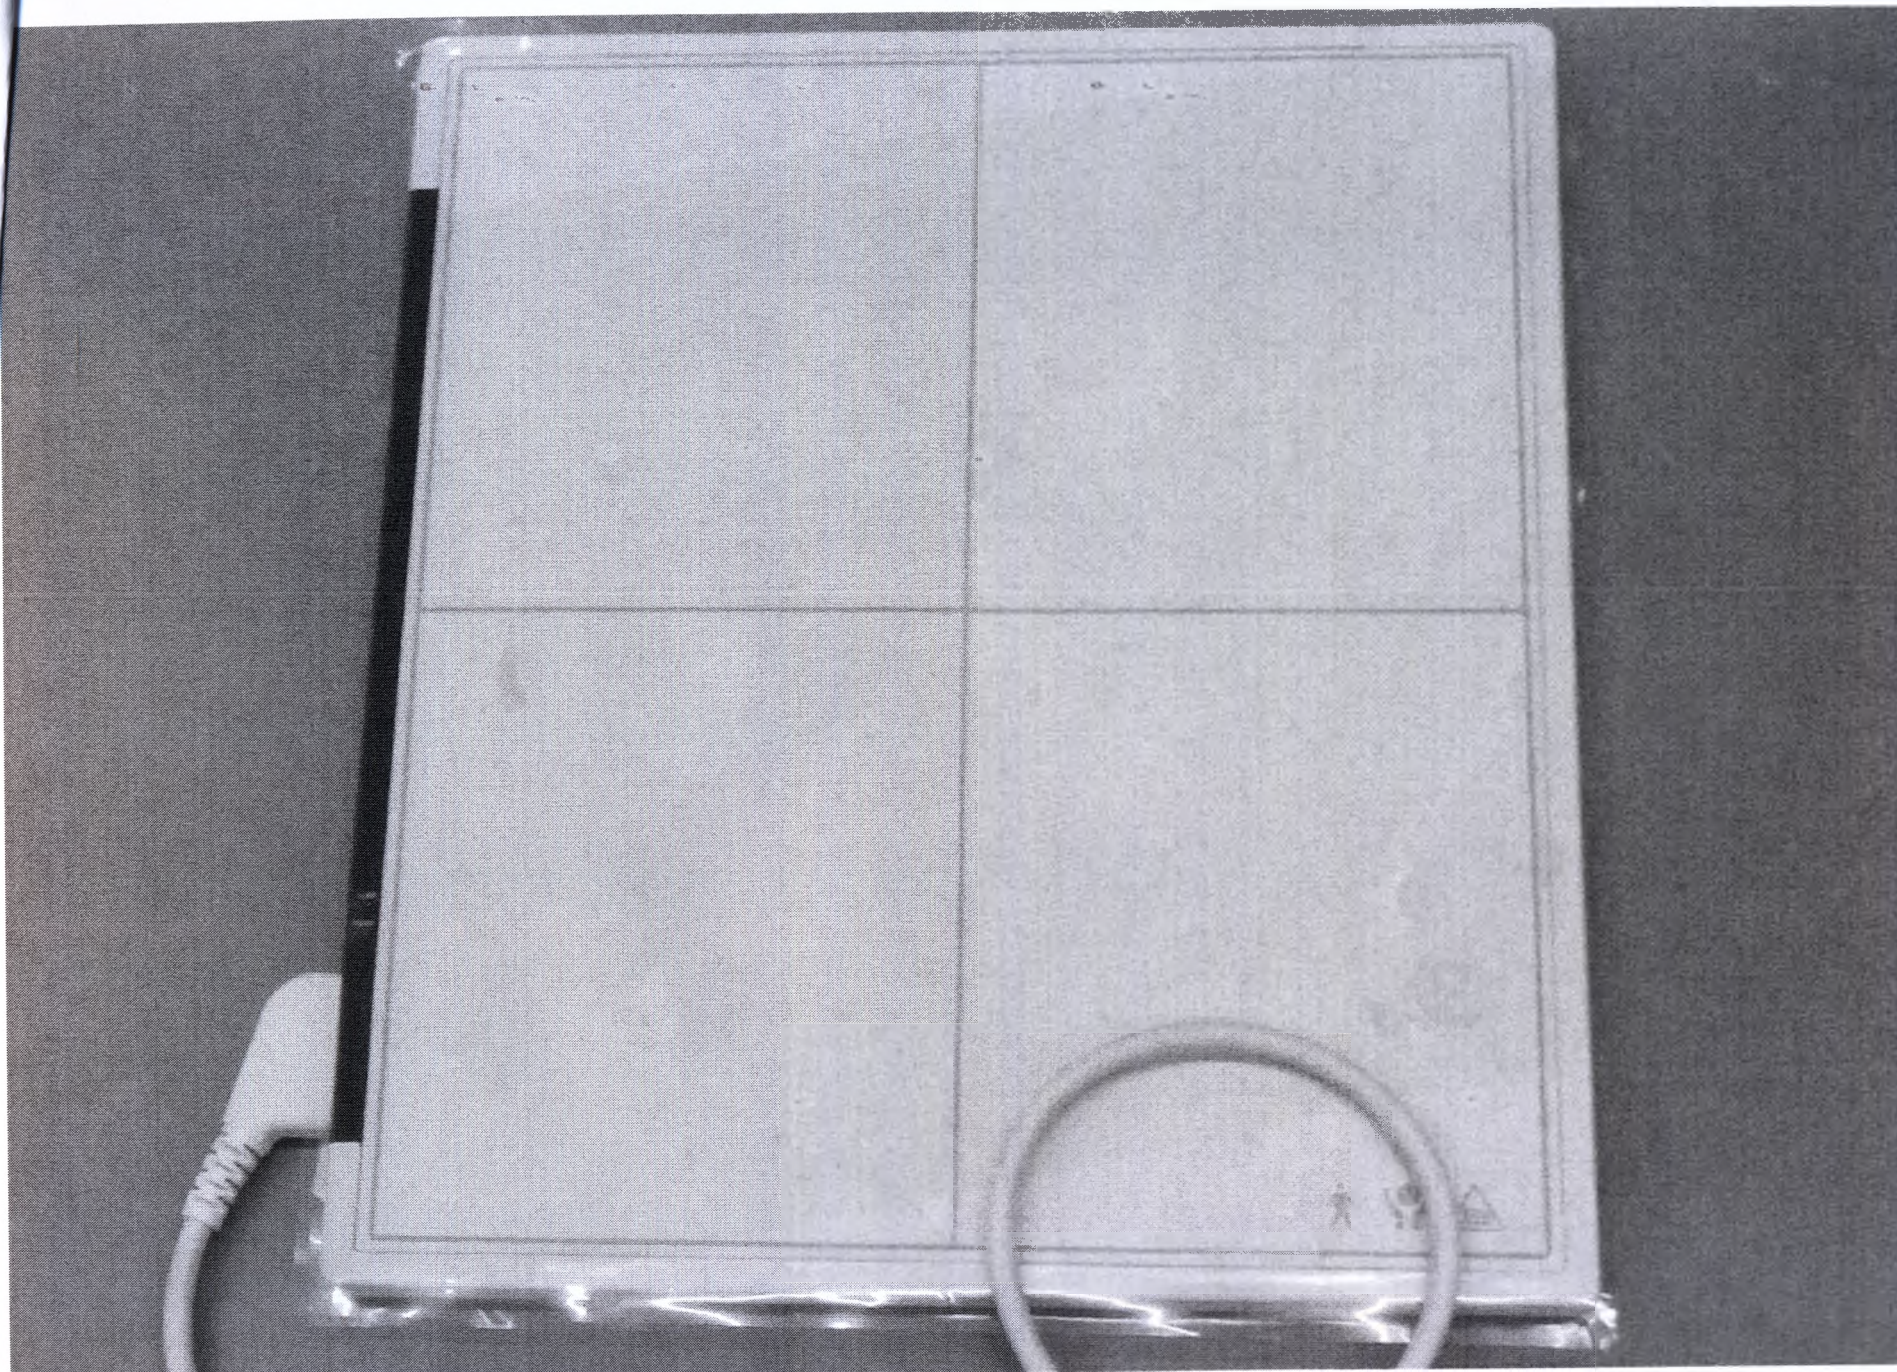

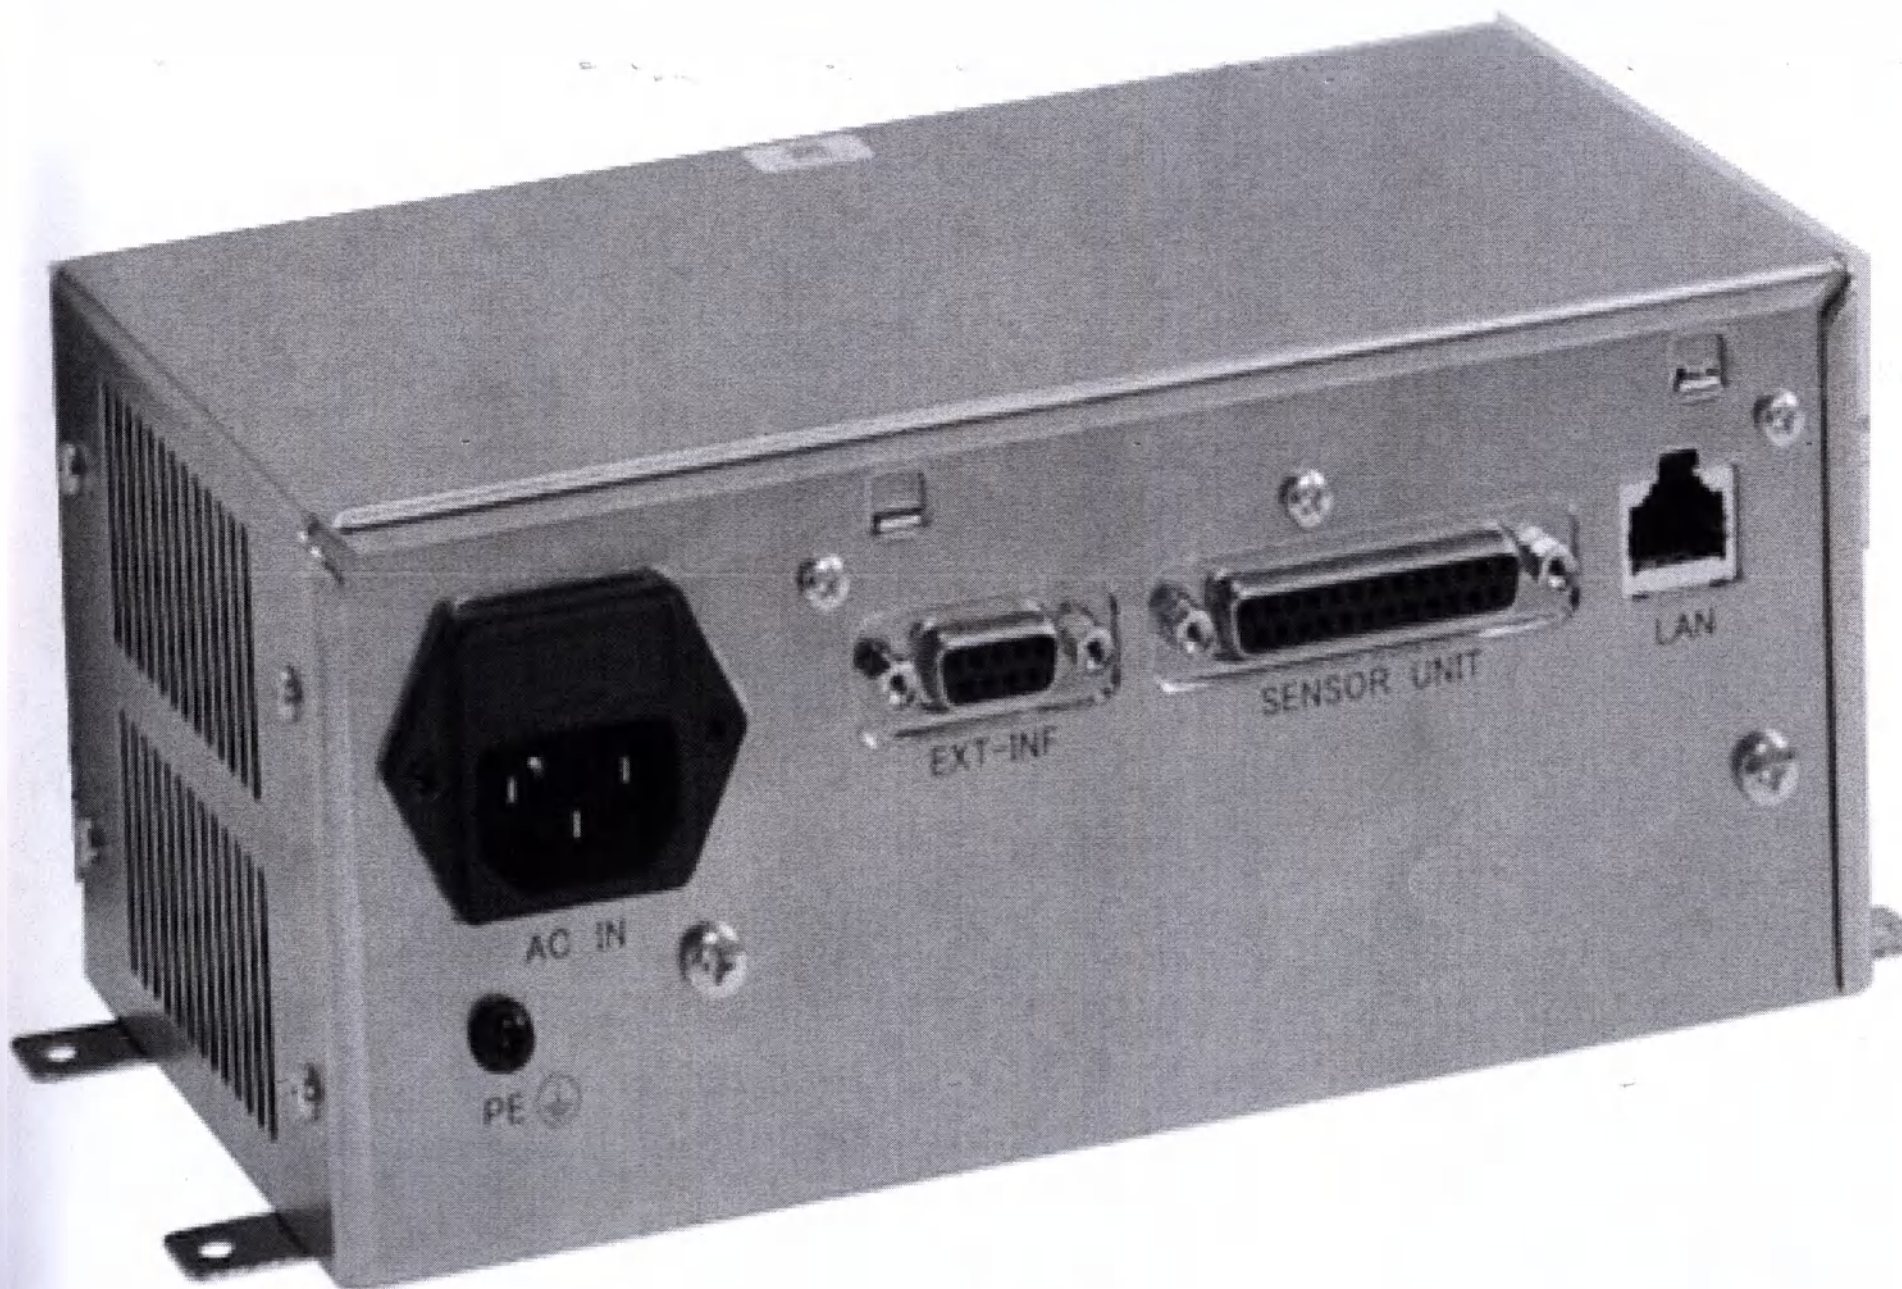


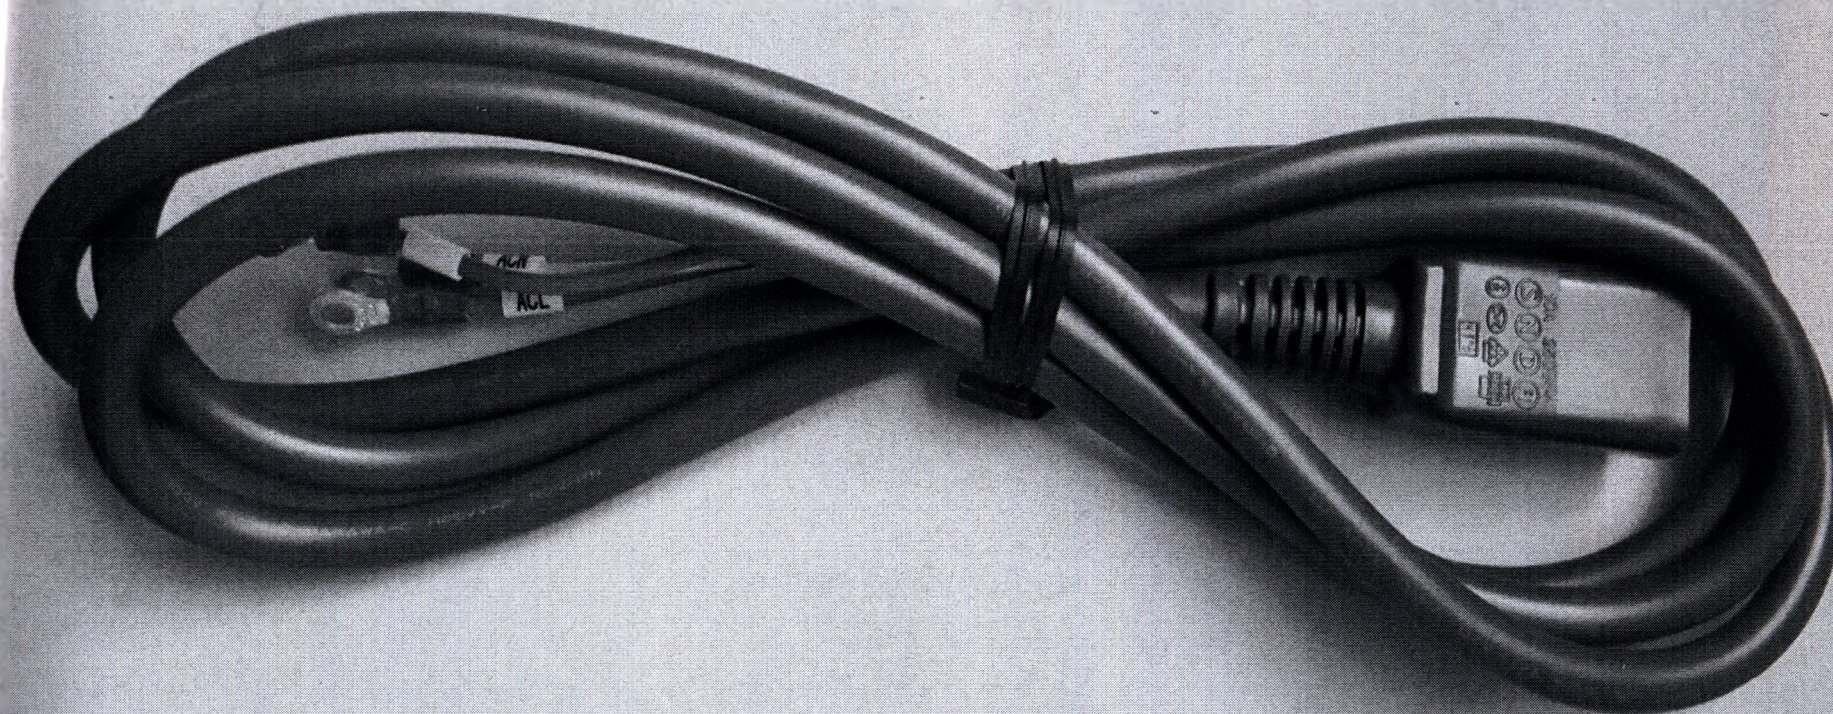



Кабель питания

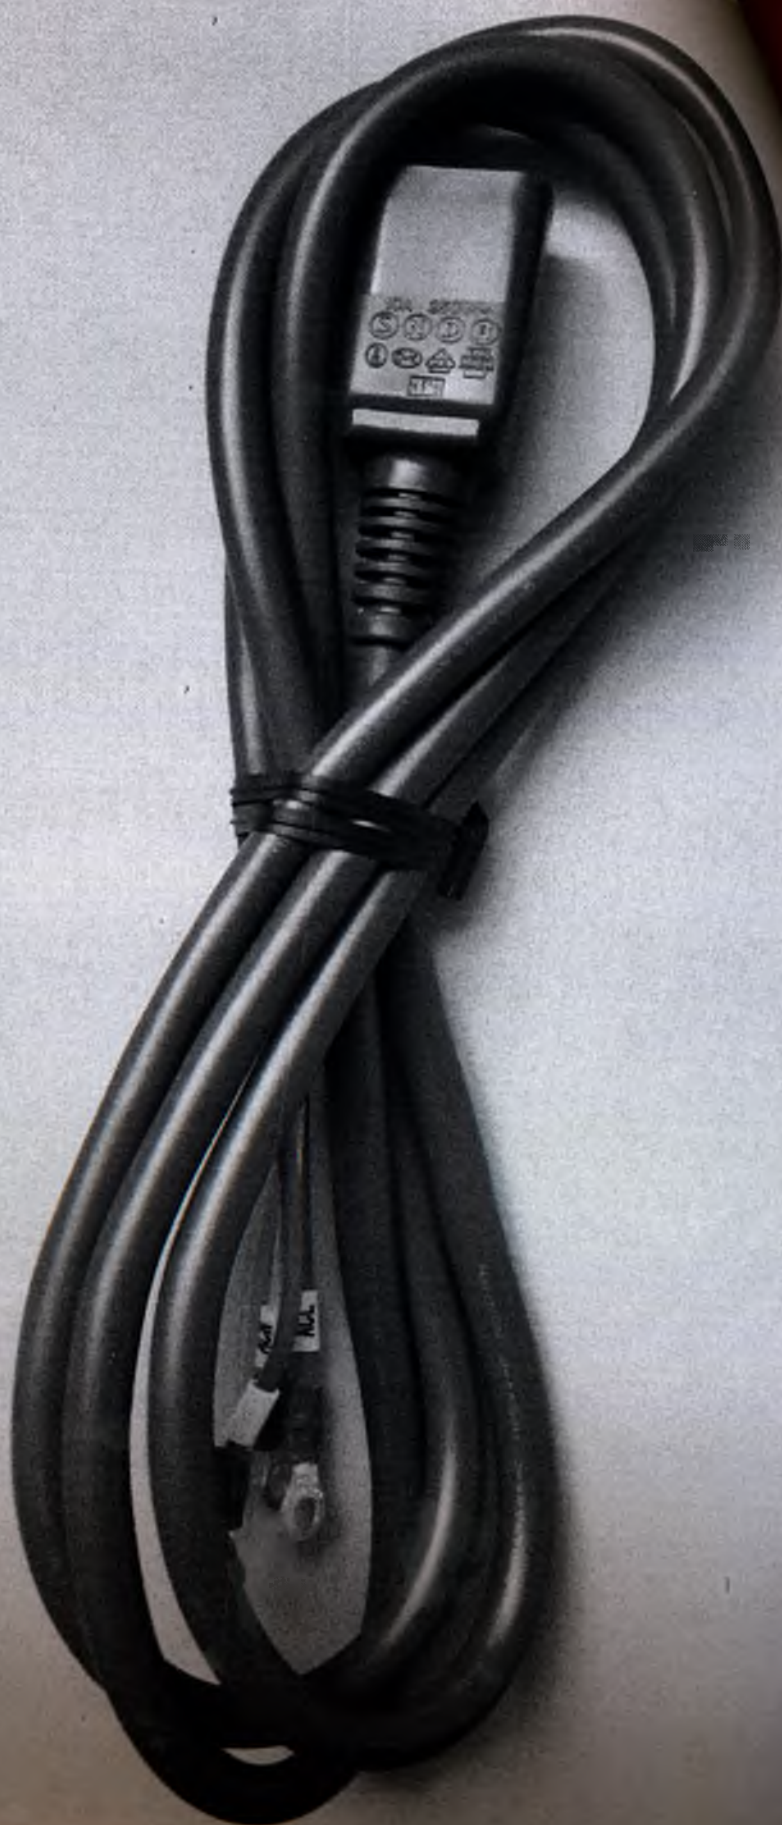



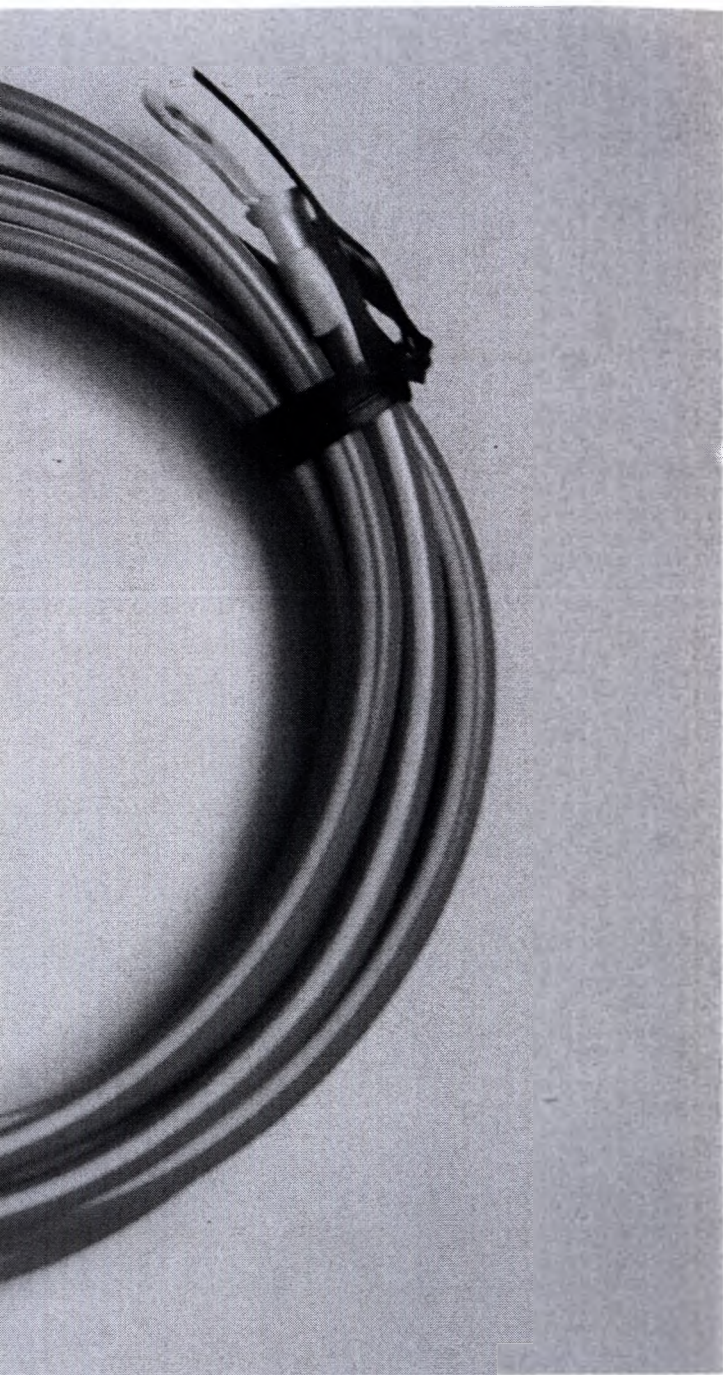

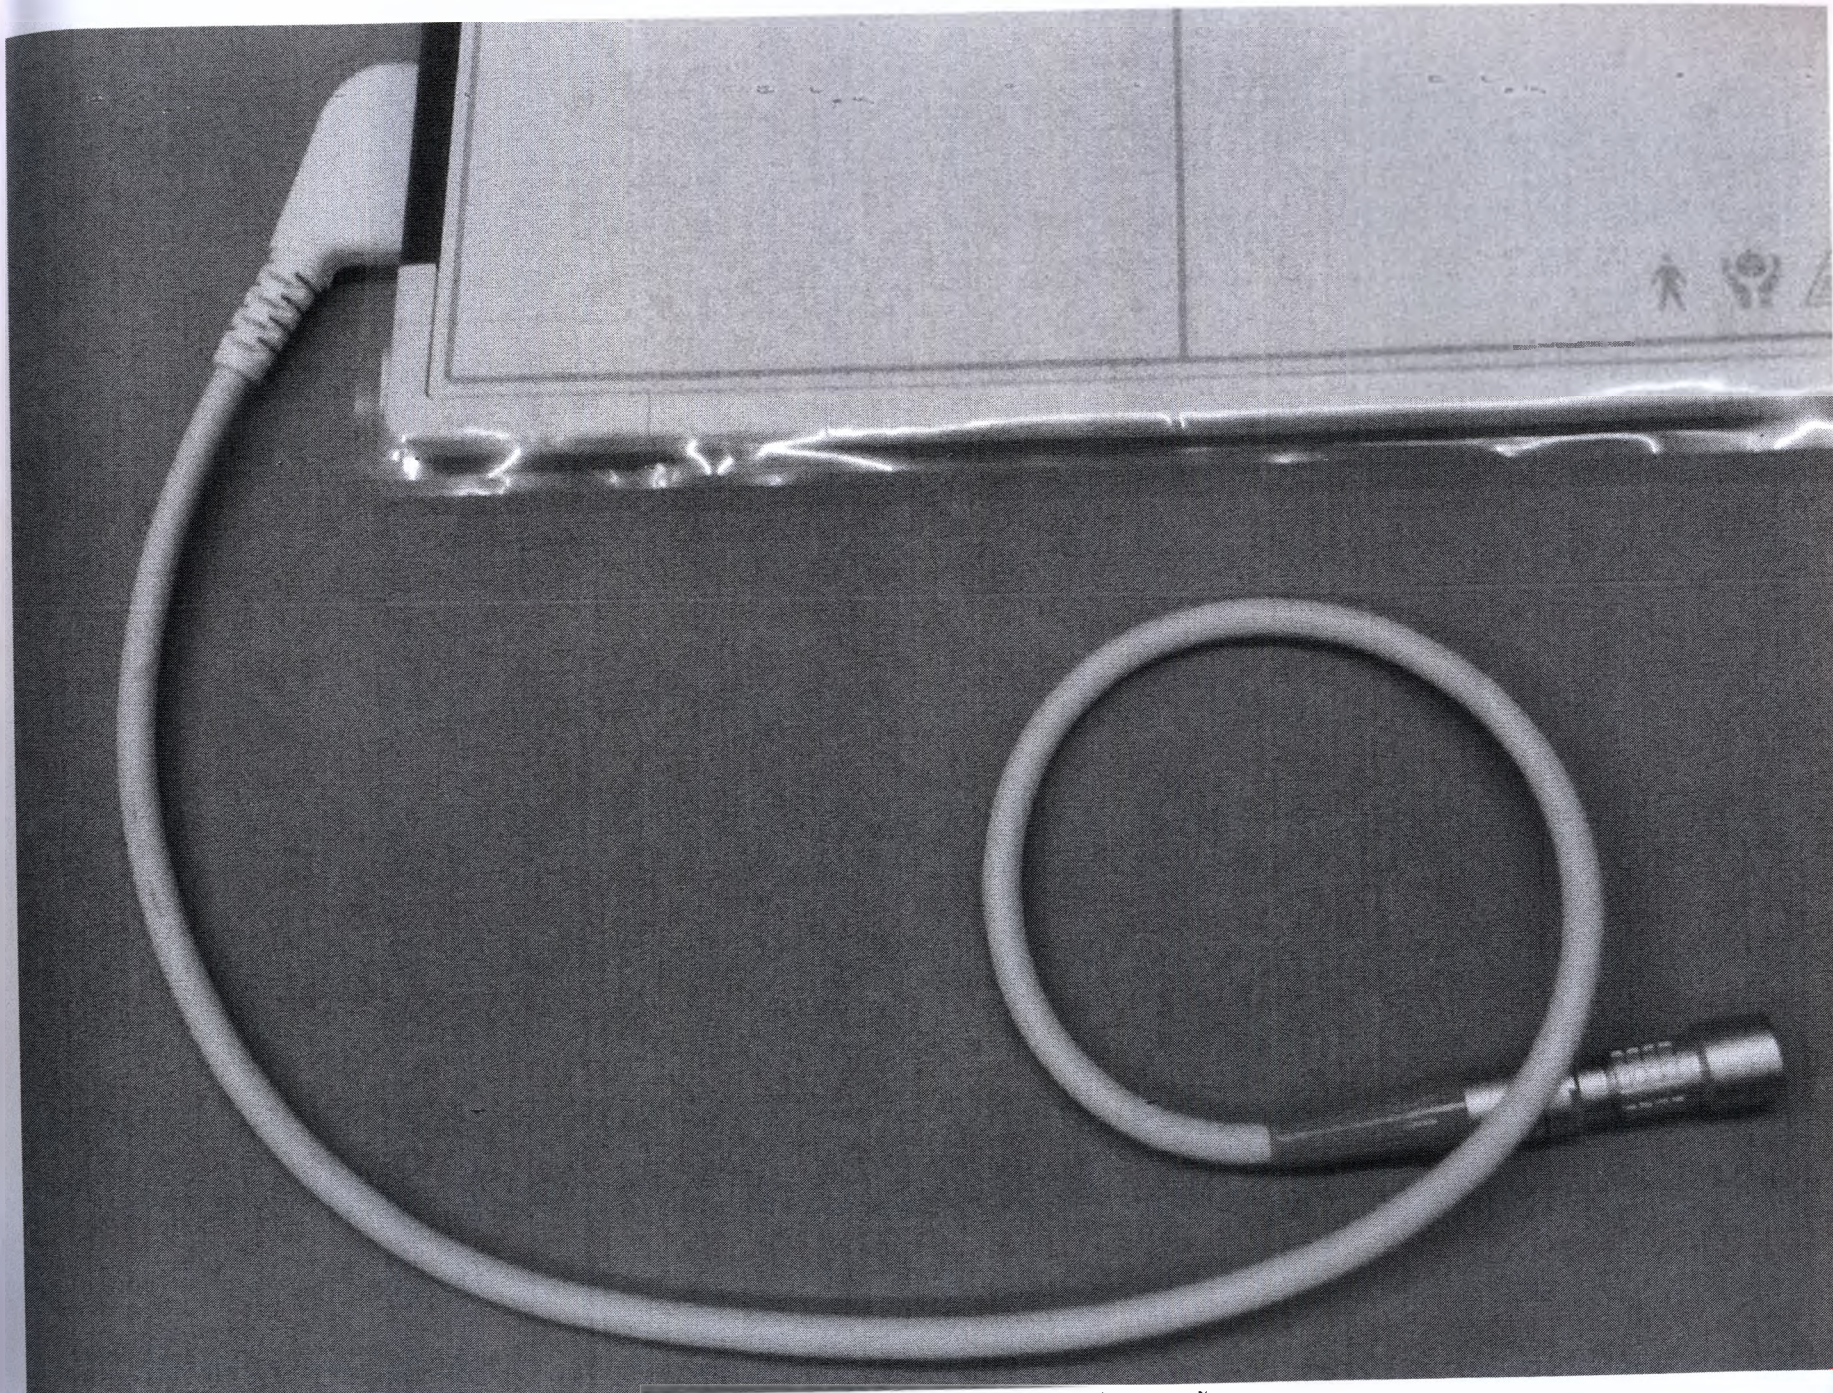


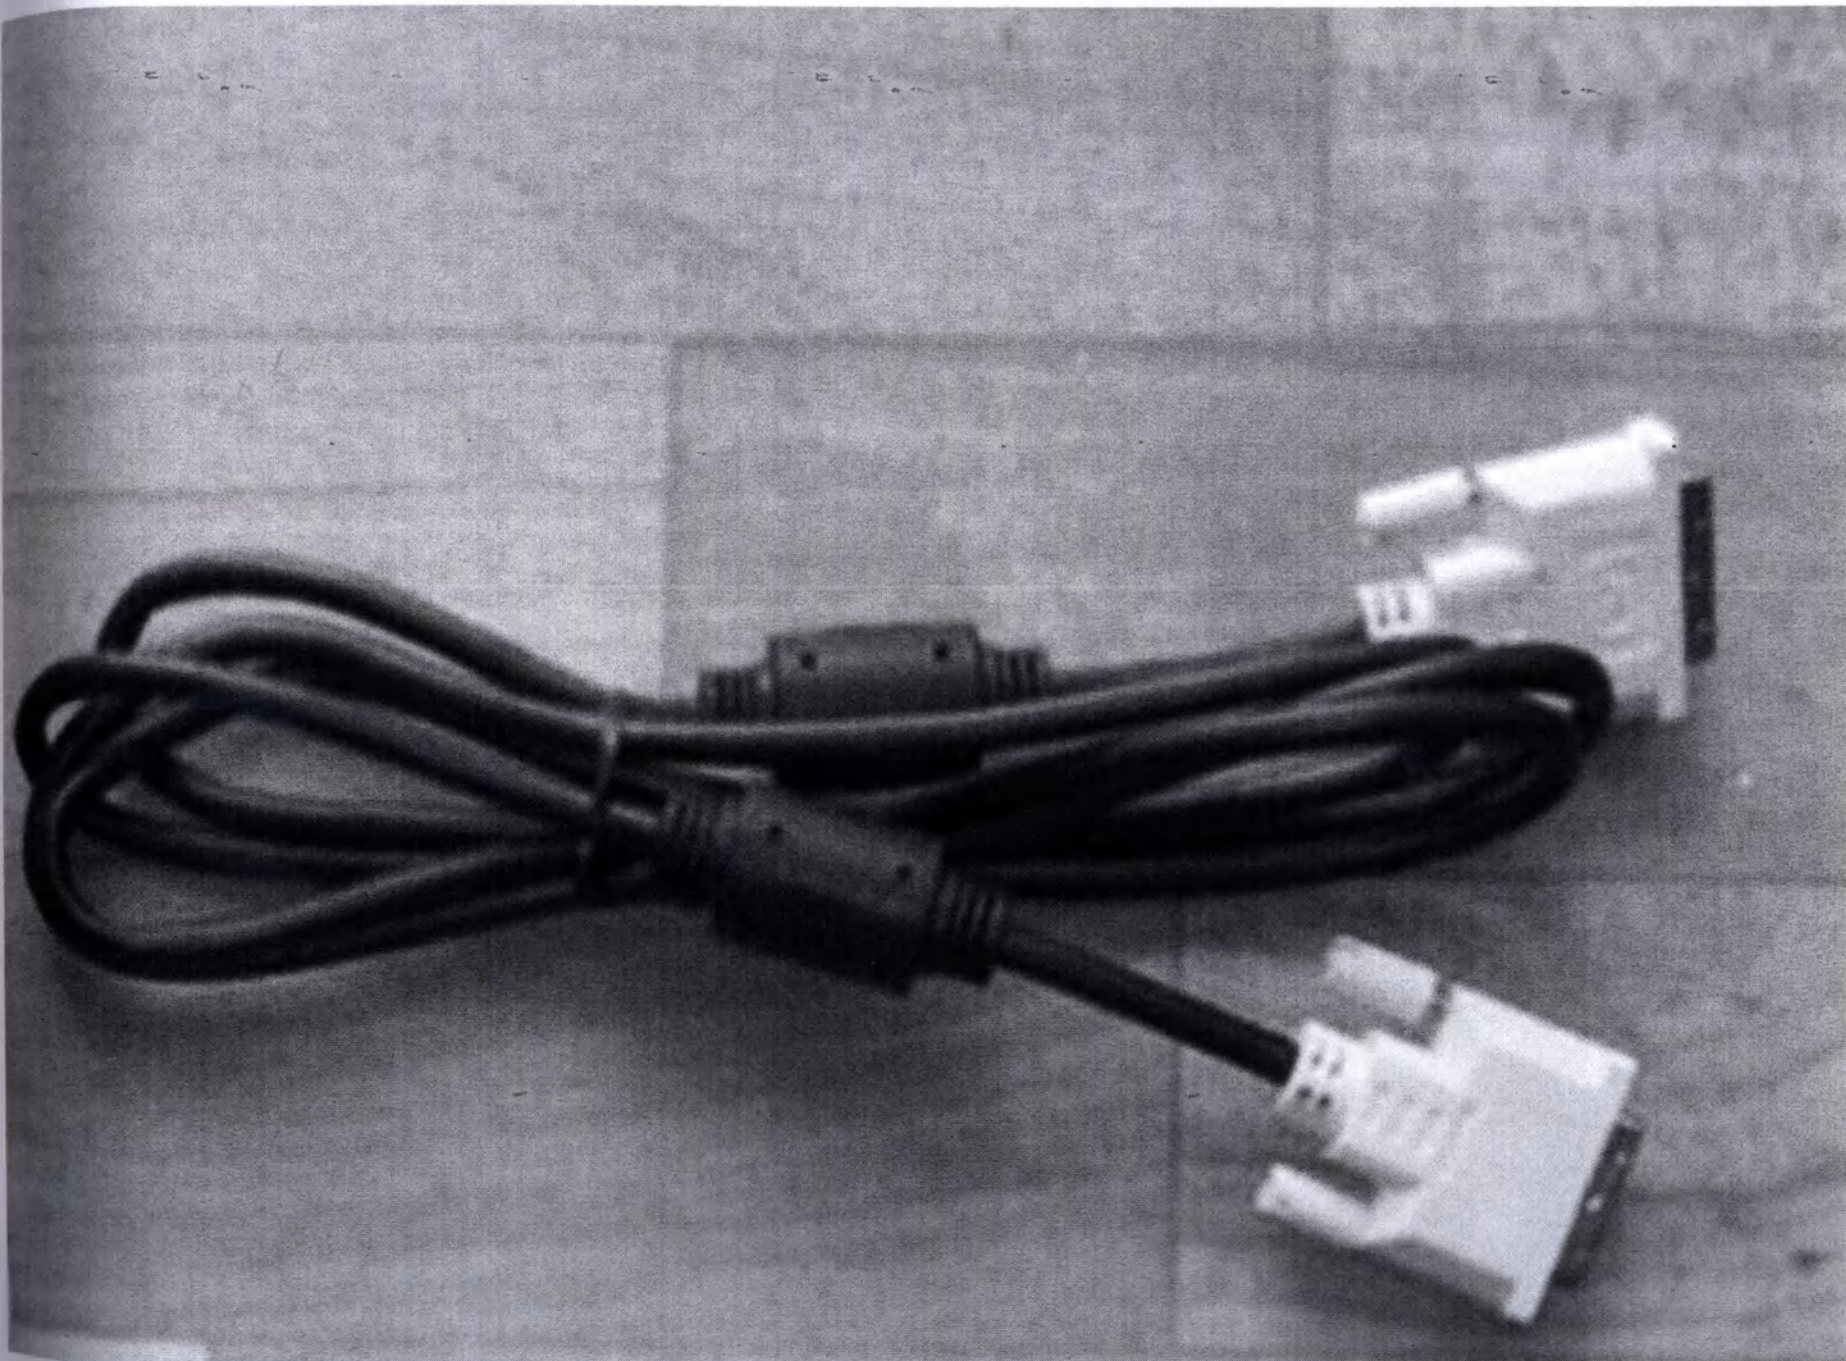


Кабель «детектор – рентгеновское питающее устройство»




Model: FDX3543RP
Serial: 16F153B

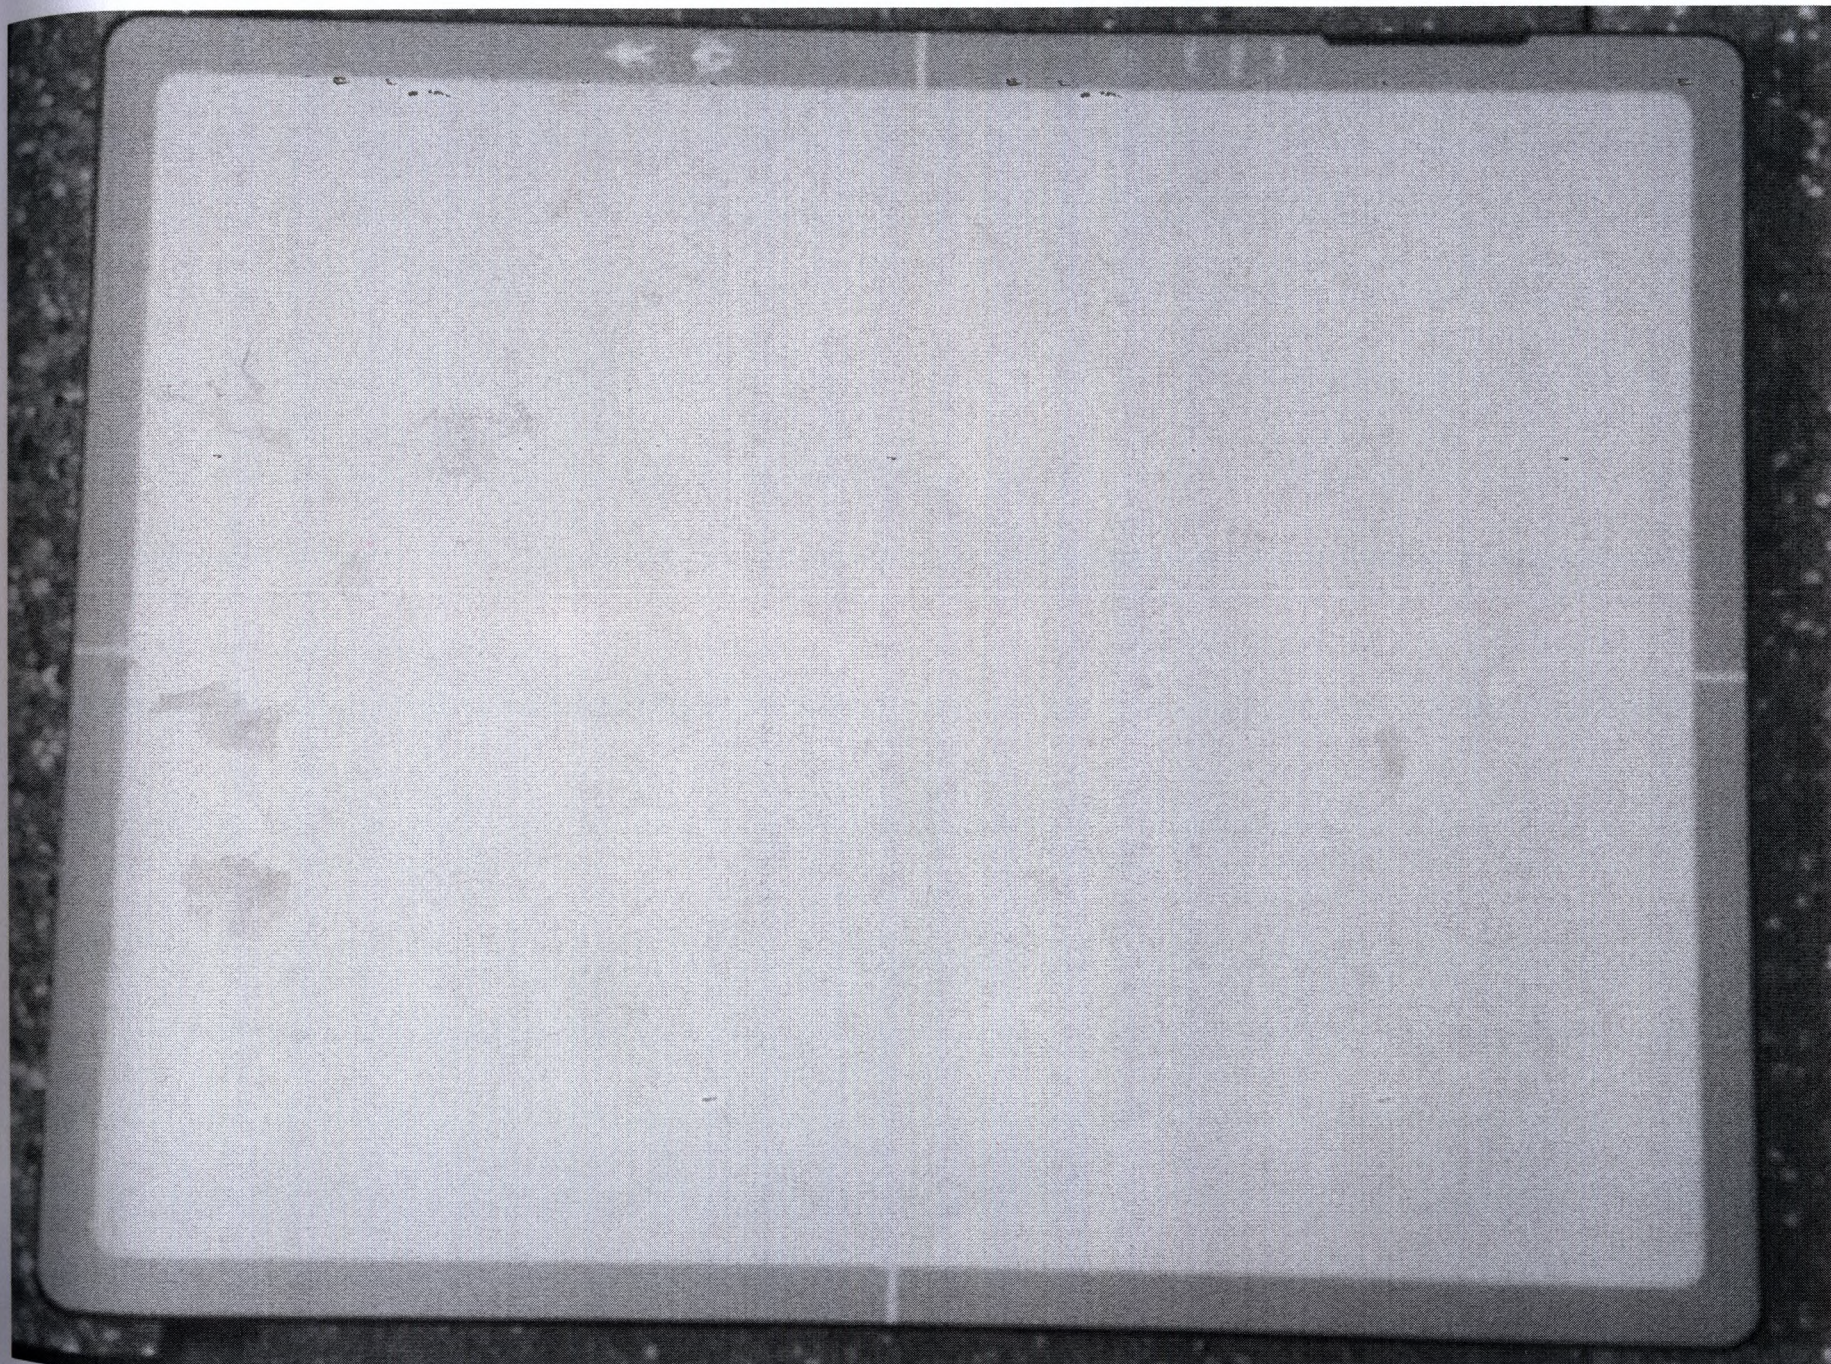

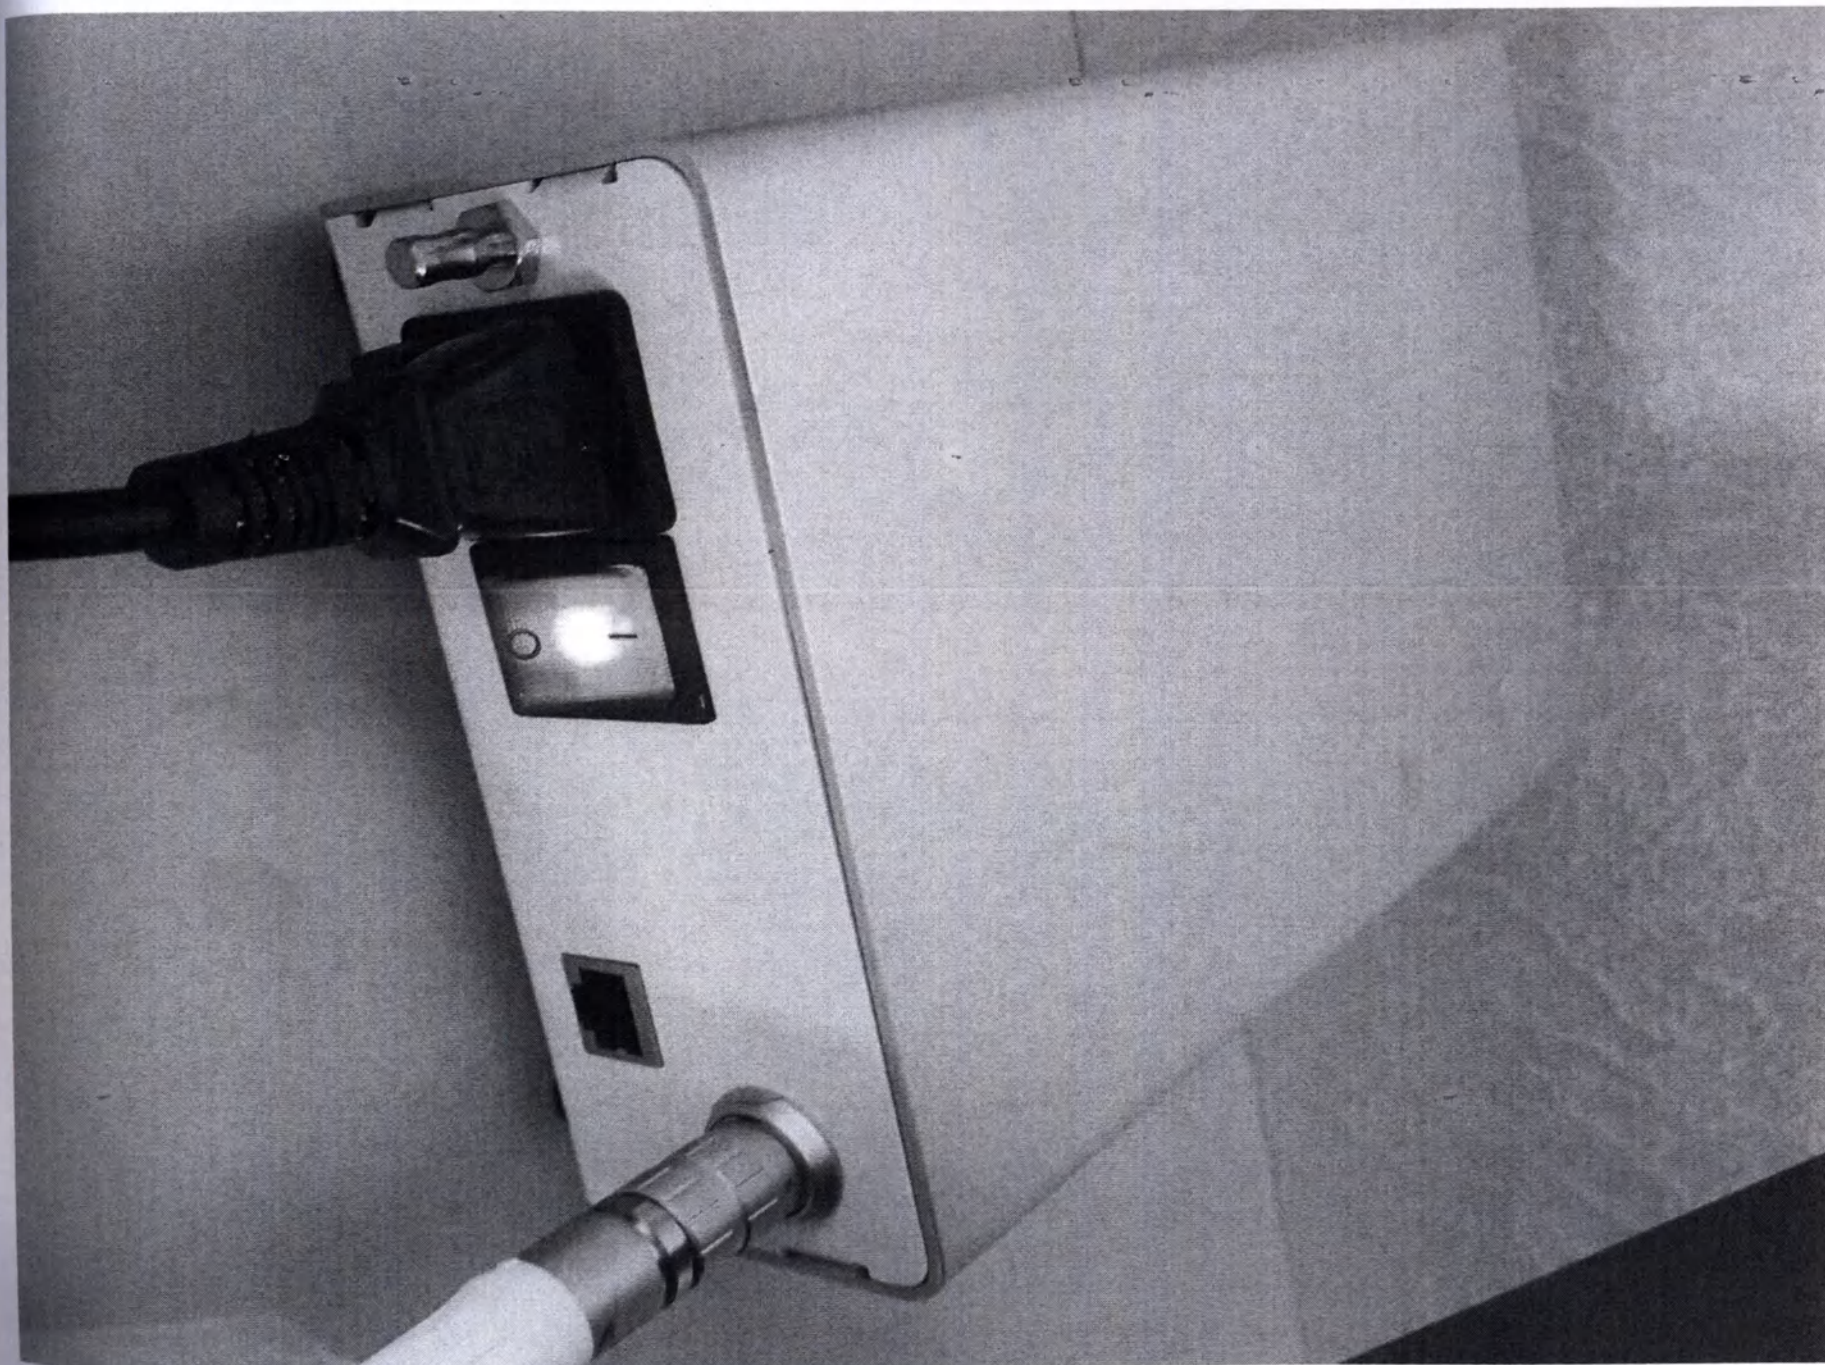


Блок питания детектора

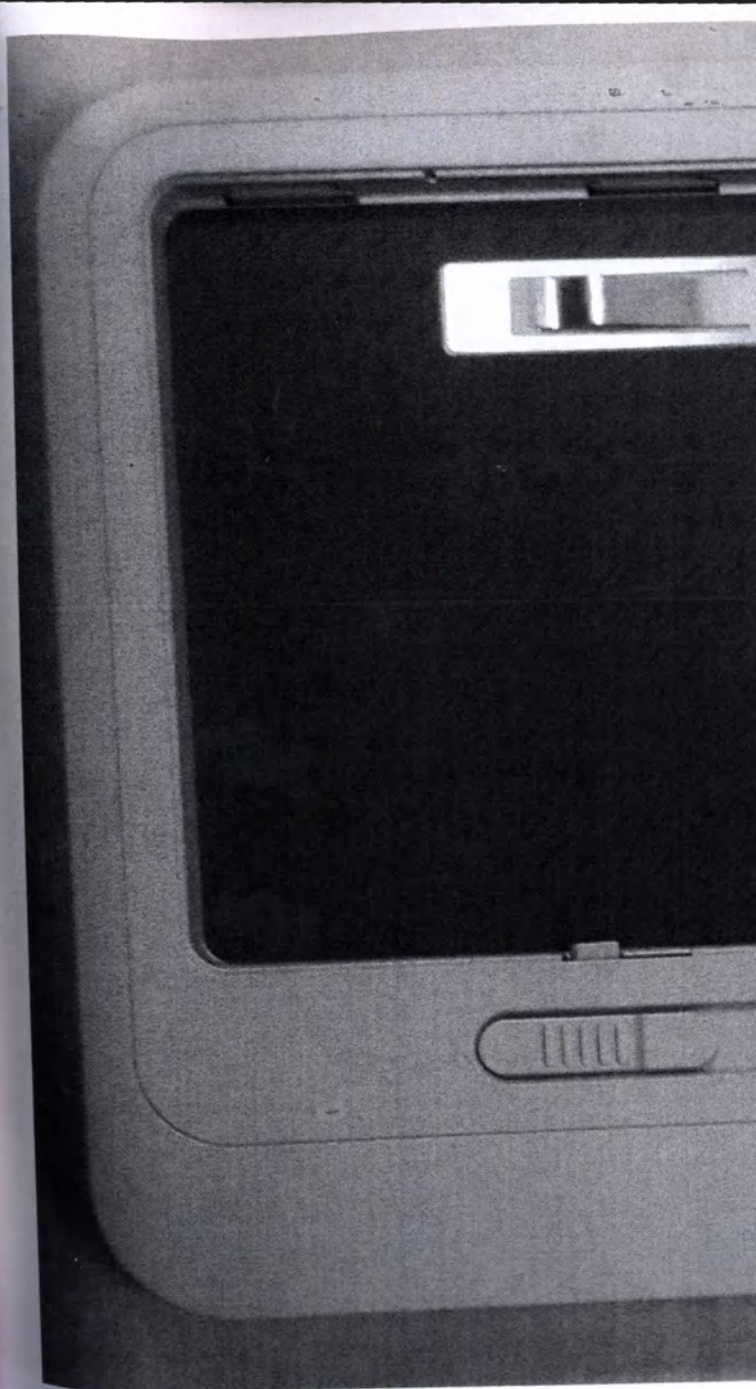




Устройство зарядное

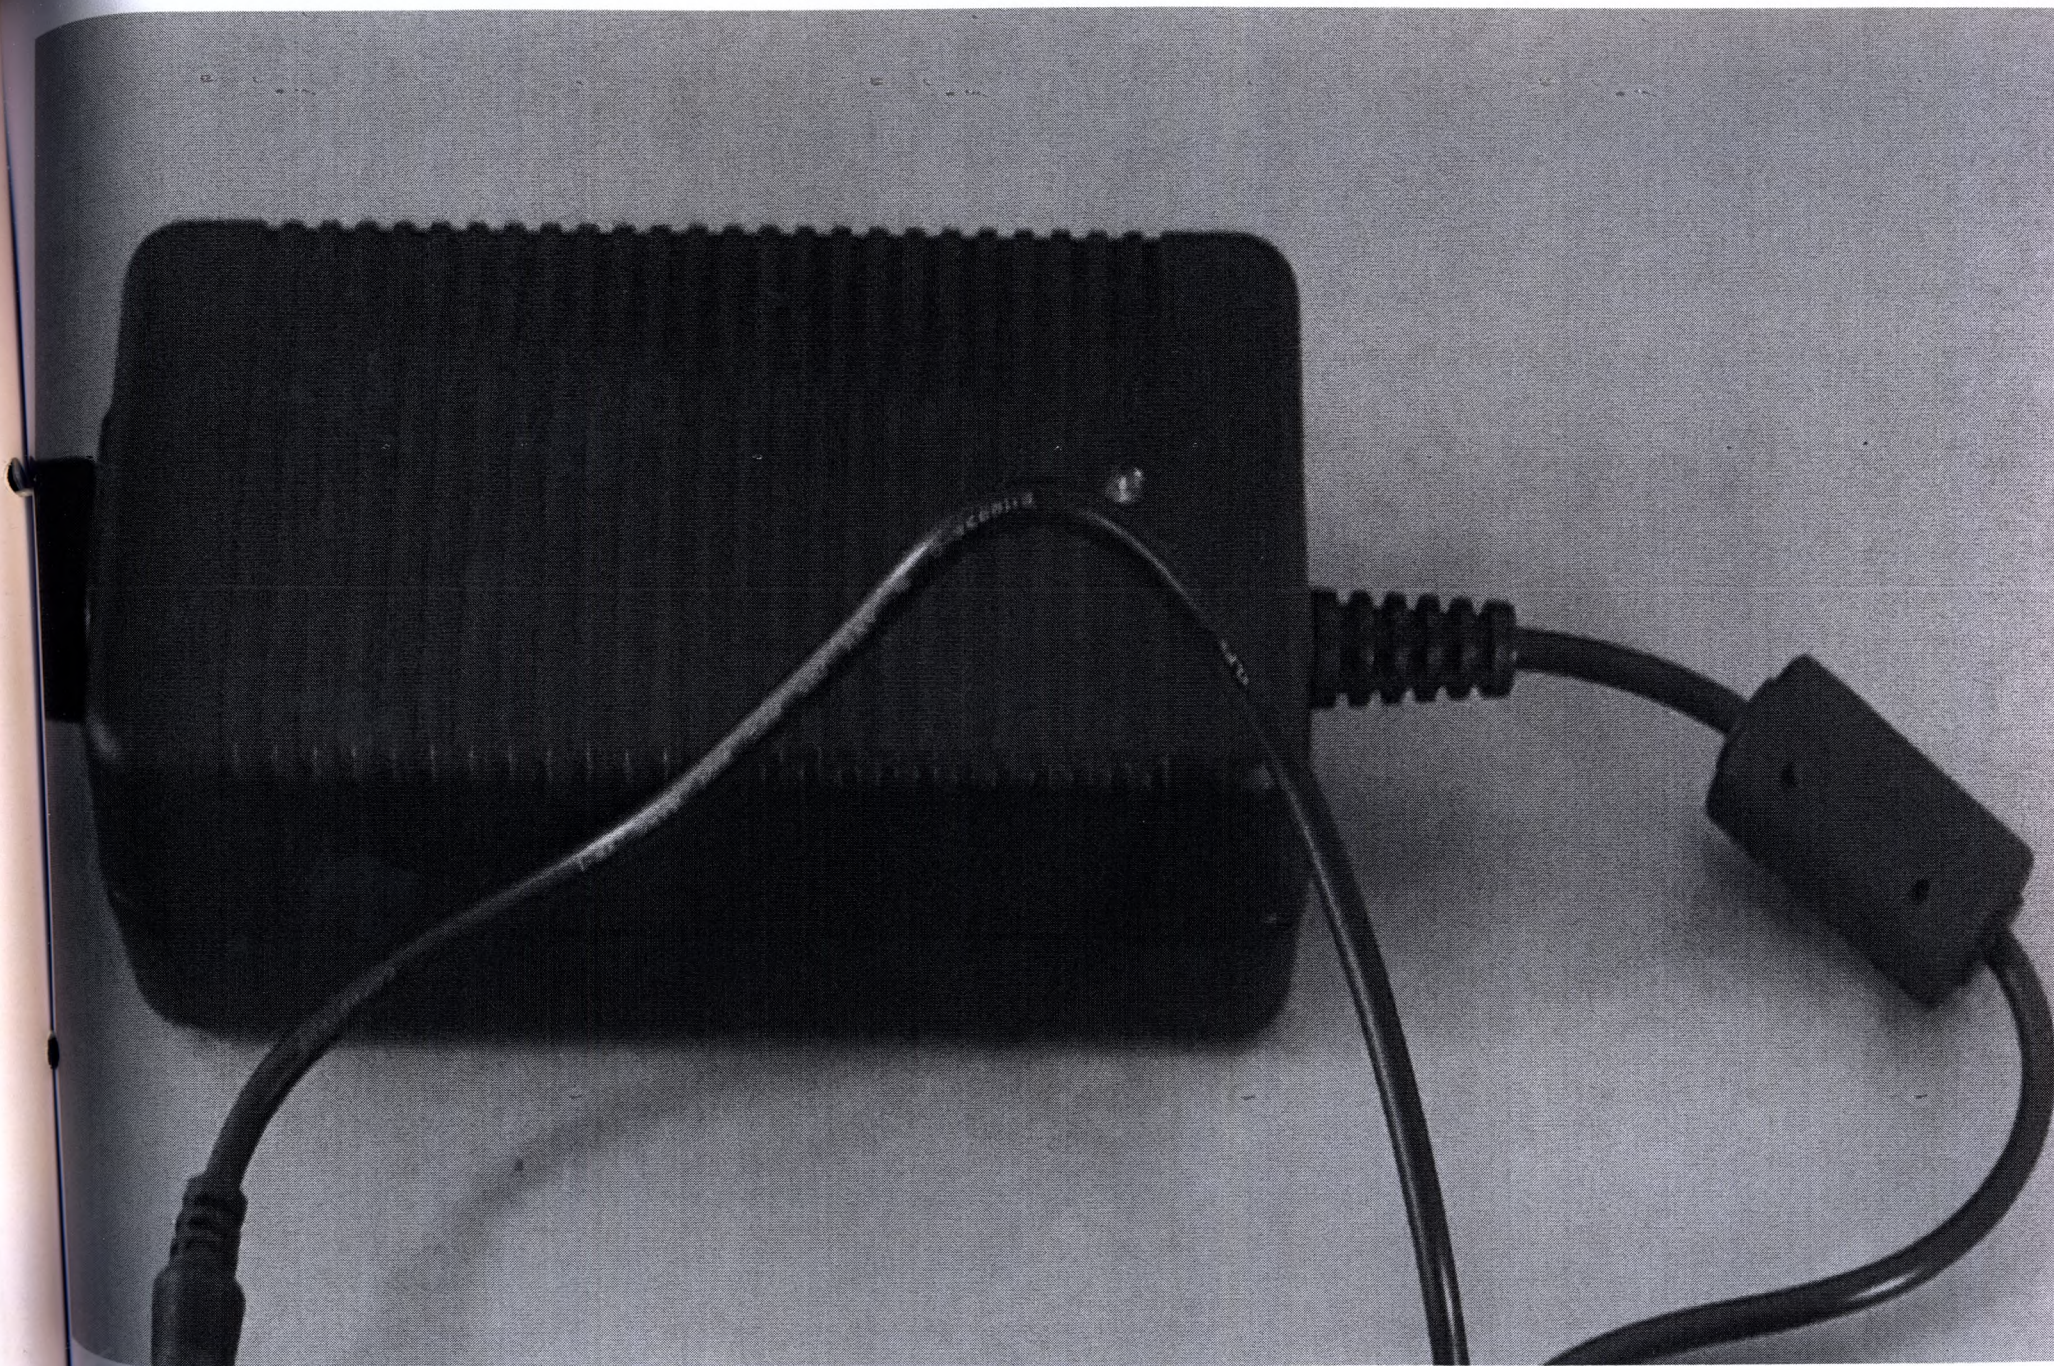

Блок питания устройства зарядного

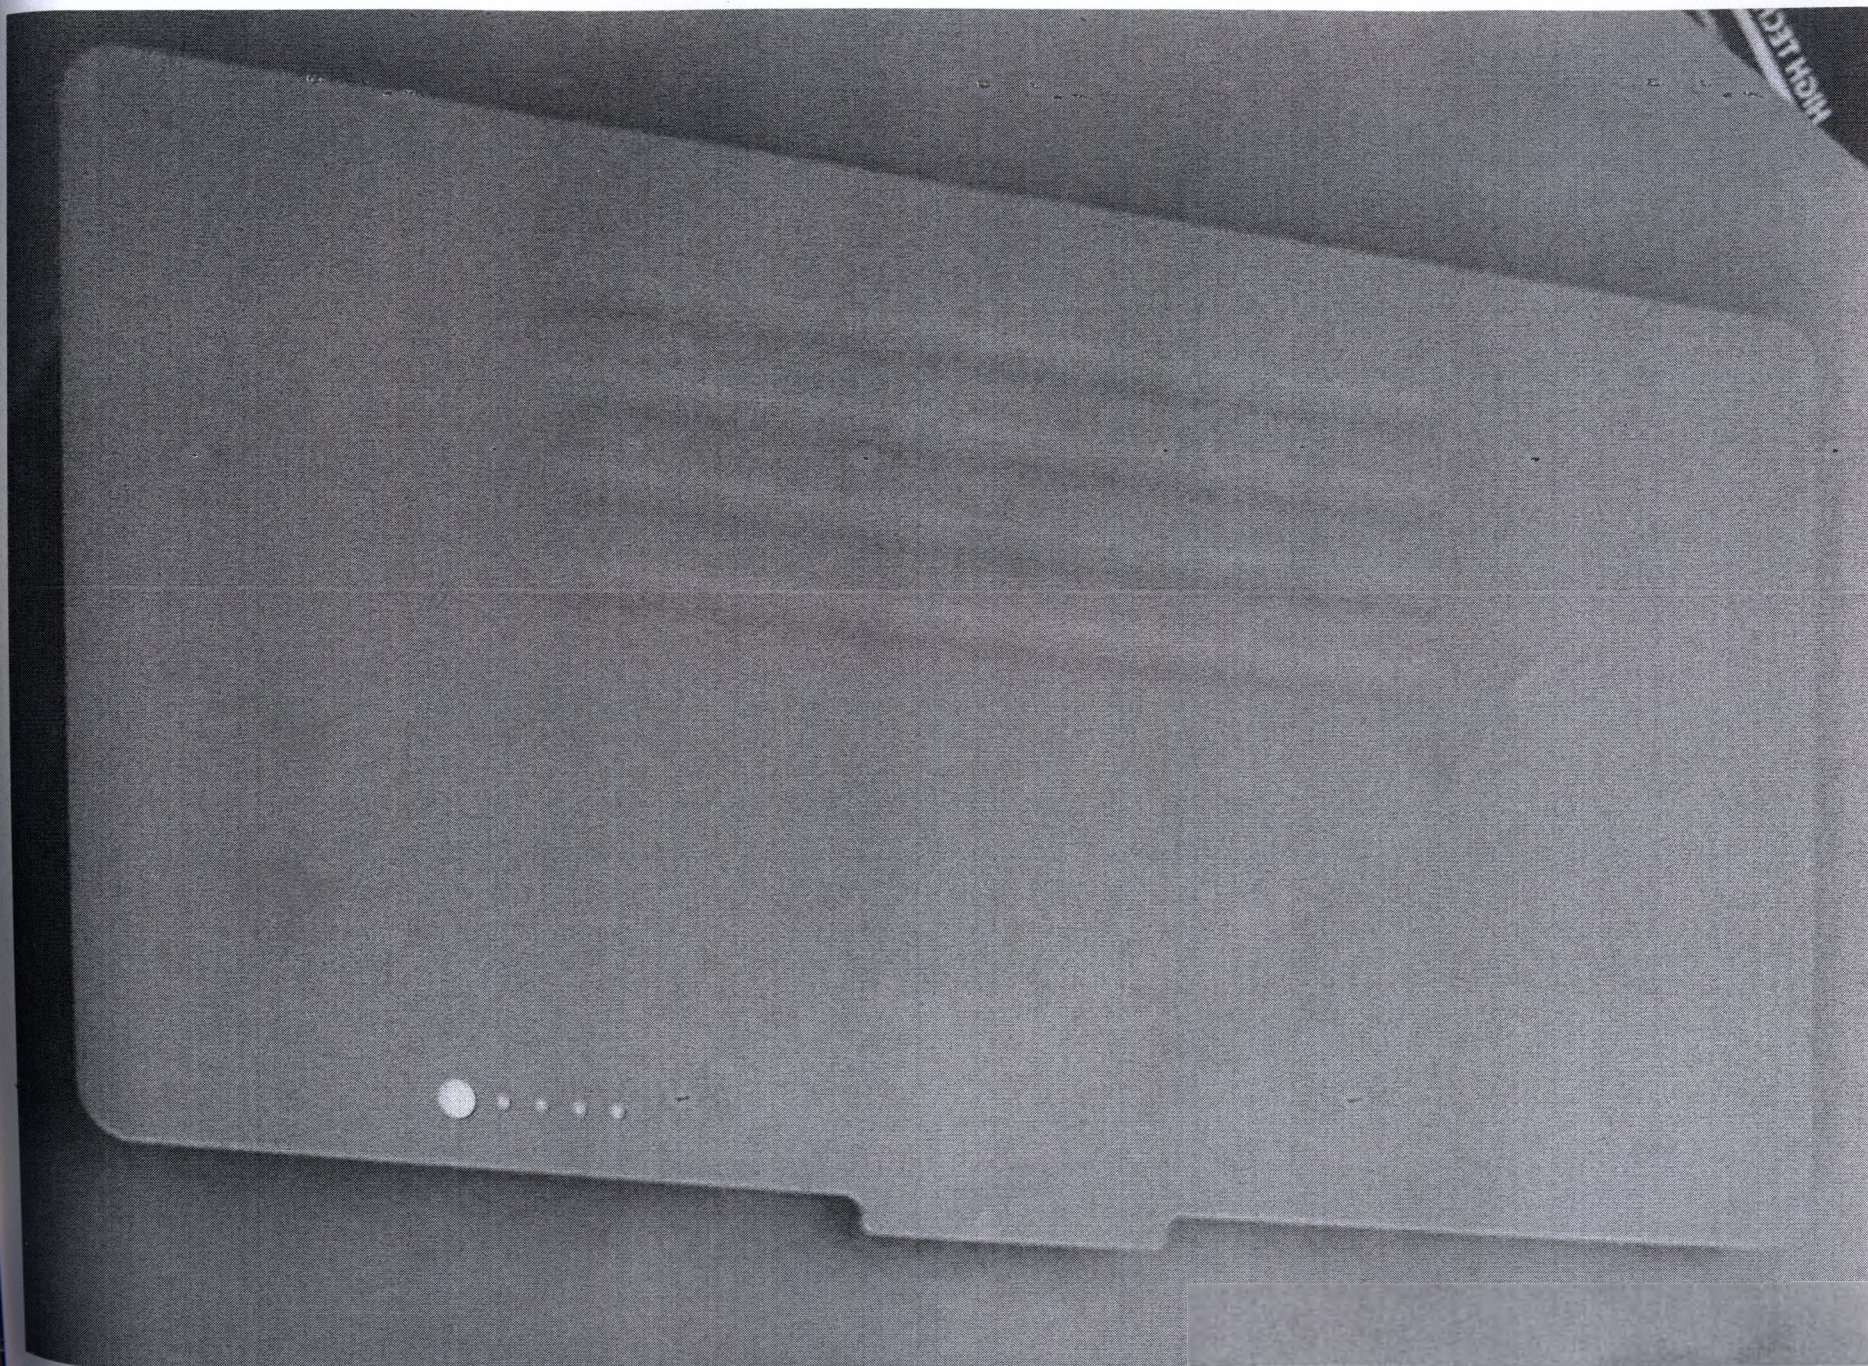

Батарея литиево-ионная





Кабель «детектор – блок питания детектора»



Кабель питания

Model : FDX3543RPW
Serial : 16B024A

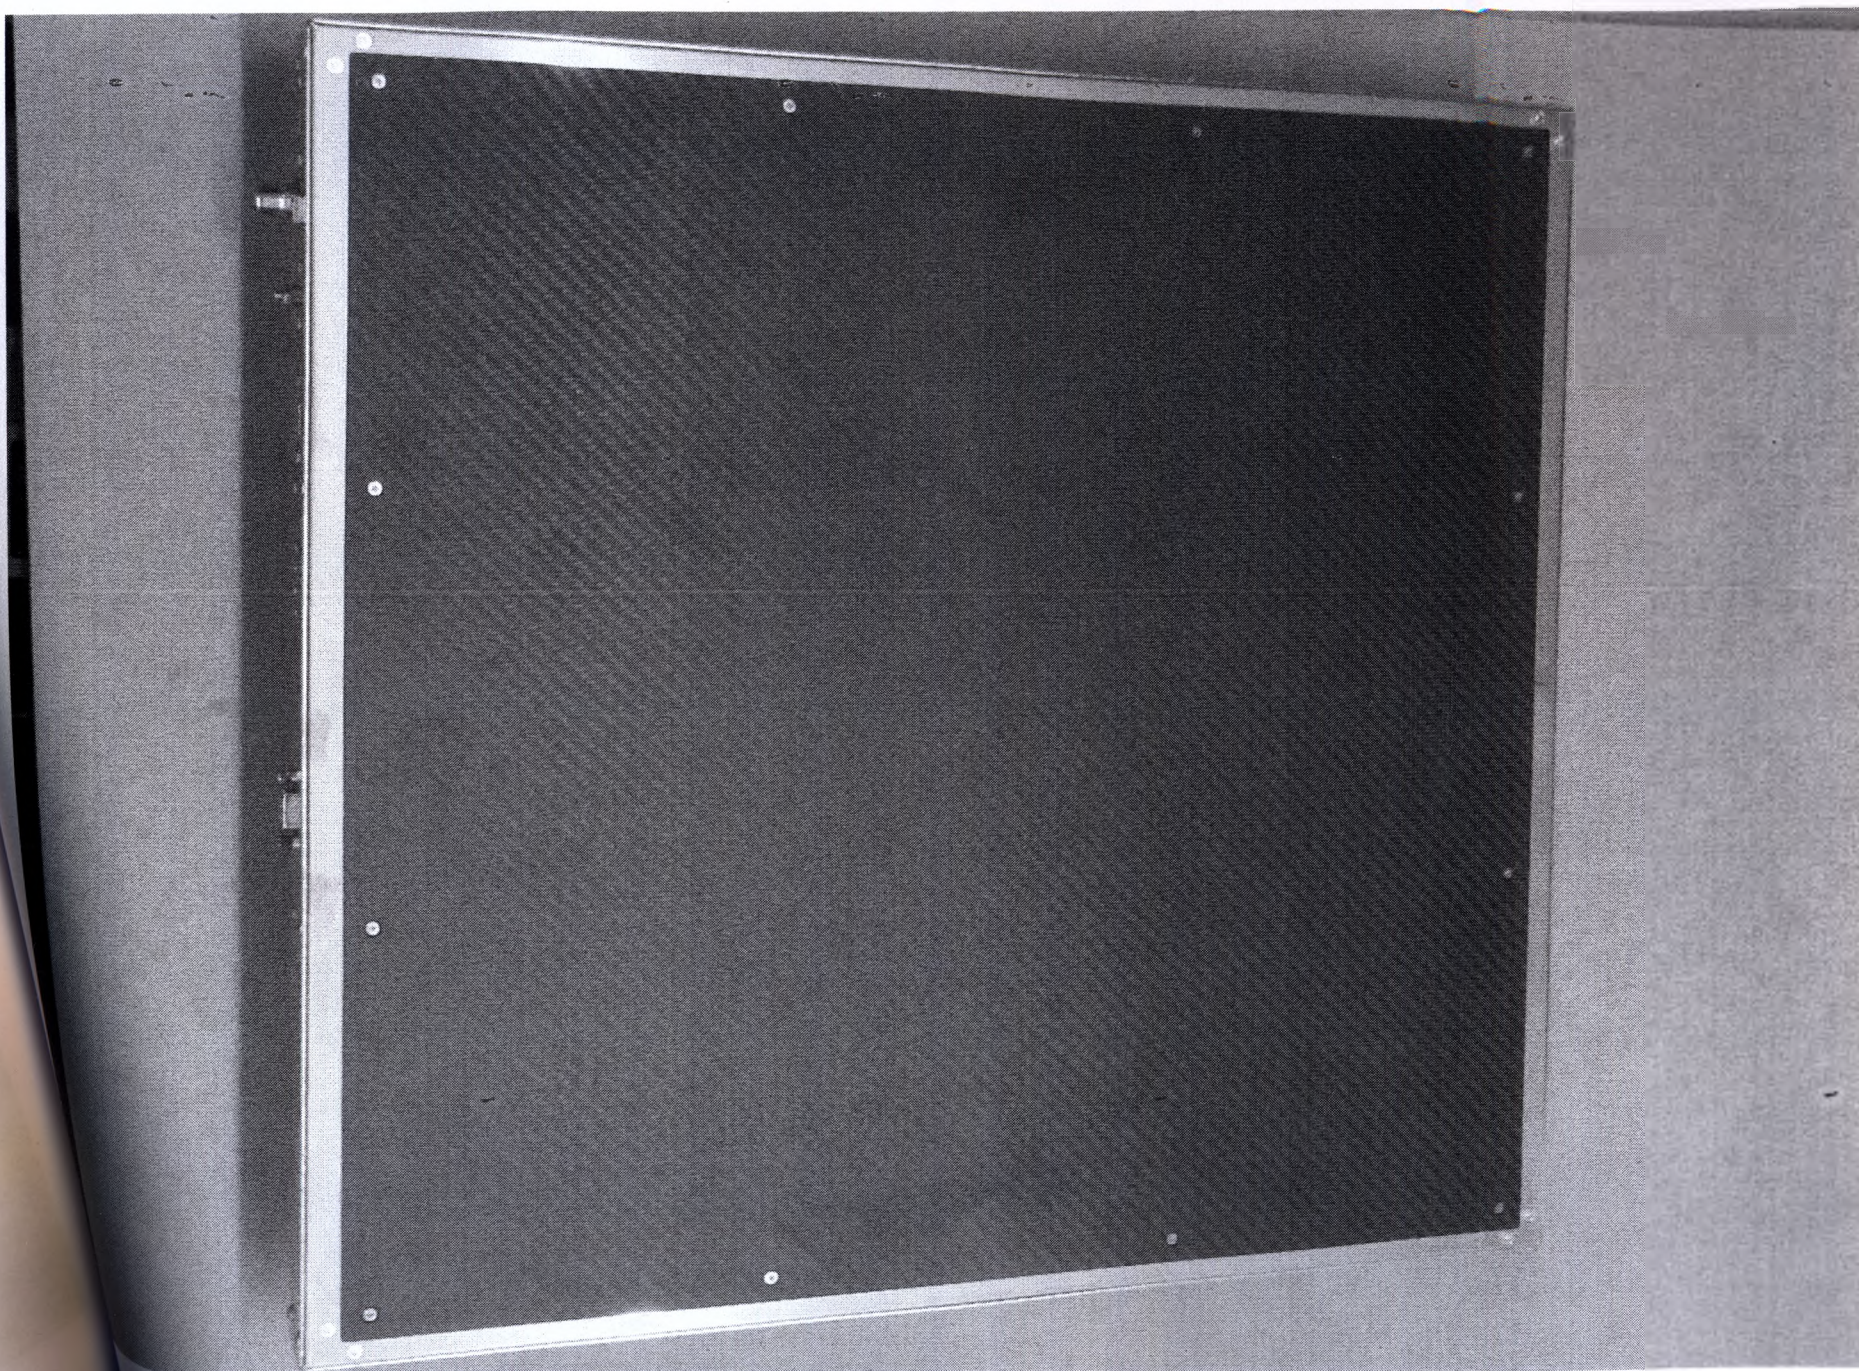


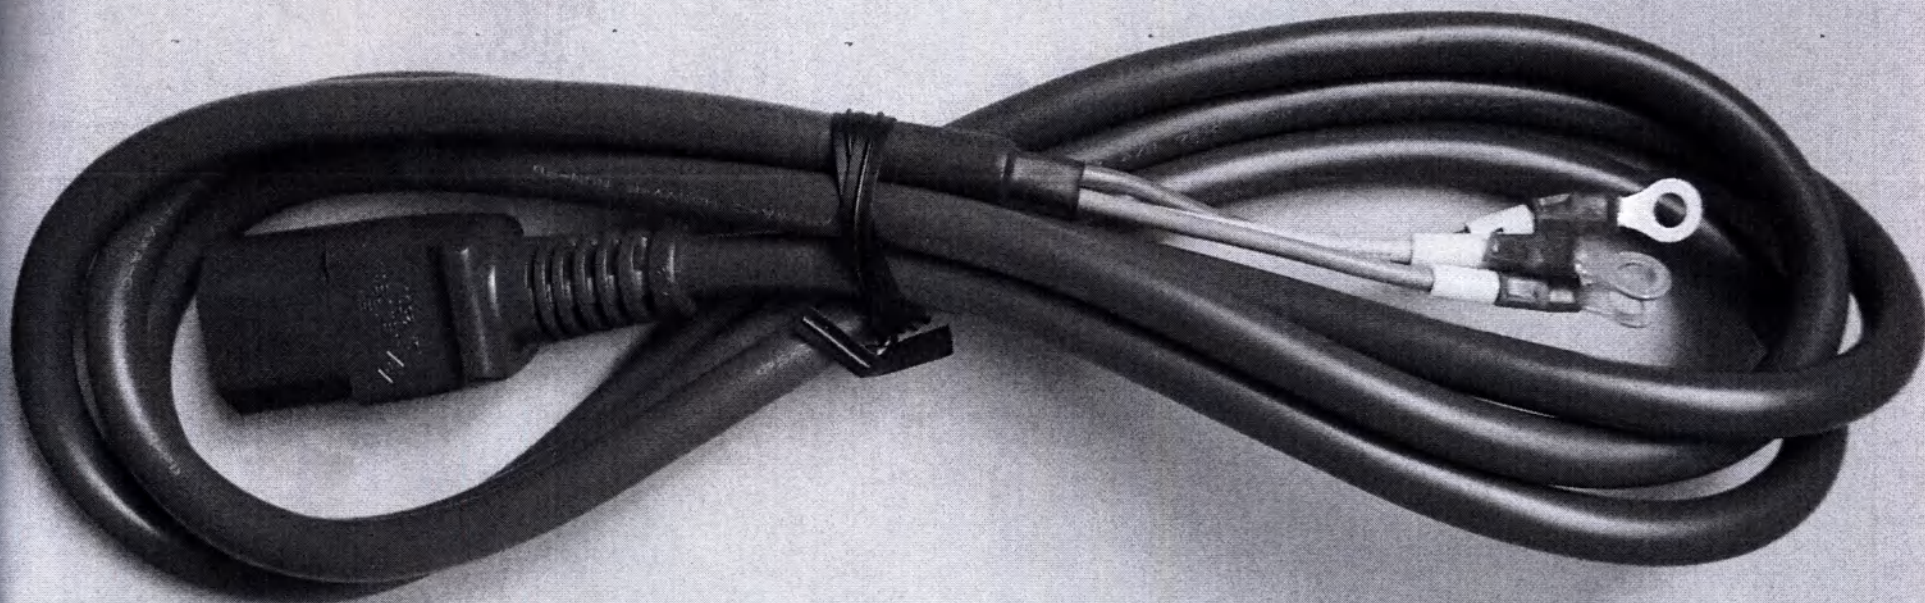


Кабель питания



Кабель заземляющий

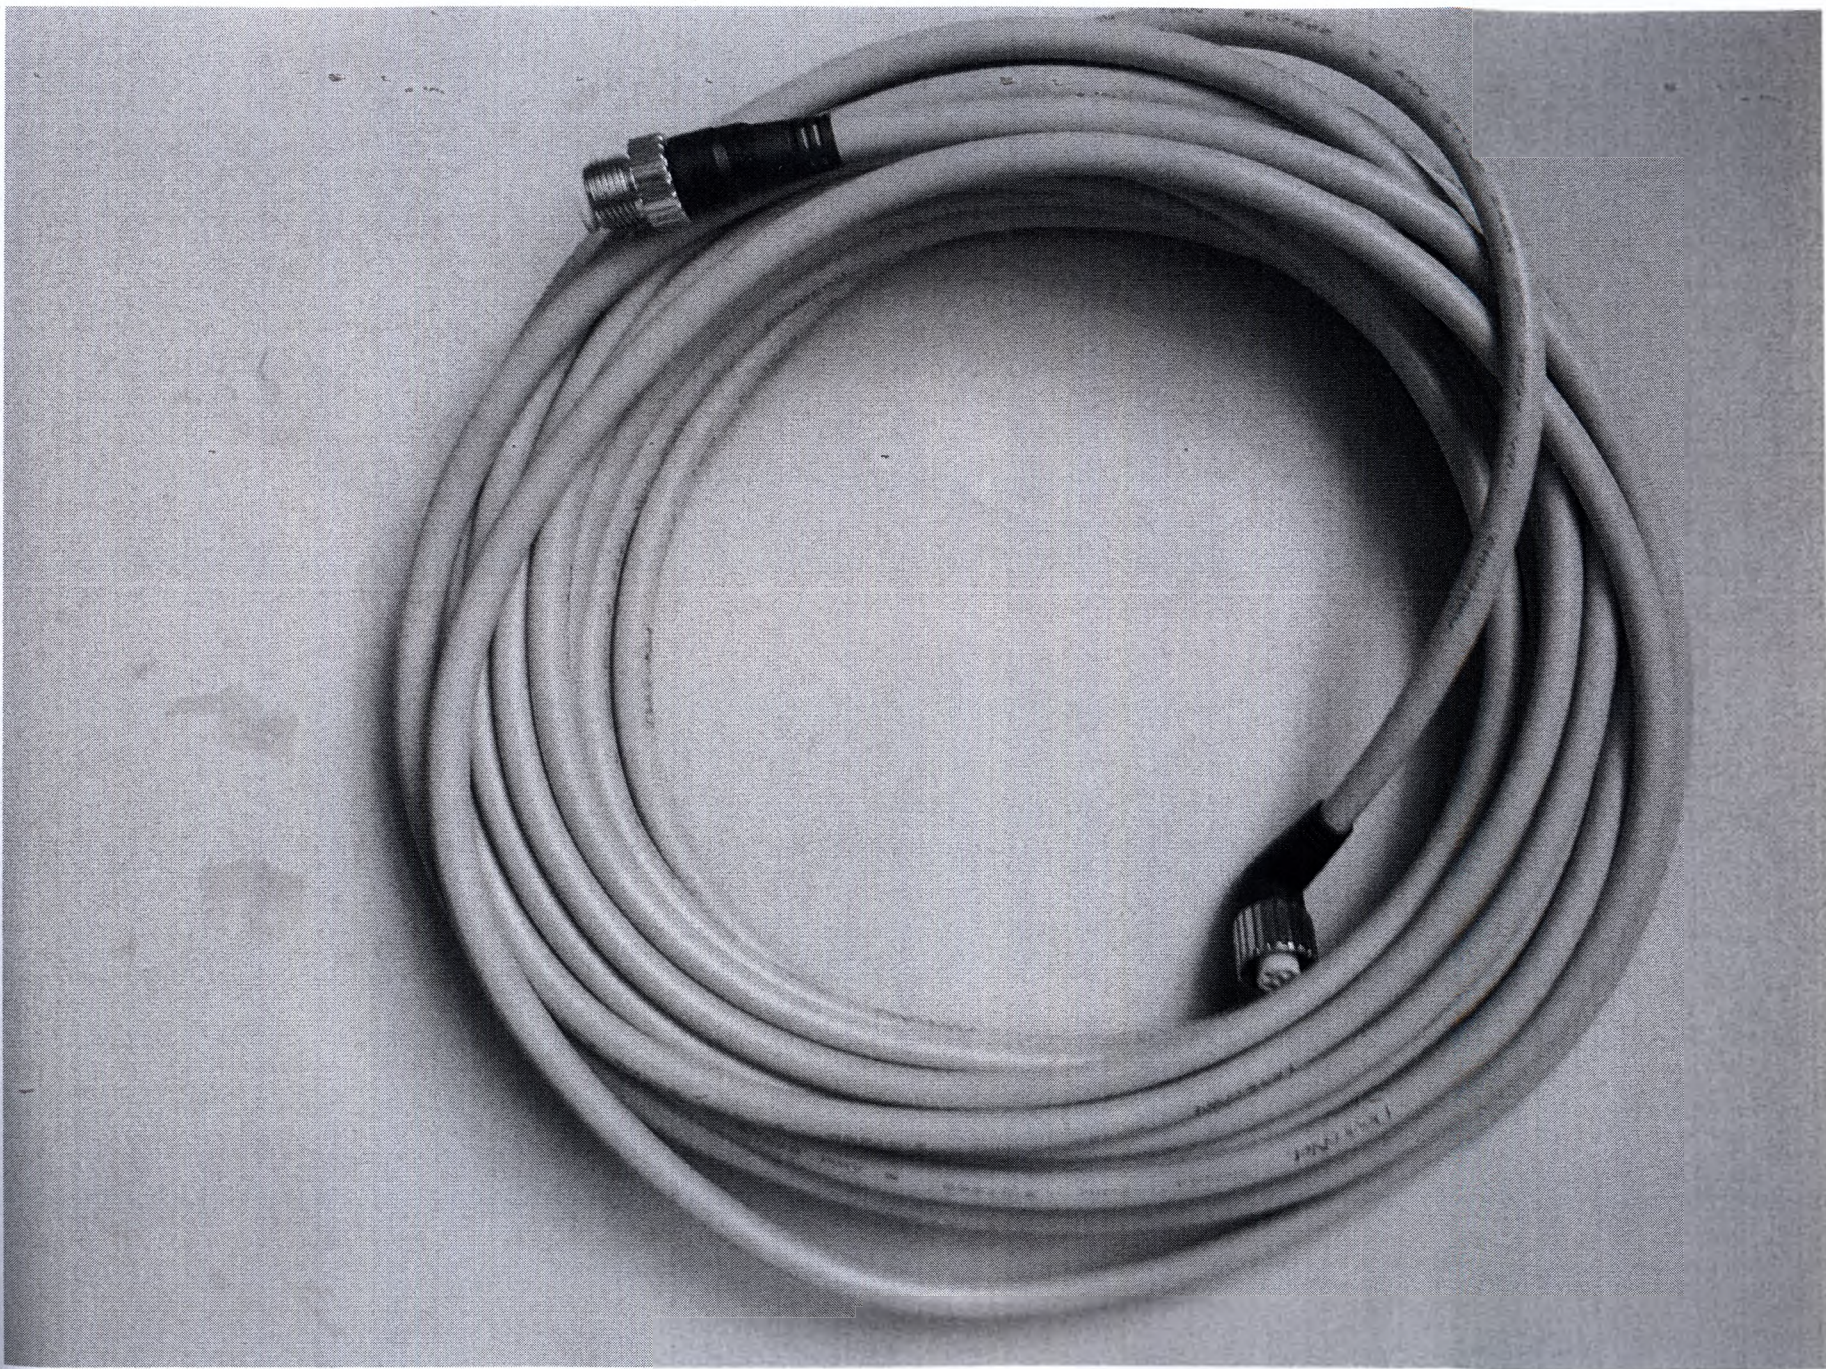

Кабель «детектор – блок питания»

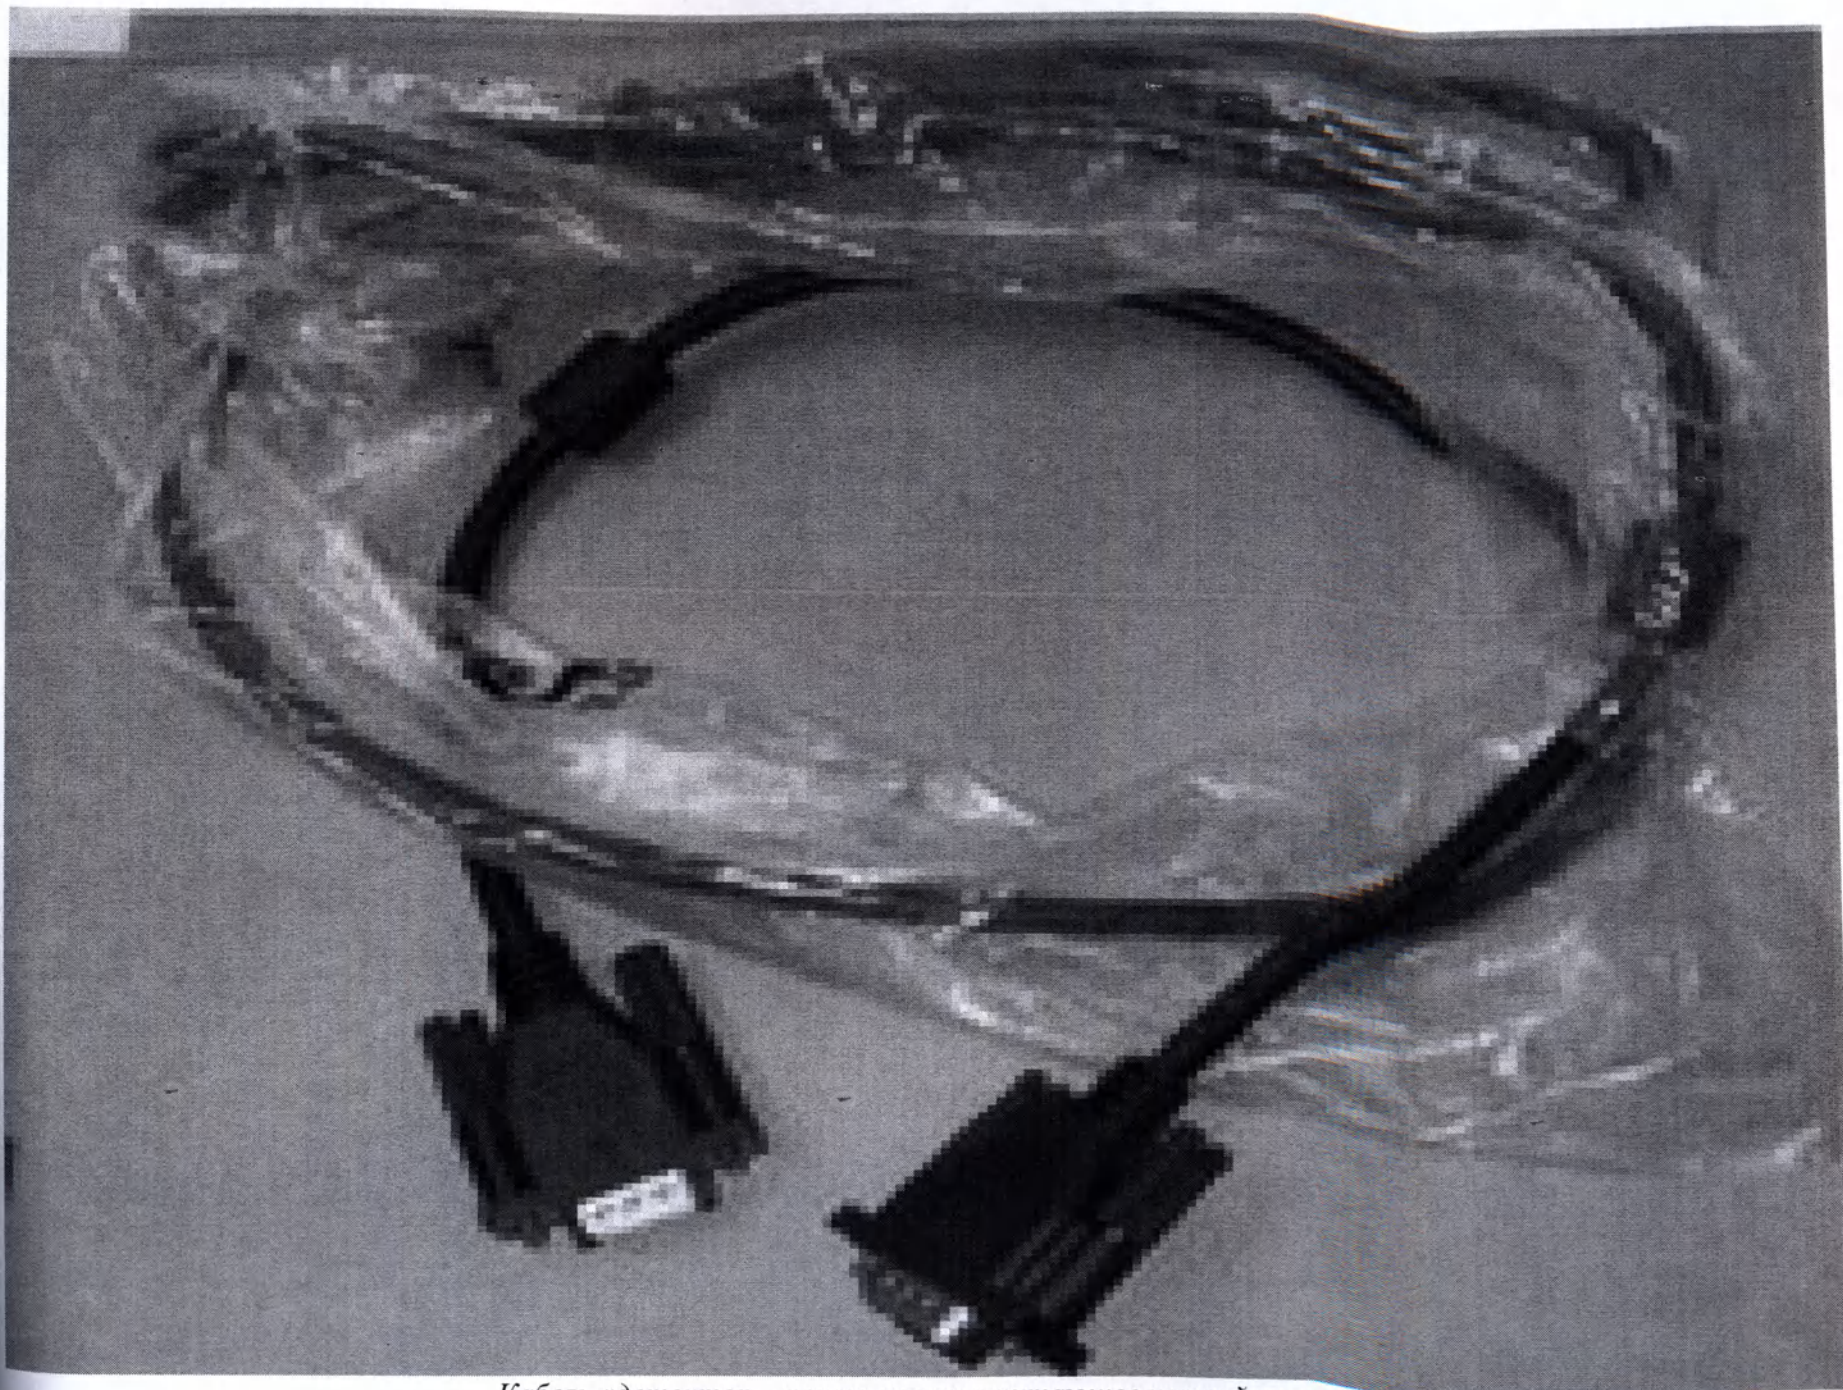

Кабель «детектор – рентгеновское питающее устройство»»



Model: FDX4343R
Serial: 16A102R

CD-диск

Генеральный директор
ООО «Рен Инн Мед»

Прошито и пронумеровано 23 листов



Обернин В.Ф.