

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Медтроник»



Плясунова Е.В.
2015 г.

Фотографические изображения

Система почечного стента для быстрой замены (RX) Nirrosamprus, с иглой



Hipocampus
Renal RX Stent System

REF: 2014-12
LOT: 1F038038

7.0 mm
15 mm
145 cm
6 F
5
0.014"

NP / RBP 8 / 14 bar

INATEC



Hipocampus
Renal RX Stent System

REF: 2014-12
LOT: 1F038038

7.0 mm
15 mm
145 cm
6 F
5
0.014"

NP / RBP 8 / 14 bar

INATEC



Hipocampus
Renal RX Stent System

REF: 2014-12
LOT: 1F038038

7.0 mm
15 mm
145 cm
6 F
5
0.014"

NP / RBP 8 / 14 bar

INATEC

INVATEC HIPPOCAMPUS Renal RX Stent

INVATEC HIPPOCAMPUS Renal RX Stent

INVATEC HIPPOCAMPUS Renal RX Stent

INVATEC HIPPOCAMPUS Renal RX Stent

REF: HPP070180145

LOT: 17038038

2017-12-28

CE 0124

INVATEC

INVATEC HIPPOCAMPUS Renal RX Stent

7.0 x 15 145

REF: HPP070180145

LOT: 17038038

2017-12-28

Content

REF: HPP070180145

LOT: 17038038

2017-12-28

1F038038

1

7.0 mm

15 mm

145 cm

6 F

5 F

0.014"

8 / 14 bar

INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent

INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent

INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent


INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent

INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent

INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent

INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent


INVATEC - HIPPOCAMPUS - Renal RX Stent

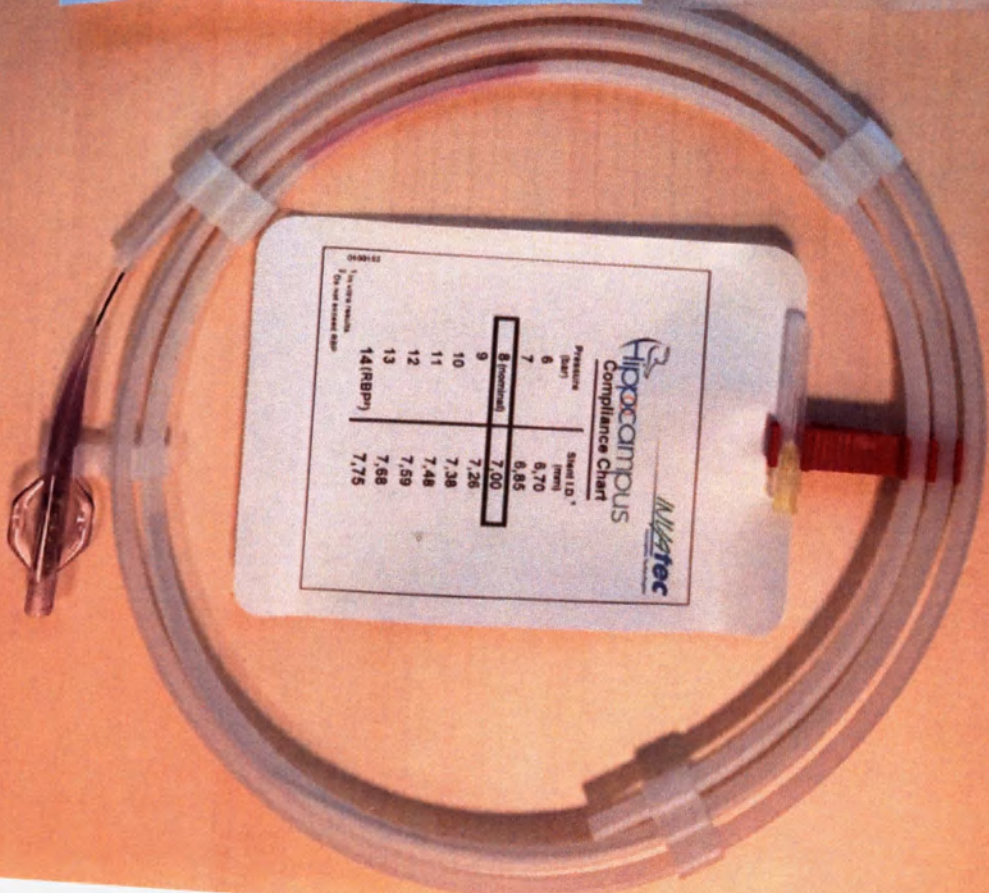

Hippocampus Compliance Chart

Pressure (bar)	Stent I.D. (mm)
6	8.70
7	8.85
8 (Nominal)	7.00
9	7.26
10	7.36
11	7.48
12	7.59
13	7.68
14 (RBP)	7.75

Система почечного стента для быстрой замены (RX) Hiprosampus, с иглой:
номинальный диаметр стента (мм) 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7; номинальная длина стента
(мм) 10, 15, 20, 24; рабочая длина катетера (см) 80, 145.

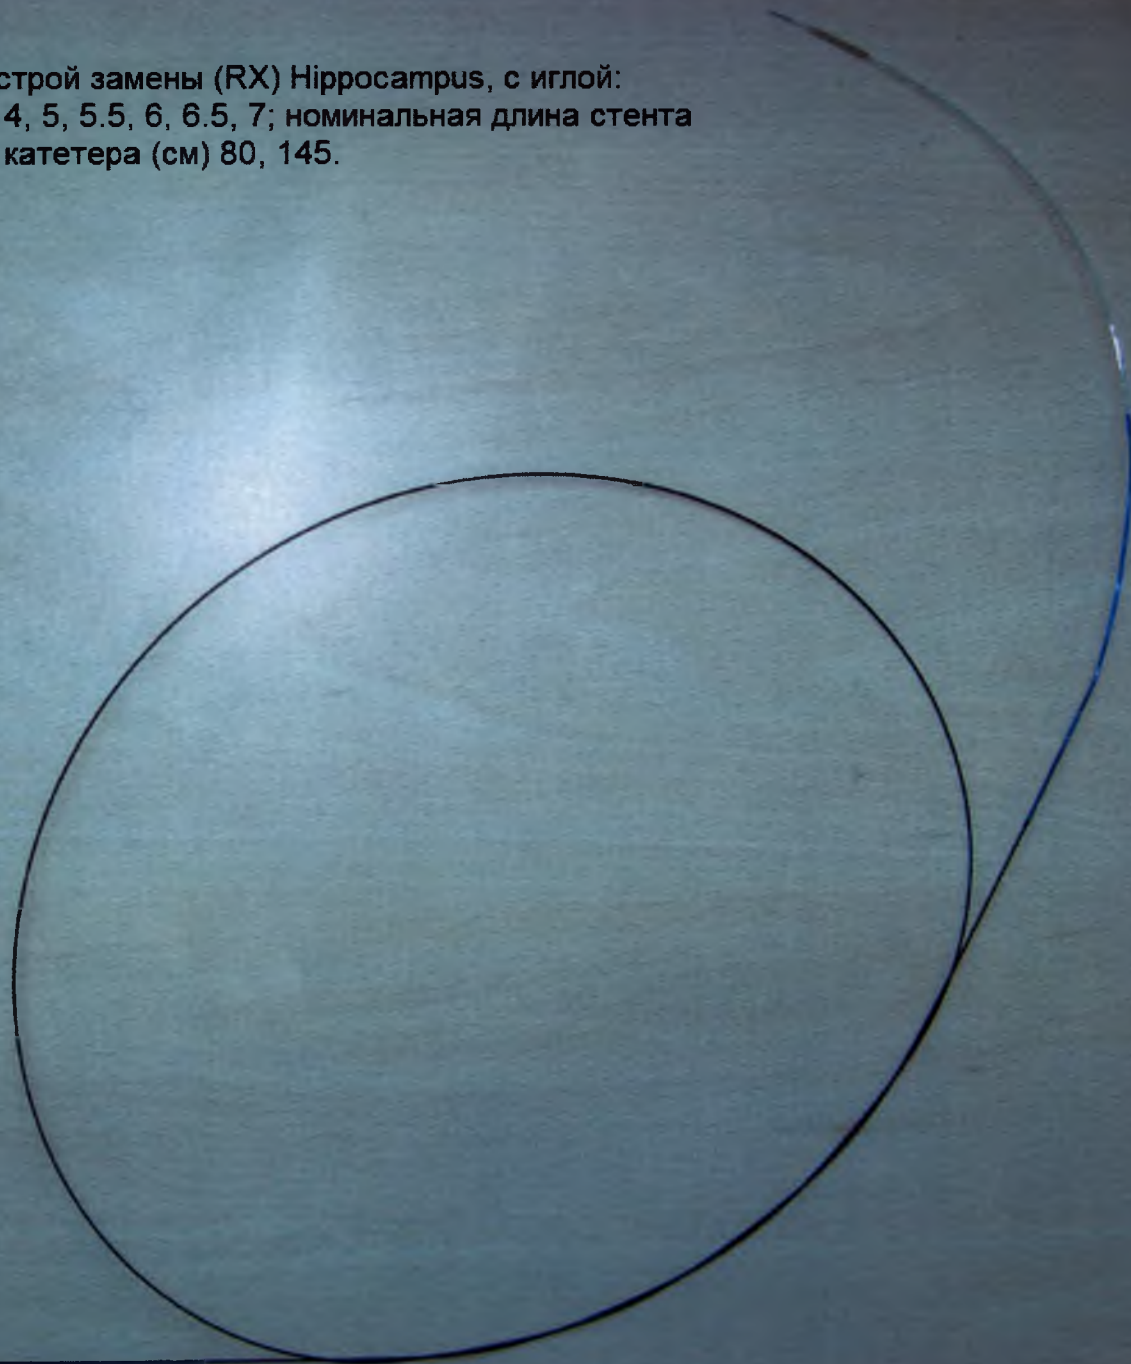

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Метроник»
4 листа(ов)

