


Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Варианты исполнения:

FOV418-18-135-3-12; FOV418-18-135-3-16; FOV418-18-135-3-20; FOV418-18-135-3-24; FOV418-18-135-3-30; FOV418-18-135-4-12; FOV418-18-135-4-16; FOV418-18-135-4-20; FOV418-18-135-4-24; FOV418-18-135-4-30; FOV418-18-135-5-12; FOV418-18-135-5-16; FOV418-18-135-5-20; FOV418-18-135-5-24; FOV418-18-135-5-30; FOV418-18-135-6-12; FOV418-18-135-6-16; FOV418-18-135-6-20; FOV418-18-135-6-24; FOV418-18-135-6-30; FOV418-18-135-7-12; FOV418-18-135-7-16; FOV418-18-135-7-20; FOV418-18-135-7-24; FOV418-18-135-7-30; FOV418-18-135-8-12; FOV418-18-135-8-16; FOV418-18-135-8-20; FOV418-18-135-8-24; FOV418-18-135-8-30; FOV418-18-80-3-12; FOV418-18-80-3-16; FOV418-18-80-3-20; FOV418-18-80-3-24; FOV418-18-80-3-30; FOV418-18-80-4-12; FOV418-18-80-4-16; FOV418-18-80-4-20; FOV418-18-80-4-24; FOV418-18-80-4-30; FOV418-18-80-5-12; FOV418-18-80-5-16; FOV418-18-80-5-20; FOV418-18-80-5-24; FOV418-18-80-5-30; FOV418-18-80-6-12; FOV418-18-80-6-16; FOV418-18-80-6-20; FOV418-18-80-6-24; FOV418-18-80-6-30; FOV418-18-80-7-12; FOV418-18-80-7-16; FOV418-18-80-7-20; FOV418-18-80-7-24; FOV418-18-80-7-30; FOV418-18-80-8-12; FOV418-18-80-8-16; FOV418-18-80-8-20; FOV418-18-80-8-24; FOV418-18-80-8-30.



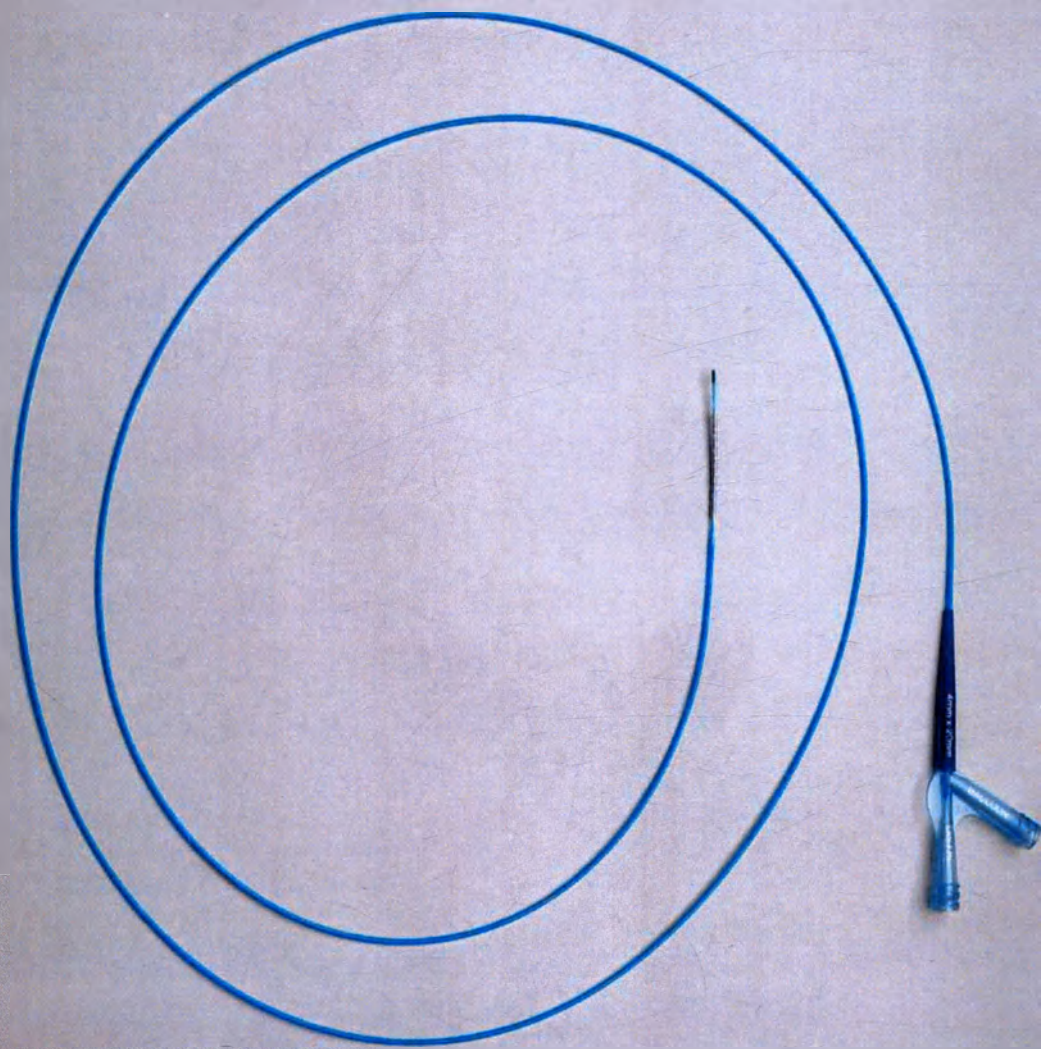

www.cookmedical.com

Formula 418*

Maximal Reductio Expositio Gress

REF: F0V418-18-135-3-12

REF: 054434



F0V418-18-135-3-12

Maximal Reductio Expositio Gress

REF: F0V418-18-135-3-12

REF: 054434



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Варианты исполнения:

FOV535-35-135-10-20; FOV535-35-135-10-30; FOV535-35-135-10-40; FOV535-35-135-10-60; FOV535-35-135-4-12; FOV535-35-135-4-16; FOV535-35-135-4-20; FOV535-35-135-4-24; FOV535-35-135-4-30; FOV535-35-135-4-40; FOV535-35-135-4-60; FOV535-35-135-5-12; FOV535-35-135-5-16; FOV535-35-135-5-20; FOV535-35-135-5-24; FOV535-35-135-5-30; FOV535-35-135-5-40; FOV535-35-135-5-60; FOV535-35-135-6-12; FOV535-35-135-6-16; FOV535-35-135-6-20; FOV535-35-135-6-24; FOV535-35-135-6-30; FOV535-35-135-6-40; FOV535-35-135-6-60; FOV535-35-135-7-12; FOV535-35-135-7-16; FOV535-35-135-7-20; FOV535-35-135-7-24; FOV535-35-135-7-30; FOV535-35-135-7-40; FOV535-35-135-7-60; FOV535-35-135-8-12; FOV535-35-135-8-16; FOV535-35-135-8-20; FOV535-35-135-8-24; FOV535-35-135-8-30; 38; FOV535-35-135-8-40; FOV535-35-135-8-60; FOV535-35-135-9-20; FOV535-35-135-9-30; FOV535-35-135-9-40; FOV535-35-135-9-60; FOV535-35-80-10-20; FOV535-35-80-10-30; FOV535-35-80-10-40; FOV535-35-80-10-60; FOV535-35-80-12-20; FOV535-35-80-12-30; FOV535-35-80-12-40; FOV535-35-80-12-60; FOV535-35-80-4-12; FOV535-35-80-4-16; FOV535-35-80-4-20; FOV535-35-80-4-24; FOV535-35-80-4-30; FOV535-35-80-4-40; FOV535-35-80-4-60; FOV535-35-80-5-12; FOV535-35-80-5-16; FOV535-35-80-5-20; FOV535-35-80-5-24; FOV535-35-80-5-30; FOV535-35-80-5-40; FOV535-35-80-5-60; FOV535-35-80-6-12; FOV535-35-80-6-16; FOV535-35-80-6-20; FOV535-35-80-6-24; FOV535-35-80-6-30; FOV535-35-80-7-40; FOV535-35-80-6-60; FOV535-35-80-7-12; FOV535-35-80-7-16; FOV535-35-80-7-20; FOV535-35-80-7-24; FOV535-35-80-7-30; FOV535-35-80-7-40; FOV535-35-80-7-60; FOV535-35-80-8-12; FOV535-35-80-8-16; FOV535-35-80-8-20; FOV535-35-80-8-24; FOV535-35-80-8-30; FOV535-35-80-8-40; FOV535-35-80-8-60; FOV535-35-80-9-20; FOV535-35-80-9-30; FOV535-35-80-9-40; FOV535-35-80-9-60.

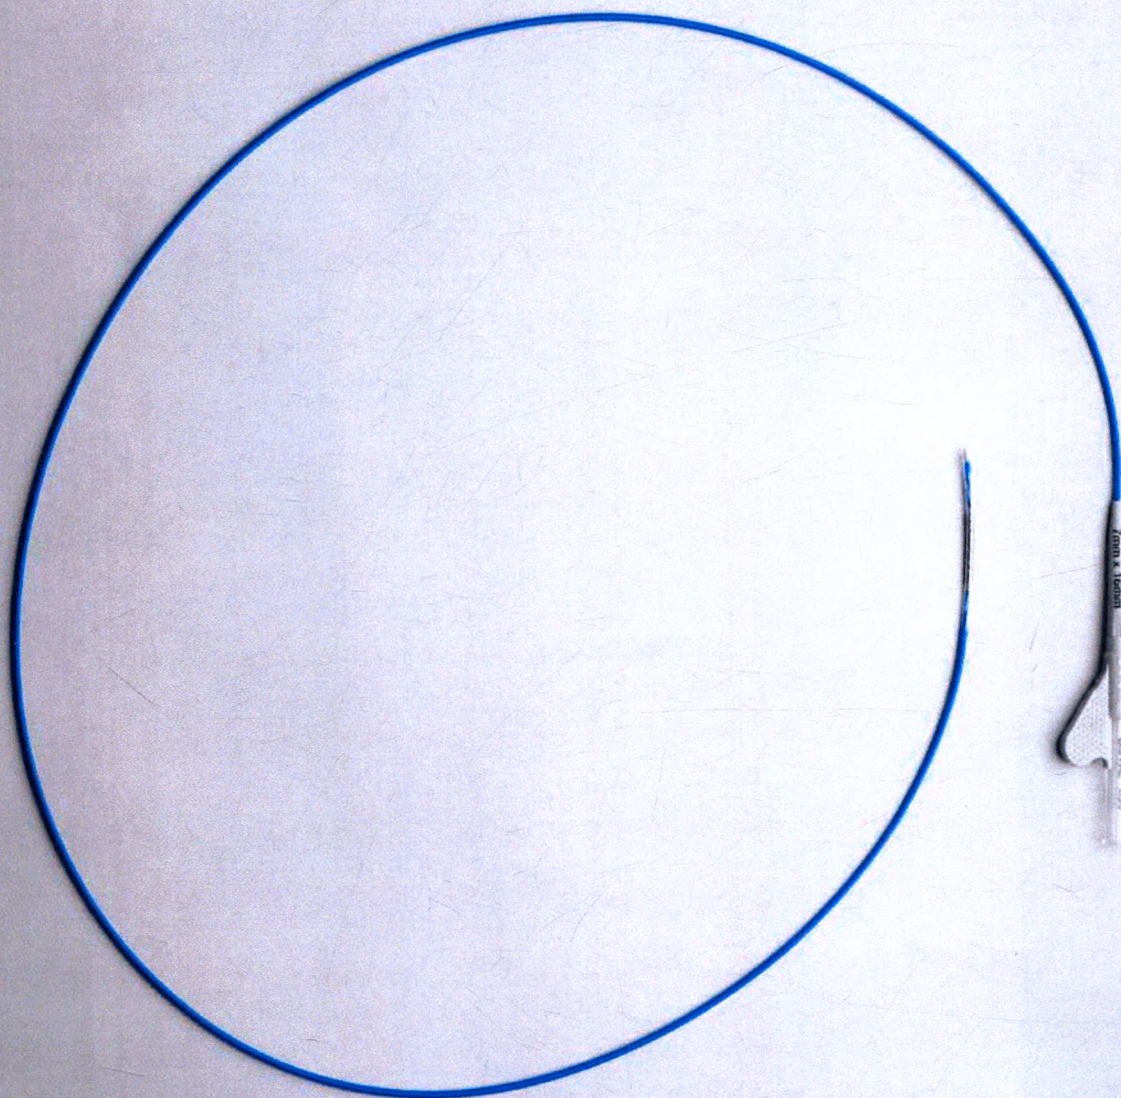

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Варианты исполнения:

FORX4-14-135-5-12; FORX4-14-135-5-16; FORX4-14-135-5-20; FORX4-14-135-5-24; FORX4-14-135-6-12; FORX4-14-135-6-16; FORX4-14-135-6-20; FORX4-14-135-6-24; FORX4-14-135-7-12; FORX4-14-135-7-16; FORX4-14-135-7-20; FORX4-14-135-7-24; FORX4-14-80-5-12; FORX4-14-80-5-16; FORX4-14-80-5-20; FORX4-14-80-5-24; FORX4-14-80-6-12; FORX4-14-80-6-16; FORX4-14-80-6-20; FORX4-14-80-6-24; FORX4-14-80-7-12; FORX4-14-80-7-16; FORX4-14-80-7-20; FORX4-14-80-7-24; FOVX414-14-135-4-12; FOVX414-14-135-4-16; FOVX414-14-135-4-20; FOVX414-14-135-4-24; FOVX414-14-135-5-12; FOVX414-14-135-5-16; FOVX414-14-135-5-20; FOVX414-14-135-5-24; FOVX414-14-135-6-12; FOVX414-14-135-6-16; FOVX414-14-135-6-20; FOVX414-14-135-6-24; FOVX414-14-135-7-12; FOVX414-14-135-7-16; FOVX414-14-135-7-20; FOVX414-14-135-7-24; FOVX414-14-80-4-12; FOVX414-14-80-4-16; FOVX414-14-80-4-20; FOVX414-14-80-4-24; FOVX414-14-80-5-12; FOVX414-14-80-5-16; FOVX414-14-80-5-20; FOVX414-14-80-5-24; FOVX414-14-80-6-12; FOVX414-14-80-6-16; FOVX414-14-80-6-20; FOVX414-14-80-6-24; FOVX414-14-80-7-12; FOVX414-14-80-7-16; FOVX414-14-80-7-20; FOVX414-14-80-7-24.

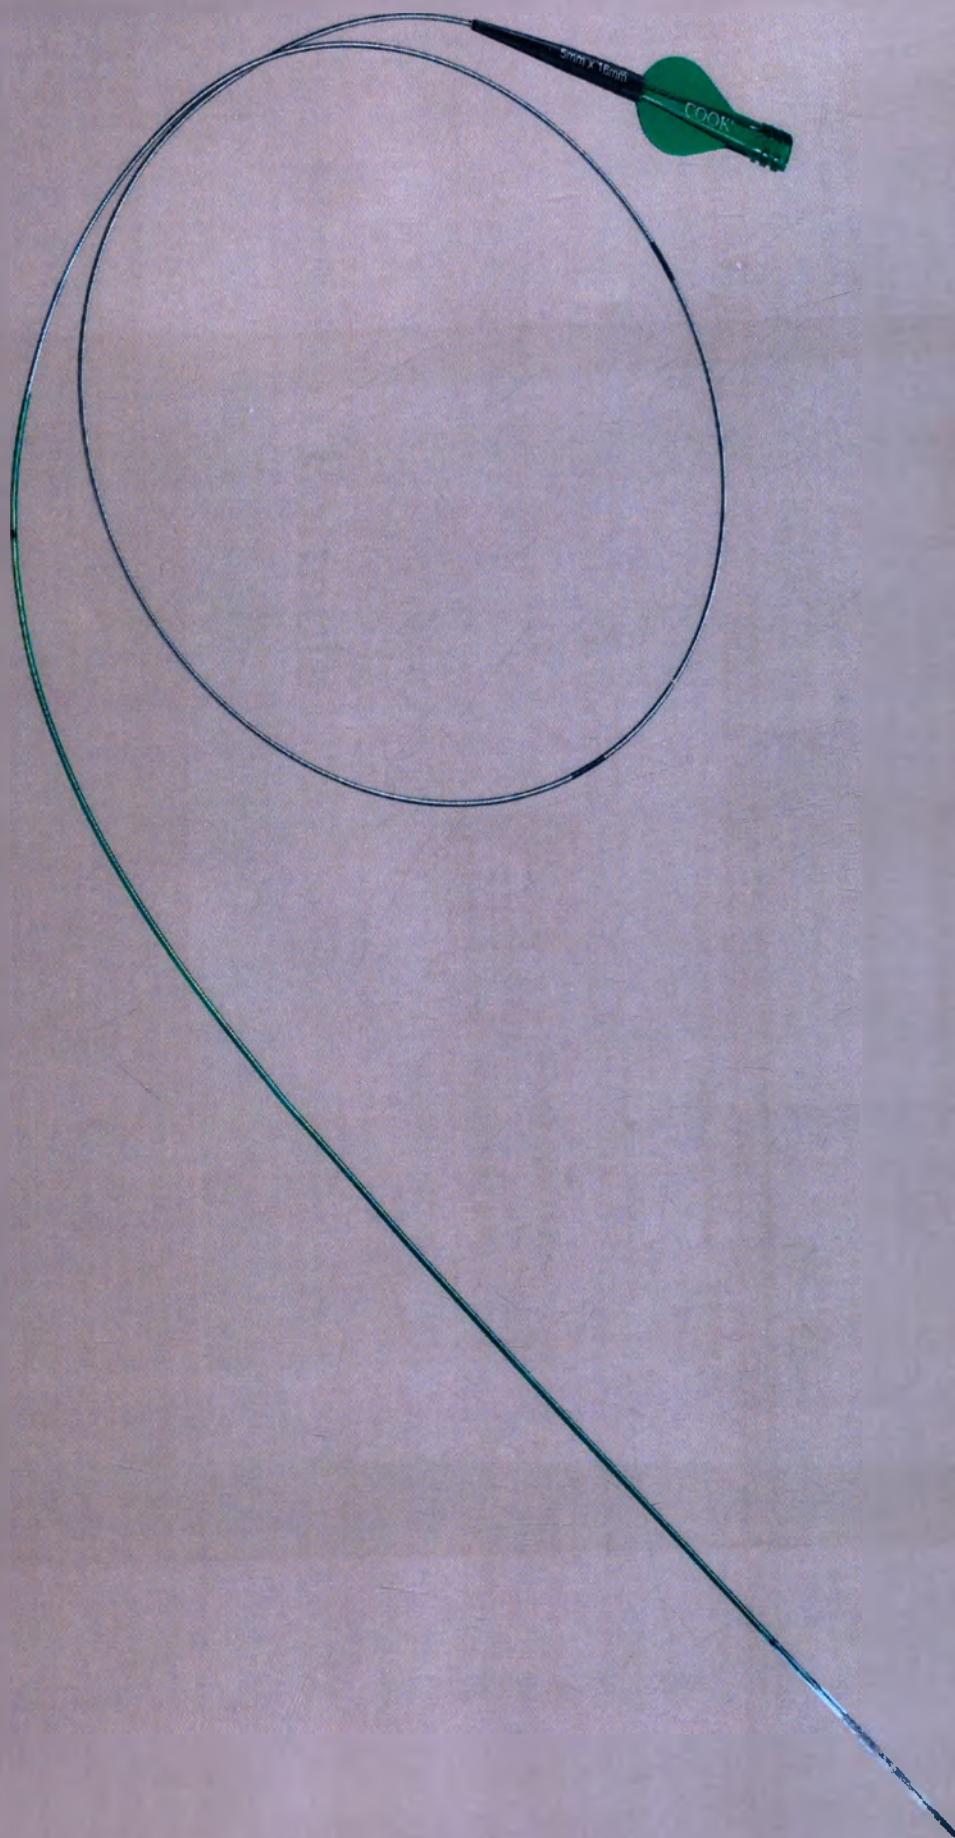




Formula™ 414 Rx

Renal Balloon-Expandable Stent

REF FORX4-14-135-5-12

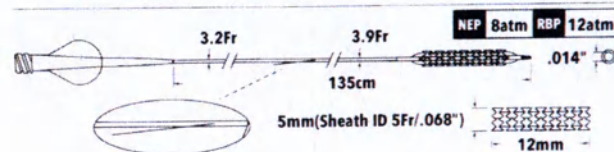

Rx only



William Cook Europe ApS
Sønderø, DK 6832
Ballerupvej 100
MADE IN DENMARK
www.cookmedical.com




www.cookmedical.com



COOLINK 1

Formula™

BALLOON-EXPANDABLE STENT



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Варианты исполнения: ZVT7-35-80-14-6.0; ZVT7-35-80-14-10.0; ZVT7-35-80-14-14.0; ZVT7-35-80-16-6.0; ZVT7-35-80-16-10.0; ZVT7-35-80-16-14.0; ZVT7-35-120-14-6.0; ZVT7-35-120-14-10.0; ZVT7-35-120-14-14.0; ZVT7-35-120-16-6.0; ZVT7-35-120-16-10.0; ZVT7-35-120-16-14.0.

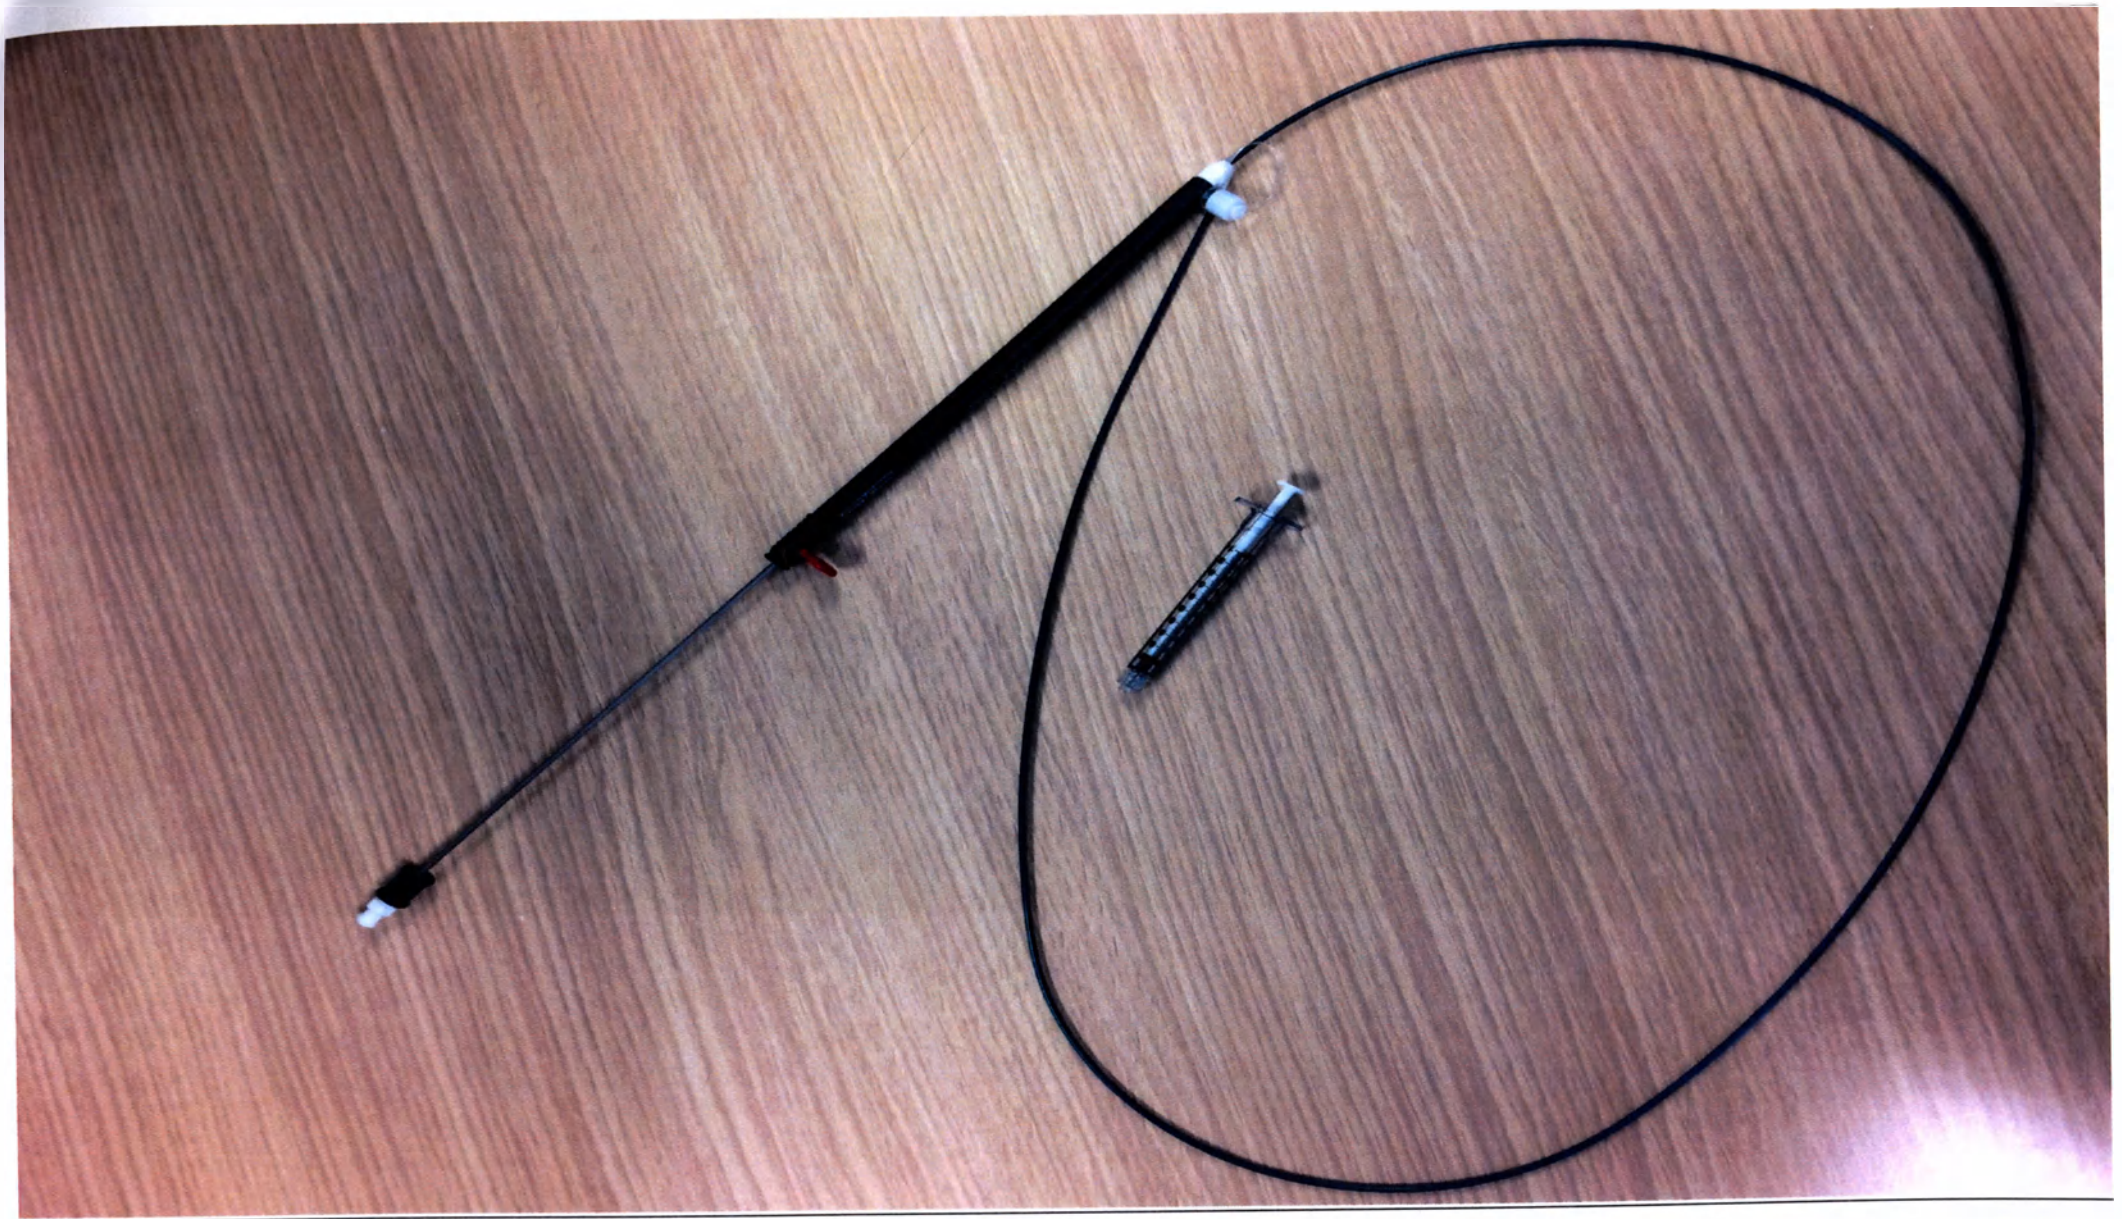

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



аты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения
арианты исполнения:

ZFV6-125-5-2.0; ZFV6-125-5-3.0; ZFV6-125-5-4.0; ZFV6-125-5-6.0; ZFV6-125-5-8.0; ZFV6-125-5-10.0; ZFV6-125-5-12.0; ZFV6-125-5-14.0; ZFV6-125-6-2.0; ZFV6-125-6-3.0; ZFV6-125-6-4.0; ZFV6-125-6-6.0; ZFV6-125-6-8.0; ZFV6-125-6-10.0; ZFV6-125-6-12.0; ZFV6-125-6-14.0; ZFV6-125-7-2.0; ZFV6-125-7-3.0; ZFV6-125-7-4.0;
ZFV6-125-7-6.0; ZFV6-125-7-8.0; ZFV6-125-7-10.0; ZFV6-125-7-12.0; ZFV6-125-7-14.0; ZFV6-125-8-2.0; ZFV6-125-8-3.0; ZFV6-125-8-4.0; ZFV6-125-8-6.0; ZFV6-125-8-8.0; ZFV6-125-8-10.0; ZFV6-125-8-12.0; ZFV6-125-8-14.0; ZFV6-125-9-2.0; ZFV6-125-9-4.0; ZFV6-125-9-6.0; ZFV6-125-9-8.0; ZFV6-125-9-10.0; ZFV6-125-9-12.0; ZFV6-125-9-14.0; ZFV6-125-10-2.0; ZFV6-125-10-4.0; ZFV6-125-10-6.0; ZFV6-125-10-8.0; ZFV6-125-10-10.0; ZFV6-125-10-12.0; ZFV6-125-10-14.0; ZFV6-125-5-17.0; ZFV6-125-5-20.0; ZFV6-125-6-17.0; ZFV6-125-6-20.0; ZFV6-125-7-17.0; ZFV6-125-7-20.0; ZFV6-125-8-17.0; ZFV6-125-8-20.0; ZFV6-80-5-2.0; ZFV6-80-5-3.0; ZFV6-80-5-4.0; ZFV6-80-5-6.0; ZFV6-80-5-8.0; ZFV6-80-5-10.0; ZFV6-80-5-12.0; ZFV6-80-5-14.0; ZFV6-80-6-2.0; ZFV6-80-6-3.0; ZFV6-80-6-4.0; ZFV6-80-6-6.0; ZFV6-80-6-8.0; ZFV6-80-6-10.0; ZFV6-80-6-12.0; ZFV6-80-6-14.0; ZFV6-80-7-2.0; ZFV6-80-7-3.0; ZFV6-80-7-4.0; ZFV6-80-7-6.0; ZFV6-80-7-8.0; ZFV6-80-7-10.0; ZFV6-80-7-12.0; ZFV6-80-7-14.0; ZFV6-80-8-2.0; ZFV6-80-8-3.0; ZFV6-80-8-4.0; ZFV6-80-8-6.0; ZFV6-80-8-8.0; ZFV6-80-8-10.0; ZFV6-80-8-12.0; ZFV6-80-8-14.0; ZFV6-80-9-2.0; ZFV6-80-9-3.0; ZFV6-80-9-4.0; ZFV6-80-9-6.0; ZFV6-80-9-8.0; ZFV6-80-9-10.0; ZFV6-80-9-12.0; ZFV6-80-9-14.0; ZFV6-80-10-10.0; ZFV6-80-10-12.0; ZFV6-80-10-14.0; ZFV6-80-10-3.0; ZFV6-80-10-4.0; ZFV6-80-10-6.0; ZFV6-80-10-8.0; ZFV6-80-10-2.0; ZFV6-80-5-17.0; ZFV6-80-5-20.0; ZFV6-80-6-17.0; ZFV6-80-6-20.0; ZFV6-80-7-17.0; ZFV6-80-8-17.0; ZFV6-80-8-20.0; ZFV6-80-7-20.0.



COOK
MEDICAL

COOK MEDICAL



Zilver® Flex™ 35 Vascular Stent
Self-Expanding Stent

REF: ZFV6-80-S-10.0

REF: 651864

1018101

5mm x 100mm



COOK
MEDICAL

Manufactured by
Cook Medical Ltd
Parsippany, NJ
Cook Medical Technologies Park
Lombard, Illinois

CE

ZFV6-80-S-10.0

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

REF: 651864

Zilver Flex™

SELF-EXPANDING STENT



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Варианты исполнения:


ZIV5-125-10-2.0; ZIV5-125-10-3.0; ZIV5-125-10-4.0; ZIV5-125-10-6.0; ZIV5-125-10-7.0; 6. Стент ZIV5-125-10-8.0; ZIV5-125-4-2.0; ZIV5-125-4-3.0; ZIV5-125-4-4.0; ZIV5-125-4-6.0; ZIV5-125-4-8.0; ZIV5-125-5-2.0; ZIV5-125-5-3.0; ZIV5-125-5-4.0; ZIV5-125-5-6.0; ZIV5-125-5-8.0; ZIV5-125-6-2.0; ZIV5-125-6-3.0; ZIV5-125-6-4.0; ZIV5-125-6-6.0; ZIV5-125-6-8.0; ZIV5-125-7-2.0; ZIV5-125-7-3.0; ZIV5-125-7-4.0; ZIV5-125-7-6.0; ZIV5-125-7-8.0; ZIV5-125-8-2.0; ZIV5-125-8-3.0; ZIV5-125-8-4.0; ZIV5-125-8-6.0; ZIV5-125-8-8.0; ZIV5-125-9-2.0; ZIV5-125-9-3.0; ZIV5-125-9-4.0; ZIV5-125-9-6.0; ZIV5-125-9-8.0; ZIV5-80-10-2.0; ZIV5-80-10-3.0; ZIV5-80-10-4.0; ZIV5-80-10-6.0; ZIV5-80-10-8.0; ZIV5-80-4-2.0; ZIV5-80-4-3.0; ZIV5-80-4-4.0; ZIV5-80-4-6.0; ZIV5-80-4-8.0; ZIV5-80-5-2.0; ZIV5-80-5-3.0; ZIV5-80-5-4.0; ZIV5-80-5-6.0; ZIV5-80-5-8.0; ZIV5-80-6-2.0; ZIV5-80-6-3.0; ZIV5-80-6-4.0; ZIV5-80-6-6.0; ZIV5-80-6-8.0; ZIV5-80-7-2.0; ZIV5-80-7-3.0; ZIV5-80-7-4.0; ZIV5-80-7-6.0; ZIV5-80-7-8.0; ZIV5-80-8-2.0; ZIV5-80-8-3.0; ZIV5-80-8-4.0; ZIV5-80-8-6.0; ZIV5-80-8-8.0; ZIV5-80-9-2.0; ZIV5-80-9-3.0; ZIV5-80-9-4.0; ZIV5-80-9-6.0; ZIV5-80-9-8.0.

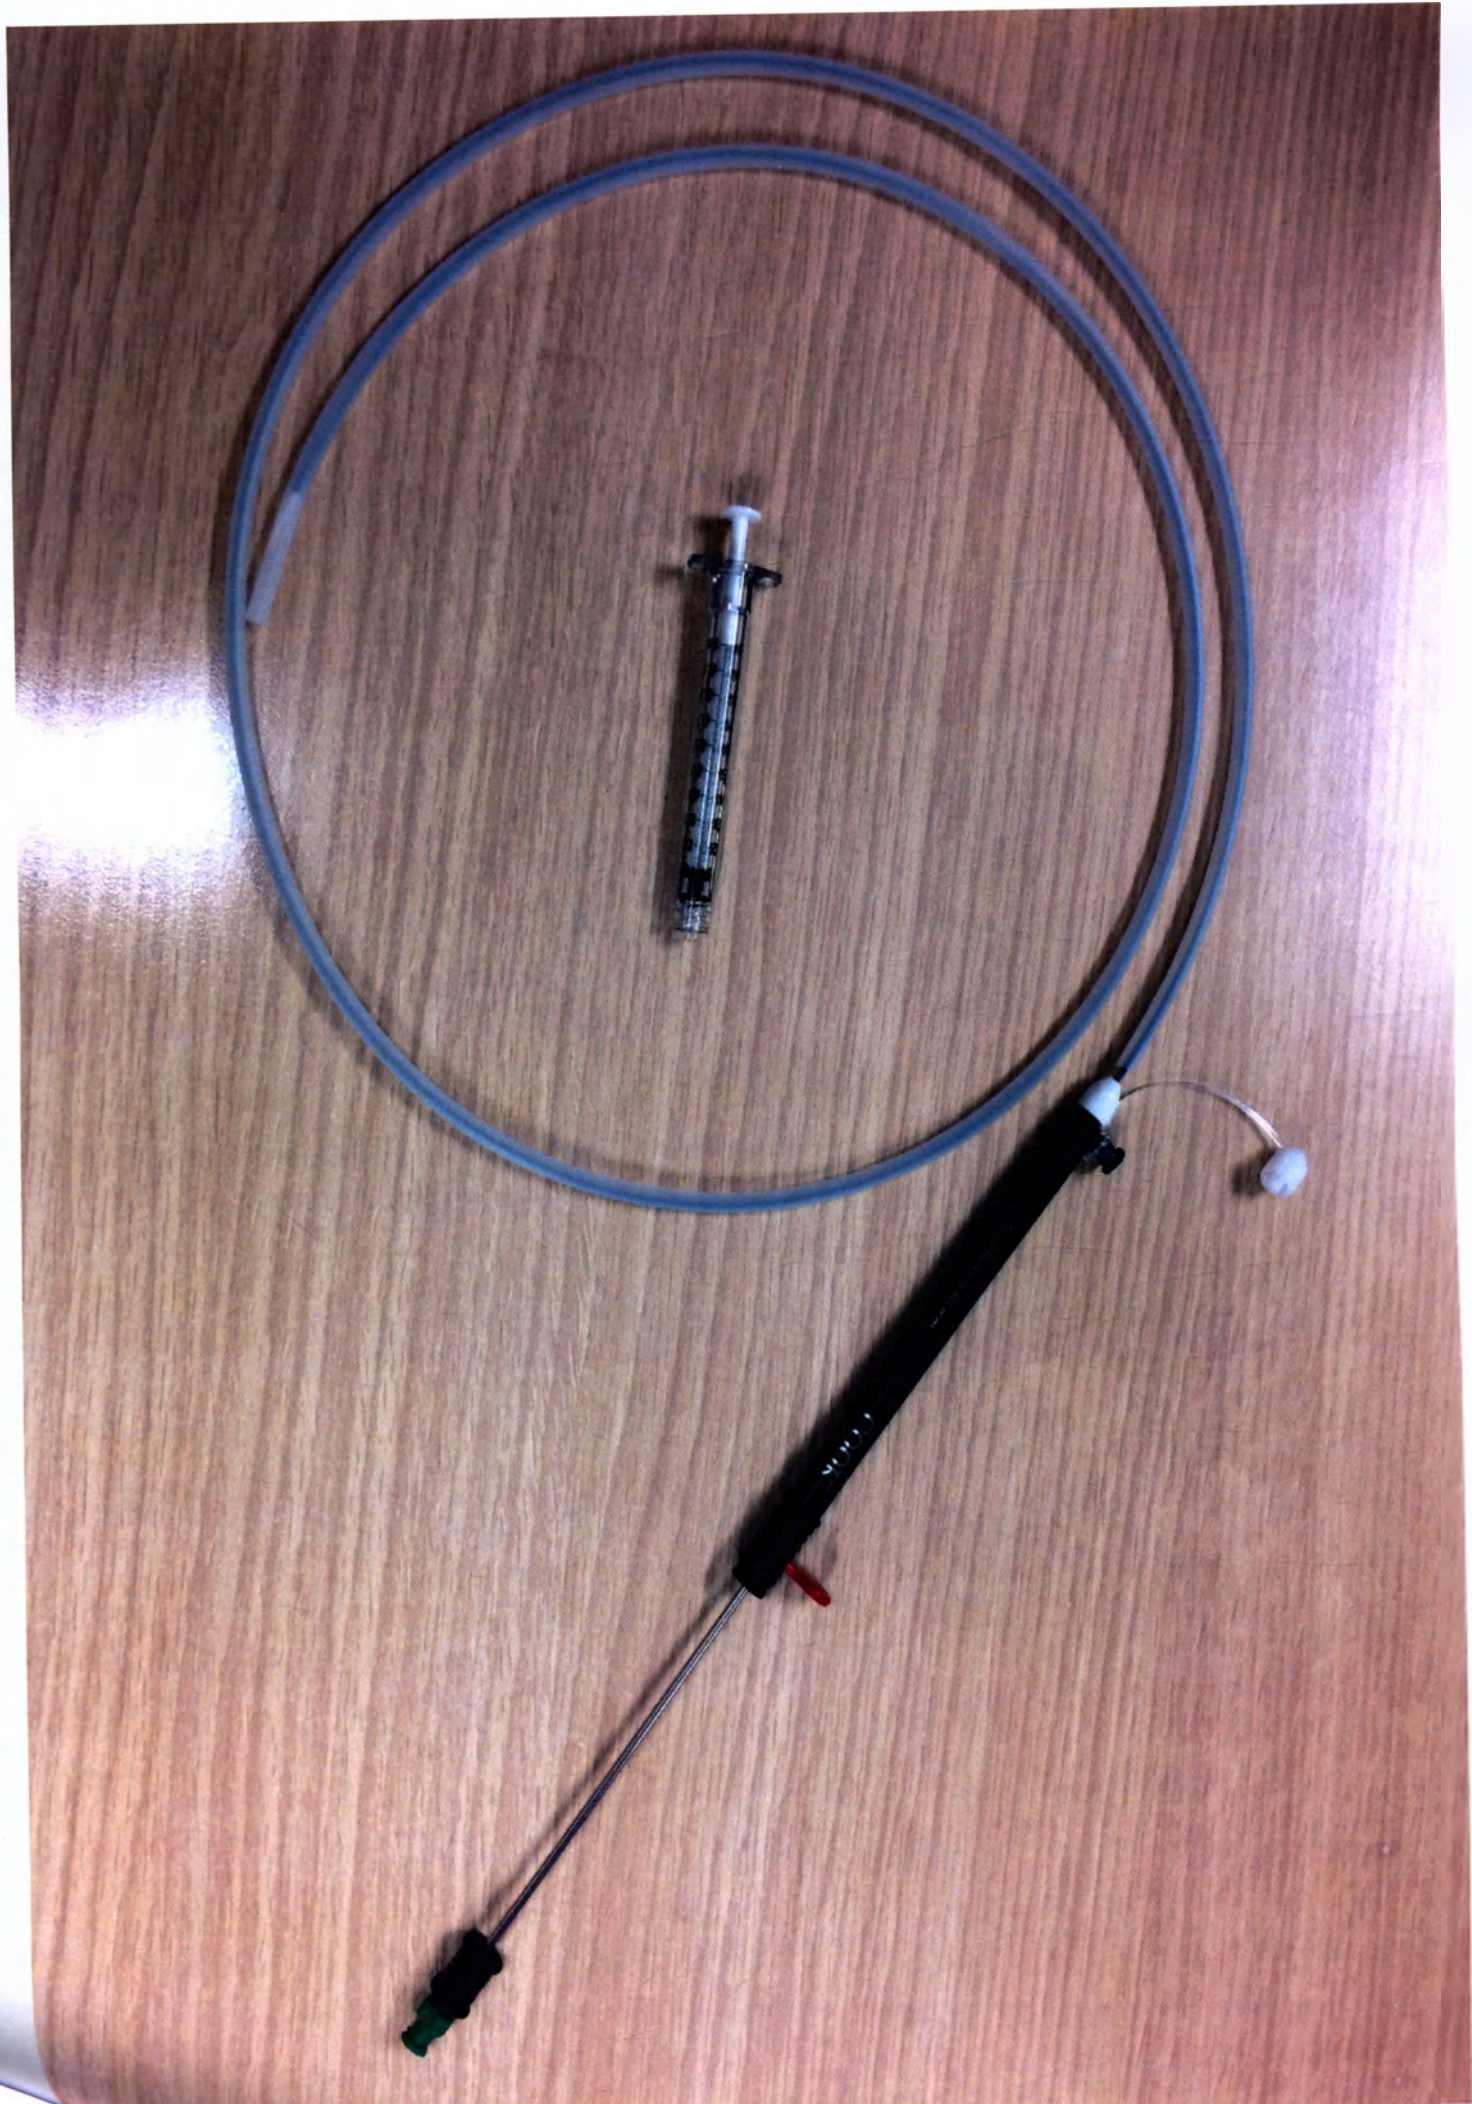



Zilver[®] 518

SELF-EXPANDING STENT

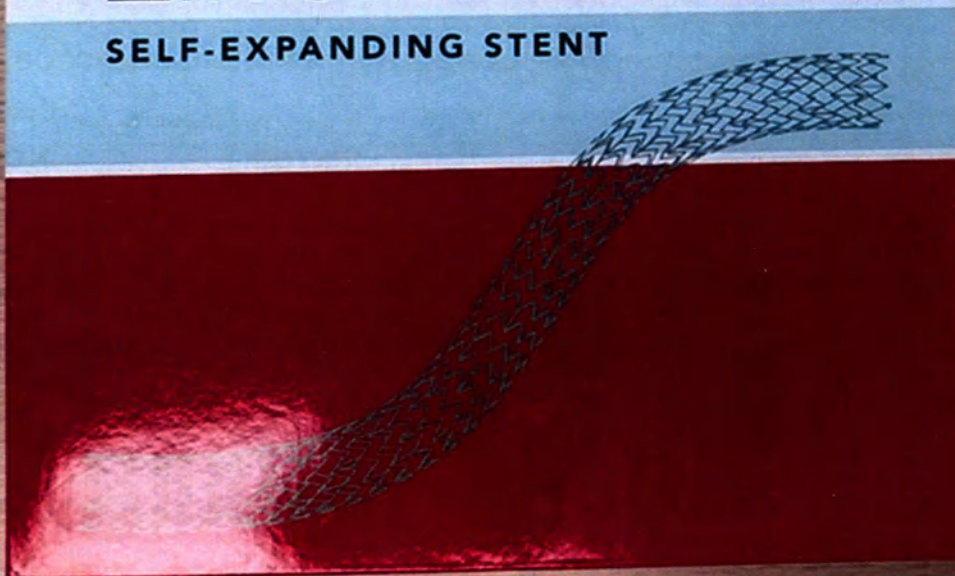

COOK MEDICAL


Zilver[®] 518[™] Vascular Stent

REF: ZIVS-125-10-8-0

REF: 633853



10mm x 80mm



Is ONLY



Manufactured For:
Cook Medical Ltd.,
Cranston Road,
National Technology Park,
Limerick, Ireland.



ZIVS-125-10-8-0
Zilver 518 Vascular Stent

For information, Cook Medical Limited, 2011 Anglin
Cook Medical Ltd, Cranston Road,
National Technology Park, Limerick, Ireland



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения


Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

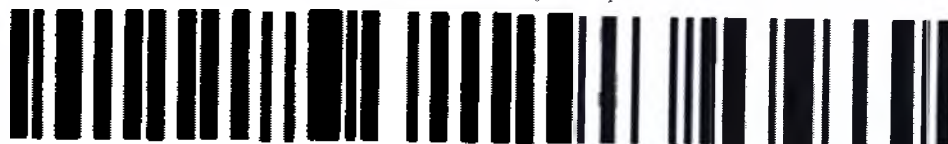

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Варианты исполнения:

ZIV6-125-10-2.0; ZIV6-125-10-3.0; ZIV6-125-10-4.0; ZIV6-125-10-6.0; ZIV6-125-10-8.0; 6. Стент ZIV6-125-12-3.0; ZIV6-125-12-4.0; 8 ZIV6-125-12-6.0; ZIV6-125-12-8.0; ZIV6-125-14-3.0; ZIV6-125-14-4.0; ZIV6-125-14-6.0; ZIV6-125-14-8.0; ZIV6-125-5-2.0; ZIV6-125-5-3.0; ZIV6-125-5-4.0; ZIV6-125-5-6.0; ZIV6-125-5-8.0; ZIV6-125-6-2.0; ZIV6-125-6-3.0; ZIV6-125-6-4.0; ZIV6-125-6-6.0; ZIV6-125-6-8.0; ZIV6-125-7-2.0; ZIV6-125-7-3.0; ZIV6-125-7-4.0; ZIV6-125-7-6.0; ZIV6-125-7-8.0; ZIV6-125-8-2.0; ZIV6-125-8-3.0; ZIV6-125-8-4.0; ZIV6-125-8-6.0; ZIV6-125-8-8.0; ZIV6-125-9-2.0; ZIV6-125-9-3.0; ZIV6-125-9-4.0; ZIV6-125-9-6.0; ZIV6-125-9-8.0; ZIV6-80-10-2.0; ZIV6-80-10-3.0; ZIV6-80-10-4.0; ZIV6-80-10-6.0; ZIV6-80-10-7.0; ZIV6-80-10-8.0; ZIV6-80-12-3.0; ZIV6-80-12-4.0; ZIV6-80-12-6.0; ZIV6-80-12-7.0; ZIV6-80-12-8.0; ZIV6-80-14-3.0; ZIV6-80-14-4.0; ZIV6-80-14-6.0; ZIV6-80-14-7.0; ZIV6-80-14-8.0; ZIV6-80-5-2.0; ZIV6-80-5-3.0; ZIV6-80-5-4.0; ZIV6-80-5-6.0; ZIV6-80-5-7.0; ZIV6-80-5-8.0; ZIV6-80-6-2.0; ZIV6-80-6-3.0; ZIV6-80-6-4.0; ZIV6-80-6-6.0; ZIV6-80-6-7.0; ZIV6-80-6-8.0; ZIV6-80-7-2.0; ZIV6-80-7-3.0; ZIV6-80-7-4.0; ZIV6-80-7-6.0; ZIV6-80-7-7.0; ZIV6-80-7-8.0; ZIV6-80-8-2.0; ZIV6-80-8-3.0; ZIV6-80-8-4.0; ZIV6-80-8-6.0; ZIV6-80-8-7.0; ZIV6-80-8-8.0; ZIV6-80-9-2.0; ZIV6-80-9-3.0; ZIV6-80-9-4.0; ZIV6-80-9-6.0; ZIV6-80-9-7.0; ZIV6-80-9-8.0.

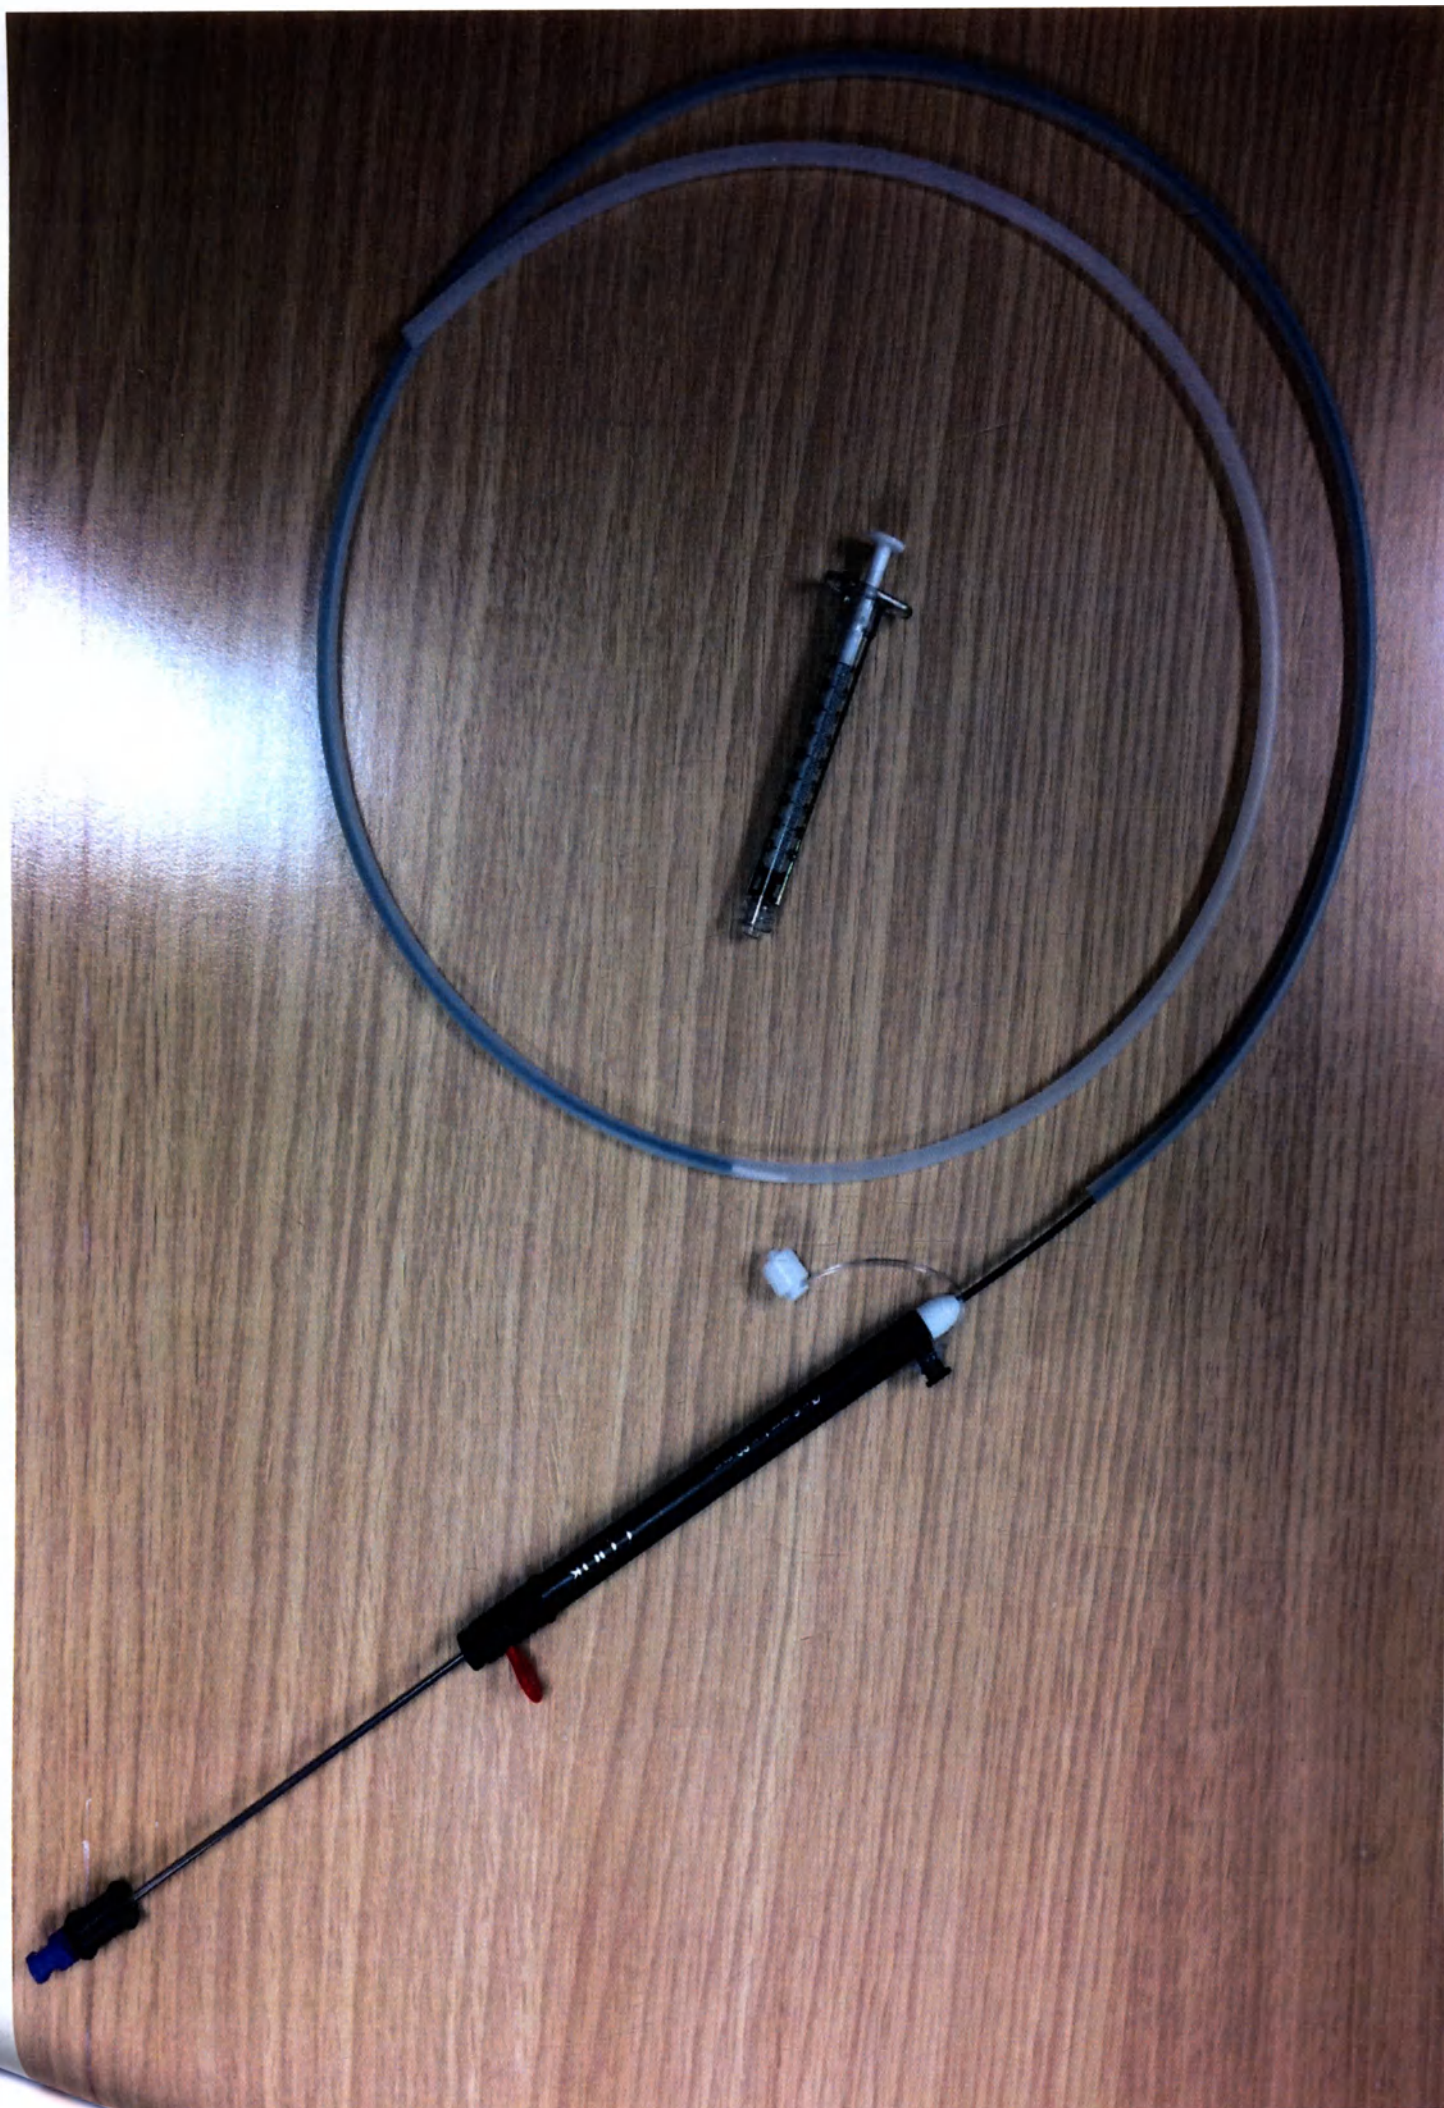

COOK®
MEDICAL

Zilver® 635

SELF-EXPANDING STENT



COOK MEDICAL

Zilver® 635™ Vascular Stent

REF ZIV6-125-14-6.0

REF 637550

14mm x 60mm



COOK
MEDICAL

Manufactured By
Cook Medical Ltd.
Chapman Road,
Barnstaple Technology Park,
Barnstaple, Devon

CE

ZIV6-125-14-6.0
14mm x 60mm (0.054" x 2.36")

Spinal Cord Injury, Cook Medical, Inc. (CMI) is a registered

trademark of Cook Medical, Inc. (CMI) and is used under license.

For more information, please contact your local Cook Medical representative.

© 2010 Cook Medical, Inc. All rights reserved.

COOK MEDICAL

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Стенты для восстановления и поддержания проходимости сосудов в различных вариантах исполнения

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 47 листов
Генеральный директор



С.Н.Курин