

Аппарат цифрового радиационного контроля
1. Плоскопанельный детектор SKR3000, модель P-61 (Direct Digitizer SKR3000, model P-61)









KONICA MINOLTA

AeroDR

**DIRECT DIGITIZER
AeroDR SYSTEM
AeroDR SYSTEM 2
SKR 3000**

**Руководство по
эксплуатации**

CE 0197



Manufacturer:

KONICA MINOLTA, INC.

1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan

RU

14



KONICA MINOLTA

DIRECT DIGITIZER

CS-7

Version 1.30



CE 0197



Manufacturer:
KONICA MINOLTA, INC.

1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan

**Руководство по
эксплуатации**

RU 09



KONICA MINOLTA

ImagePilot

Version 1.80



Руководство по
эксплуатации

CE 0197



Manufacturer:
KONICA MINOLTA, INC.

1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan

RU 05

KONICA MINOLTA, INC.

Руководство к библиотеке AeroSDK для 3^{-го} поколения AeroDR V1.00



KONICA MINOLTA


Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию компании Konica Minolta. Запрещается копировать и распространять настоящий документ без получения предварительного письменного согласия со стороны Konica Minolta, Inc. Внесение изменений в документ может осуществляться без предварительного уведомления. Компания Konica Minolta, Inc. не несет ответственность за ущерб и повреждения, которые были получены в результате выполнения процедур, описанных в настоящем документе.

Copyright © 2014 KONICA MINOLTA, INC.

1/154

Copyright ©2014 KONICA MINOLTA, INC.




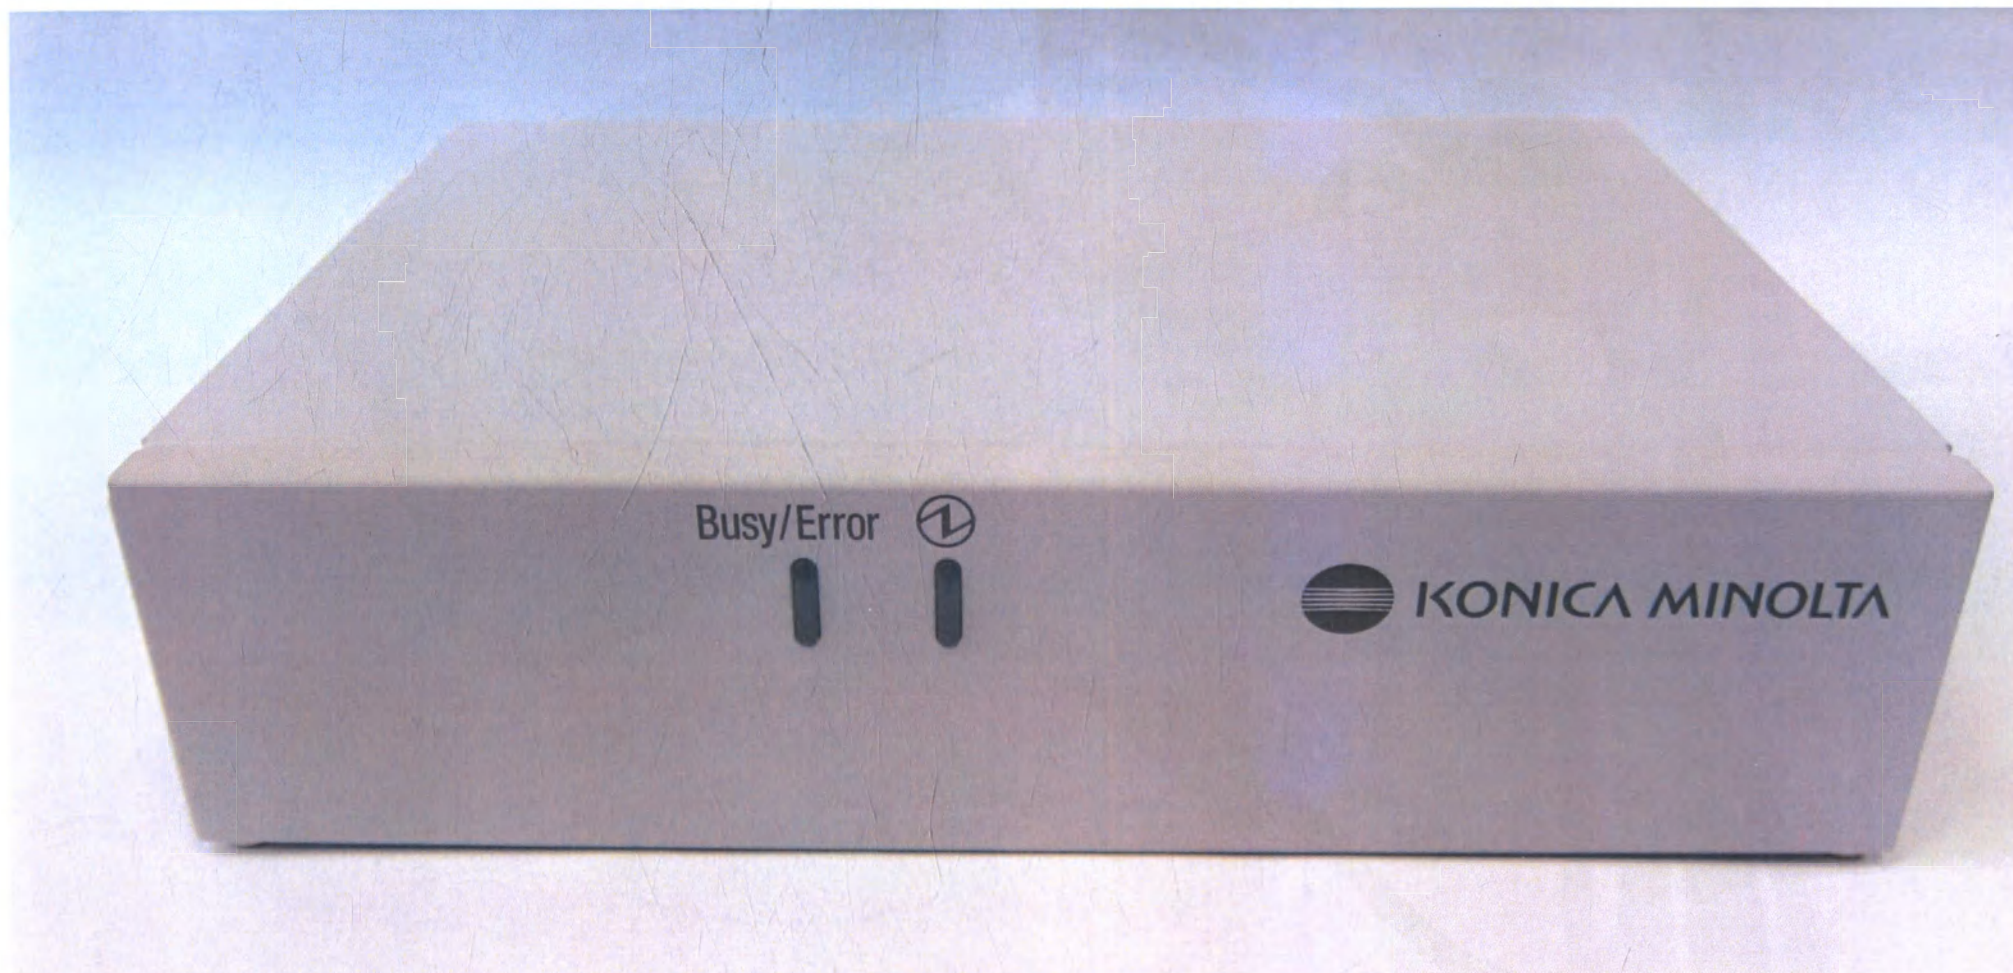

4. Блок питания интерфейсного модуля подключен к генератору рентгеновского излучения




6. Устройство зарядное компактное (AeroDR Battery Charging Unit)

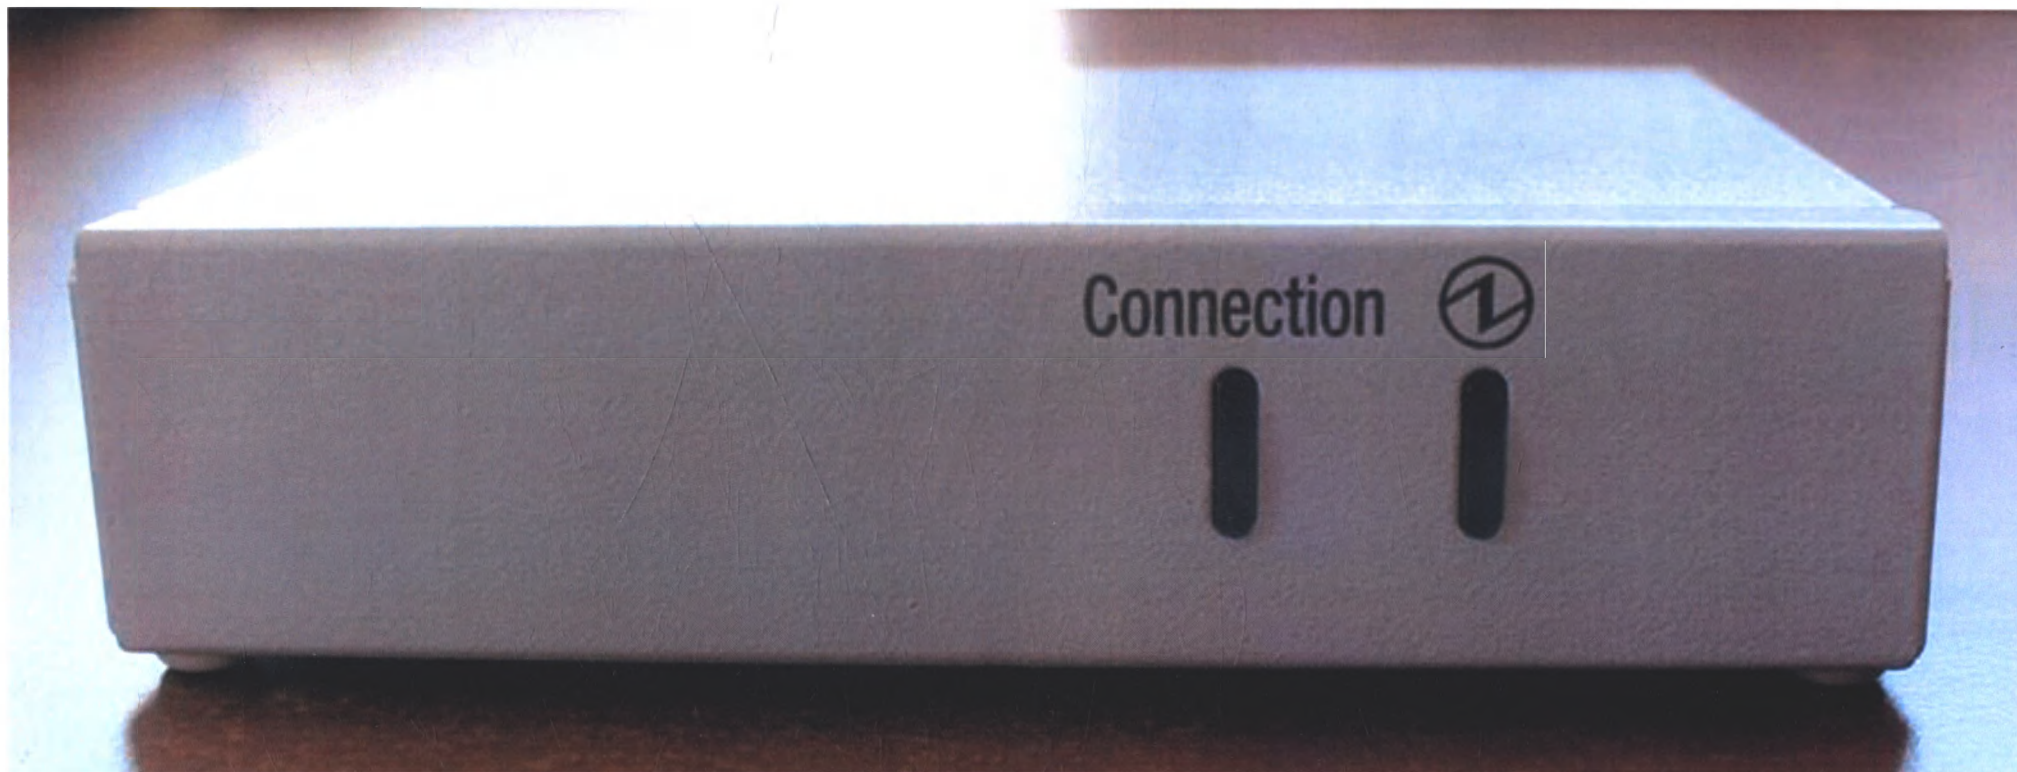






9. Коммутационный кабель с платой интерфейса на 2-го для подключения к генераторам рентгеновского излучения (коммутационный кабель)

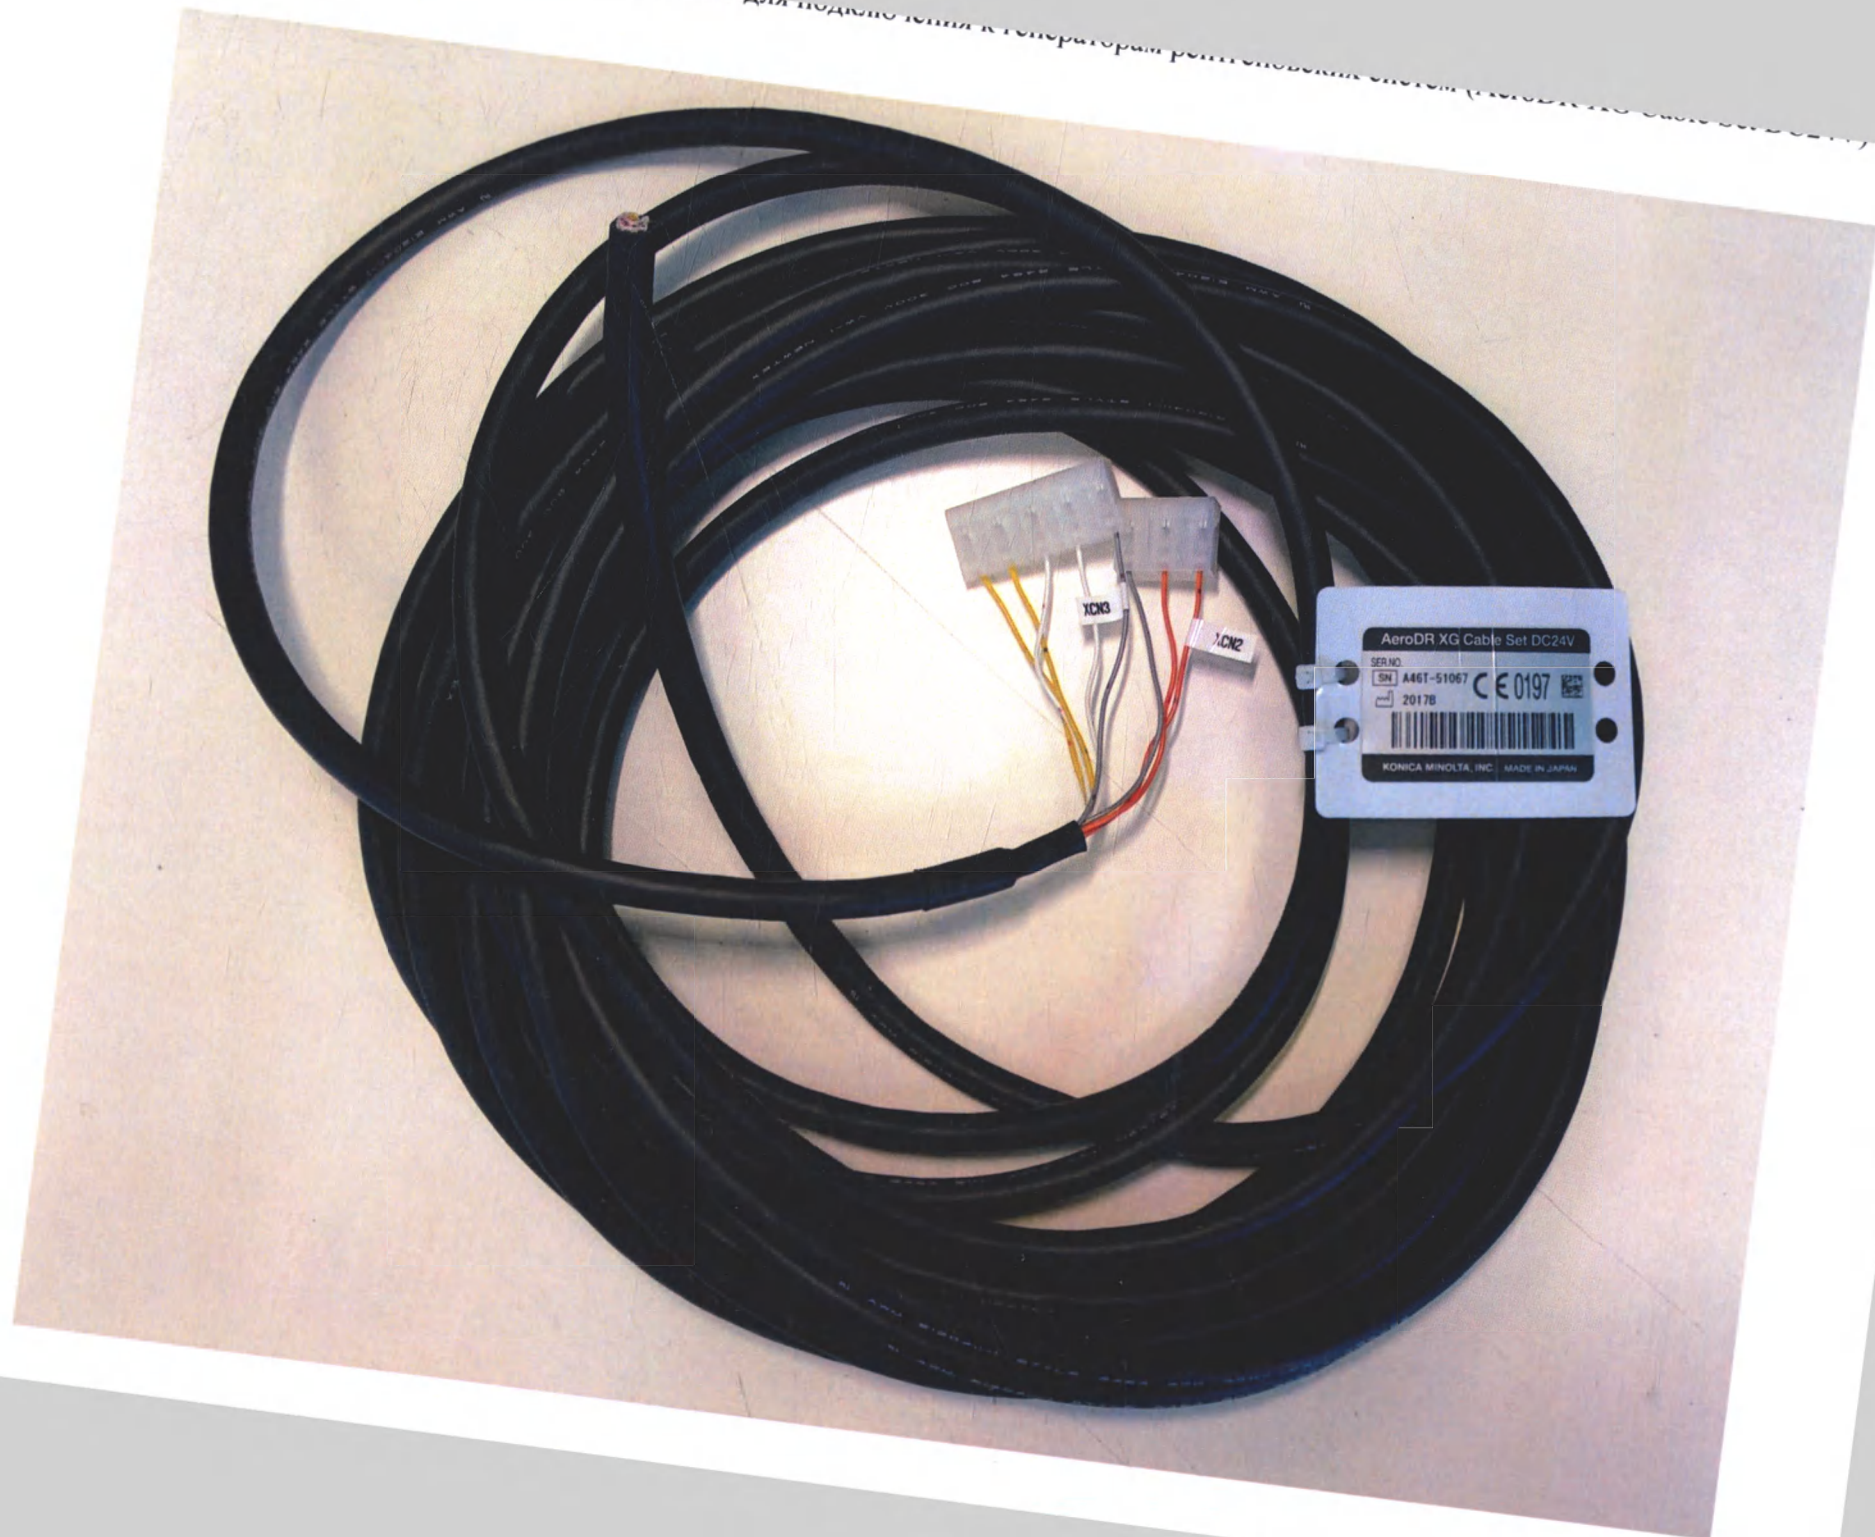


9. Коммутационный кабель с платой интерфейса на 24В для подключения к генераторам рентгеновских систем (Ае10ВК XG Cable Set DC24V)
(плата интерфейса)

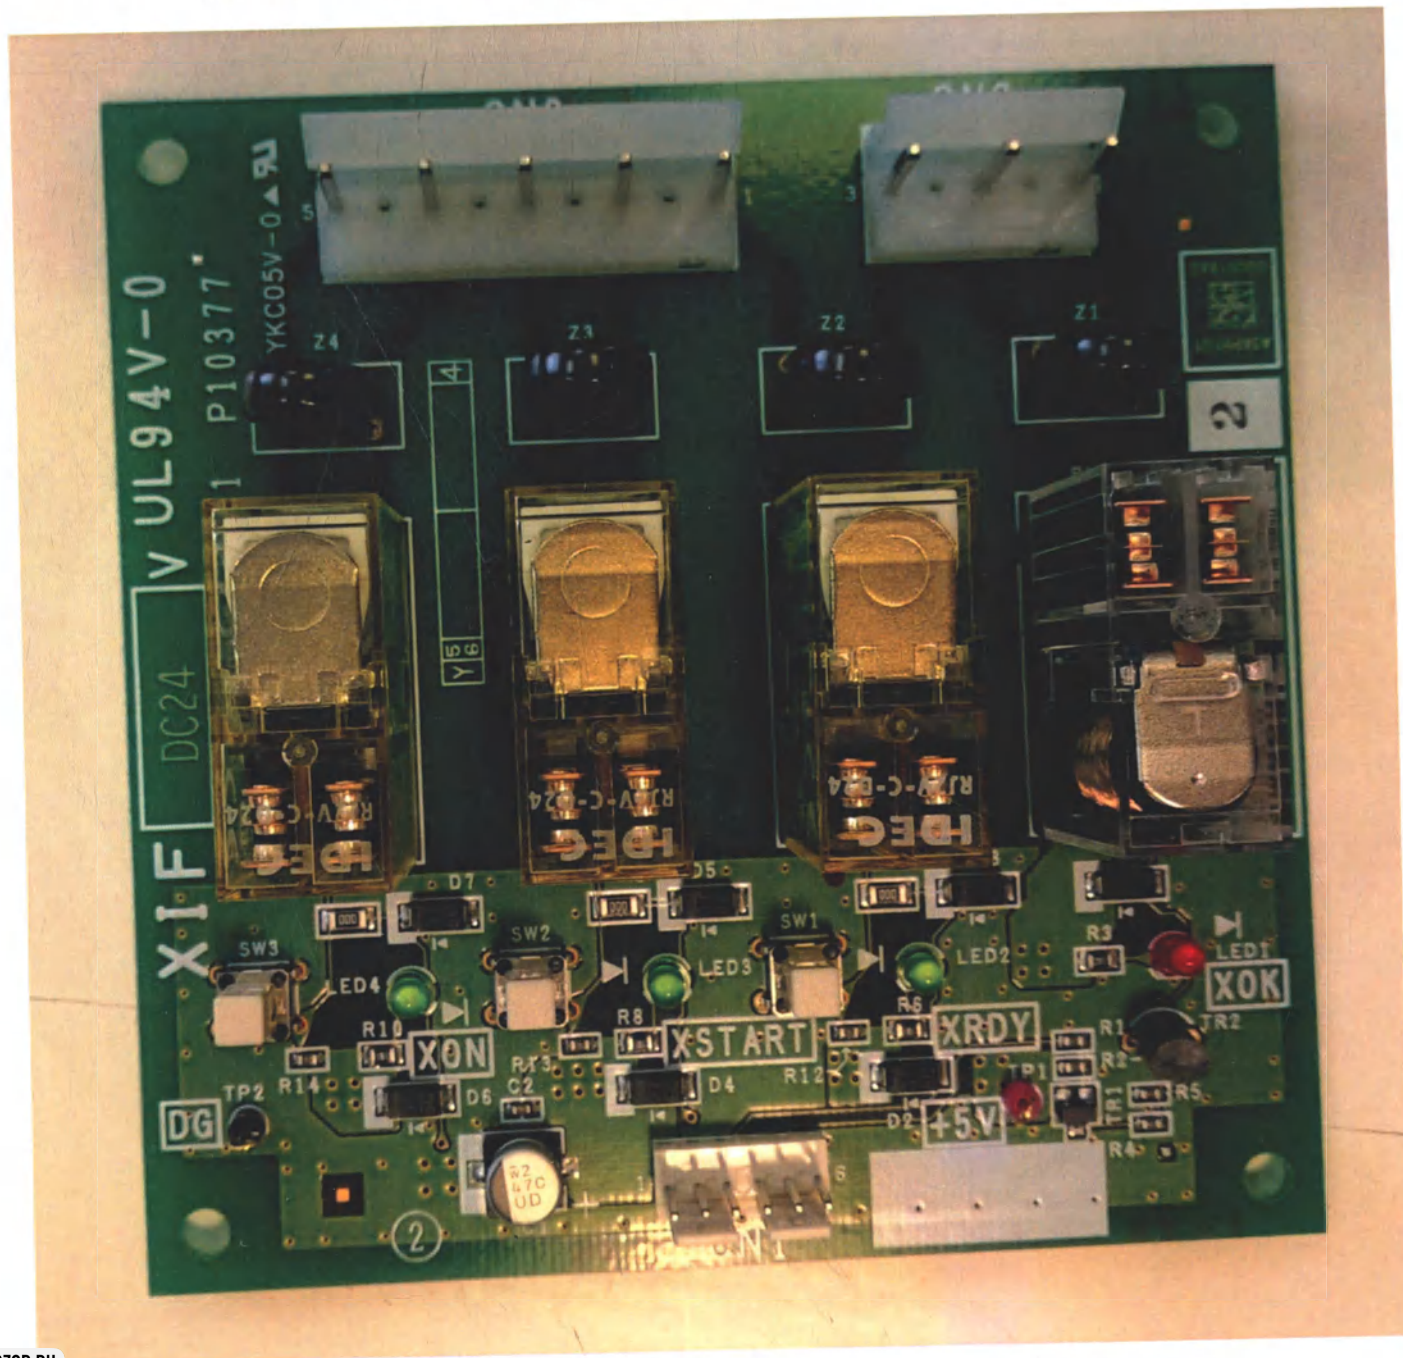


10. Коммутационный кабель с сигнальным интерфейсом RS-485
(коммутационный кабель)



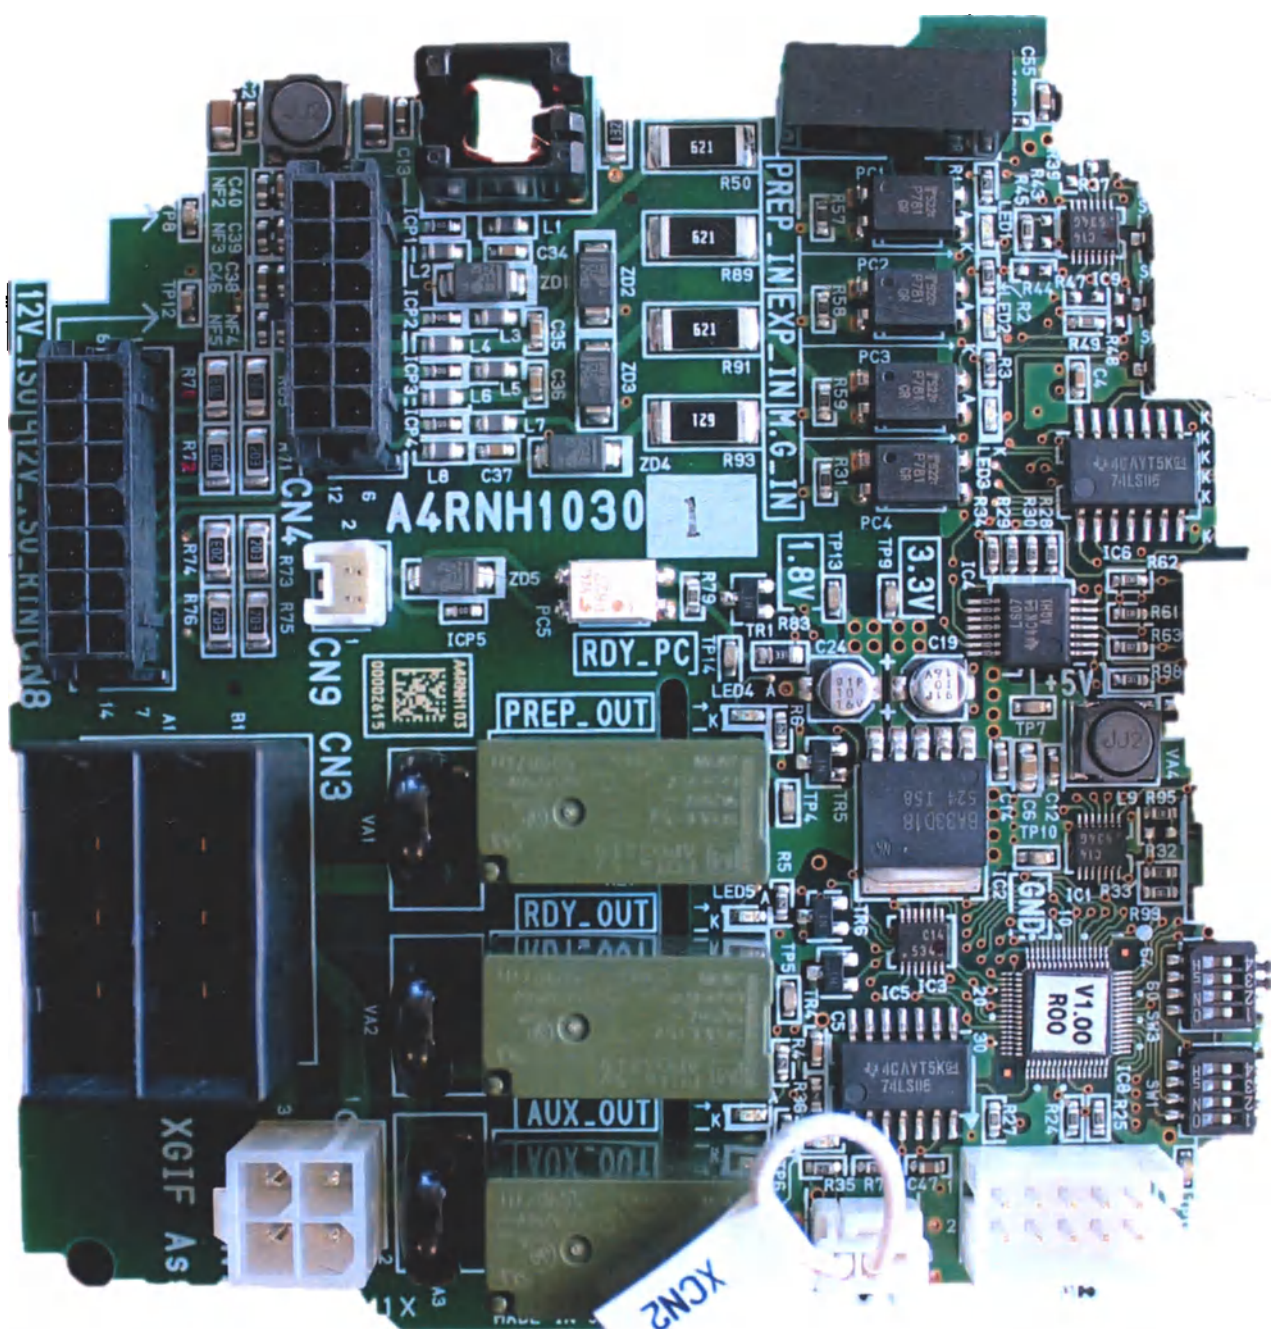




12. Кнопка включения с платой интерфейса и креплением (AeroDR S-SRM Kit)
(кнопка включения)

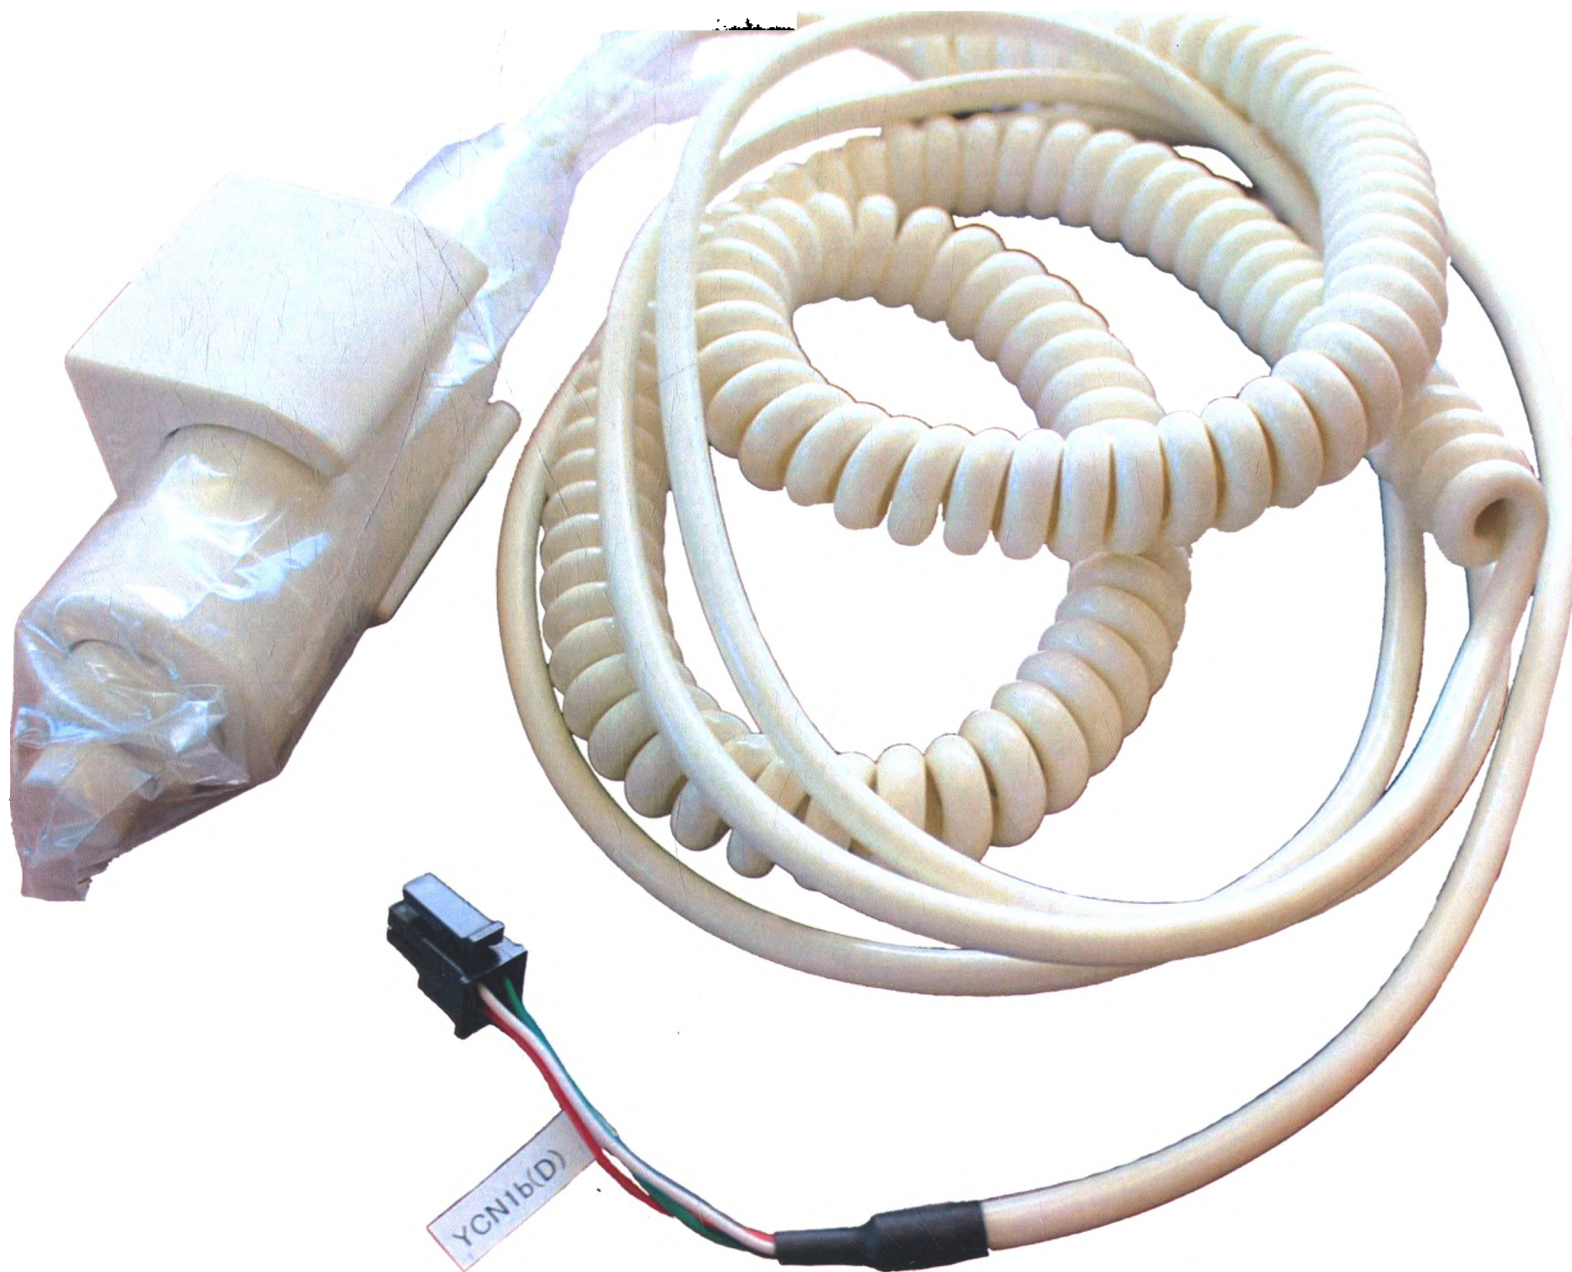

2. Кнопка включения с платой интерфейса и креплением (AeroDR S-SKM Kit)
(плата интерфейса)

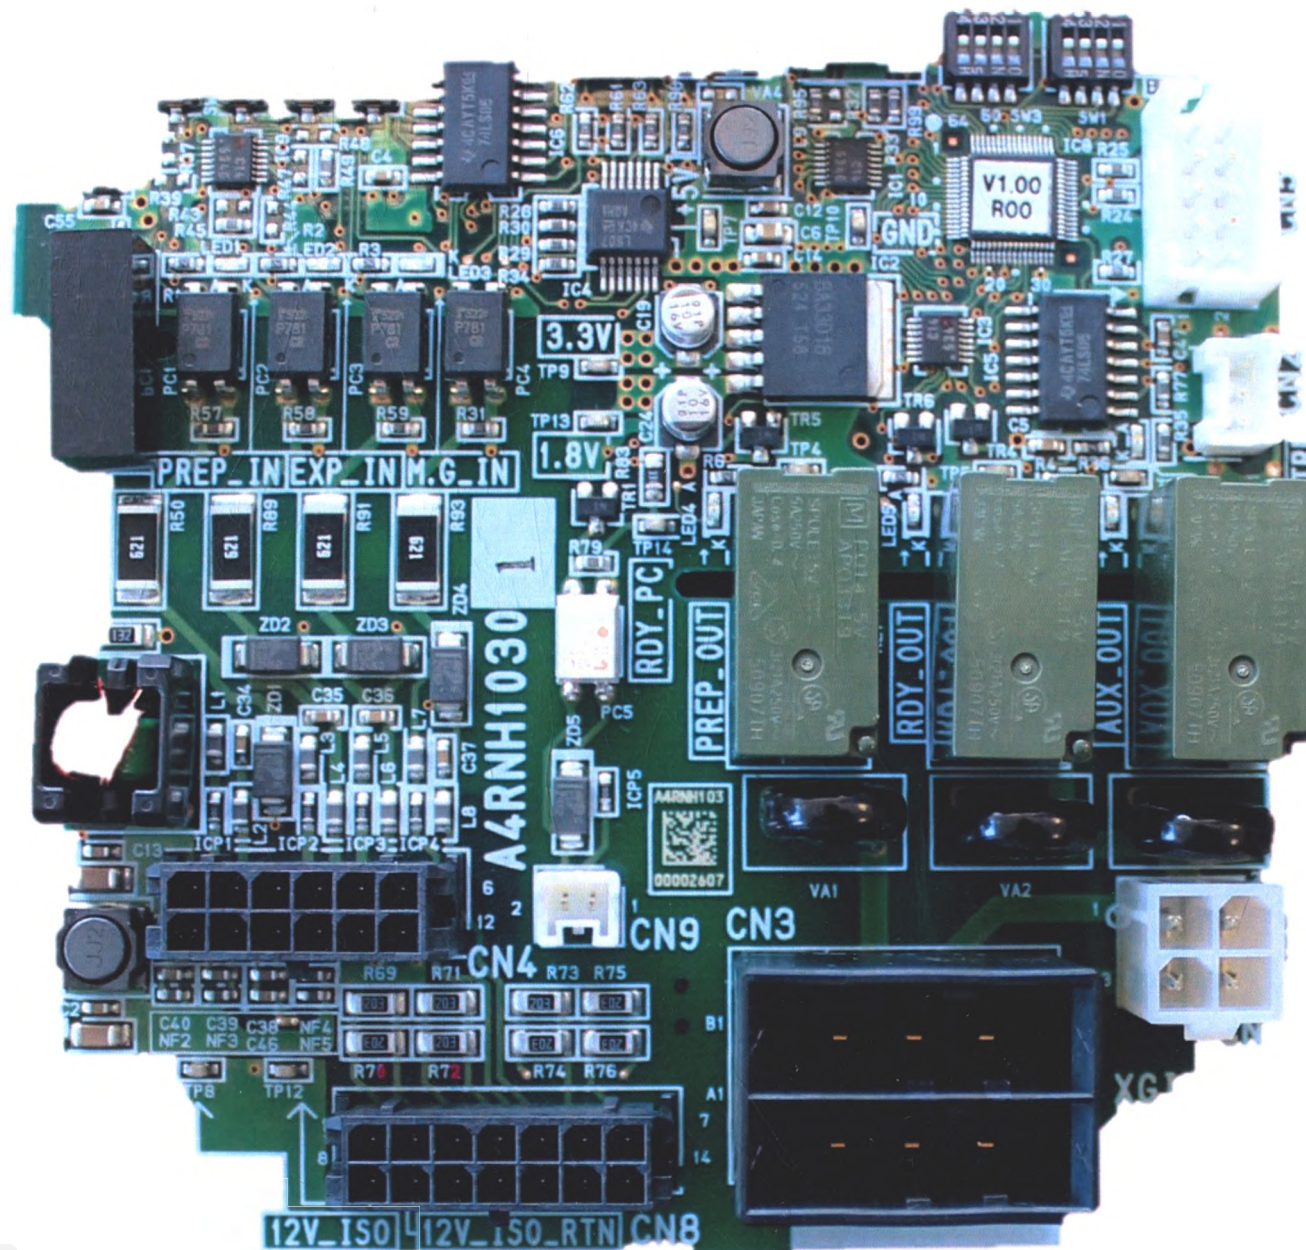



14. Коммутационный кабель подключения к рентгеновским системам (AeroDR S-SRM Cable NC)











SKR 3000 / G-21 (Detector Interface Unit)



CE 0197

SN A9G5-01266




2018-01-28




GS1
(01) 04560141945197 (21) A9G5-01266


KONICA MINOLTA, INC.

MADE IN JAPAN

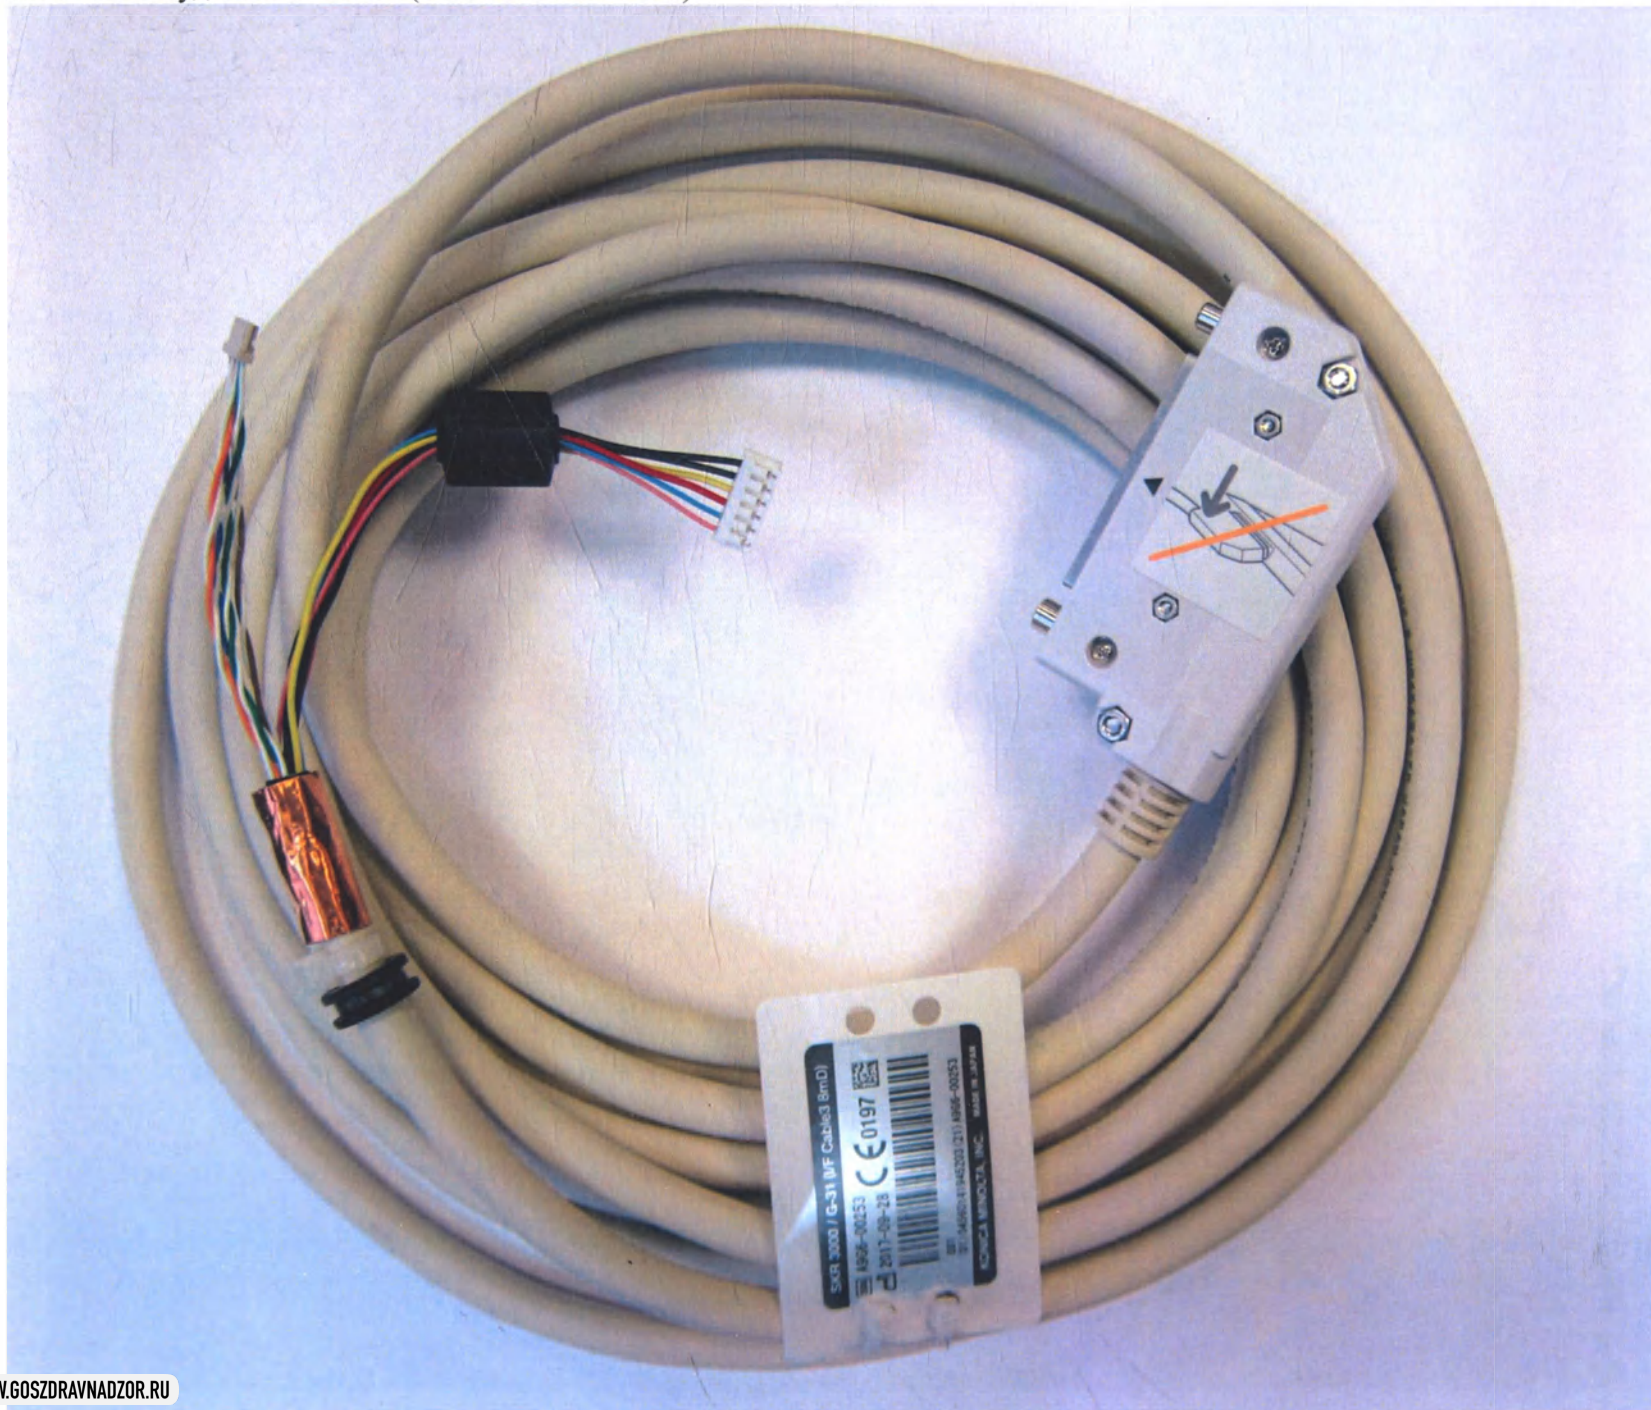

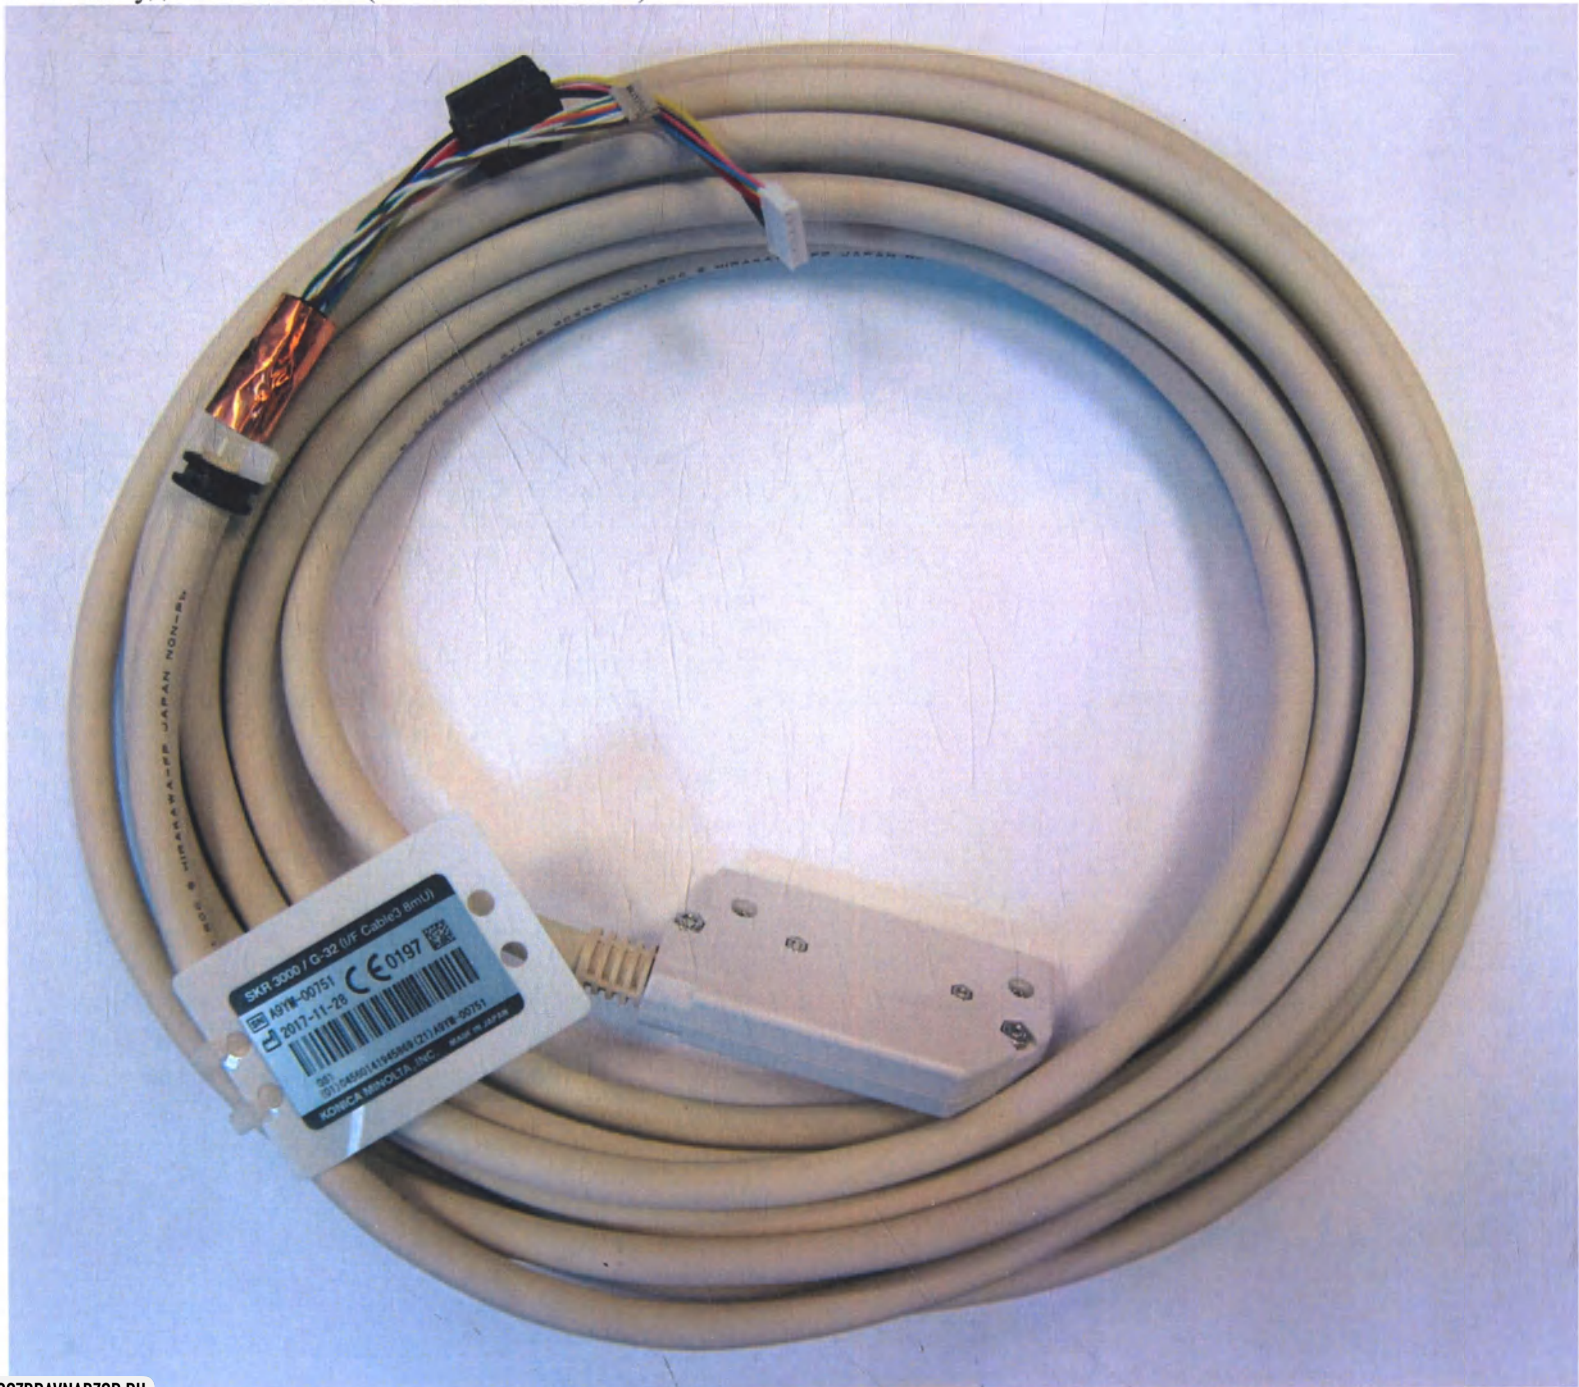


КОМПЛЕКТОВАНИЕ

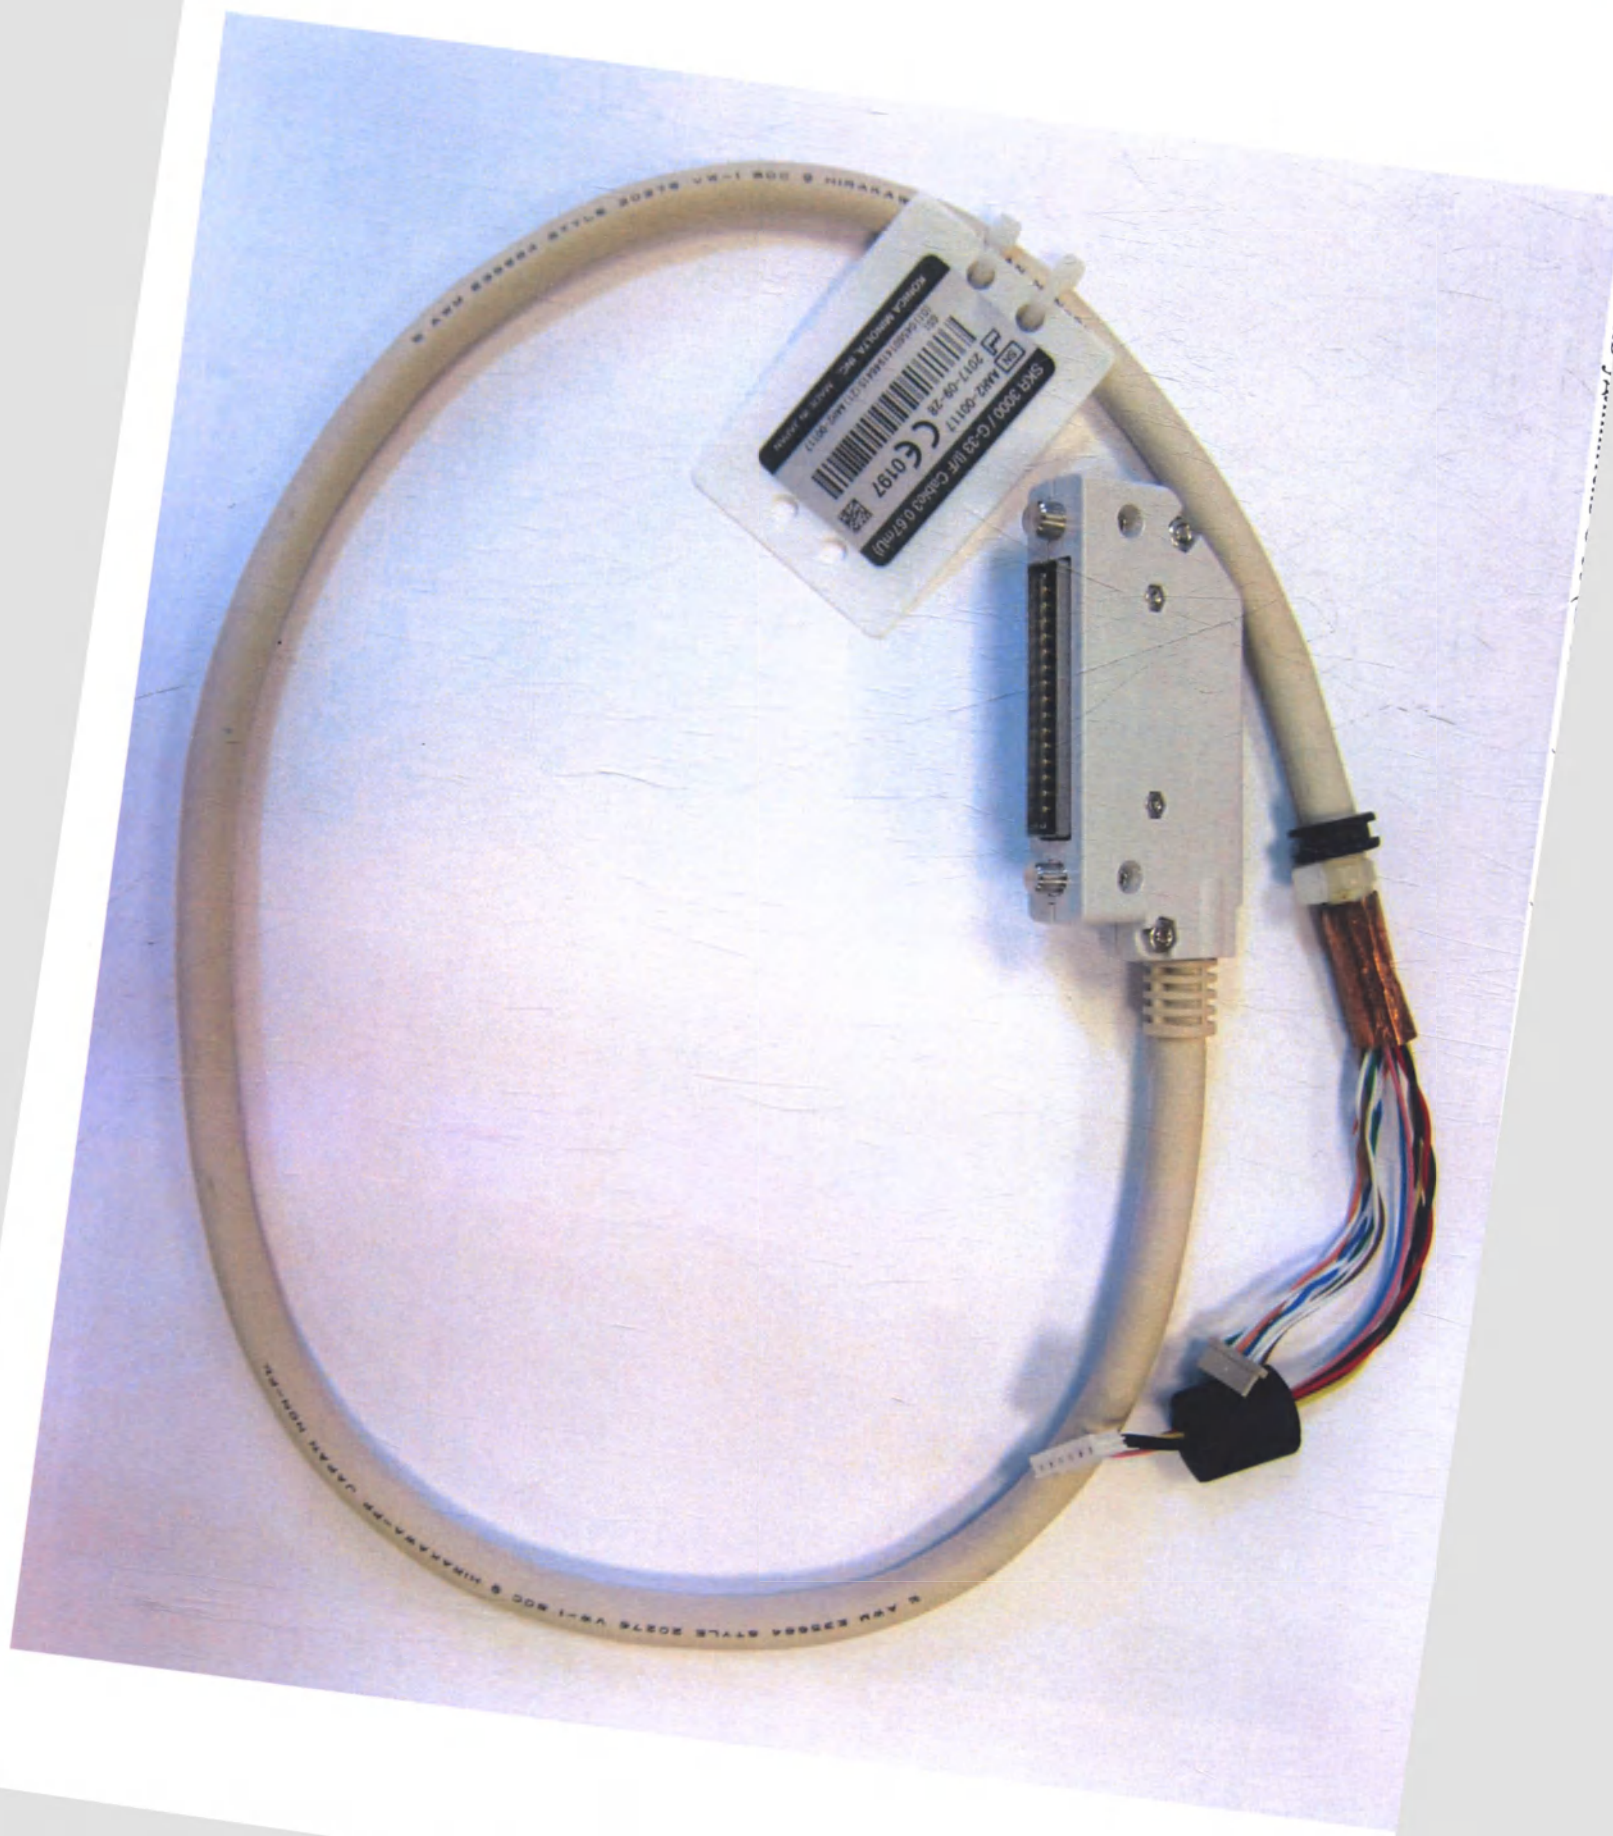





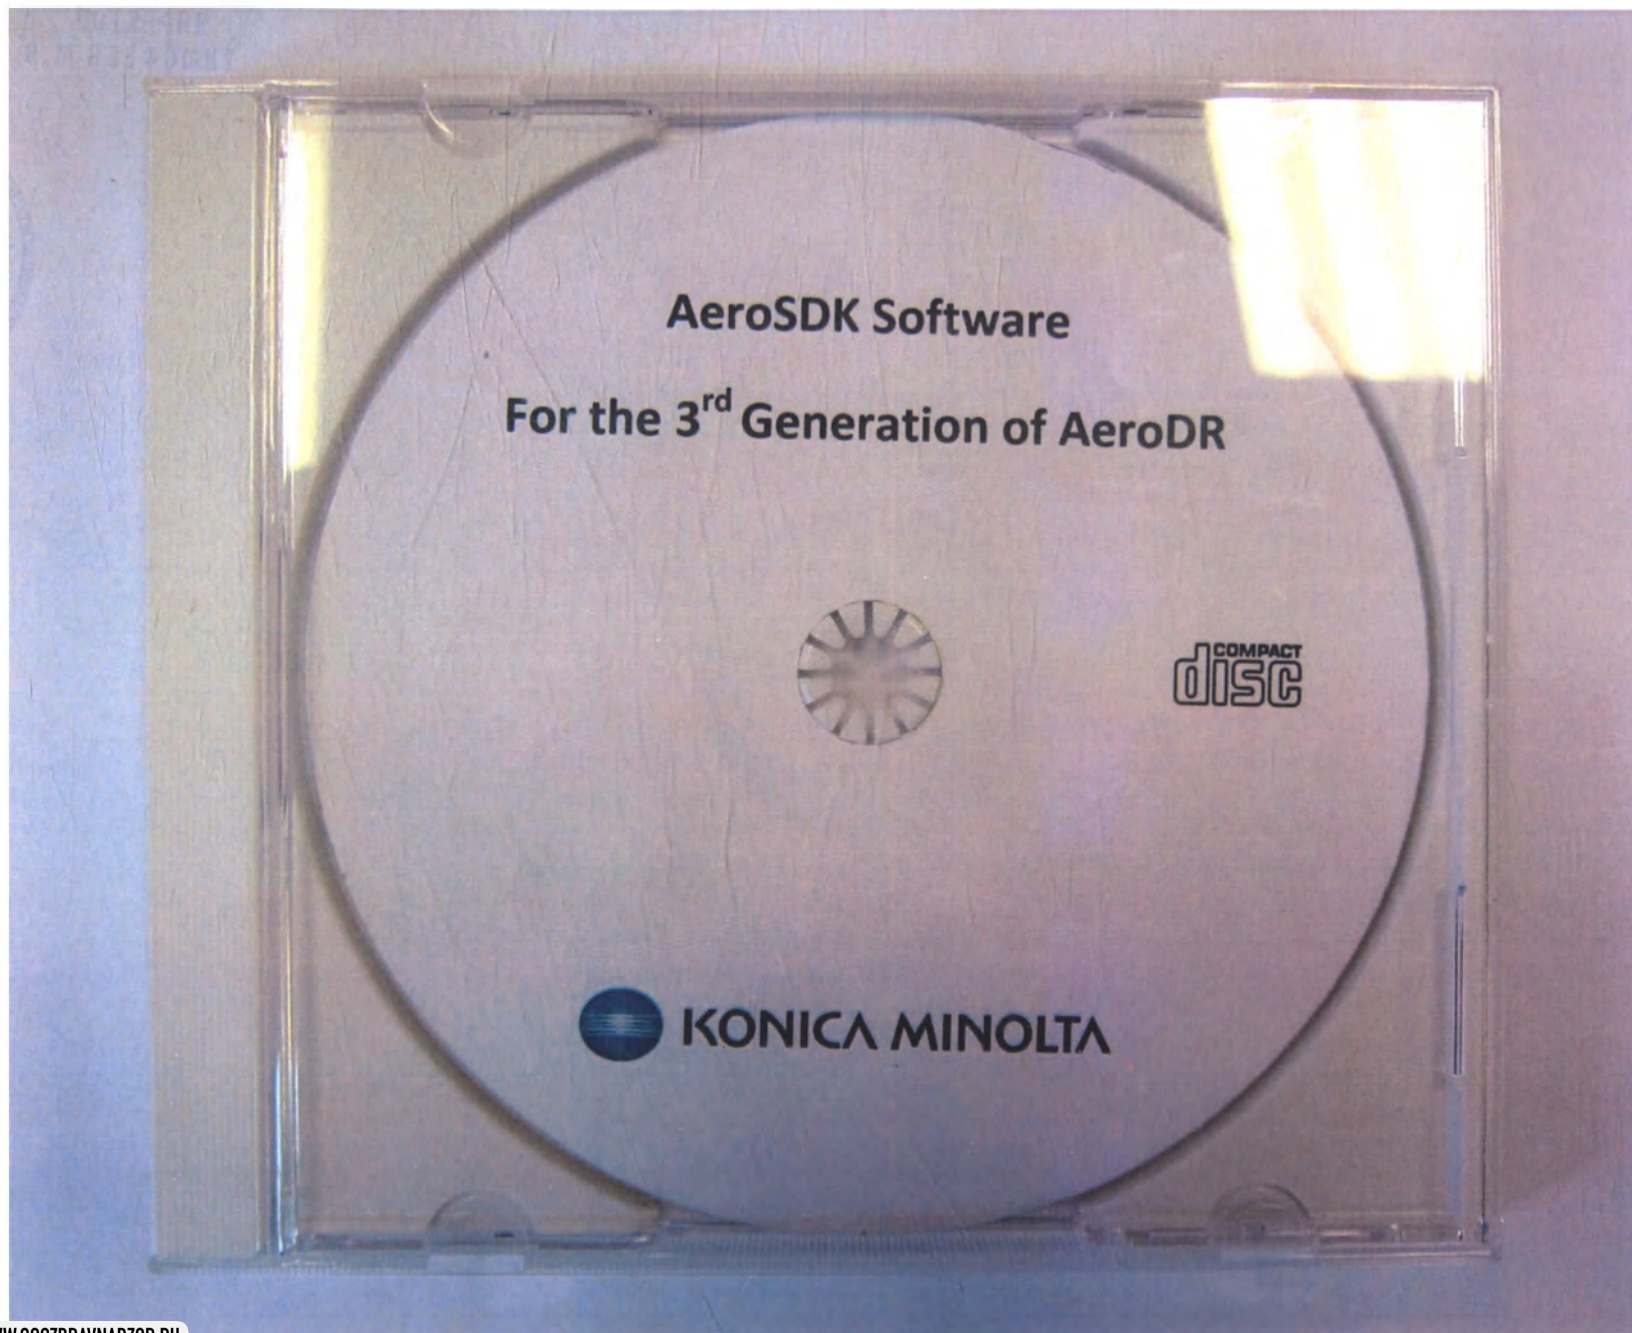

Прошито и
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Тимофеев М.В. пронумеровано 32 лист

