

ФОТОГРАФИИ
медицинского изделия


«Набор стоматологических изделий для костной пластики BOSS»

производства


Cowell Medi Co., Ltd. (Ковэлл Меди Ко., Лтд.),

Корея

2018

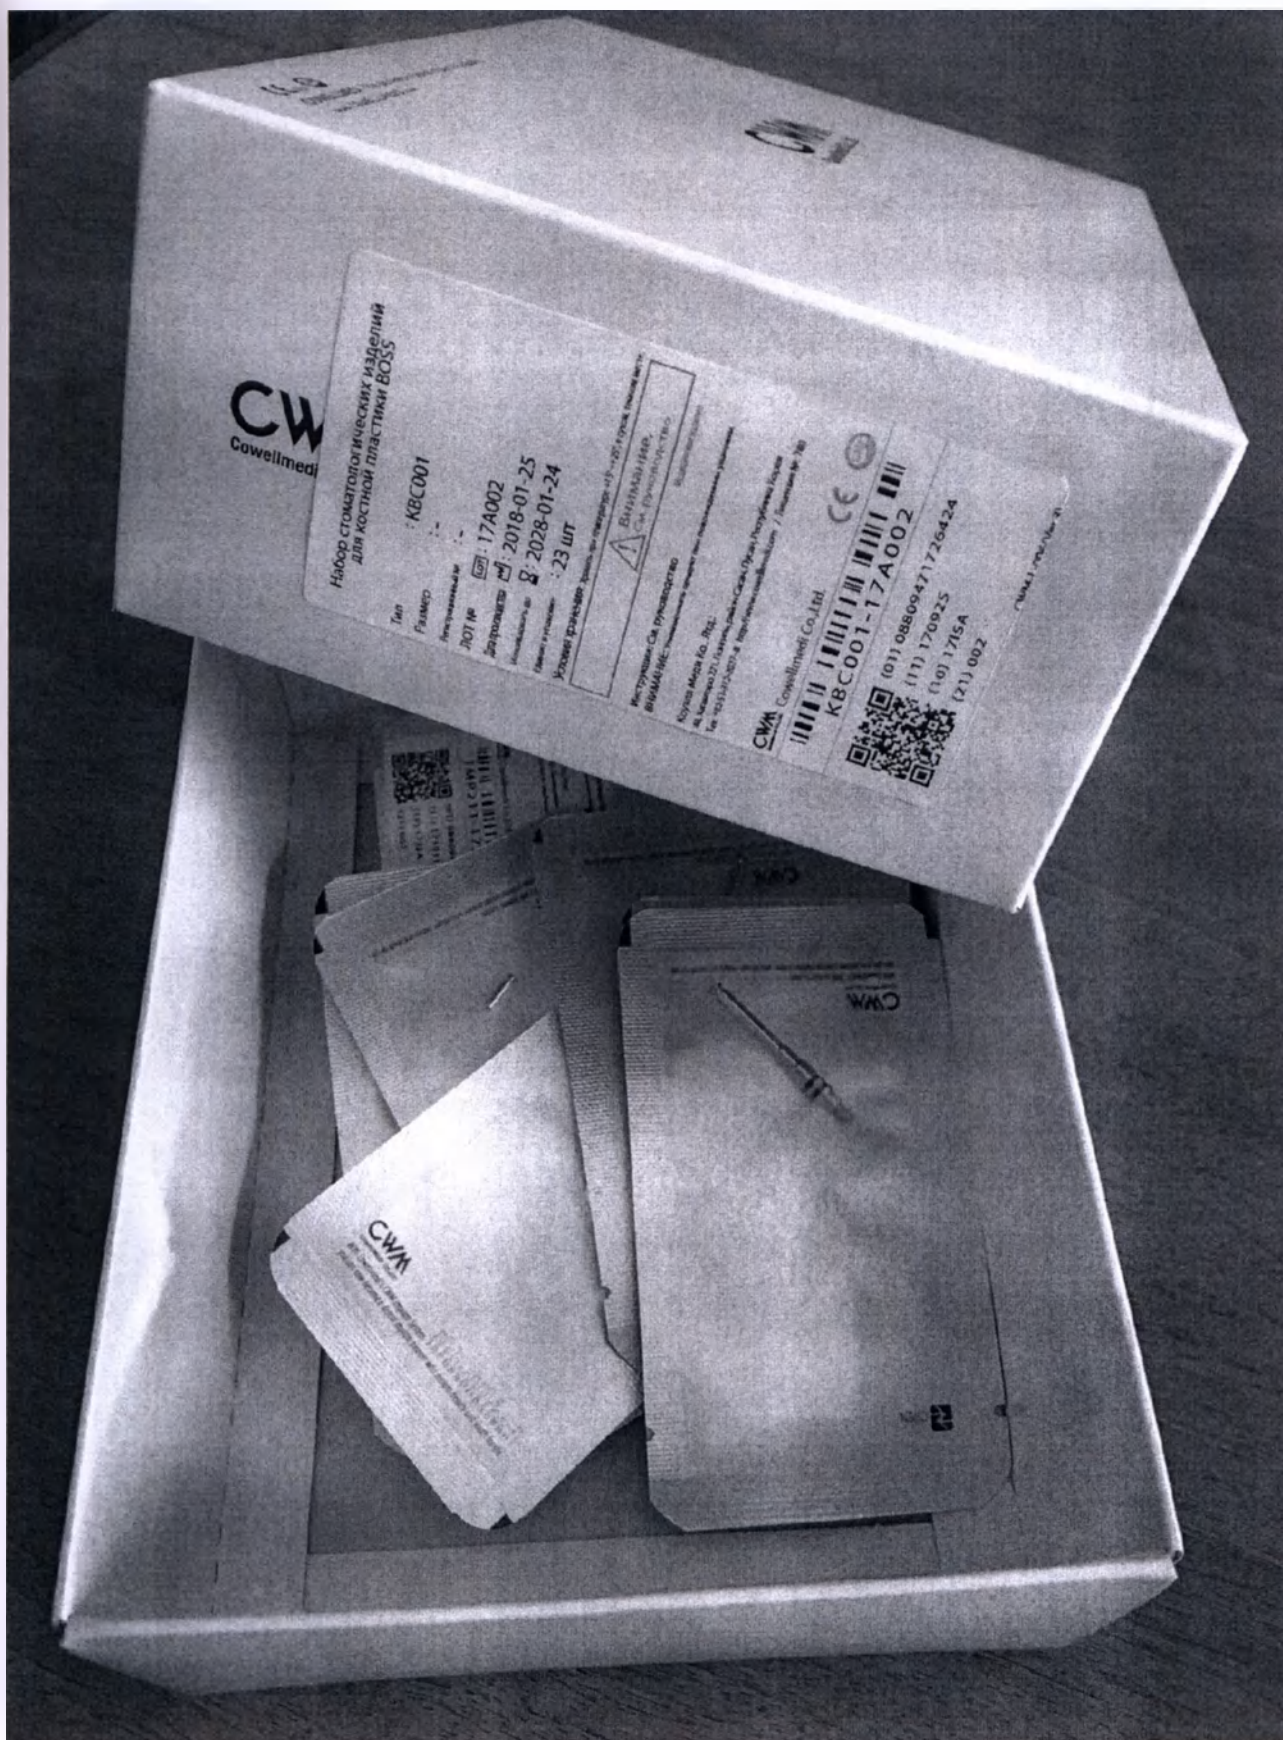

Набор стоматологических изделий для костной пластики BOSS

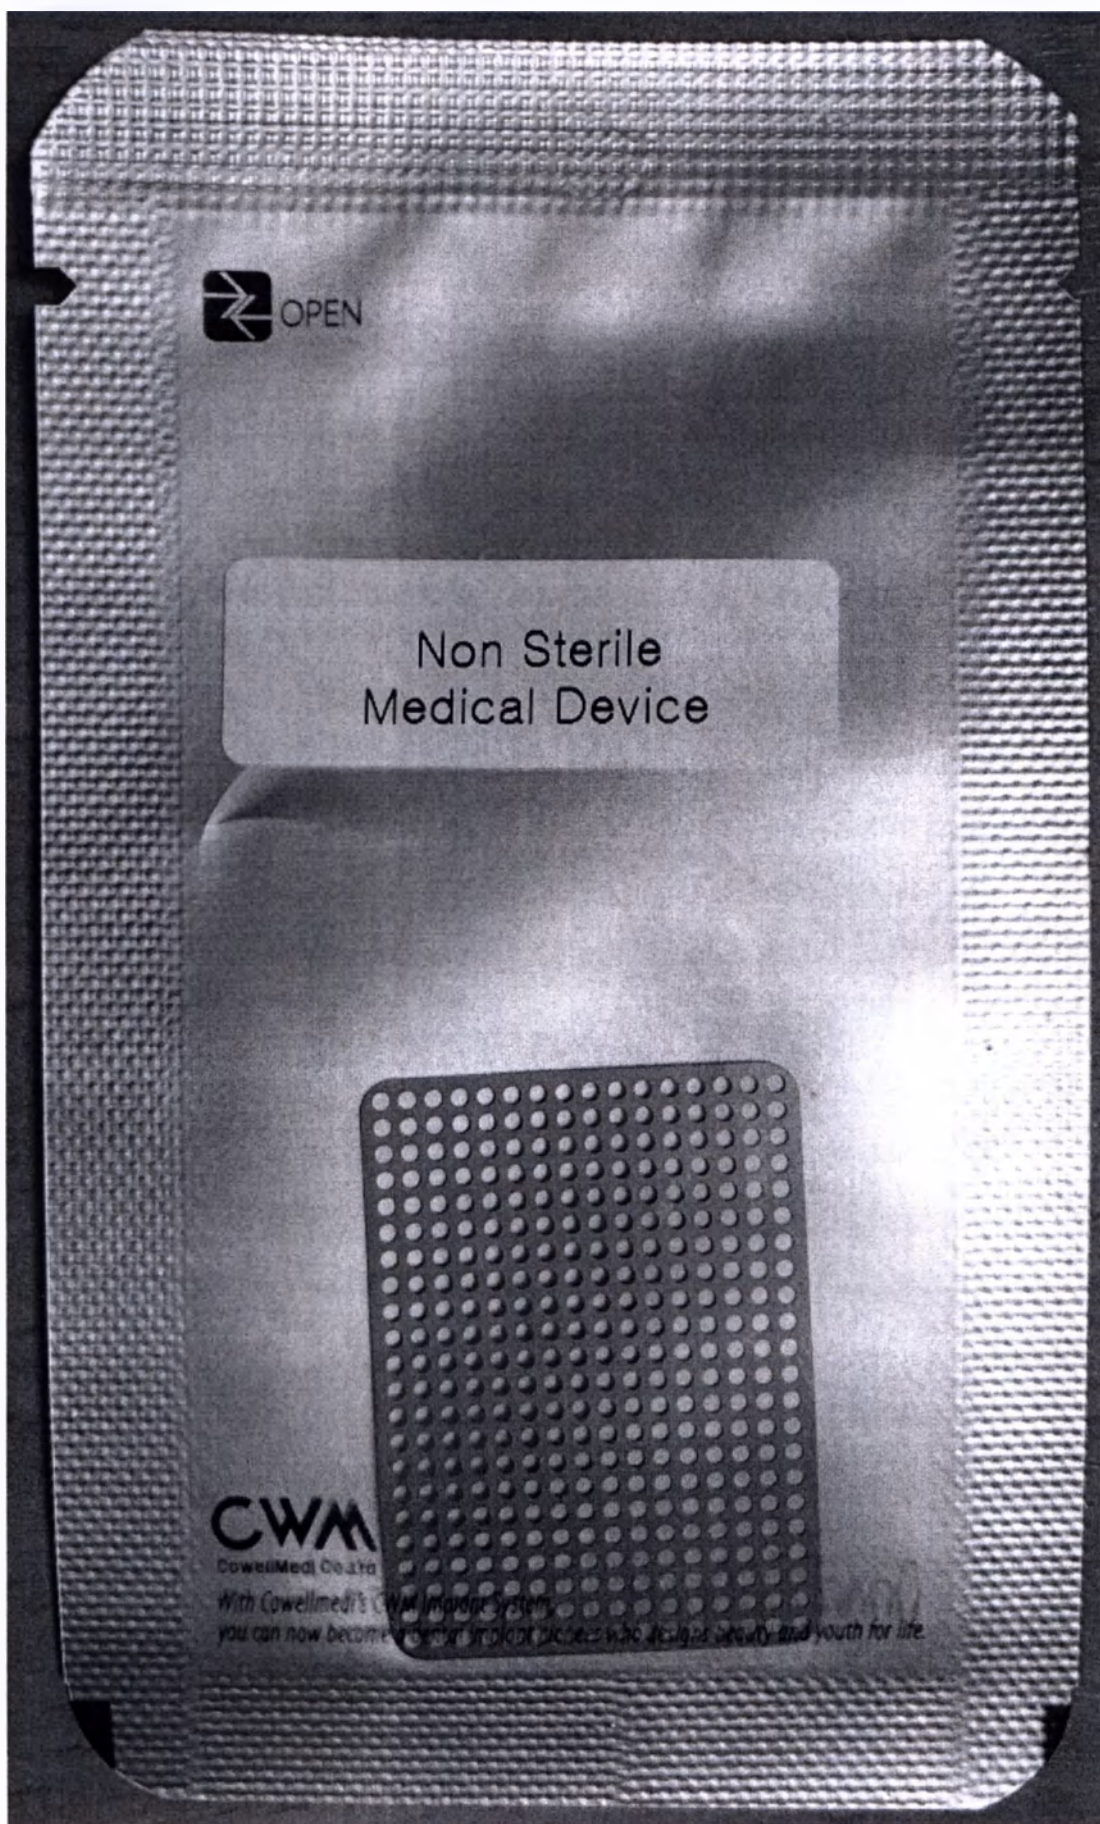


Сетка титановая (Titanium Mesh)

Сетка титановая

Тип : TMP211
Размер : 25*34*0.1Т
Регистрационный № : 11-1297
ЛОТ №  : 17J2A007
Дата производства  : 2017-10-11
Использовать до  : 2027-10-10
Единиц в упаковке : 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15° - +25°, в сухом, темном месте.



Do Not
Reuse



Внимание,
См. руководство

Медицинское изделие

Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: Утилизировать продукт при повреждении упаковки.

Ковэлл Меди Ко., Лтд.:

48, Хагамтэро 221, Понгиль, район Сасан, Гусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027-8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия №: 780



Cowellmedi Co.,Ltd.



TMP211-17J2A007



(01) 08809471726417


(11) 171011

(10) 17J2A

(21) 007

CWM-1-00606-21

Сетка титановая (Titanium Mesh)

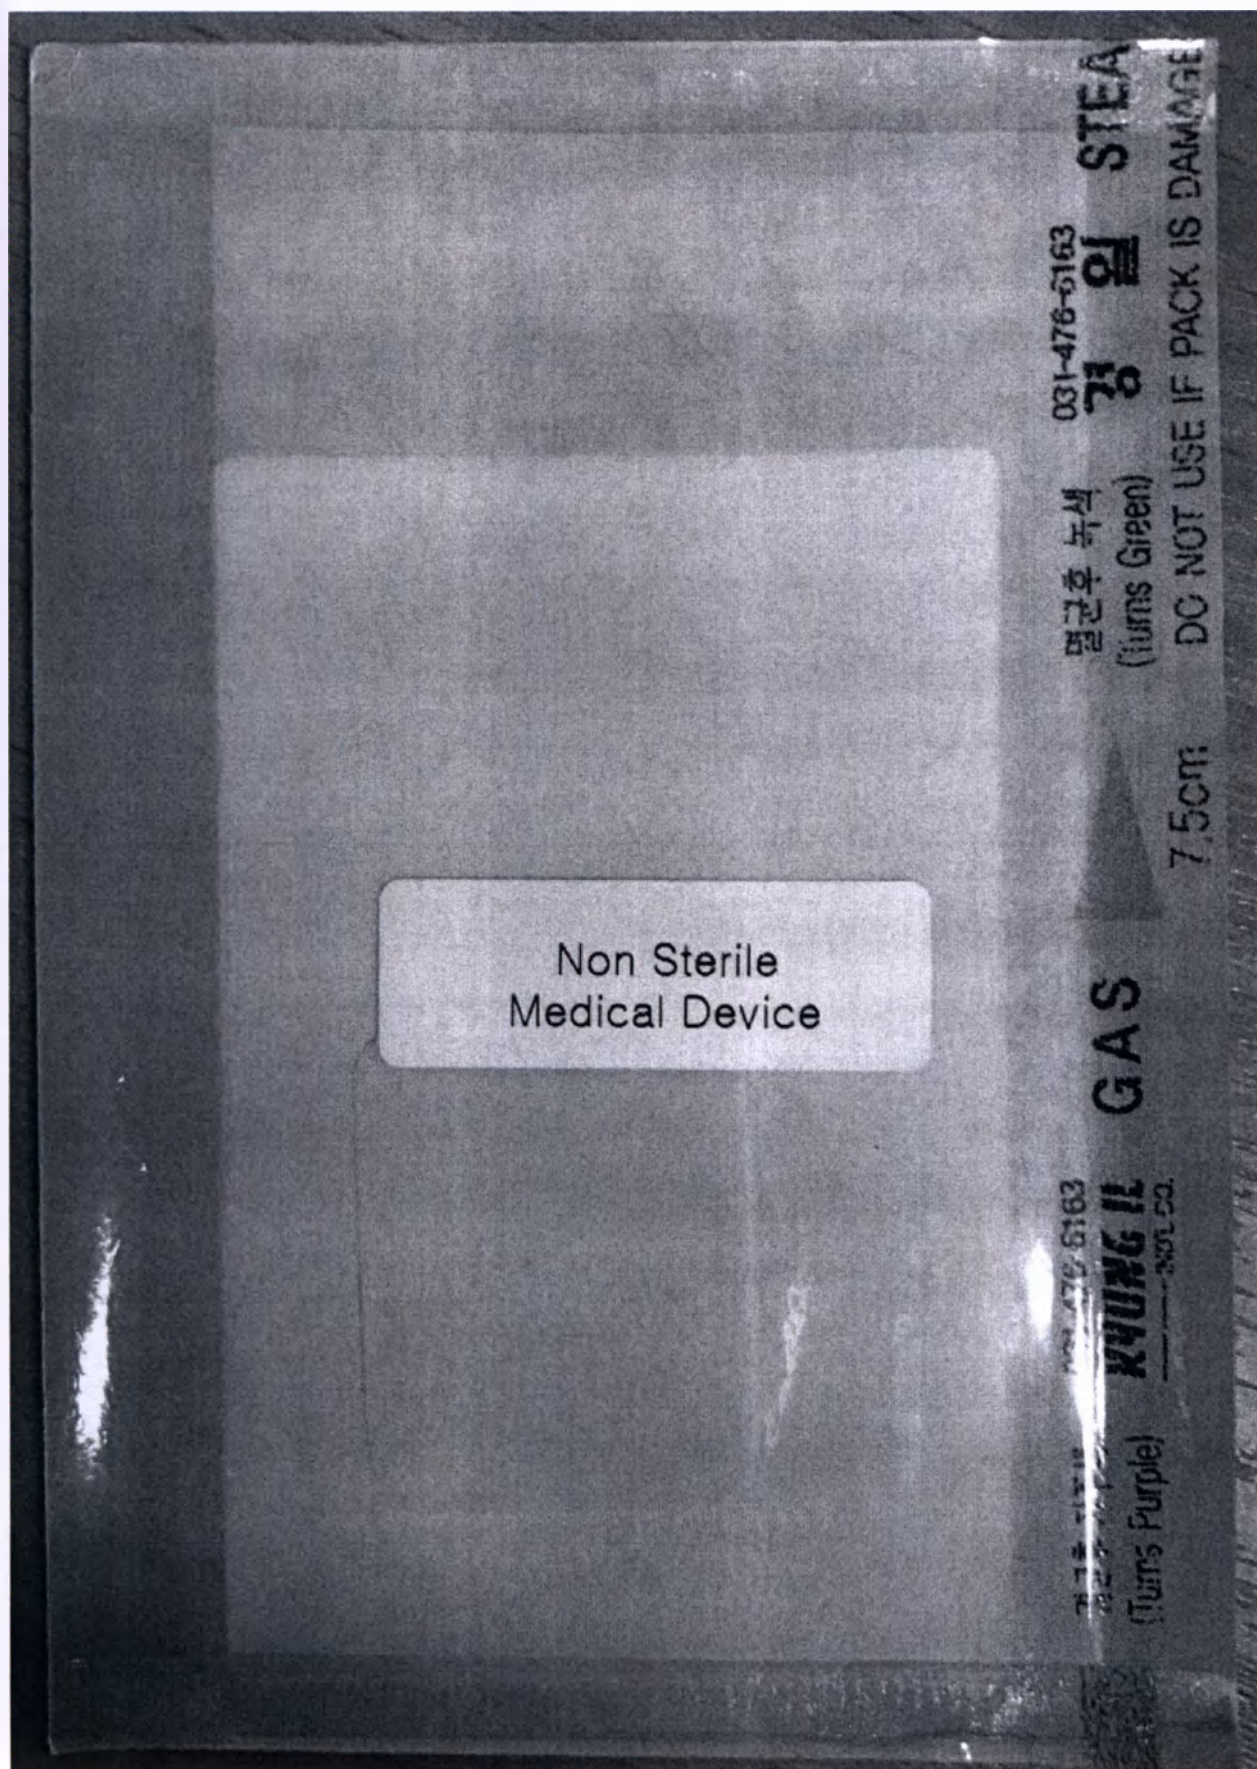

Мембрана политетрафторэтиленовая BOSS

Мембрана политетрафторэтиленовая BOSS

Тип : TS17251
Размер : 17*25*0.1T
Регистрационный № : 09-166
ЛОТ №  : 18A1A020
Дата производства  : 2018-01-05
Использовать до  : 2028-01-04
Единиц в упаковке : 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15°--+25°, в сухом, темном месте.



Do Not
Reuse



Внимание,
См. руководство

Медицинское изделие


Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: Утилизировать продукт при повреждении упаковки.

Коуэлл Меди Ко., Лтд.:

48, Хагамгаро 221, Понгиль, район Сасан, Пусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027~8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия № 780



Cowellmedi Co., Ltd.



TS17251-18A1A020



(01) 08809471726394


(11) 180105

(10) 18A1A

(21) 020

CWM-L-0050/01-21

Мембрана политетрафторэтиленовая BOSS

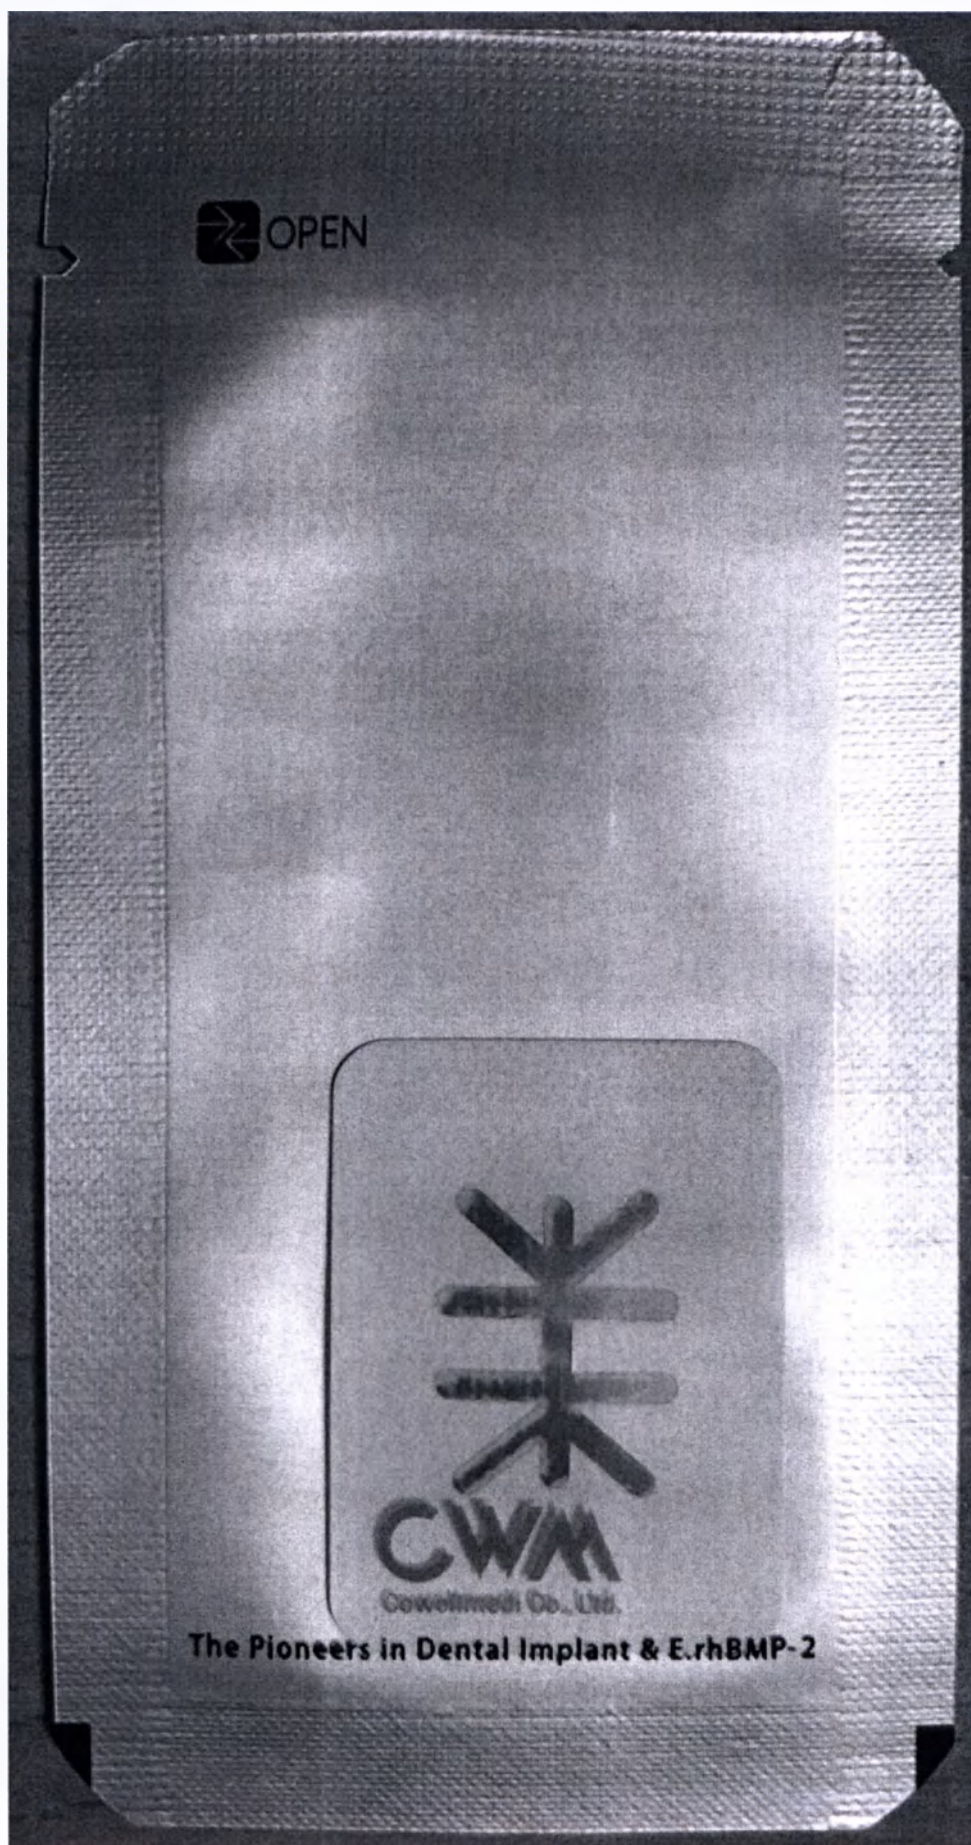

**Мембрана политетрафторэтиленовая с титановым каркасом
(Ti-PTFE Membrane)**

Мембрана политетрафторэтиленовая с титановым каркасом

Тип : BTP3040
Размер : 20 X 40
Регистрационный № : 15-65
ЛОТ №  : 18A1A027
Дата производства  : 2018-01-03
Использовать до  : 2028-01-02
Единиц в упаковке : 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15° - +25°, в сухом, темном месте.


Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: Утилизировать продукт при повреждении упаковки.

Коуэлл Меди Ко., Лтд:-

48, Хагамтэро 221, Понгиль, район Сасан, Пусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027~8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия №: 780



Do Not
Reuse



Внимание,
См. руководство



Cowellmedi Co., Ltd.

Cowellmedi Co., Ltd.

Медицинское изделие



BTP3040-18A1A027




(01) 08800016105858

(11) 180103


(10) 18A1A

(21) 027


Мембрана политетрафторэтиленовая с титановым каркасом
(Ti-PTFE Membrane)

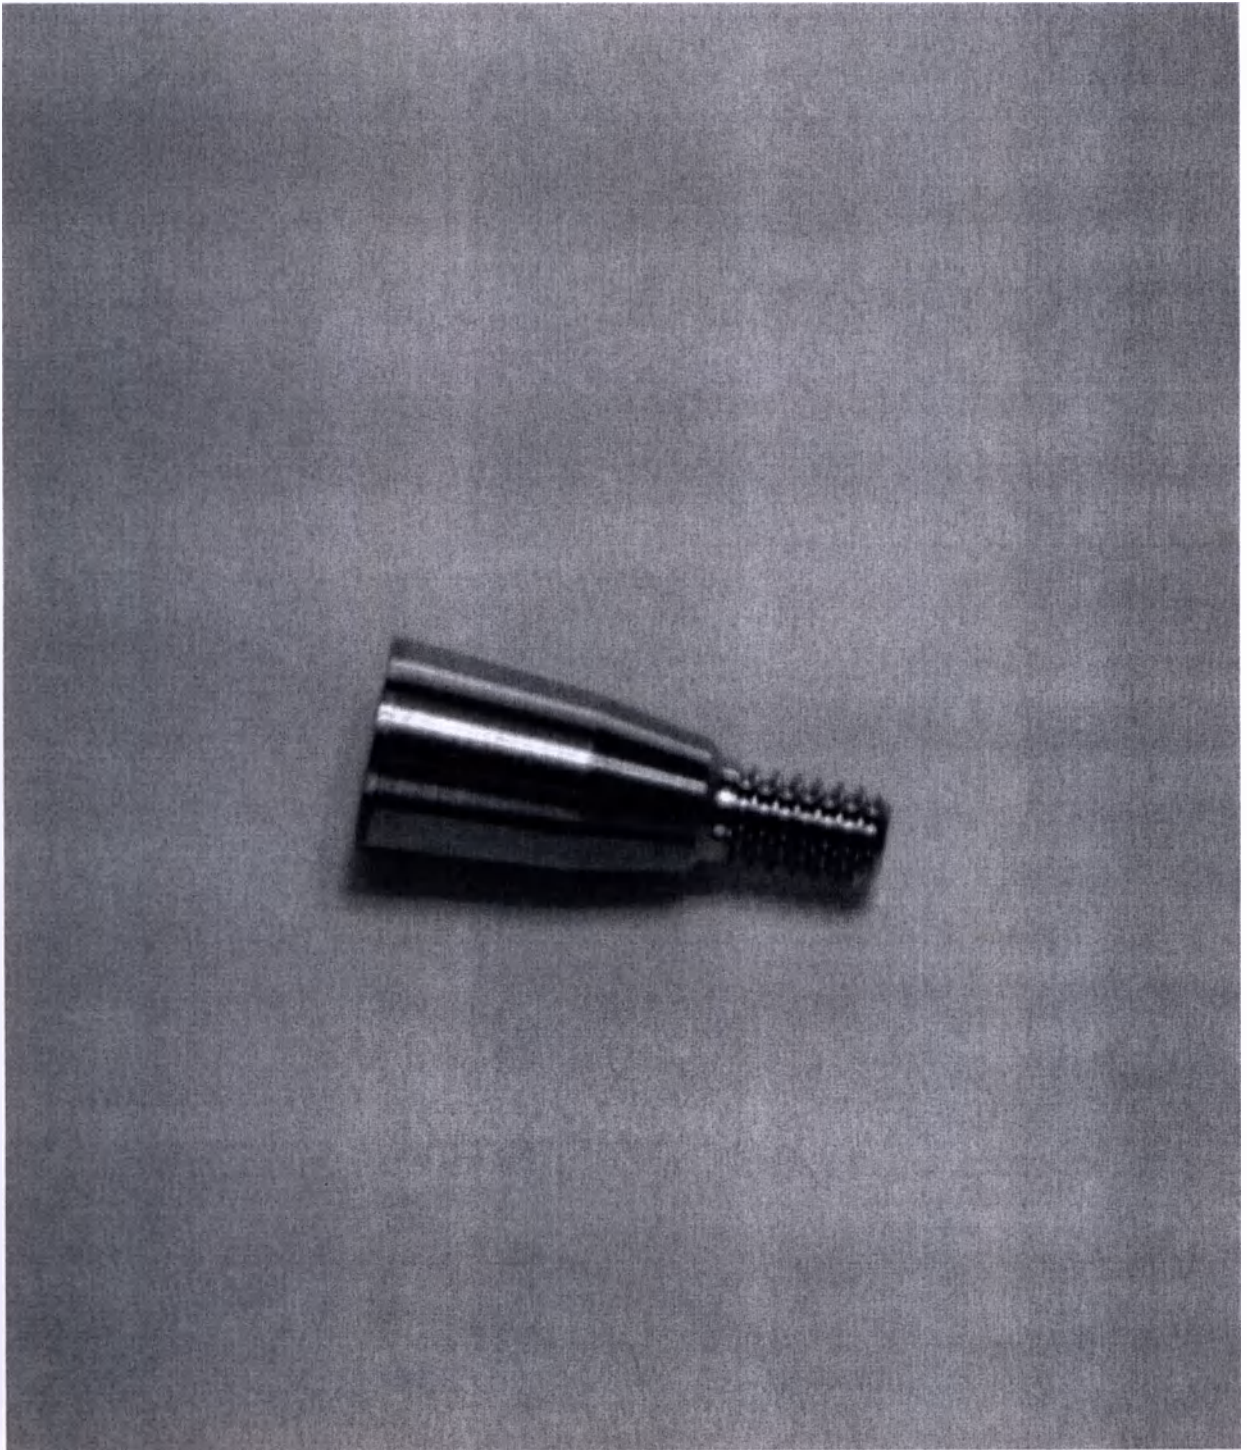

Корпус BOSS Тип I (BOSS Type I Body)

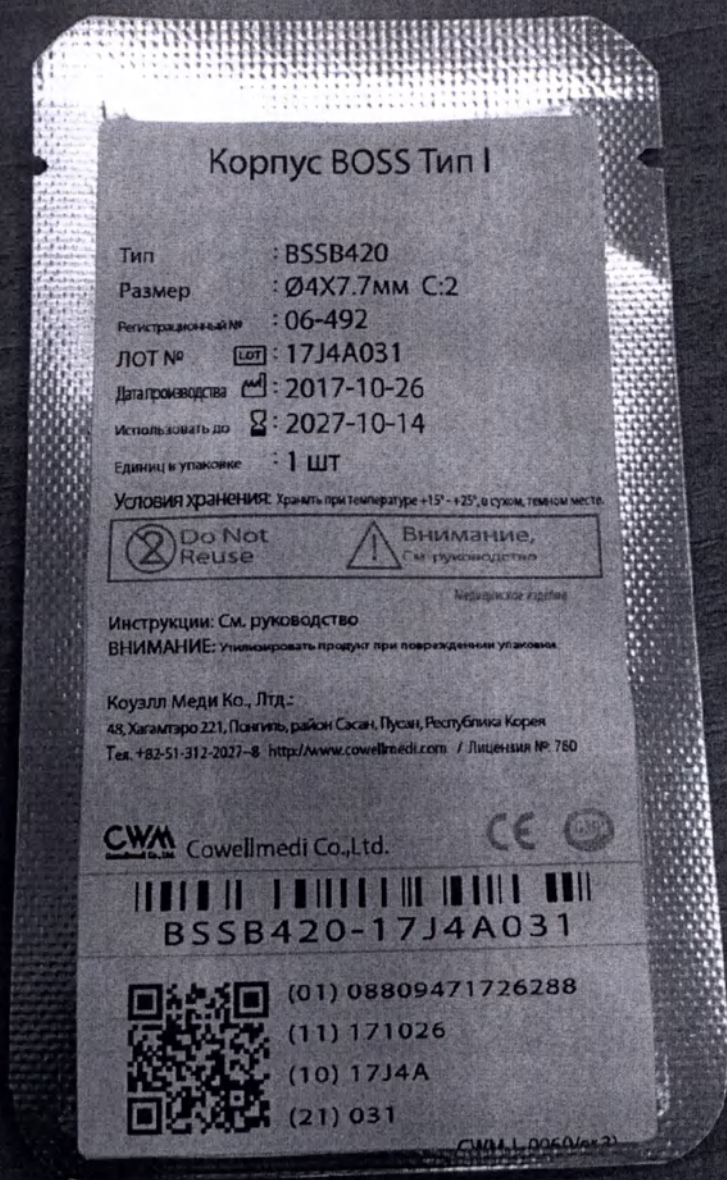

Корпус BOSS Тип I (BOSS Type I Body)

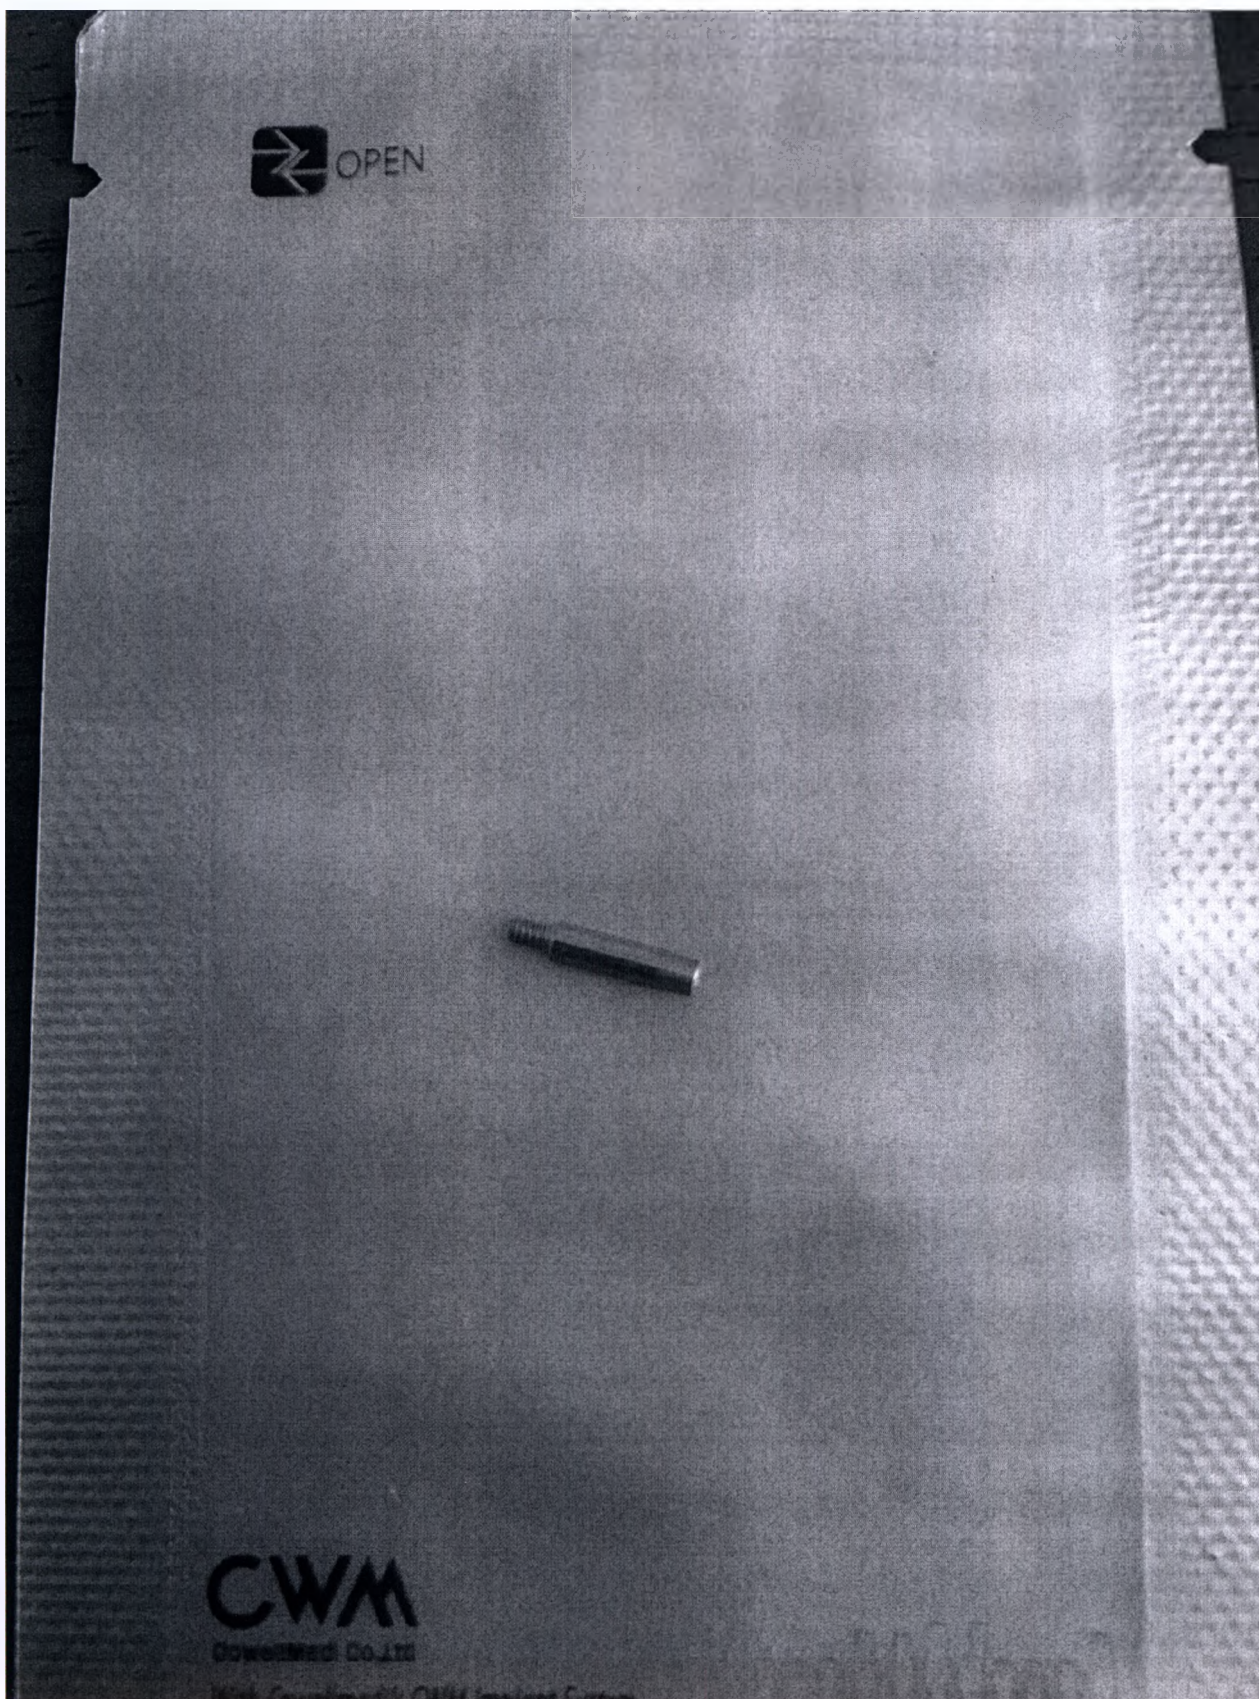


Опора временная BOSS Тип I

Опора временная BOSS Тип I

Тип : BSST001
Размер : Ø2X7.7MM
Регистрационный № : 09-135
ЛОТ №  : 17G3A010
Дата производства  : 2017-07-13
Использовать до  : 2027-07-12
Единица в упаковке : 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15° - +25°, в сухом, темном месте



Do Not
Reuse



Внимание,
См. руководство

Модель изделия

Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: утилизировать продукт при повреждении упаковки


Коуэлл Меди Ко., Лтд.:

48, Хагамгэро 221, Покчипль, район Сасан, Пусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027-8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия № 7861



Cowellmedi Co.,Ltd.



BSST001-17G3A010



(01) 08809471726325


(11) 170713

(10) 17G3A

(21) 010

CWA 1 006-01-71

Опора временная BOSS Тип I

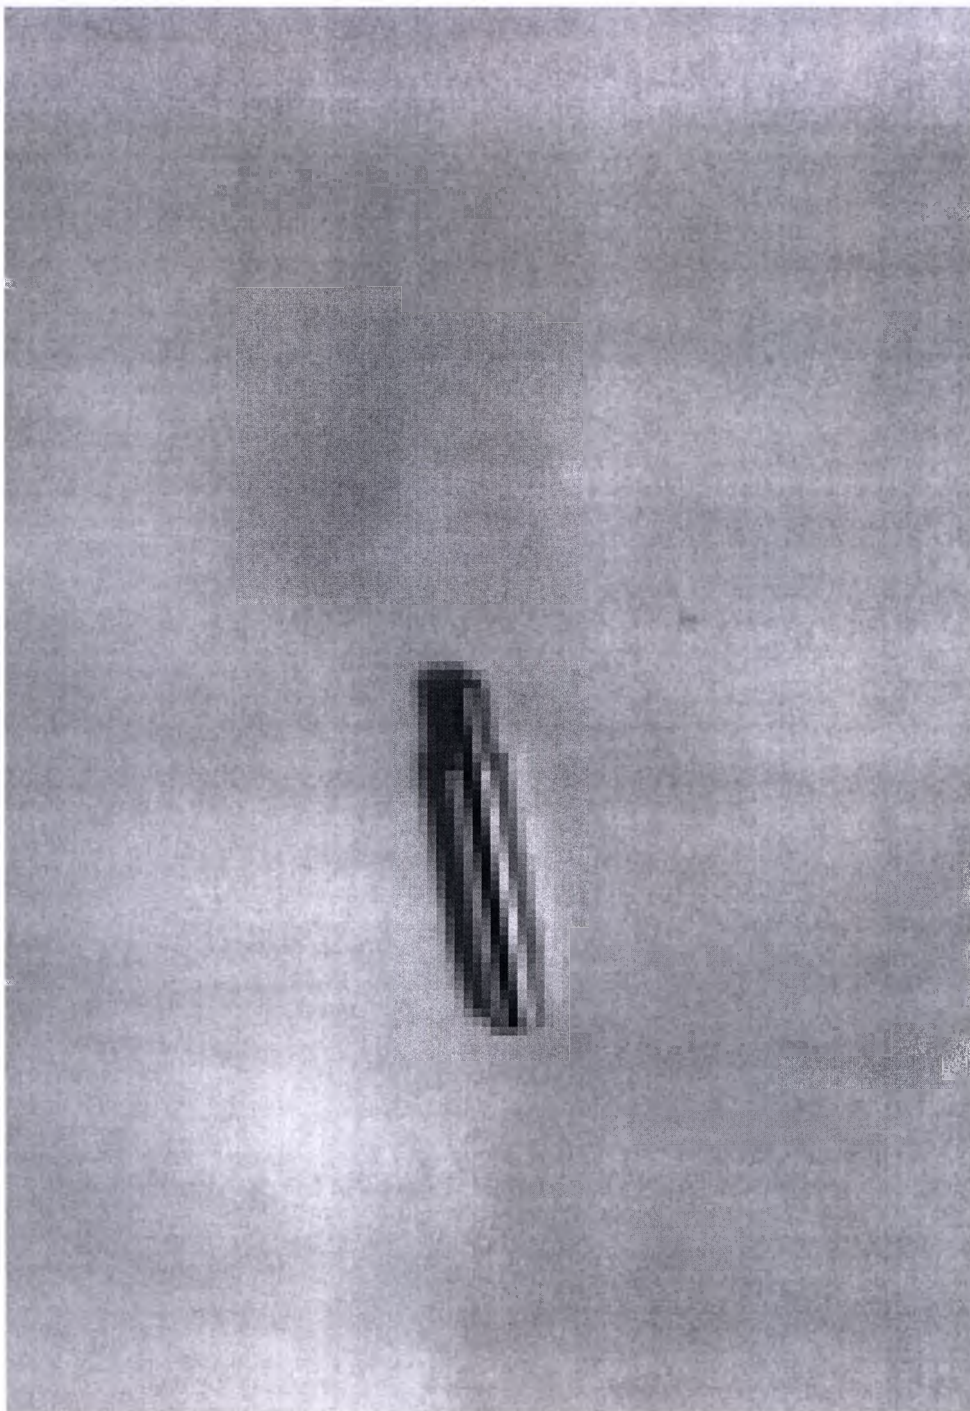

Опора временная BOSS Тип II

Опора временная BOSS Тип II

Тип : 2BSSG001
Размер : Ø2X9.2мм
Регистрационный № : 09-135
ЛОТ №  : 17C3A006
Дата производства  : 2017-03-16
Использовать до  : 2027-03-15
Единиц в упаковке 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15° - +25°, в сухом темном месте.



Do Not
Reuse



Внимание,
См. руководство

Медицинское изделие

Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: утилизировать продукт при повреждении упаковки.

Коуэлл Меди Ко., Лтд.:

48, Хагамтэро 221, Понгиль, район Сасан, Пусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027-8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия №: 780



Cowellmedi Co., Ltd.



2BSSG001-17C3A006



(01) 08809471726363


(11) 170316

(10) 17C3AQ

(21) 006

CWM 1 006001-21

Опора временная BOSS Тип II

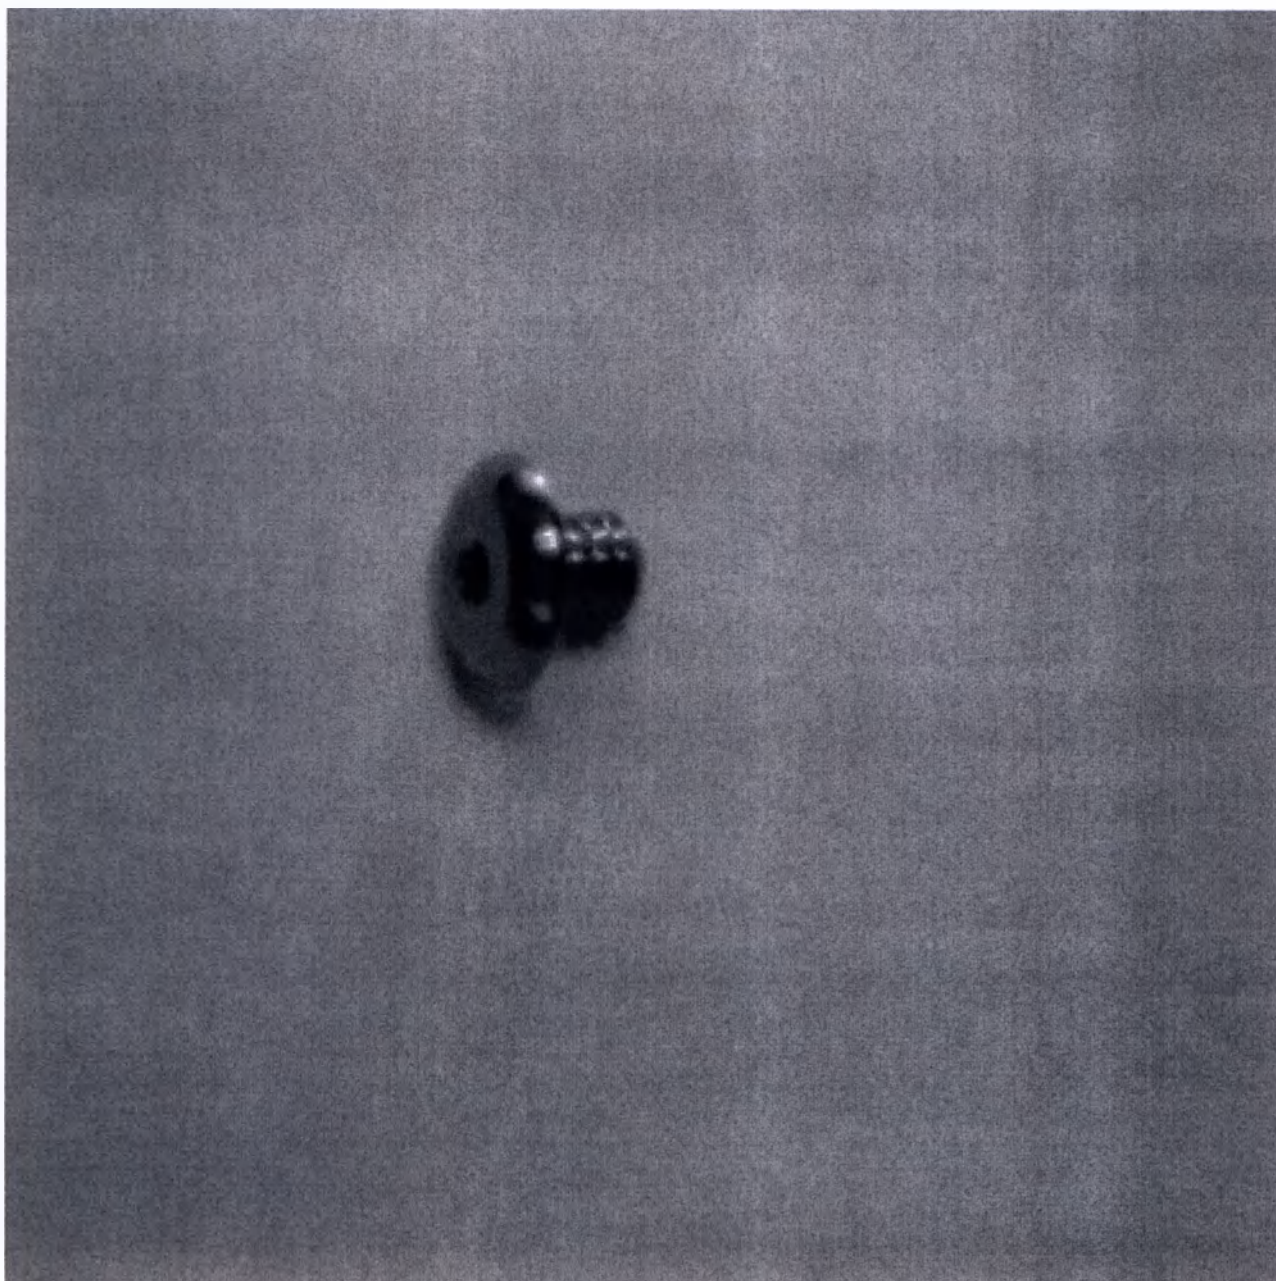


Формирователь десны BOSS Тип I (BOSS Type I Healing)

Формирователь десны BOSS Тип I

Тип : BSSH001
Размер : Ø4X3мм C:0.8
Регистрационный № : 06-492
ЛОТ №  : 17J4A030
Дата производства  : 2017-10-26
Использовать до  : 2027-10-25
Единиц в упаковке : 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15°-+25°, в сухом, темном месте.



Внимание,
См. руководство

Медицинское изделие

Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: Утилизировать продукт при повреждении упаковки.

Коуэлл Меди Ко., Лтд.:

48, Хагамтэро 221, Понгиль, район Сасан, Пусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027-8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия № 780



Cowellmedi Co., Ltd.



BSSH001-17J4A030



(01) 08809471726318


(11) 171026

(10) 17J4A

(21) 006

CWM 1 00606-73


Формирователь десны BOSS Тип I (BOSS Type I Healing)

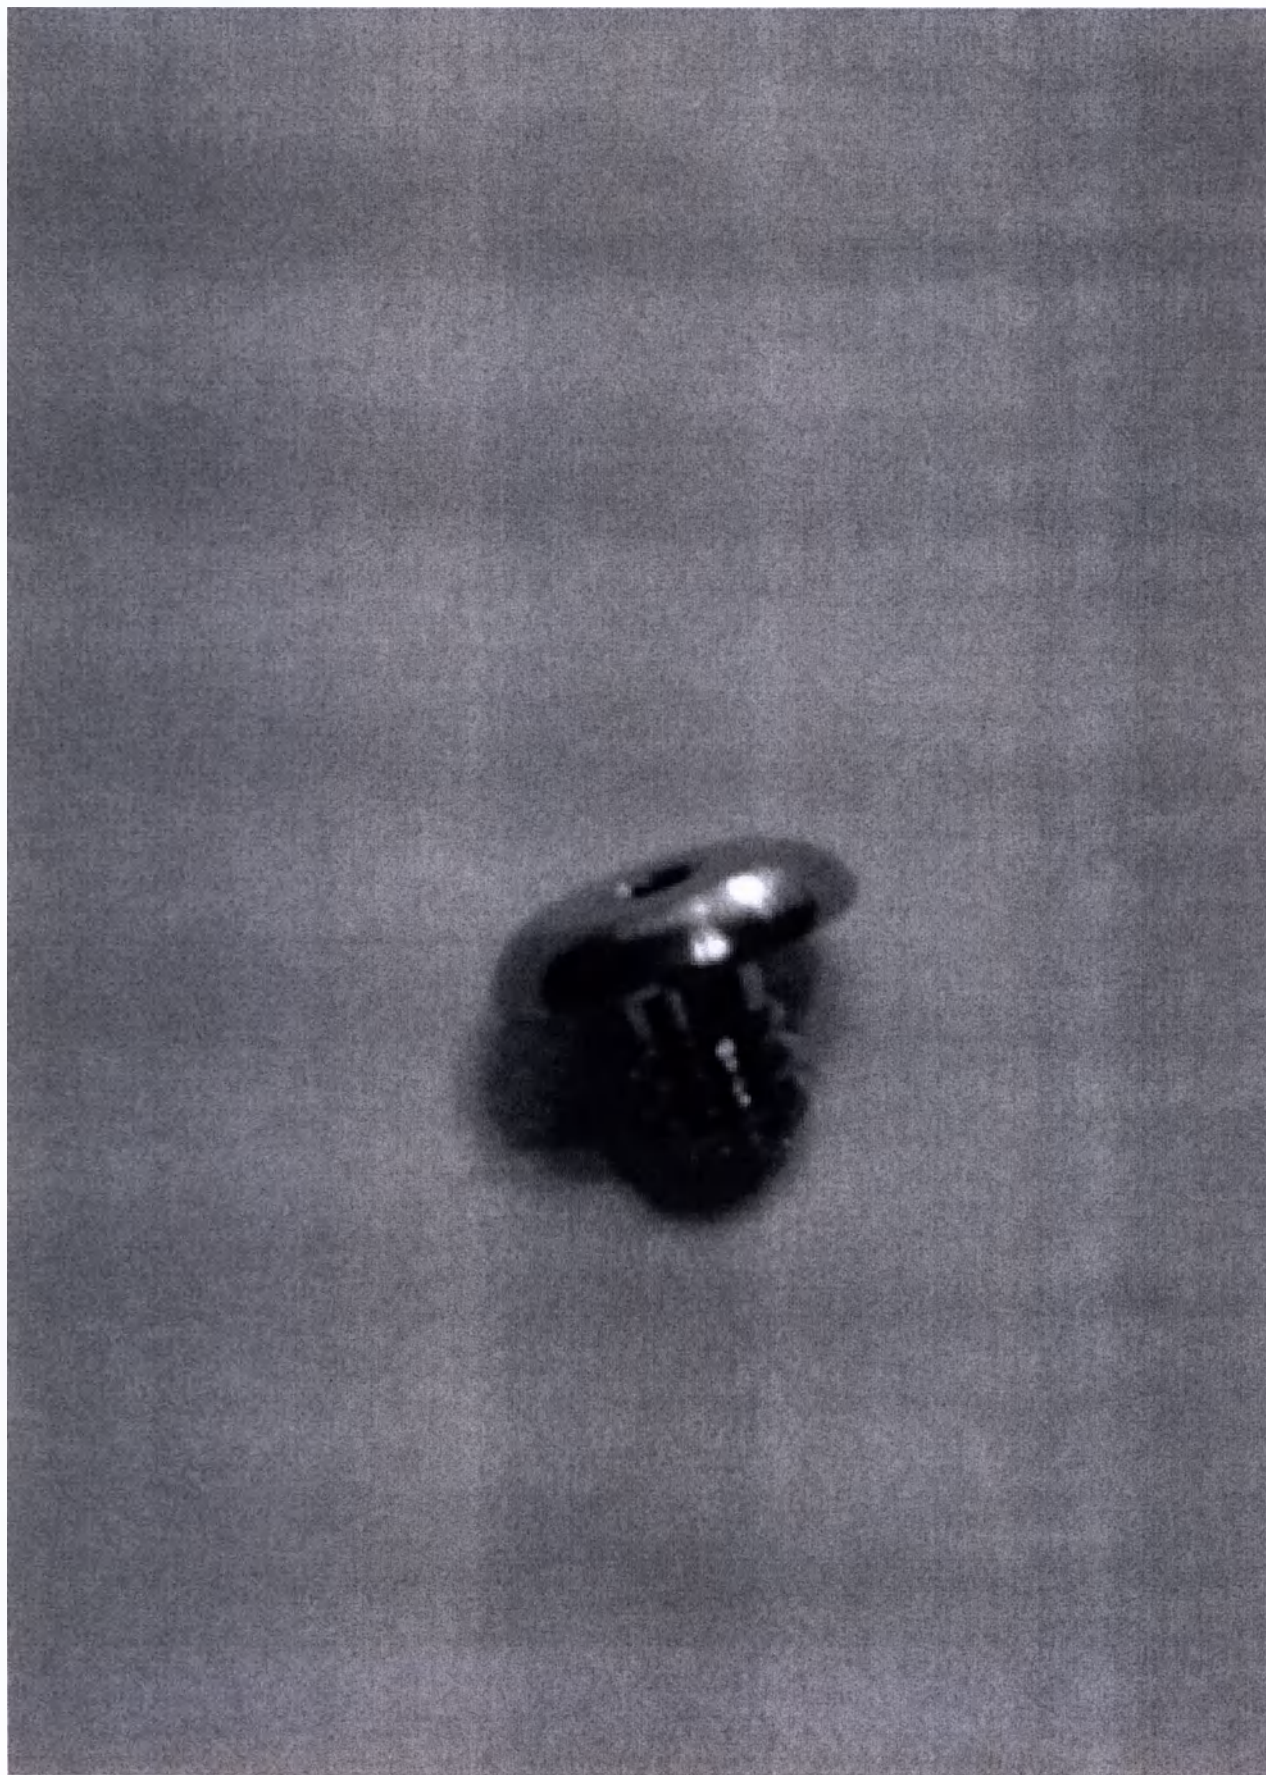

Формирователь десны BOSS Тип II (BOSS Type II Healing)



Формирователь десны BOSS Тип II (BOSS Type II Healing)

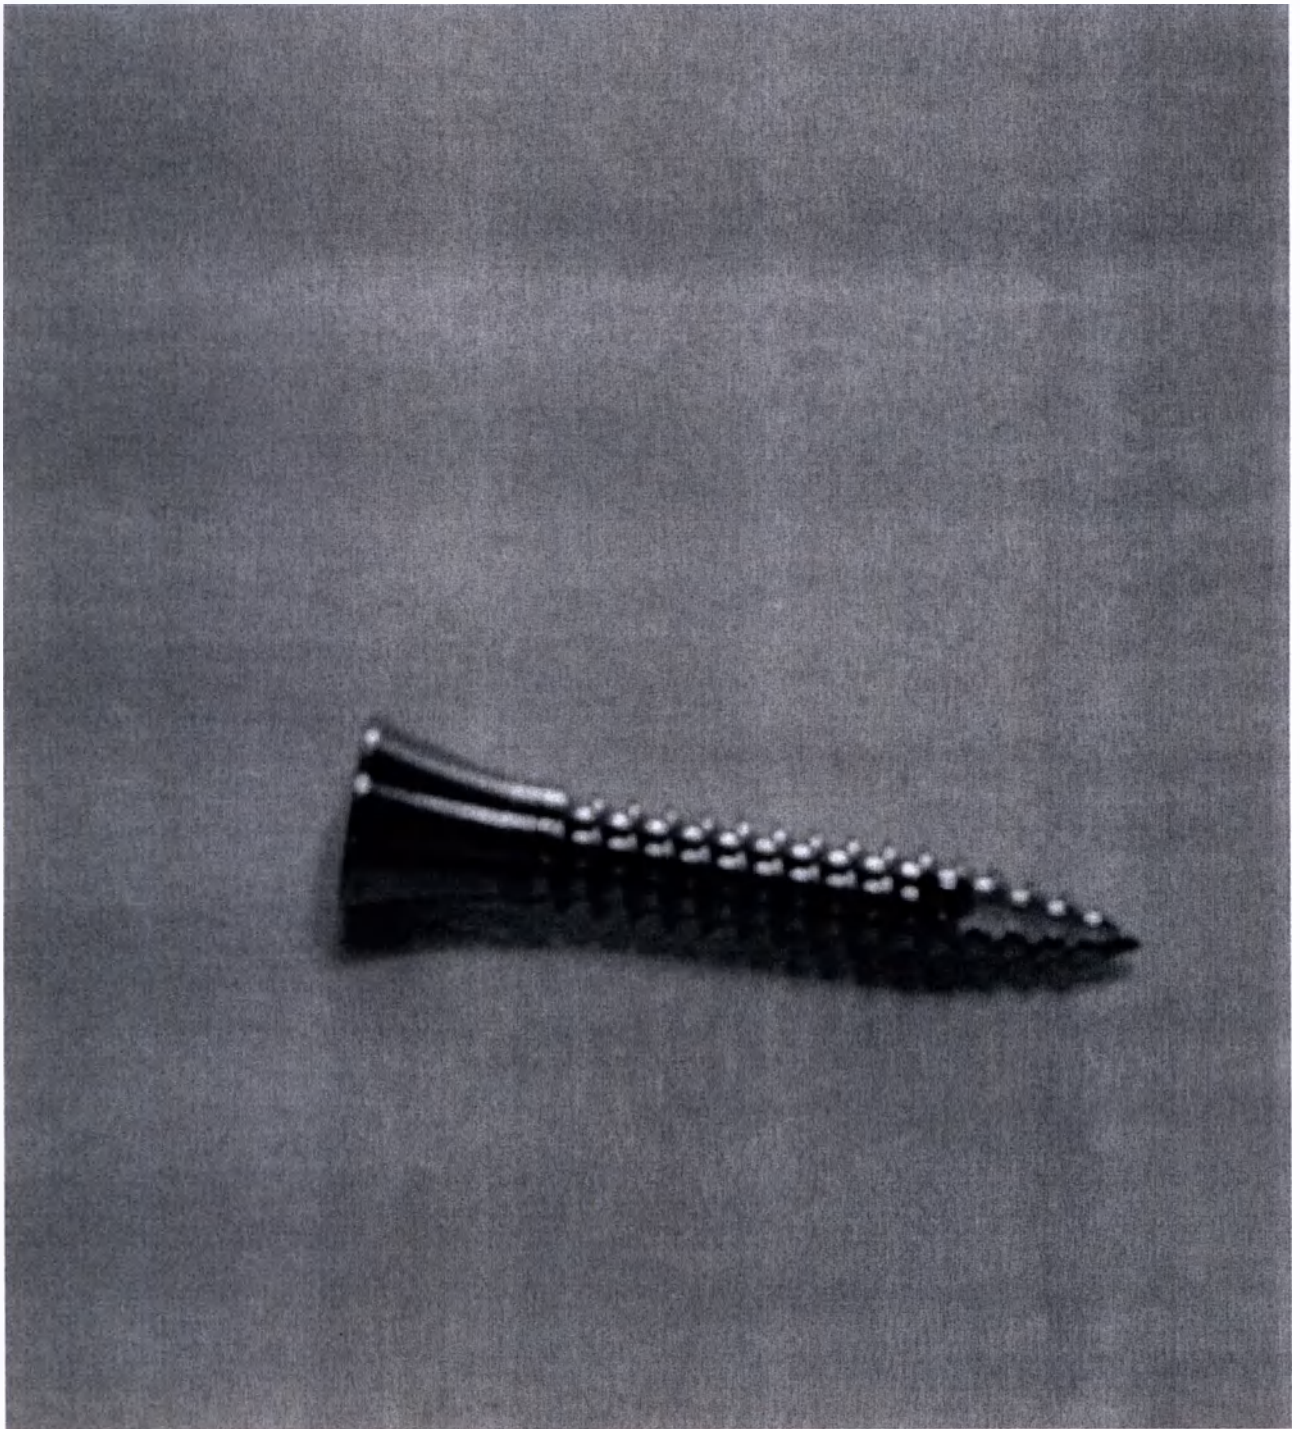


Винт BOSS Тип II (BOSS Type II Screw)

Винт BOSS Тип II

Тип : BSS52306
Размер : L:6мм C:3
Регистрационный № : 09-135
ЛОТ №  : 17K3A010
Дата производства  : 2017-11-17
Использовать до  : 2027-11-16
Единиц в упаковке : 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15° - +25°, в сухом, темном месте.



Do Not
Reuse



Внимание,
См. руководство

Медицинское изделие

Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: Утилизировать продукт при повреждении упаковки

Коуэлл Меди Ко., Лтд.:

48, Хагамгиро 221, Понгиль, район Сасан, Пусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027-8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия № 780



Cowellmedi Co., Ltd.



BSS52306-17K3A010



(01) 08809471726332


(11) 171117

(10) 17K3A

(21) 010

CWM L 006/161231

Винт BOSS Тип II (BOSS Type II Screw)

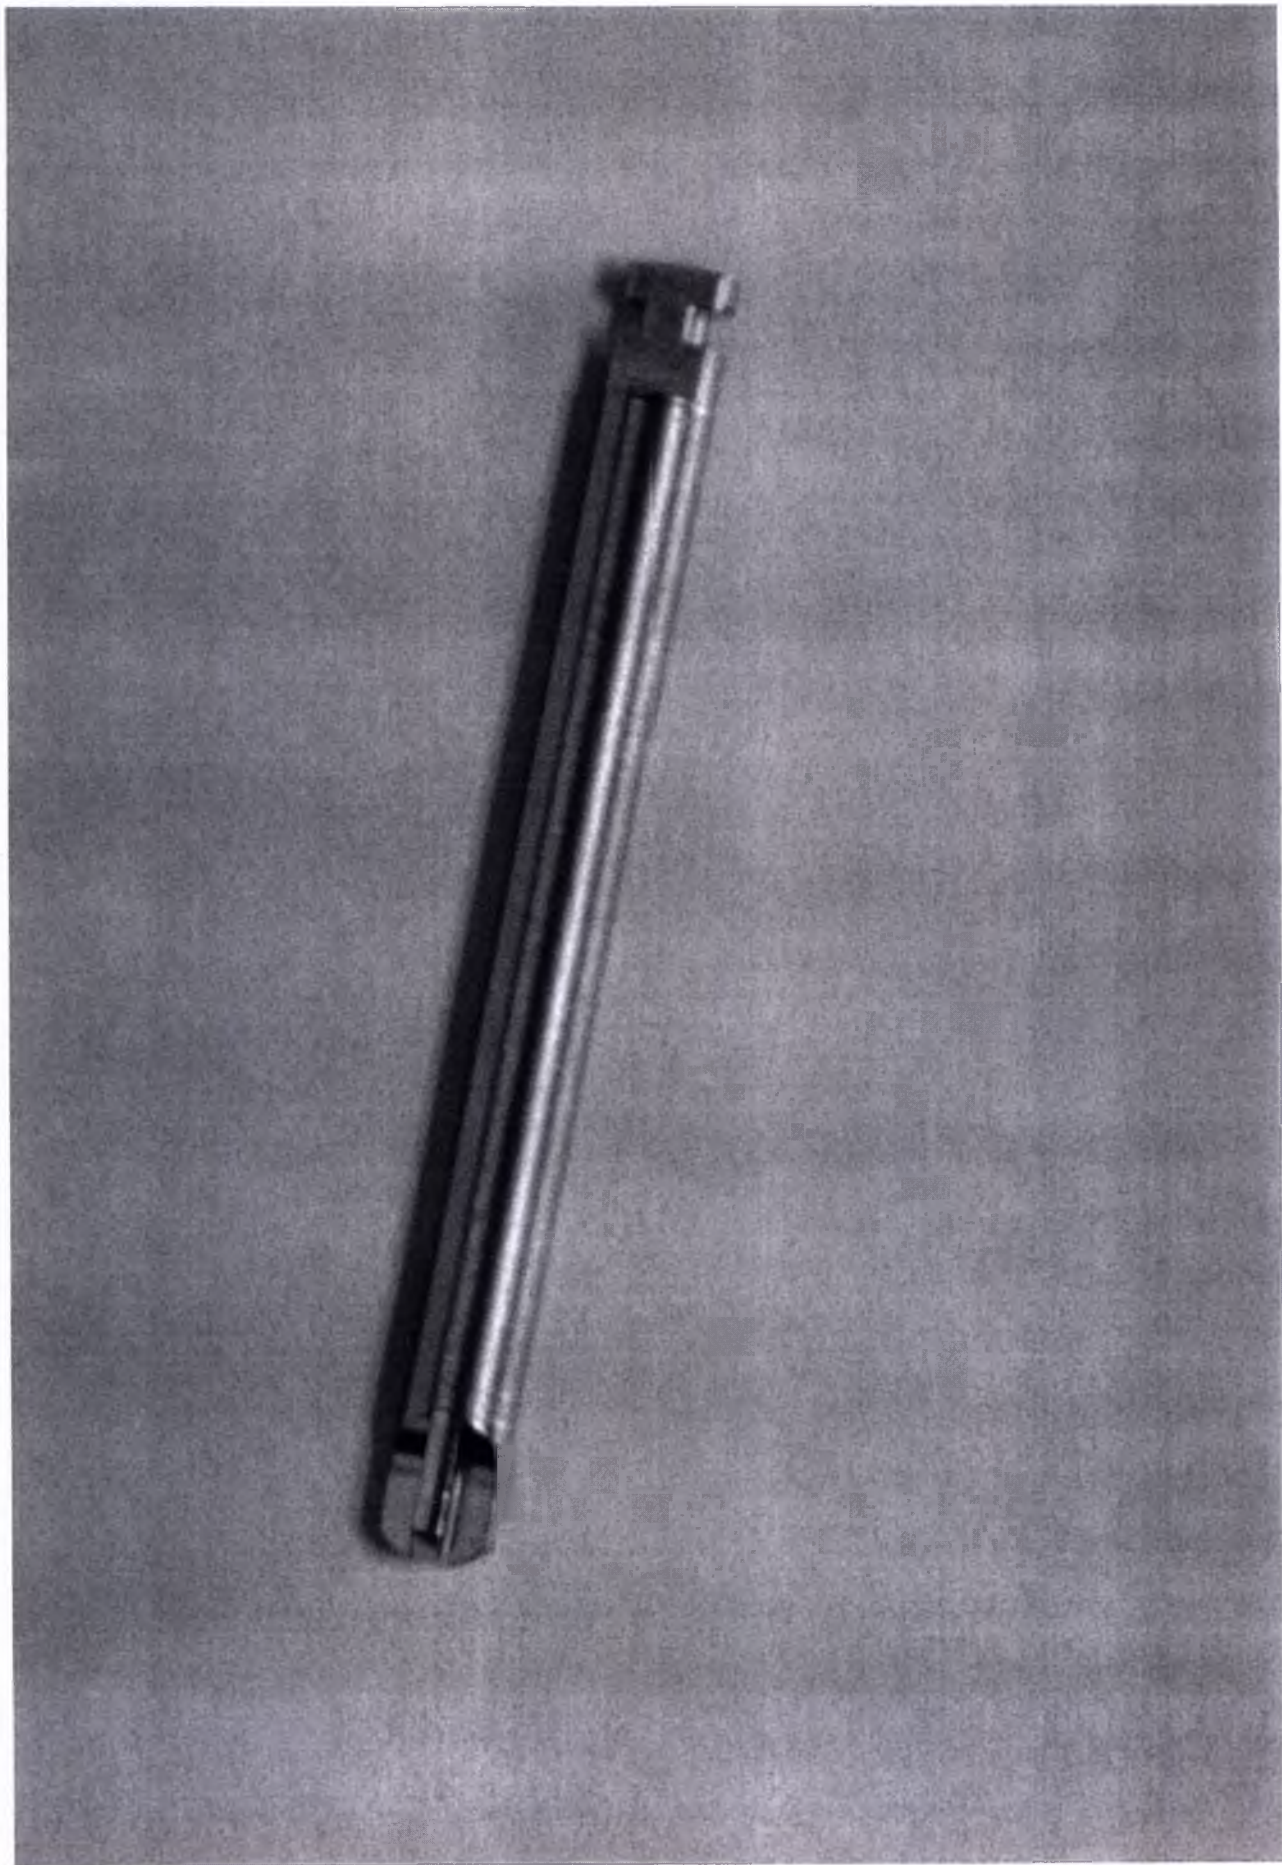

Отвертка (Screw Driver)

Отвертка

Тип : KBSD01
Размер : Type 2
Регистрационный № : 09-83
ЛОТ №  : 17K4A010
Дата производства  : 2017-11-24
Использовать до  : 2027-11-23
Единиц в упаковке : 1 шт

Условия хранения: Хранить при температуре +15° - +25°, в сухом, темном месте.



Внимание,
см. руководство

Медицинское изделие

Инструкции: См. руководство

ВНИМАНИЕ: Утилизировать продукт при поврежденной упаковке

Коуэлл Меди Ко., Лтд.:

48, Хагамтэро 221, Понгиль, район Сасан, Пусан, Республика Корея

Тел. +82-51-312-2027~8 <http://www.cowellmedi.com> / Лицензия №: 780



Cowellmedi Co., Ltd.



KBSD01-17K4A010



(01) 08809471726240

(11) 171124

(10) 17K4A


(21) 010

CWM.I.00601-21


Отвертка (Screw Driver)




Отвертка ручная (шестигранник 0,9) (Ratchet 0.9 HexDriver)

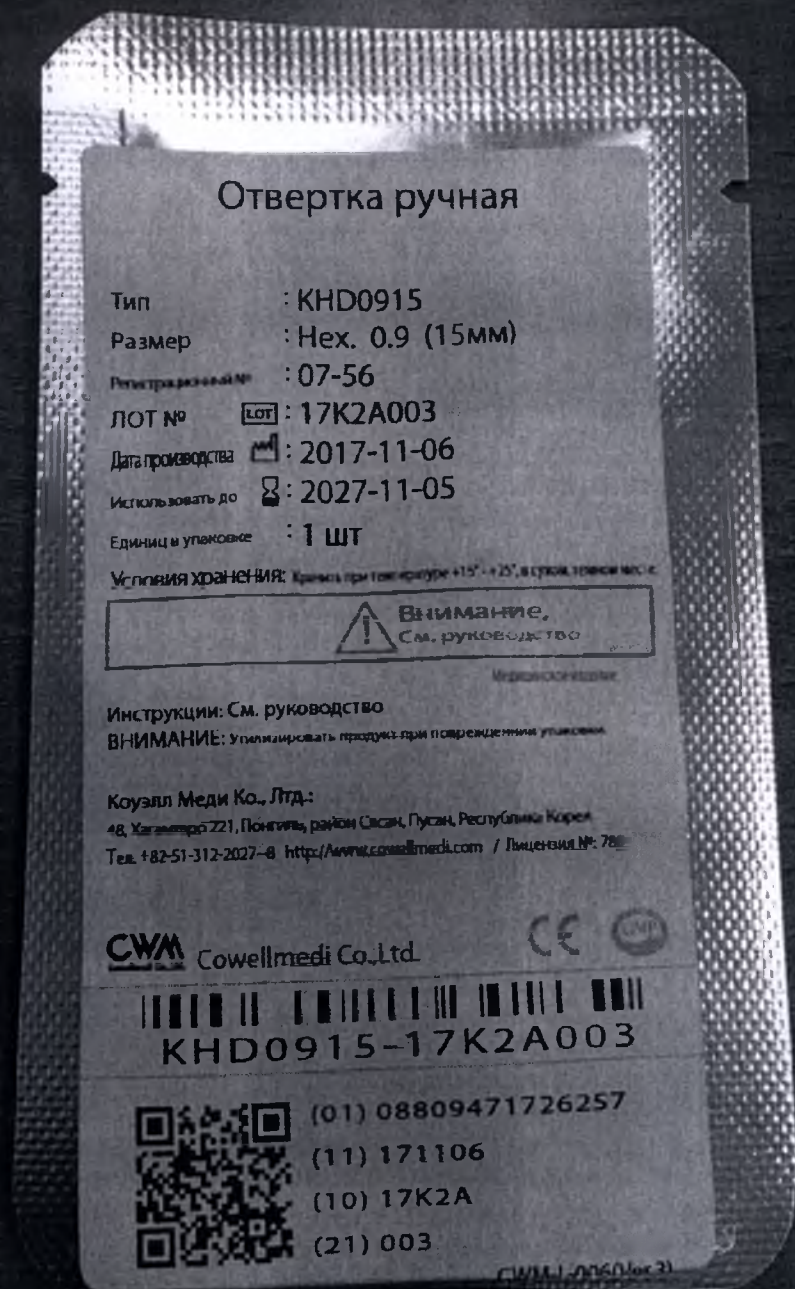

Отвертка ручная (шестигранник 0,9) (Ratchet 0.9 HexDriver)

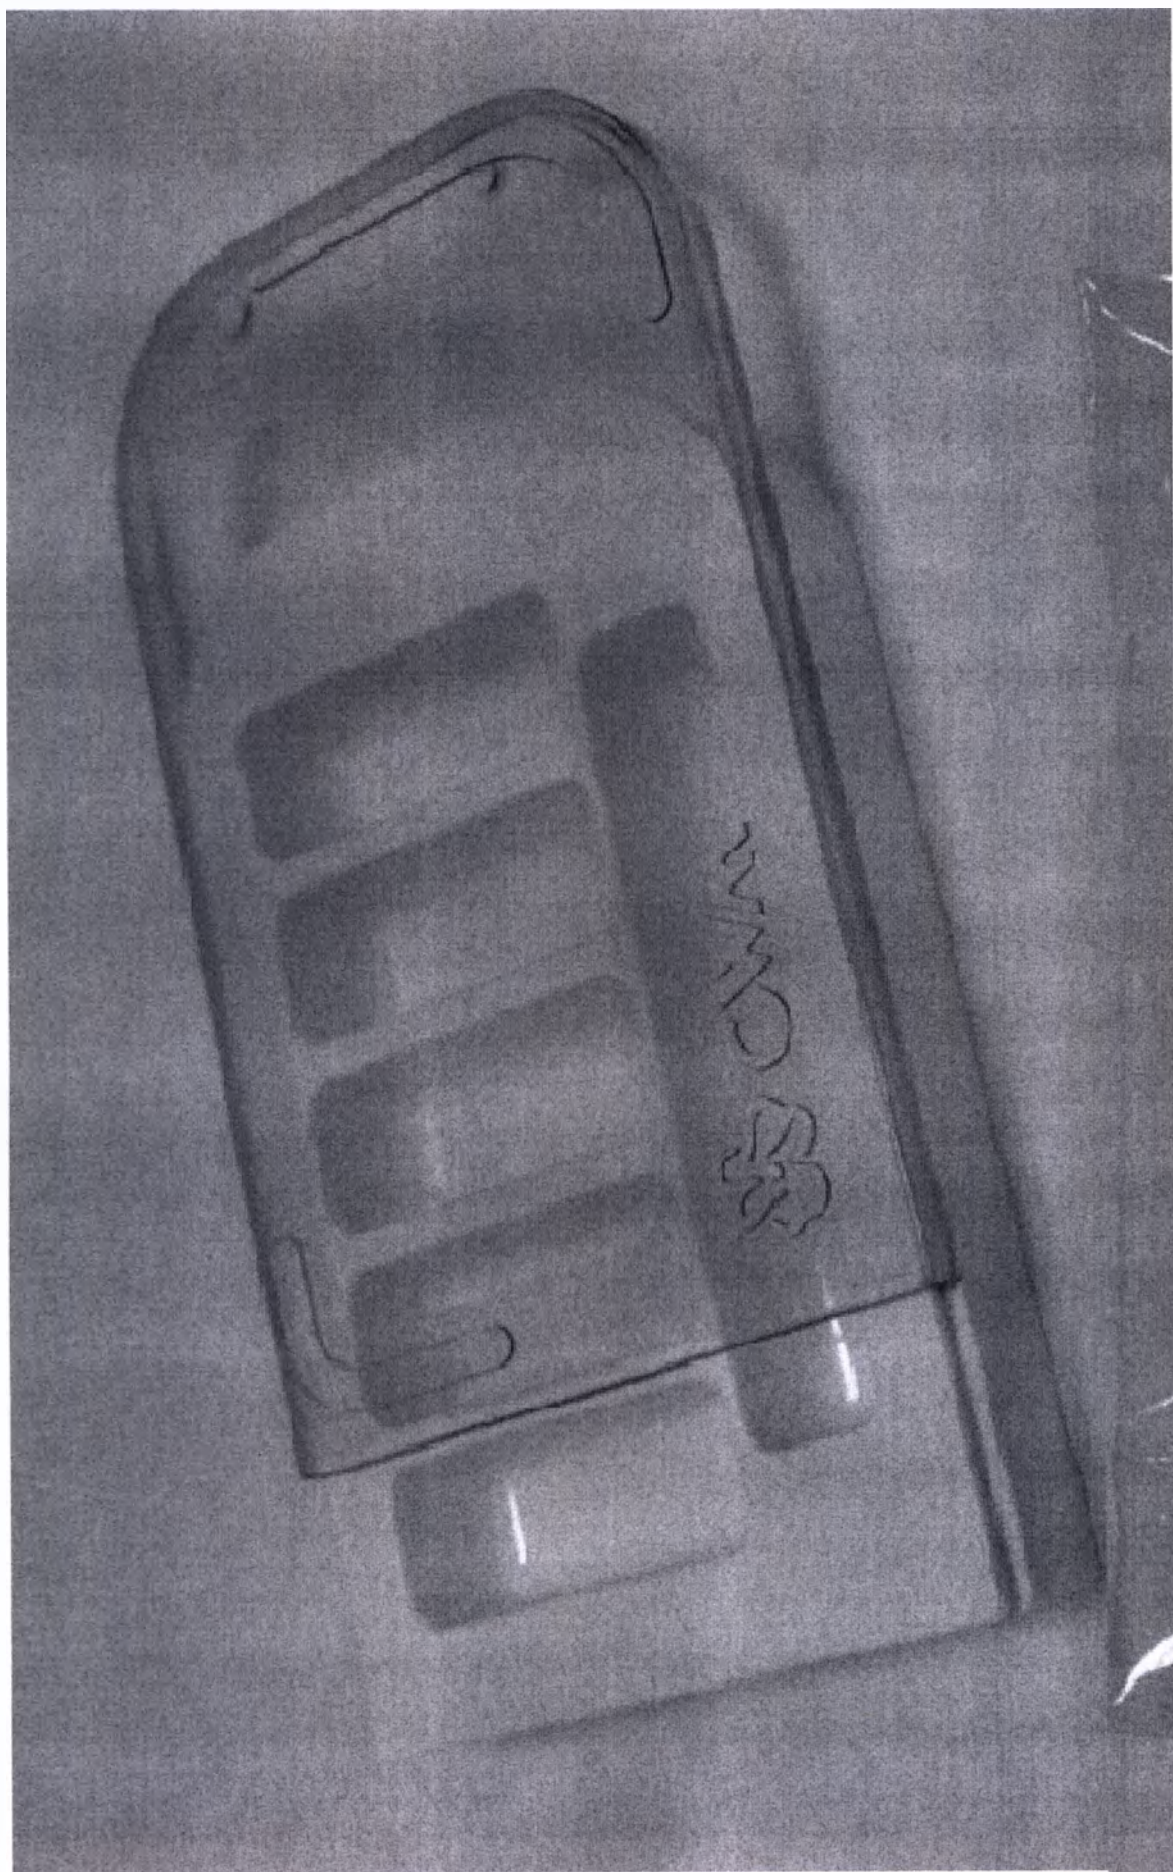

Футляр BOSS (BOSS Case)

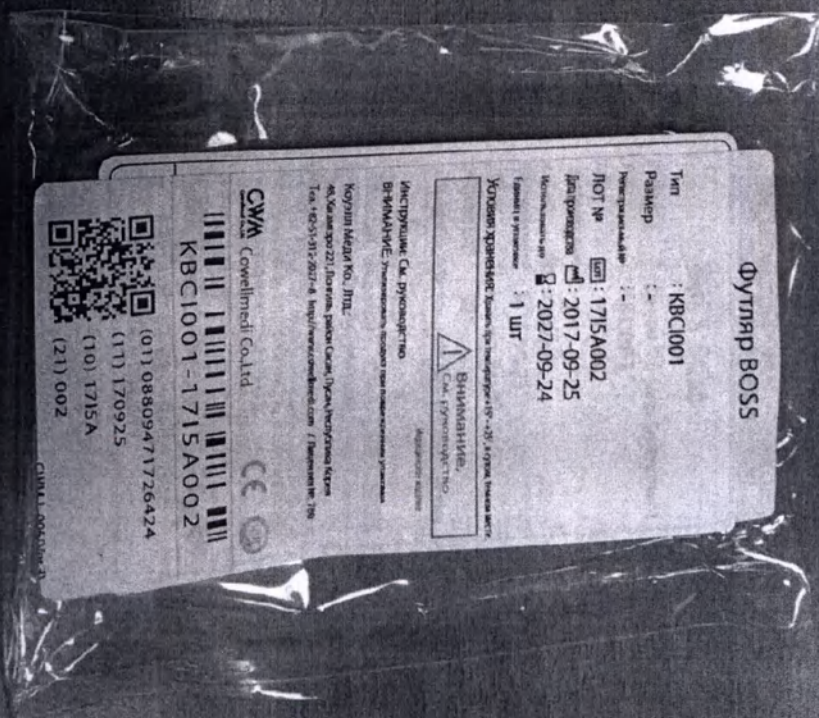

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



26.06.2023