




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Шестаков А.Я.

« 18 » июня 2019 г.


ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Набор контрольных материалов «BioPlex 2200 Syphilis Total & RPR Control Set» для
качественного определения суммарных антител (IgG/IgM) к *Treponema pallidum* и
нетрепонемных реактивных антител в сыворотке или плазме человека методом
мультиплексной проточной иммунофлуоресценции на приборе BioPlex 2200 с
принадлежностями,
производства**

Bio-Rad Laboratories, Inc., США, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547, USA

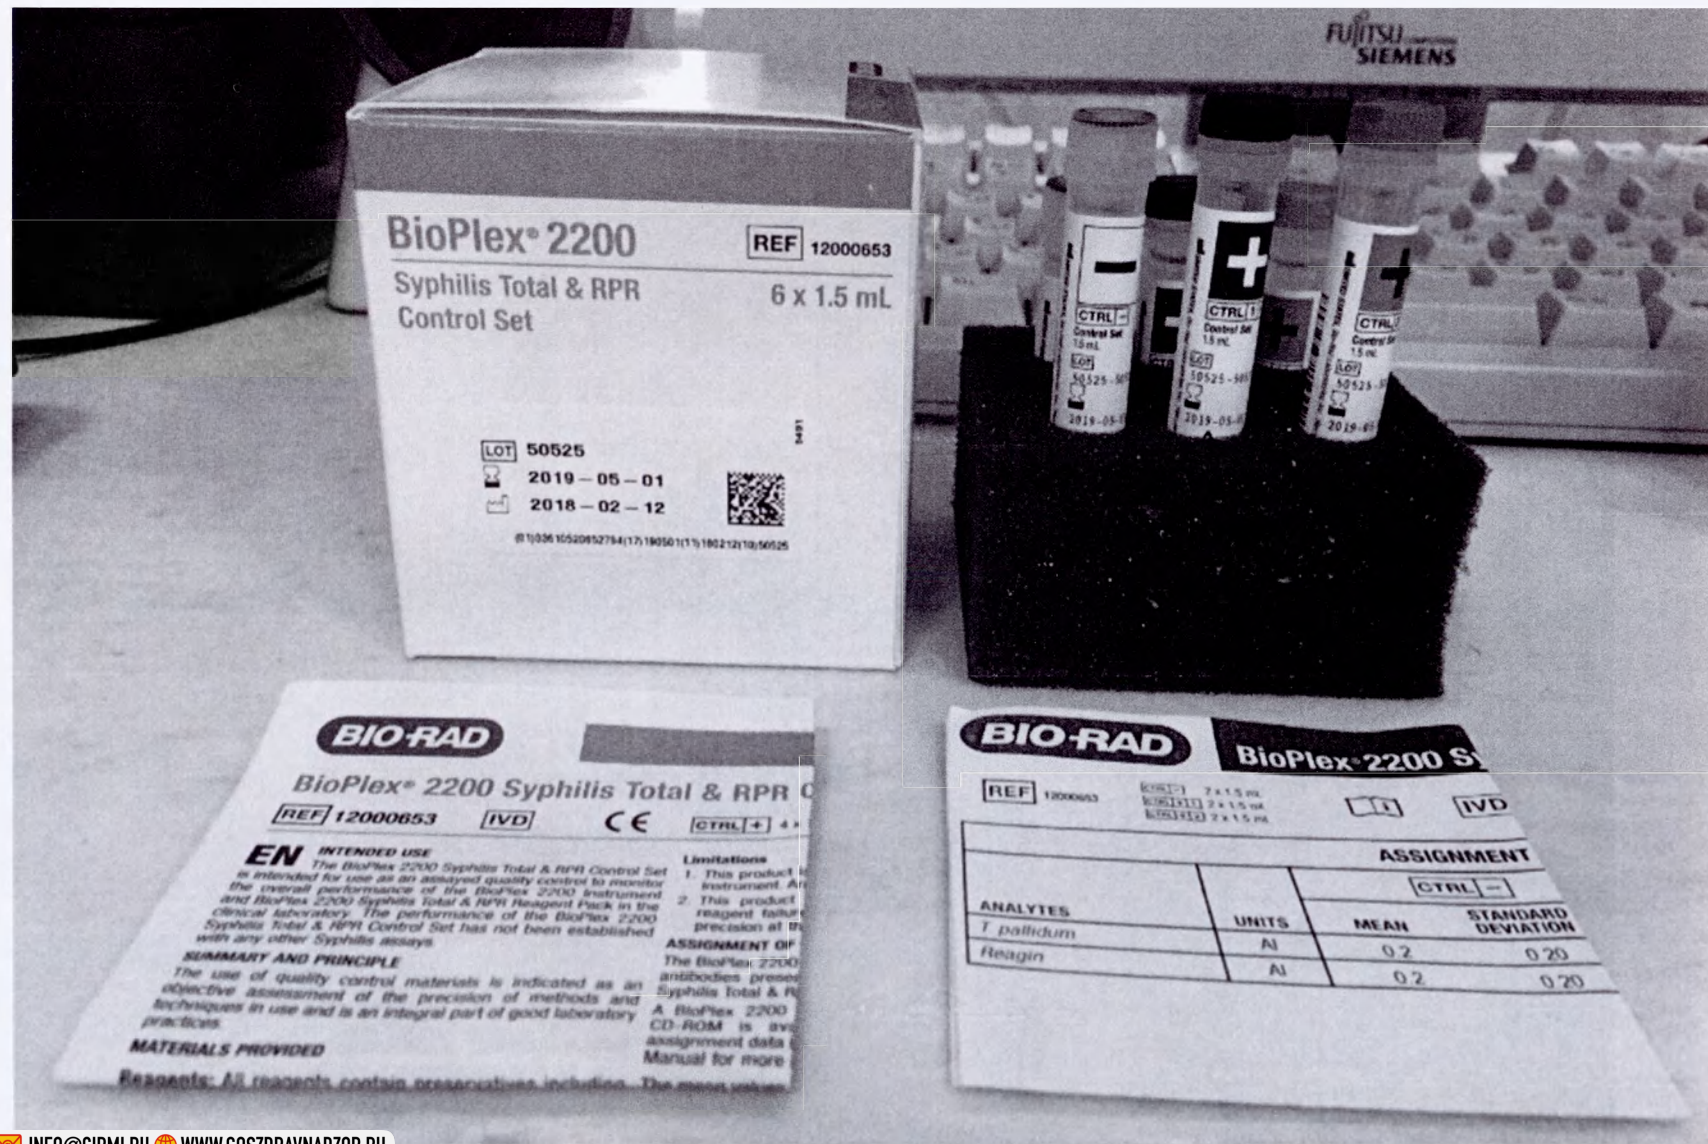

Внешний вид МИ «Набор контрольных материалов «BioPlex 2200 Syphilis Total & RPR Control Set» для качественного определения суммарных антител (IgG/IgM) к *Трепонема паллидум* и нетрепонемных реактивных антител в сыворотке или плазме человека методом мультиплексной проточной иммунофлуоресценции на приборе BioPlex 2200 с принадлежностями»

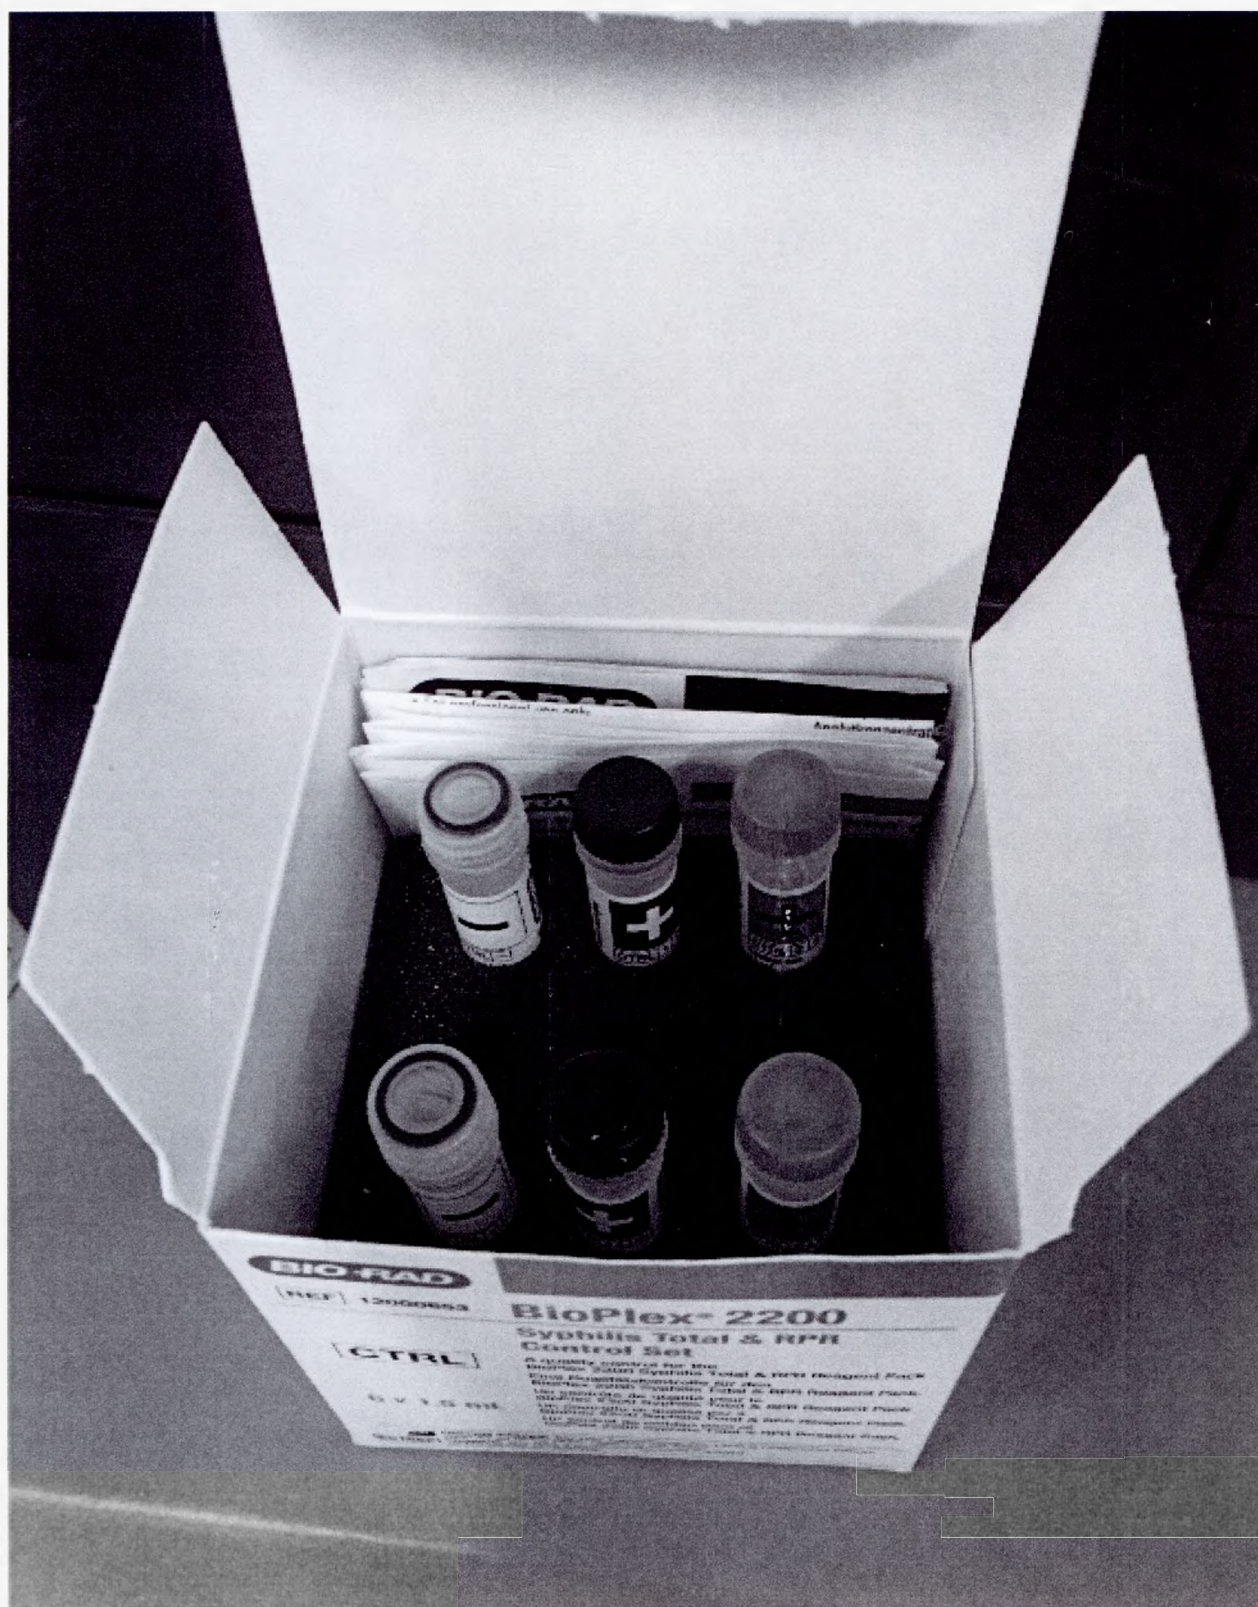

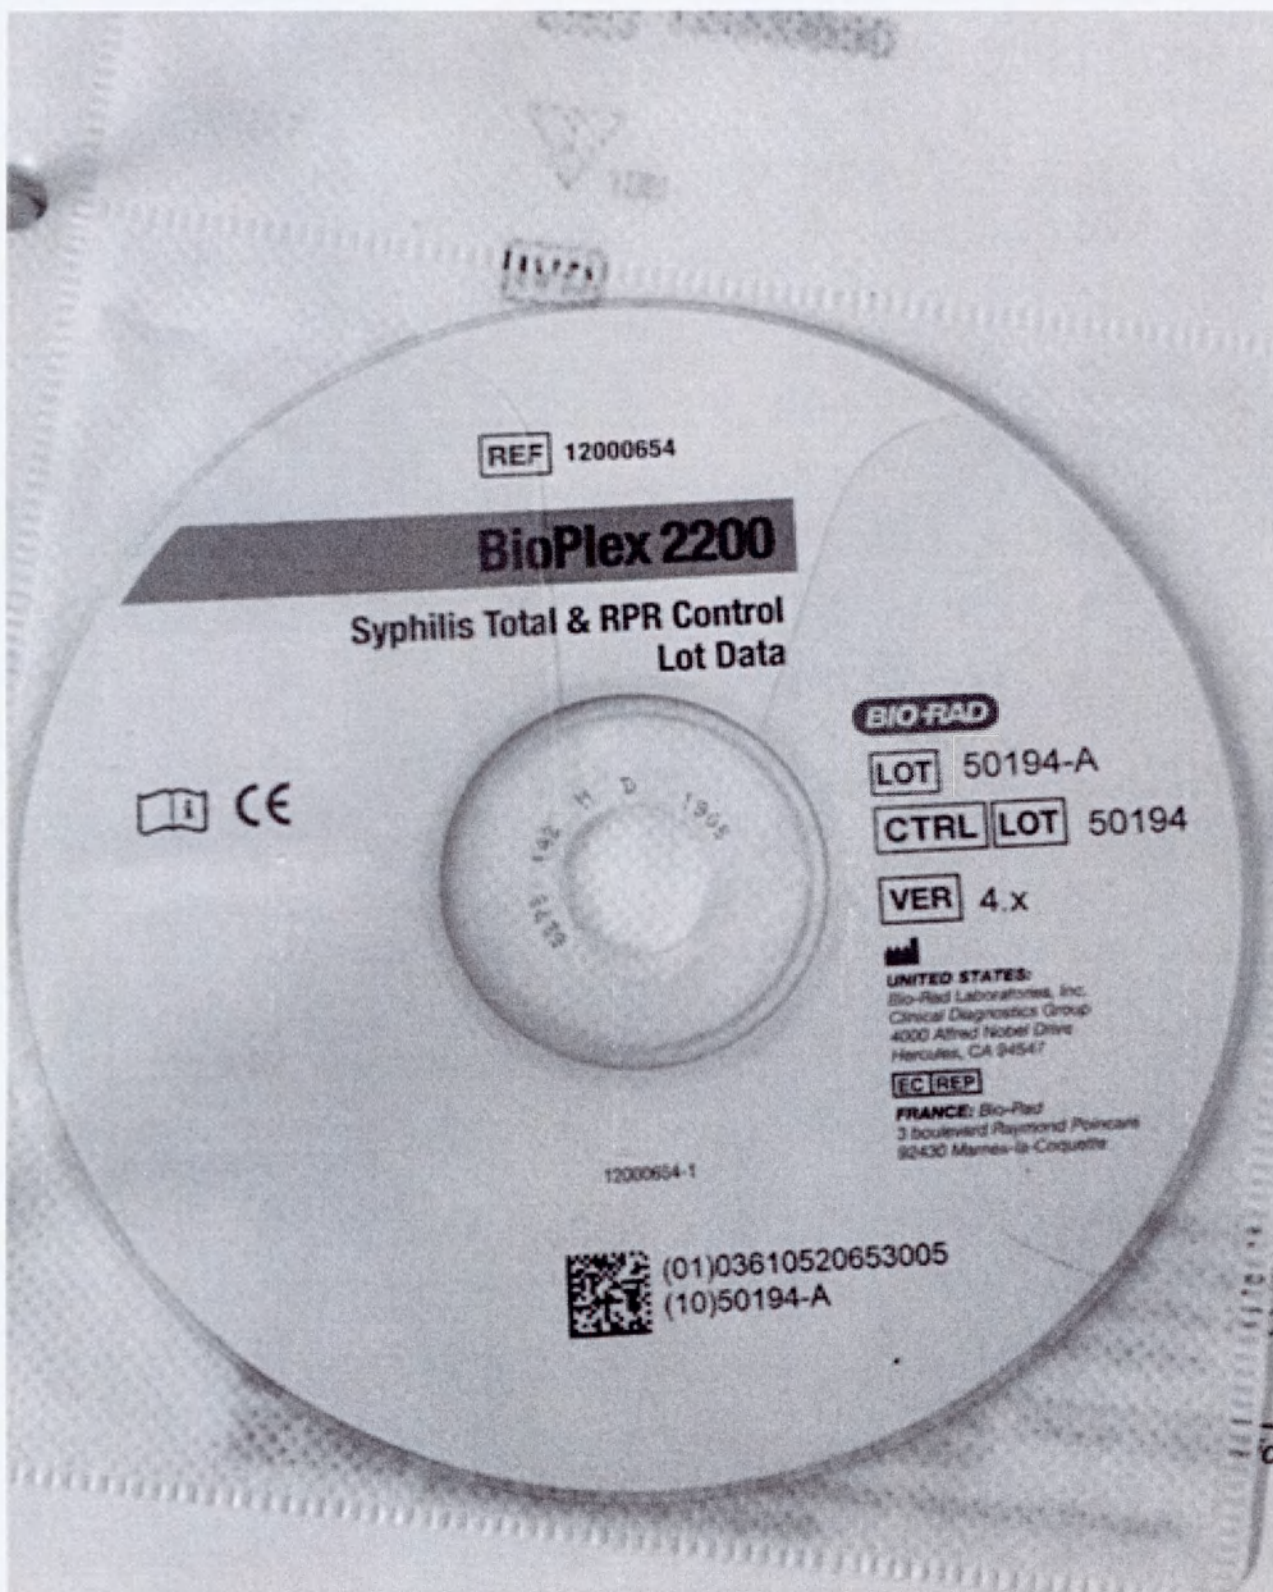

Компакт-диск с данными контрольных материалов BioPlex 2200 Syphilis Total & RPR Control Data.

Всего прошнуровано и
скреплено печатью
4 листа(ов)

