**УТВЕРЖДАЮ**
**Генеральный директор**
**ООО «ВИТ МЕДИКАЛ»**
**_____ Федоров П.Л.**
**«25» июля 2022 г**

# ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

## Аппарат «ВИТ» для лечения ран отрицательным давлением

## по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

## I. Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018:

### 1.1 Аппарат «ВИТ Ультра»

#### 1.1.1 Аппарат «ВИТ Ультра» (спереди)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

### 1.1.2 Аппарат «ВИТ Ультра» (сбоку)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

### 1.1.3 Аппарат «ВИТ Ультра» (с маркировкой)

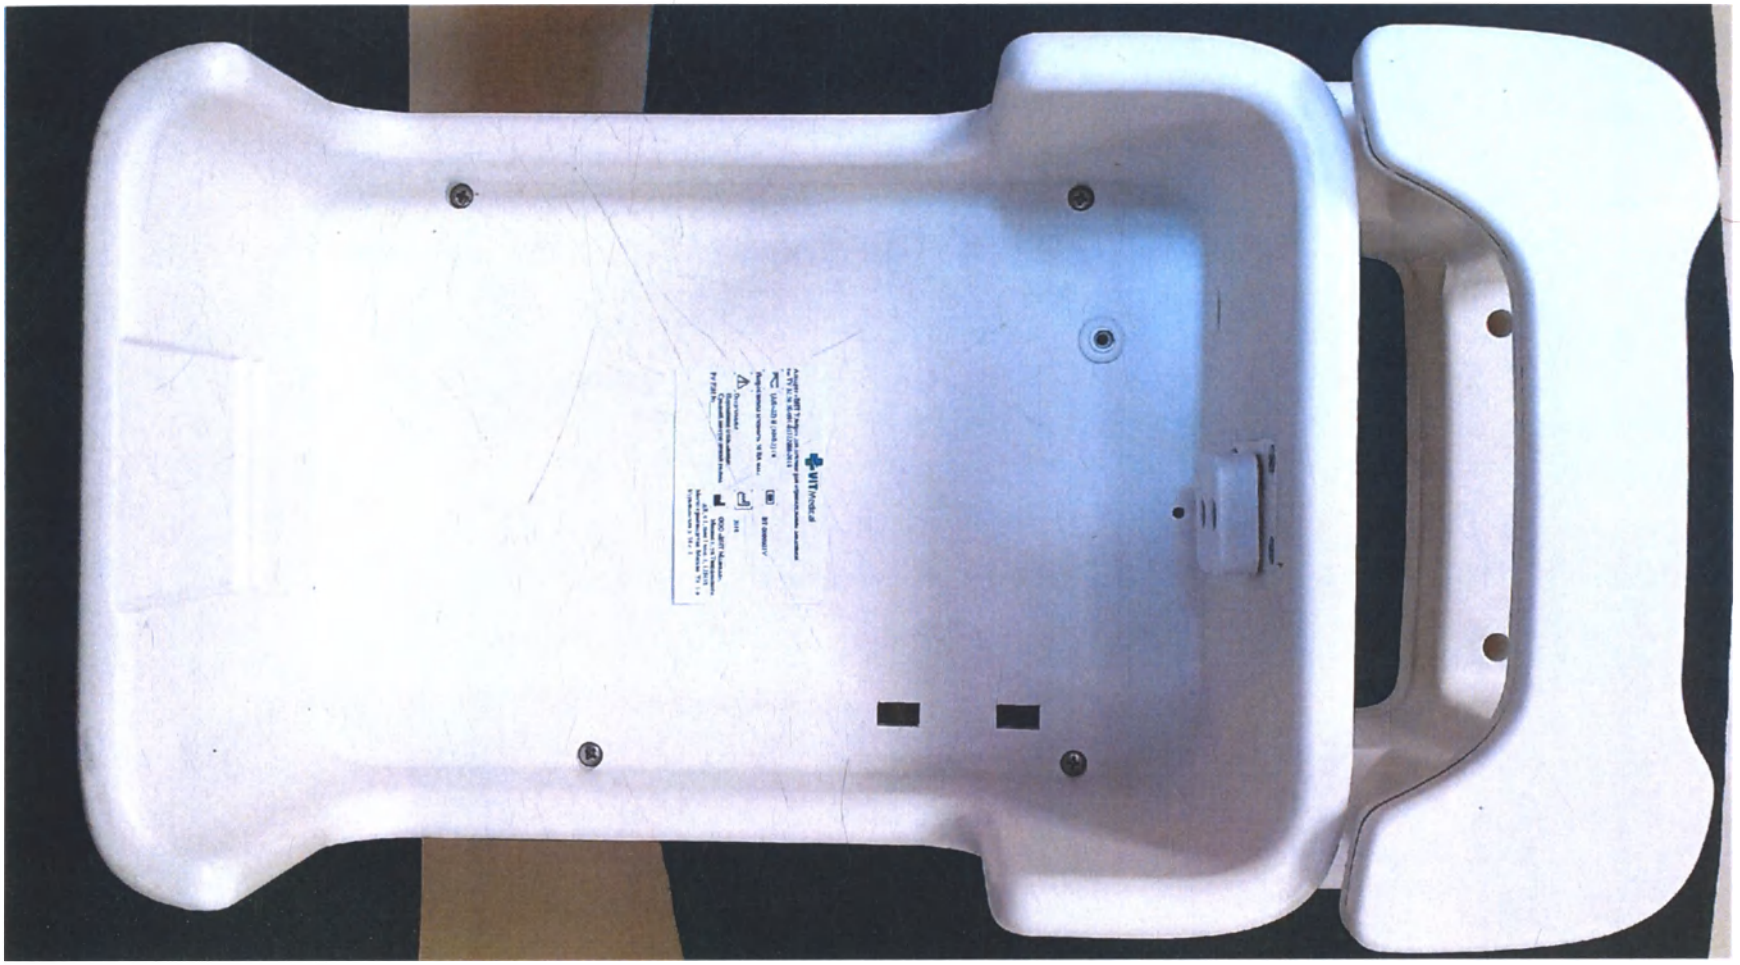

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

VITMedical

**Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением**
**по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018**

(220±22) В (50±0,5) Гц

**Потребляемая мощность 50 ВА макс.**

**Отсасывание.**
**Переменное отсасывание.**
**Средний вакуум/низкий расход**

**РУ РЗН №_____**

SN ВТ-0000001-У

2018

**ООО «ВИТ Медикал»,**
**Москва г, ул.Твардовского, д.8, с.1, пом.1 ком. 3, 123458**
**Место производства: Москва. Ул. 1-я Курьяновская д 34 с 3**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## II. Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018:

### 2.1 Аппарат «Вит МобилПлюс»

### 2.1.1 Аппарат «Вит МобилПлюс»(с маркировкой)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 2.1.2 Аппарат «Вит МобилПлюс»(спереди)

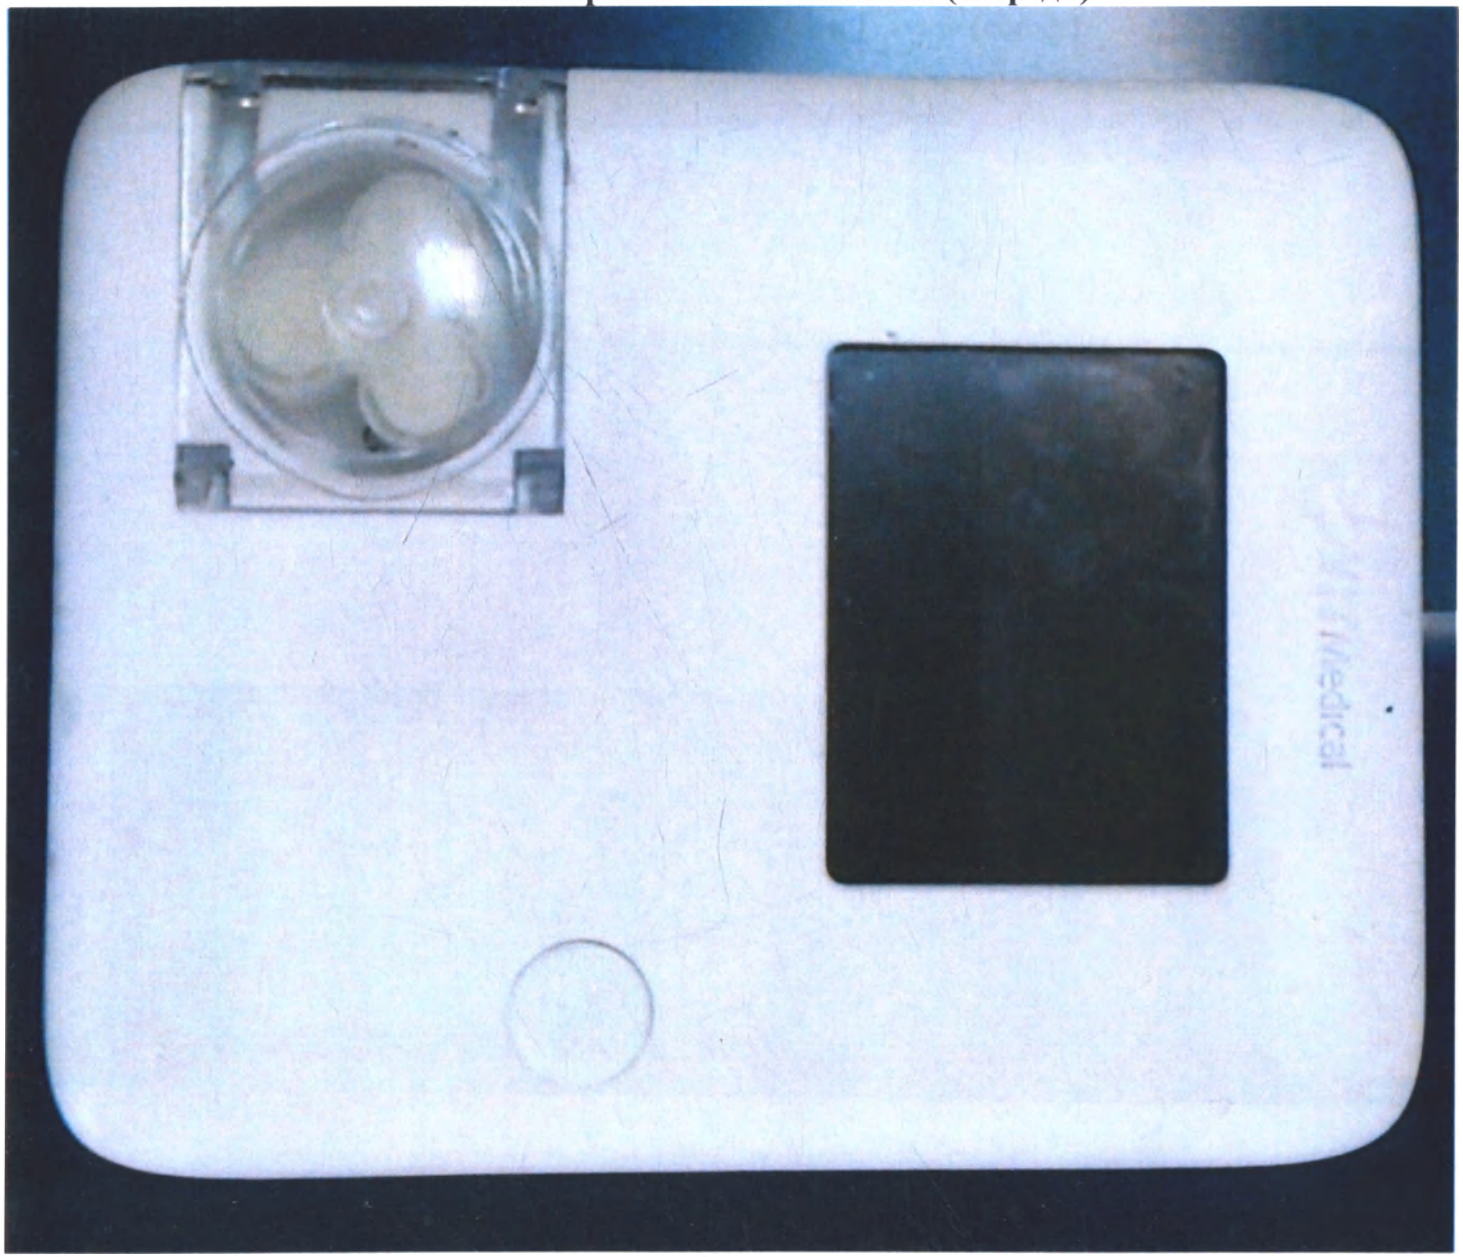


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

### 2.1.3 Аппарат «Вит МобилПлюс» (сбоку)

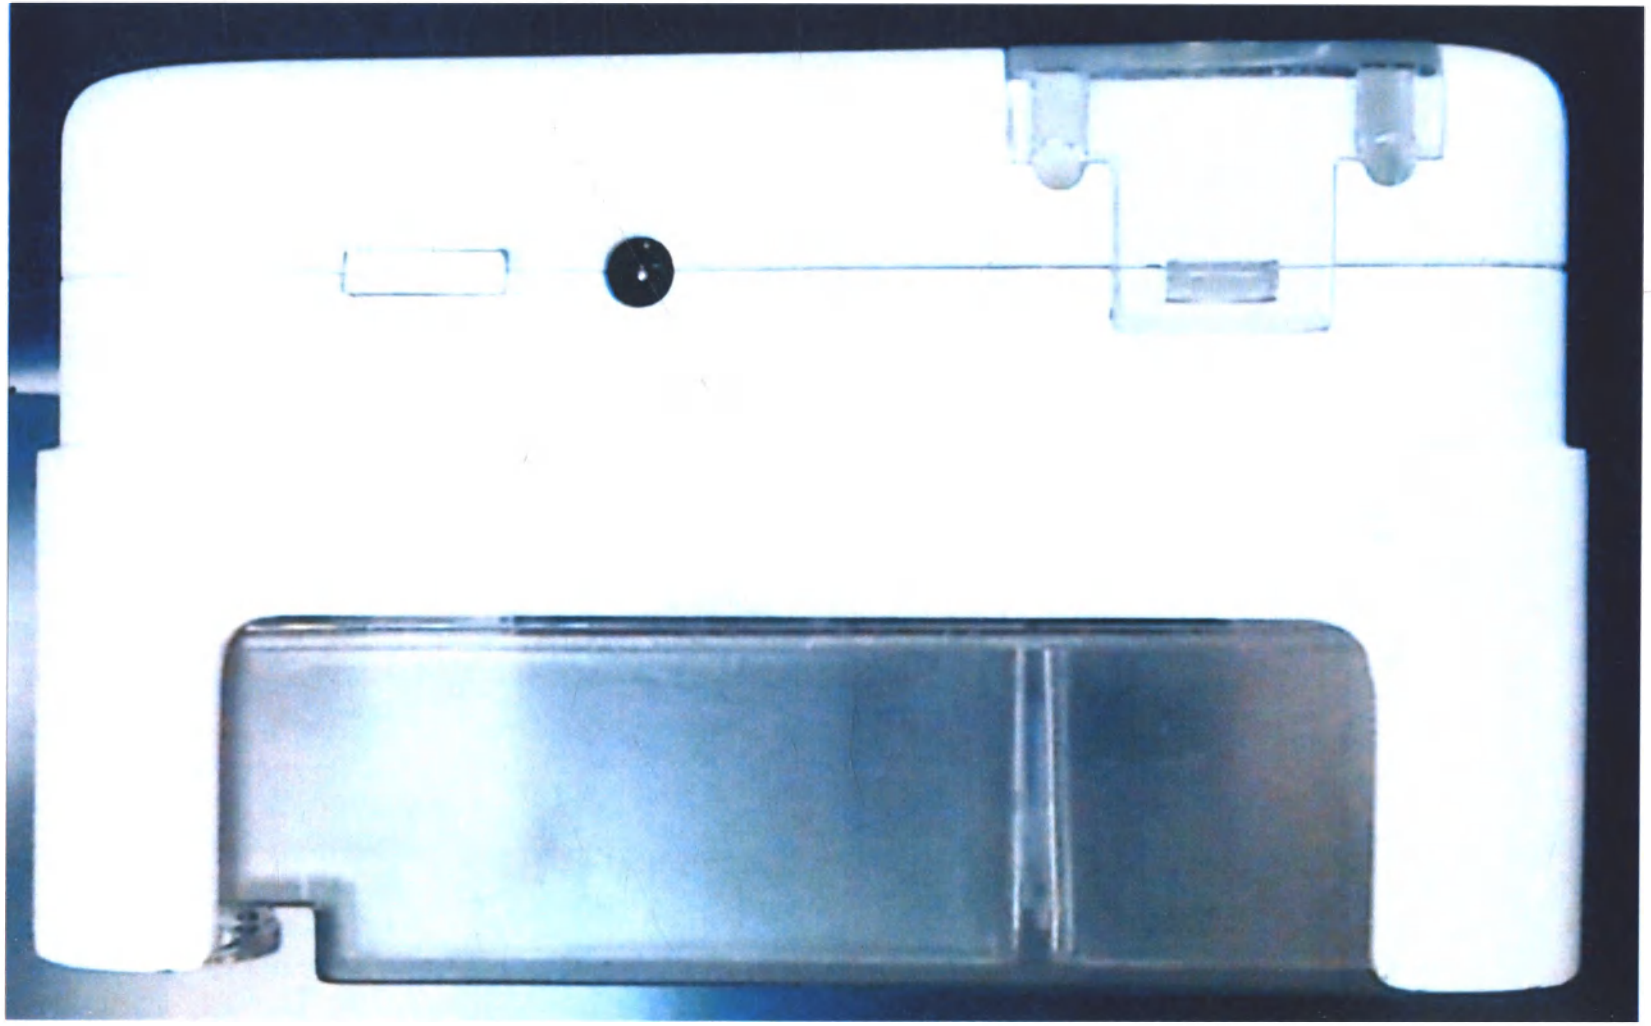

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**2.2 Аппарат «Вит МобилПлюс» с емкостью для сбора экссудата 400 мл**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 2.3 Зарядное устройство

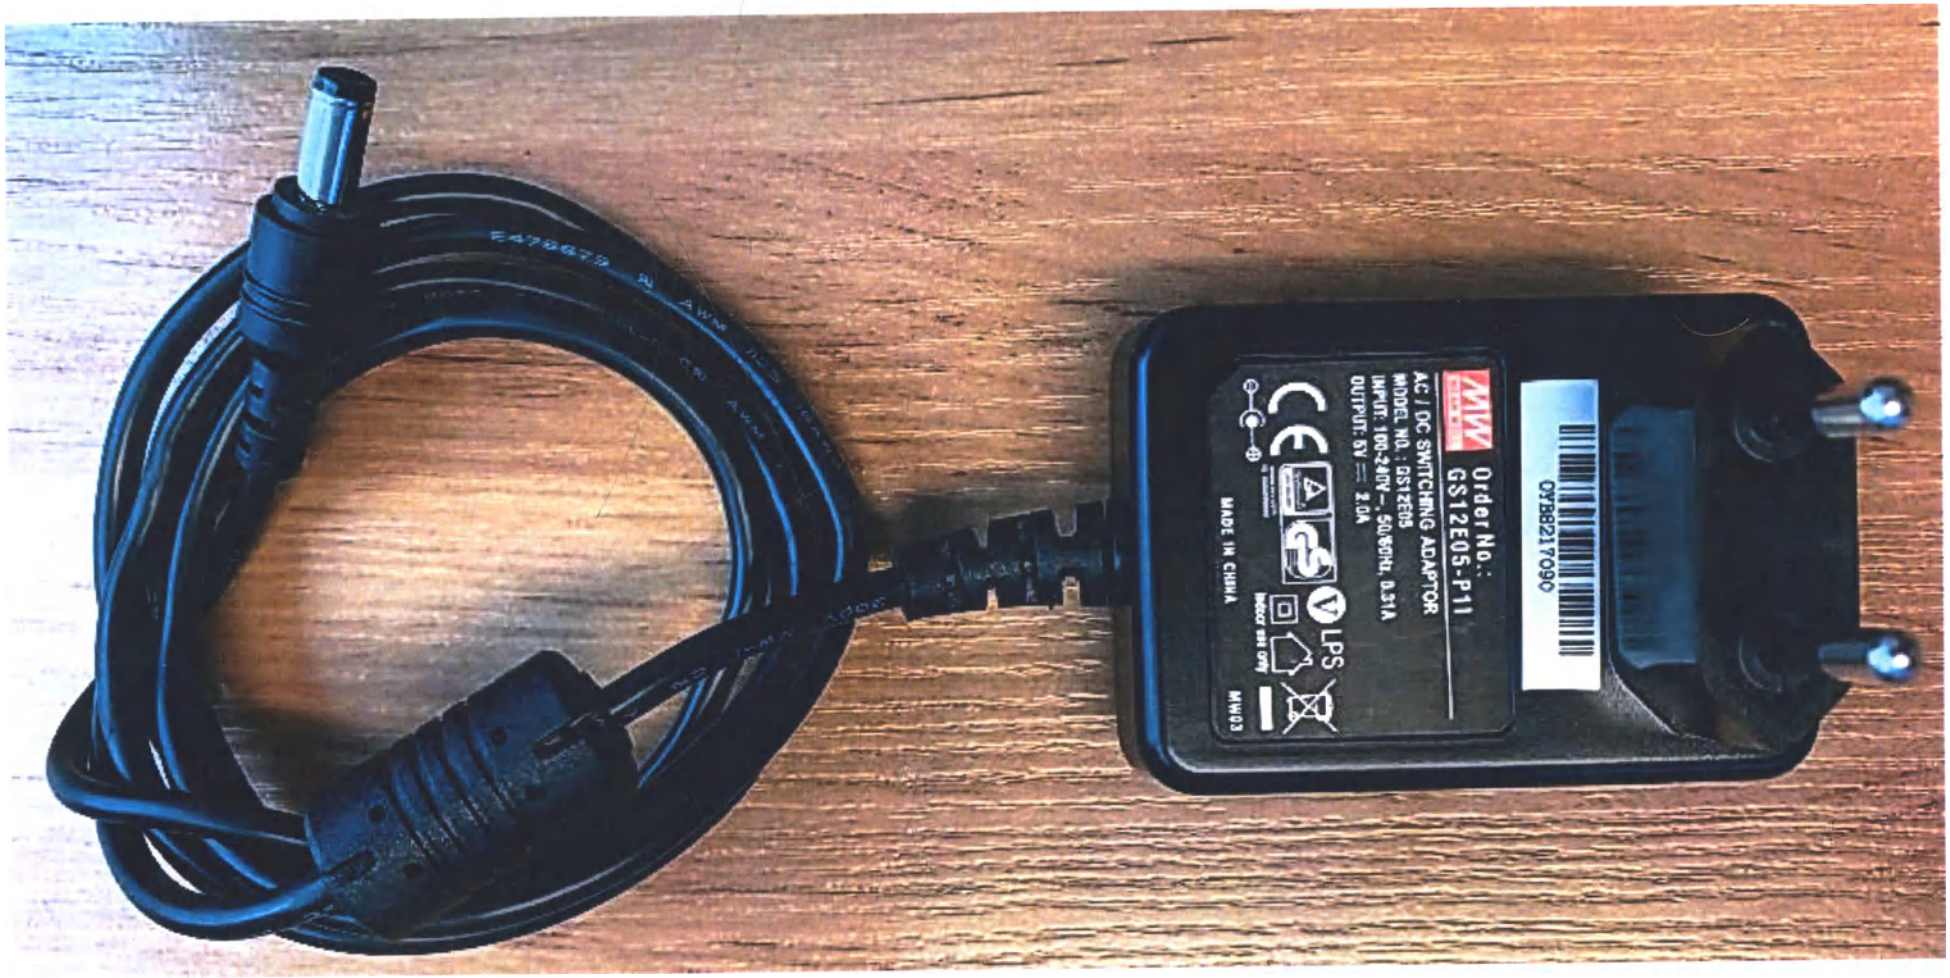


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 2.4 Емкость для сбора экссудата 2000 мл

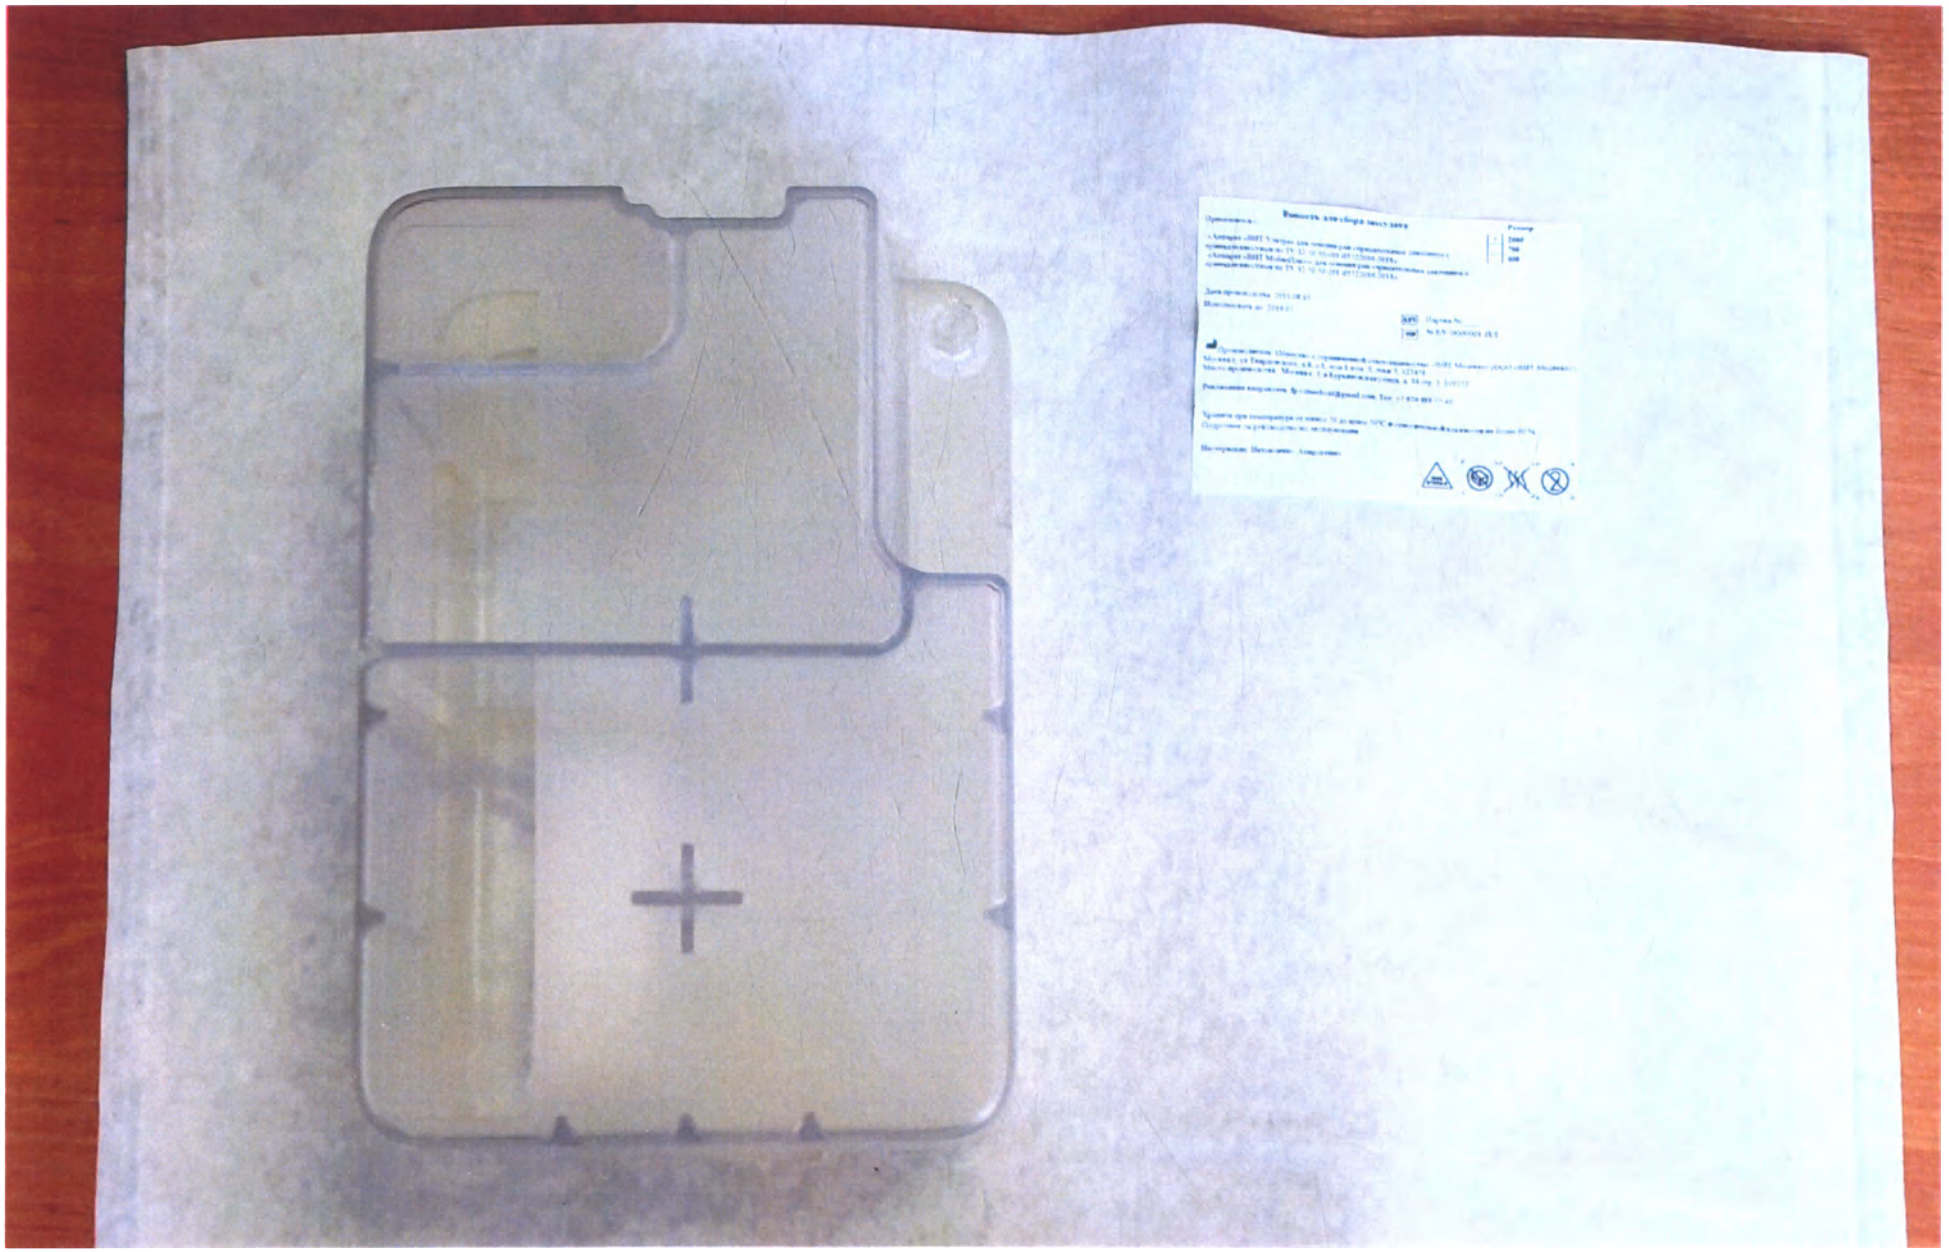

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 2.5 Емкость для сбора экссудата 700 мл

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 2.6 Маркировка для Емкости для сбора экссудата 700 мл

**Емкость для сбора экссудата**

**Размер**

- [ ] 2000
- [x] 700
- [ ] 400

**Применяется с:**

**«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»**

**«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»**

**«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»**

**Дата производства:** 2018.08.15

**Использовать до:** 2019.07

LOT **Партия №_____**

SN № ЕМ-0000001-РП

**Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)
Москва г, ул.Твардовского, д.8, с.1, пом.1 ком. 3, 123458
**Место производства:** Москва г, 1-я Курьяновская улица, д. 34 стр. 3, 109235

**Рекламации направлять:** fp.vitmedical@gmail.com, Тел: +7 926 888 77 40

**Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности не более 90 %.**
**Подробнее см руководство по эксплуатации.**

**Нестерильно. Нетоксично. Апирогенно.**

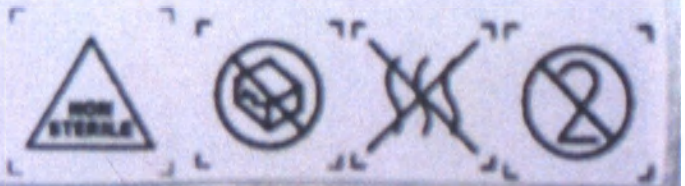


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**2.7 Емкость для сбора экссудата 400 мл**

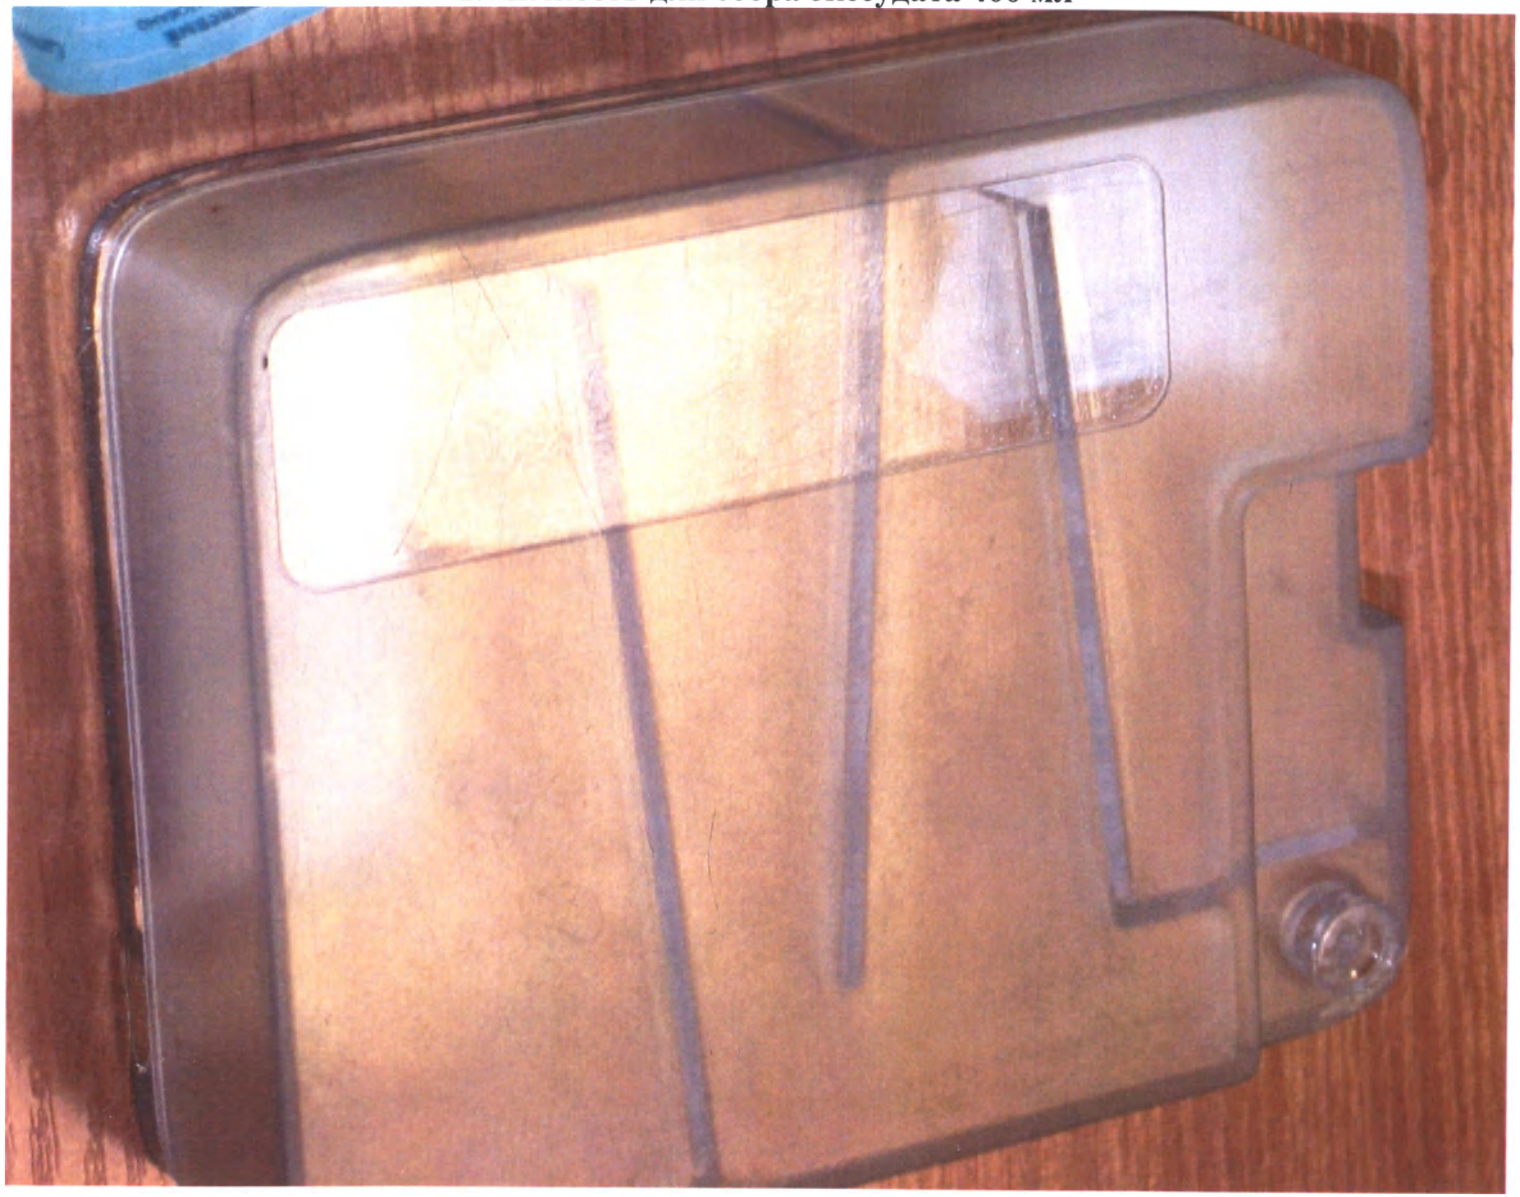

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Проект маркировки для Емкости для сбора экссудата 400 мл**

**Емкость для сбора экссудата**

Размер
- [ ] 700
- [x] 400
- [ ] 200

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»

Дата производства: 2018.08.15

Использовать до: 2019.07

LOT Партия №_____

SN № ЕМ-0000001-РД

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»), Москва г, ул.Твардовского, д.8, с.1, пом.1 ком. 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д. 34 стр. 3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com, Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности не более 90 %.
Подробнее см.руководство по эксплуатации.

Нестерильно. Нетоксично. Апирогенно.

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 Повязка-губка для ран (применяется с Аппаратами «Вит Ультра», «Вит МобилПлюс»)

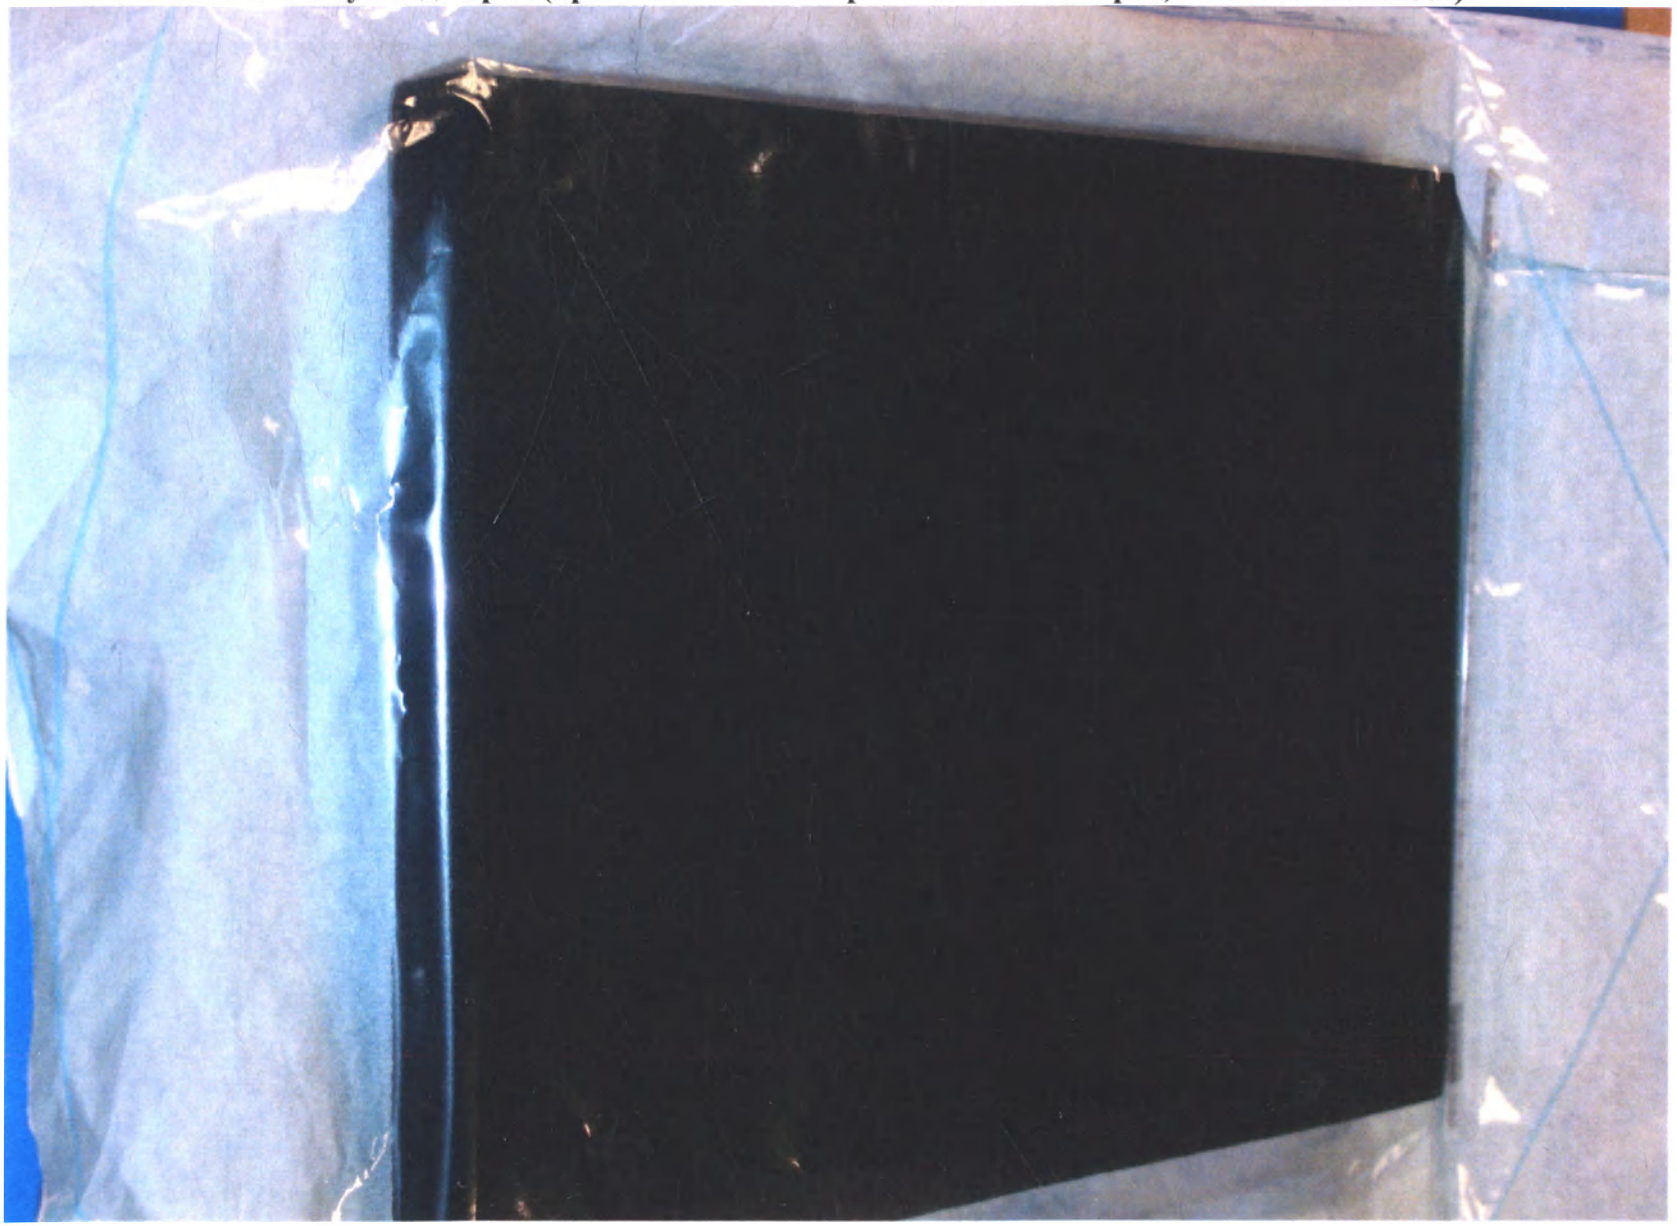

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 3 Повязка-губка для ран (маркировка)

**Повязка-губка для ран**

**Размер**

☐ S
☐ M
☐ L

Применяется с:
«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»
«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»
«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»
«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»

Дата стерилизации: 2018.08.15

Использовать до: 2020.07

LOT Партия №_____

SN № ПГ-0000001-АА

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»), Москва г, ул.Твардовского, д.8, с.1, пом.1 ком. 3, : , 123458
Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д. 34 стр. 3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com, Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности не более 90 %.
Подробнее см.руководство по эксплуатации.

Стерильно. Нетоксично. Апирогенно.

STERILE R

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4 Пленка инцизная (применяется с Аппаратами «Вит Ультра», «Вит МобилПлюс»)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 5 Пленка инцизная в рулоне (применяется с Аппаратами «Вит Ультра», «Вит МобилПлюс»)

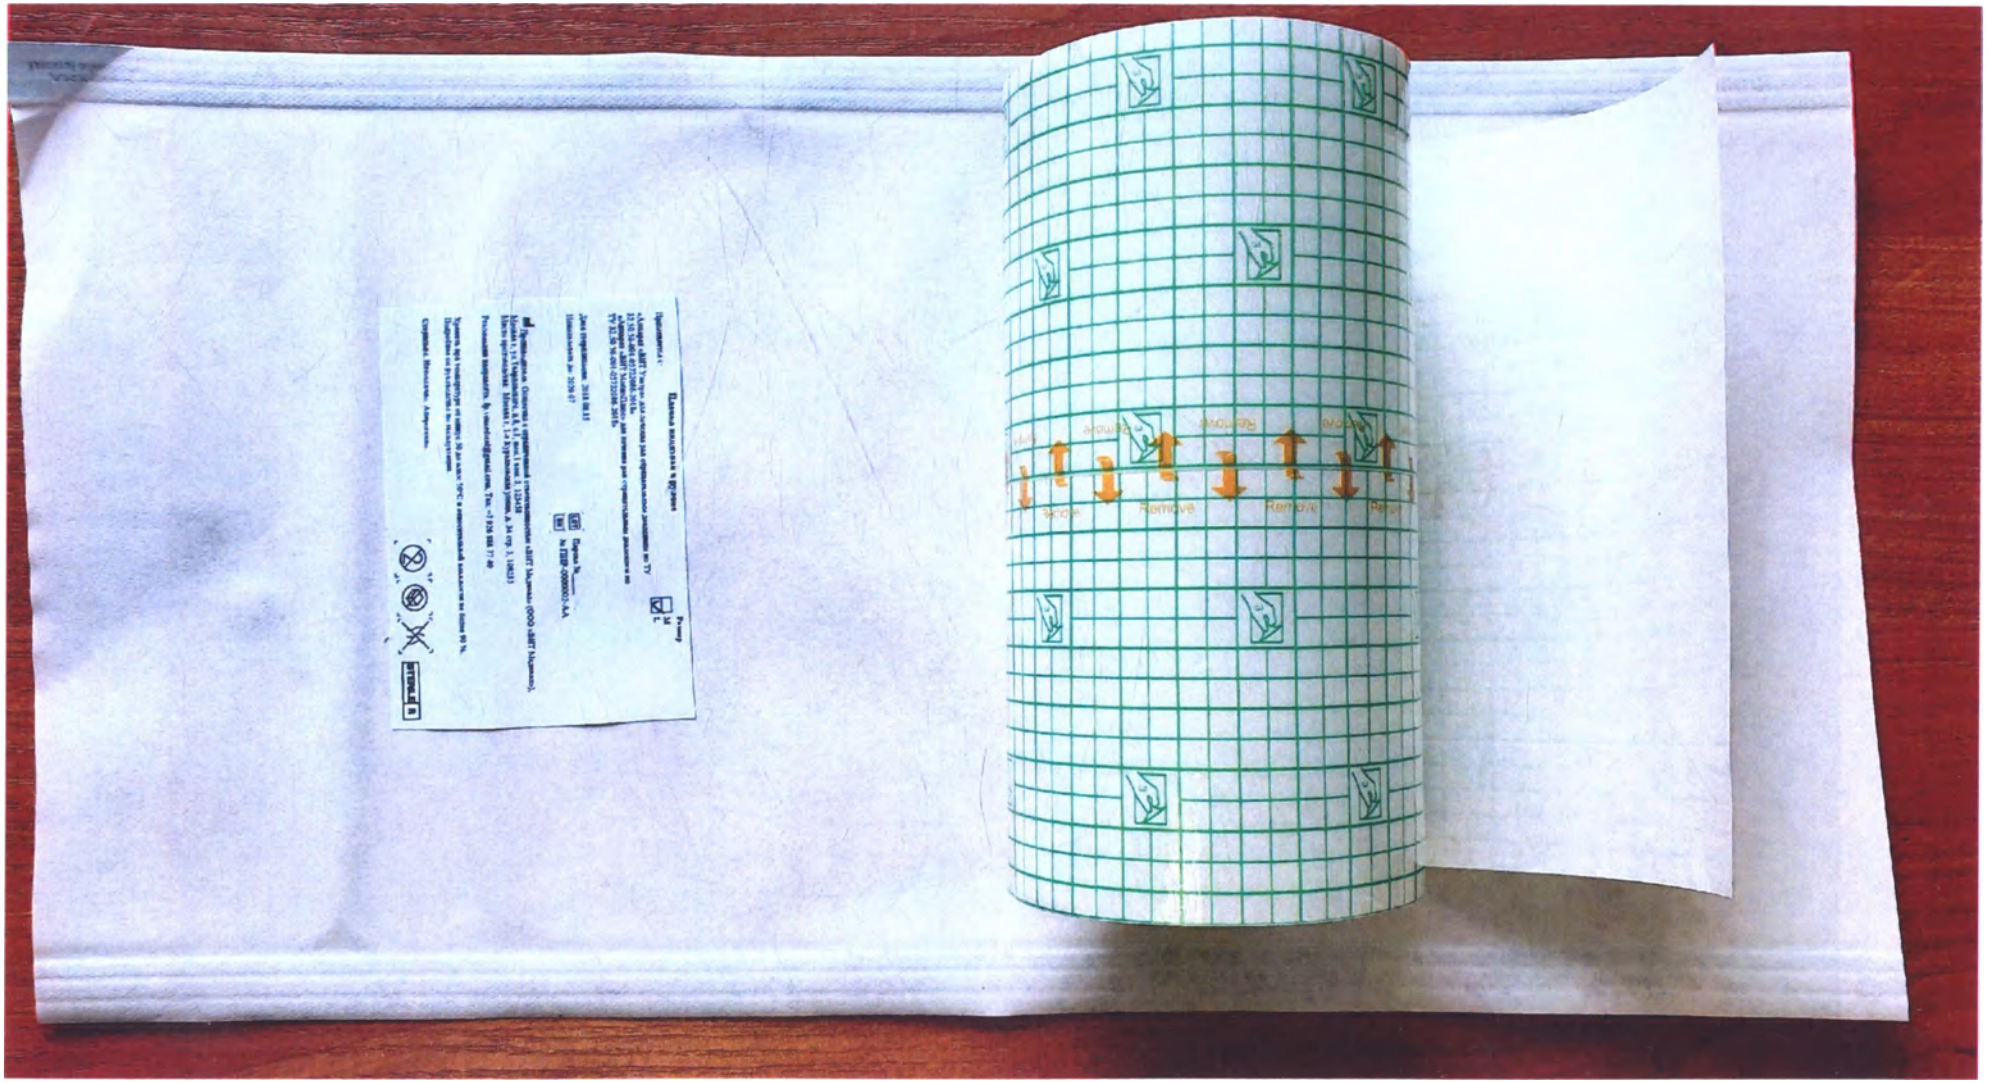


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 6 Порт дренажный (применяется с Аппаратами «Вит Ультра», «Вит МобилПлюс»)

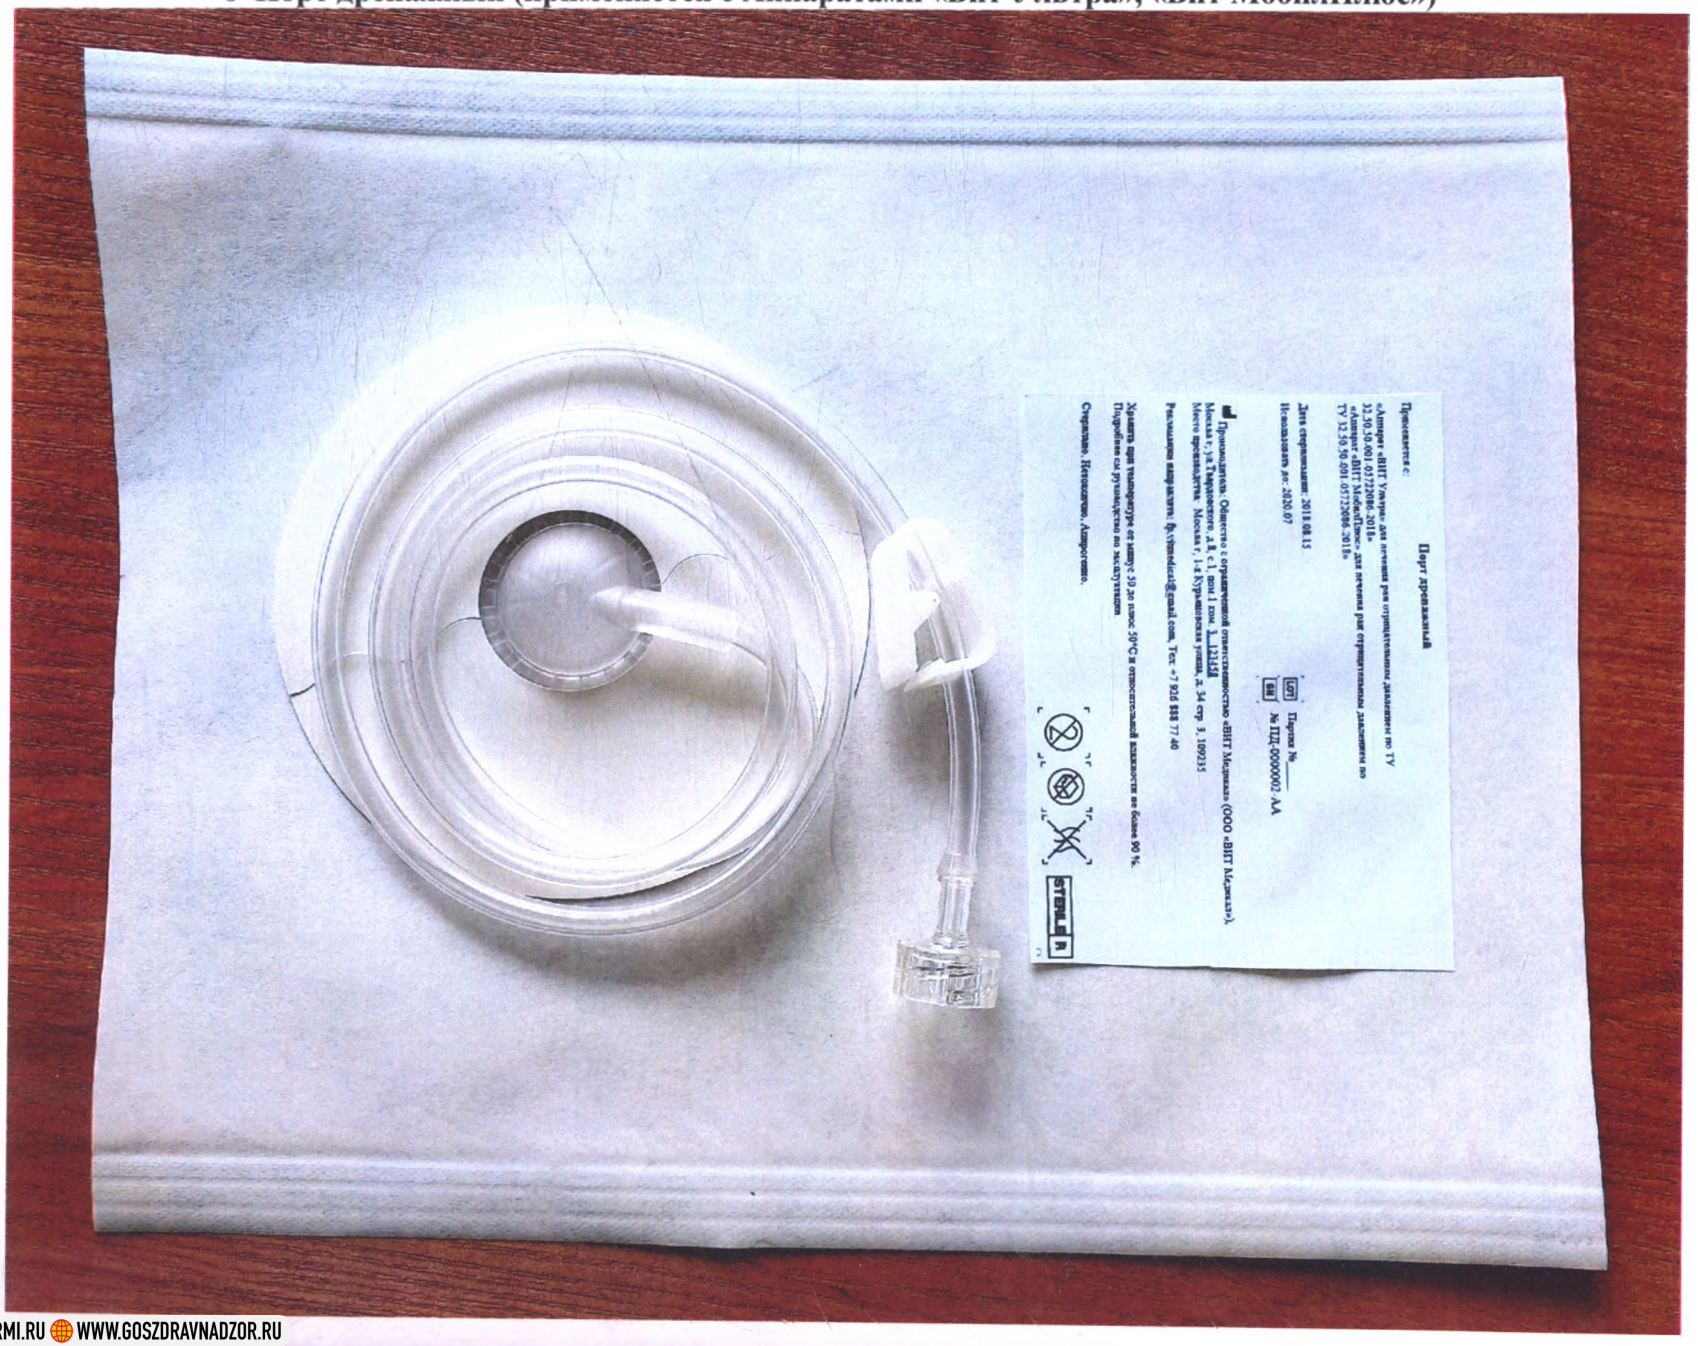


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 7 Порт дренажный мягкий (применяется с Аппаратами «Вит Ультра», «Вит МобилПлюс»)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**8 Порт дренажный впитывающий ( на примере размера L) (применяется с Аппаратами «Вит Ультра», «Вит МобилПлюс»)**

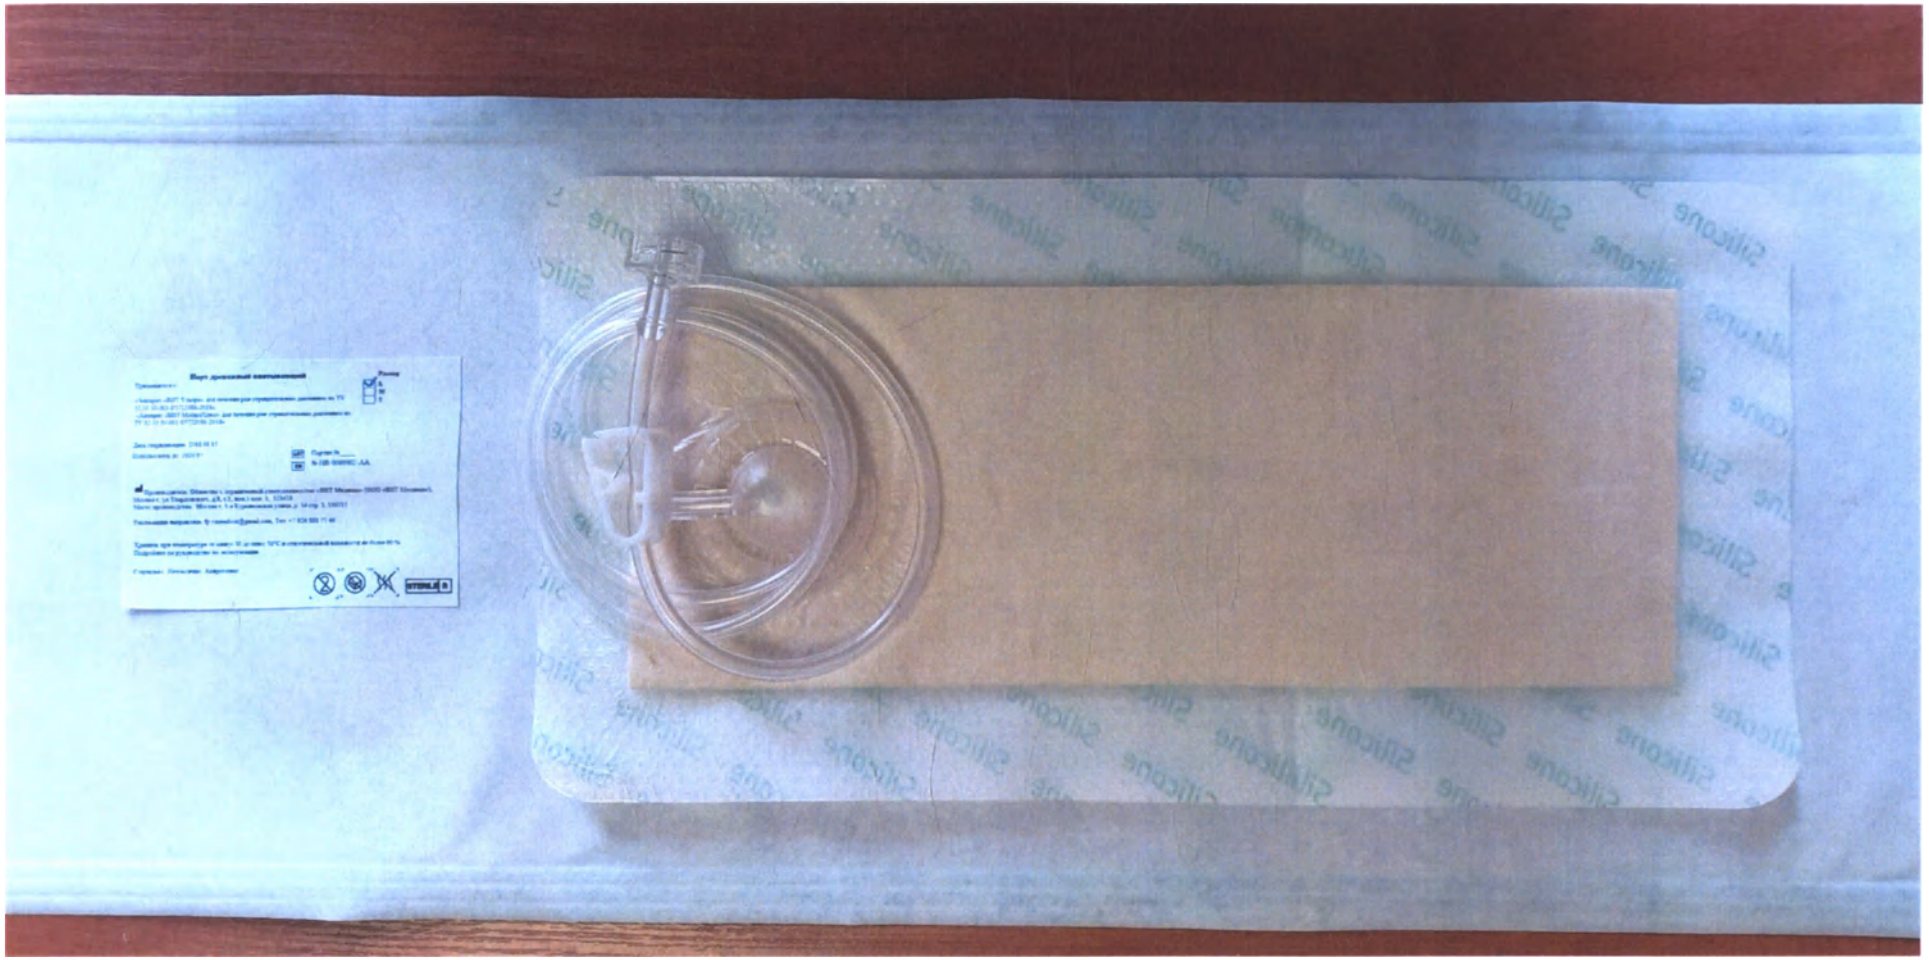

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**9 Покрытие атравматическое (на примере размера S) (применяется с Аппаратами «Вит Ультра», «Вит МобилПлюс»)**

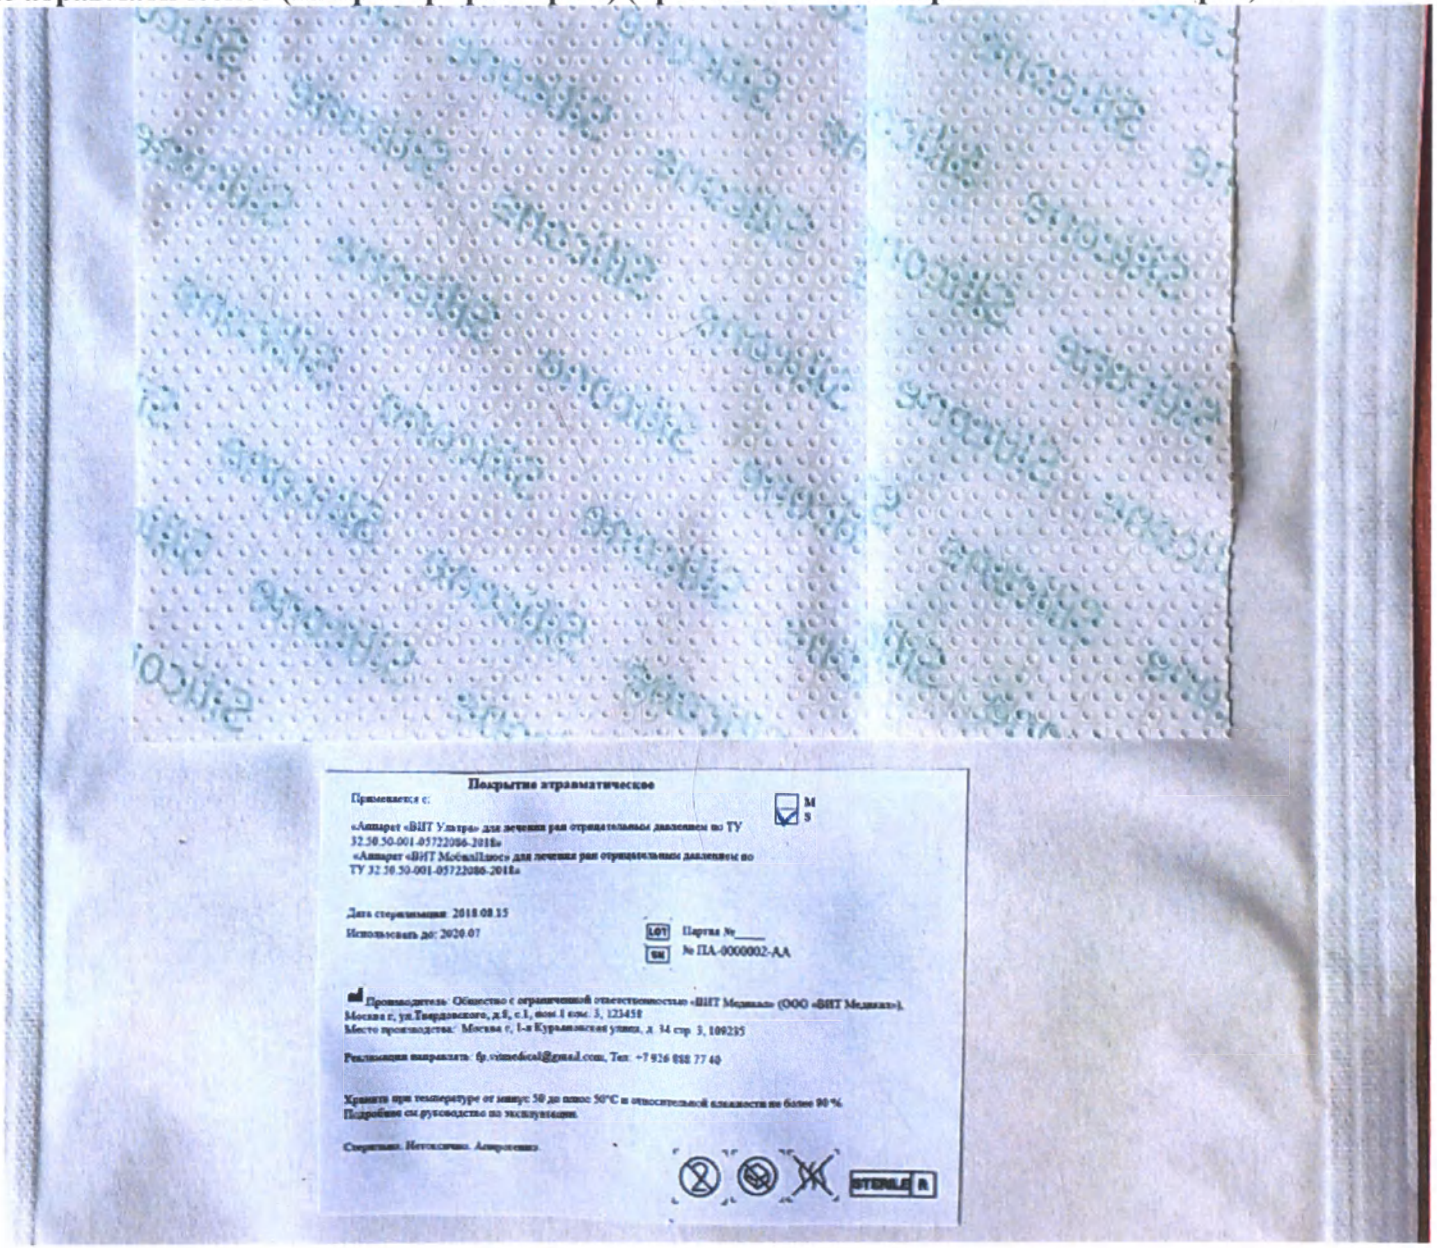


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10 Переходники (вход/выход)

**Переходники (вход/выход)**

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»
«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»

Дата стерилизации: 2018.08.15
Использовать до: 2019.07

LOT Партия №_____
SN № П-0000001-АА

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»), Москва г, ул.Твардовского, д.8, с.1, пом.1 ком. 3, 123458
Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д. 34 стр. 3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com, Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности не более 90 %.
Подробнее см.руководство по эксплуатации.

Нетерильно. Нетоксично. Апирогенно.

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 11 Сумка для ношения (применяется с Аппаратом «Вит МобилПлюс»)

### 11.1 Сумка для ношения (маркировка)



Сумка для ношения

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением
по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением
по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением
по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»

LOT Партия №

SN № С-0000001-АА

Дата производства: 2019.08.15

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»), Москва г, ул. Гвардейского, д.8, с.1, пом.1 ком. 3, этаж 3, 123458
Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д. 34 стр. 3, 109235
Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com, Тел: +7 926 888 77 40

Аппарат не пригоден для использования при температуре ниже плюс 1 или выше плюс 41 °С.

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности не более 90 %.
Подробнее см. руководство по эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 11.2 Сумка для ношения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12 Абдоминальное покрытие однослойное (на примере размера М)

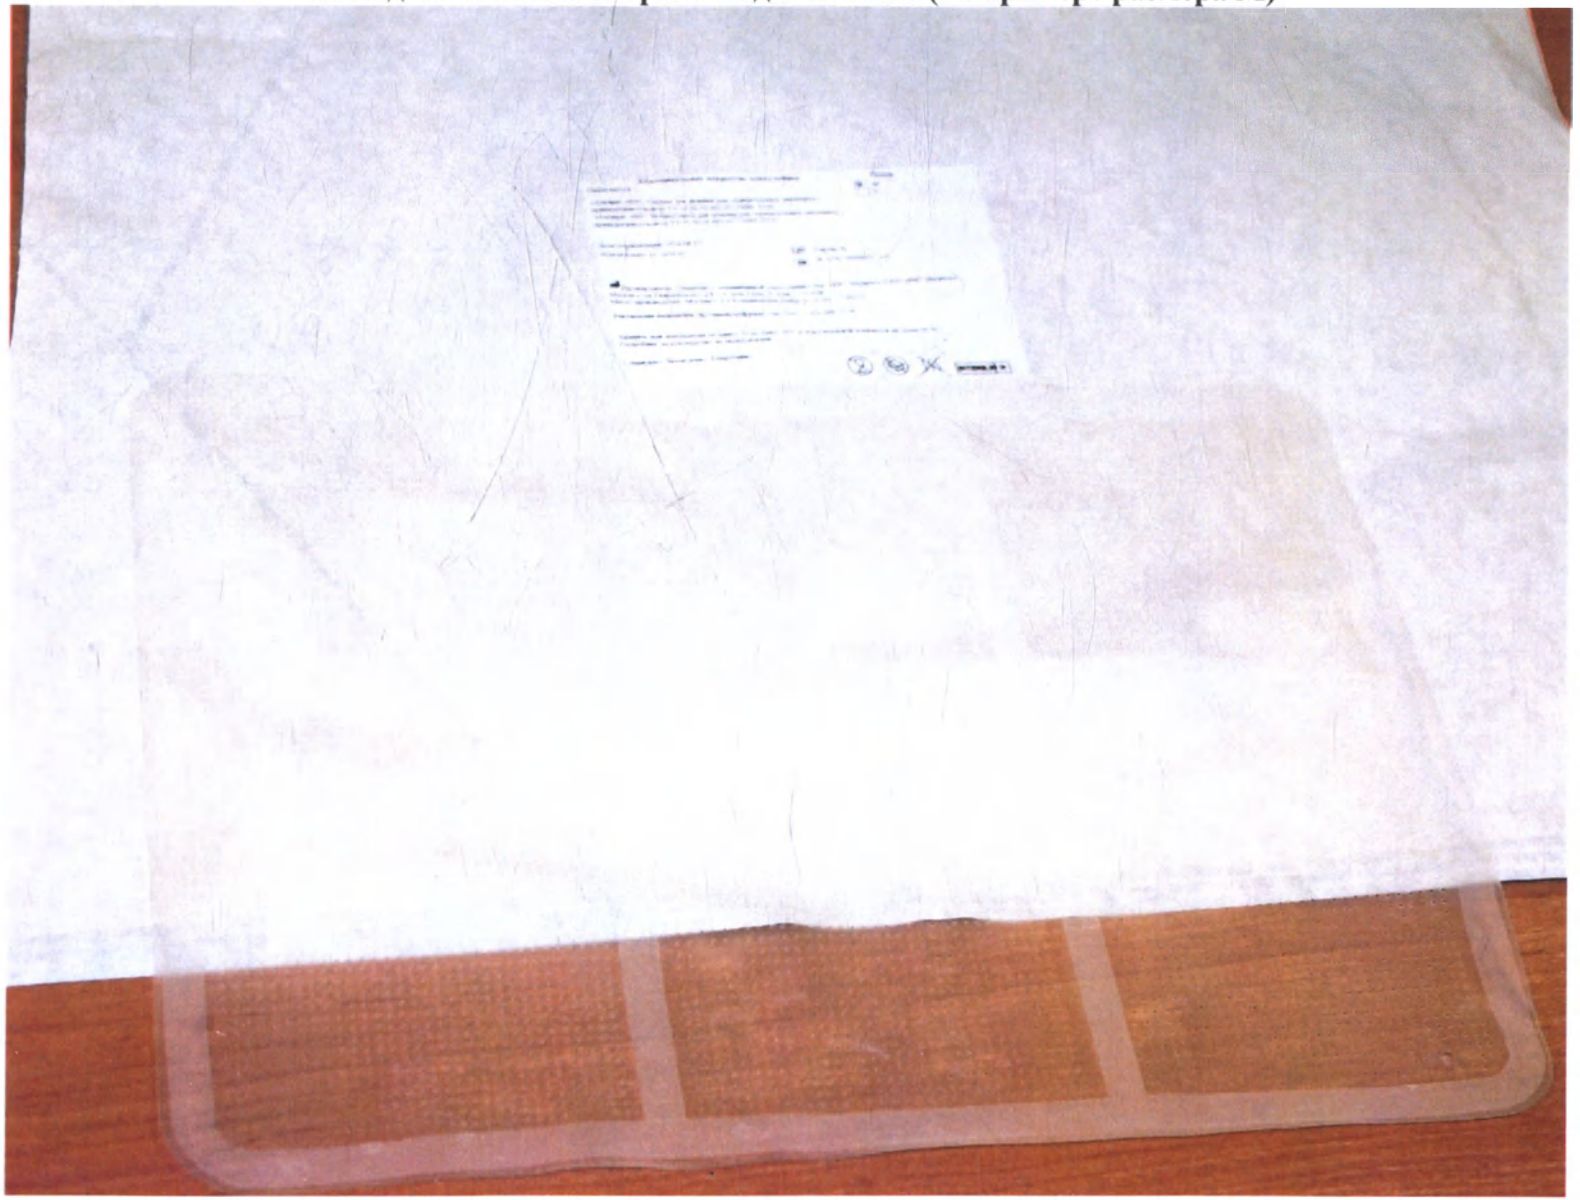

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13 Абдоминальное покрытие многослойное (на примере размера М)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU