


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Досчатинский завод
медицинского оборудования»

 Костров А. В.
« 09 » 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
медицинского изделия

«Тележки медицинские для перевозки больных
по ТУ 32.50.50-003-07614107-2018 с принадлежностями»

производства АО «Досчатинский завод
медицинского оборудования», Россия

Тележки медицинские для перевозки больных по ТУ 32.50.50-003-07614107-2018 с принадлежностями,
в вариантах исполнения:

I. Односекционные, моделей Т-ДЗМО-1-1/С, Т-ДЗМО-1-1 в составе:

1. Каркас тележки – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Спинная секция – 1 шт.
4. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
5. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
6. Матрац односекционный - 1 шт. (при необходимости)
7. Угловой бампер – не более 4 шт.
8. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Фотографические изображения (далее – фото, фотоизображения, фотографии) изделий, не показанные на общих фотографиях моделей, см. в разделе «Принадлежности и изделия входящие в состав, не изображенные на фото общего вида варианта исполнения тележки».

Фото 1.1 Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-1-1/С.


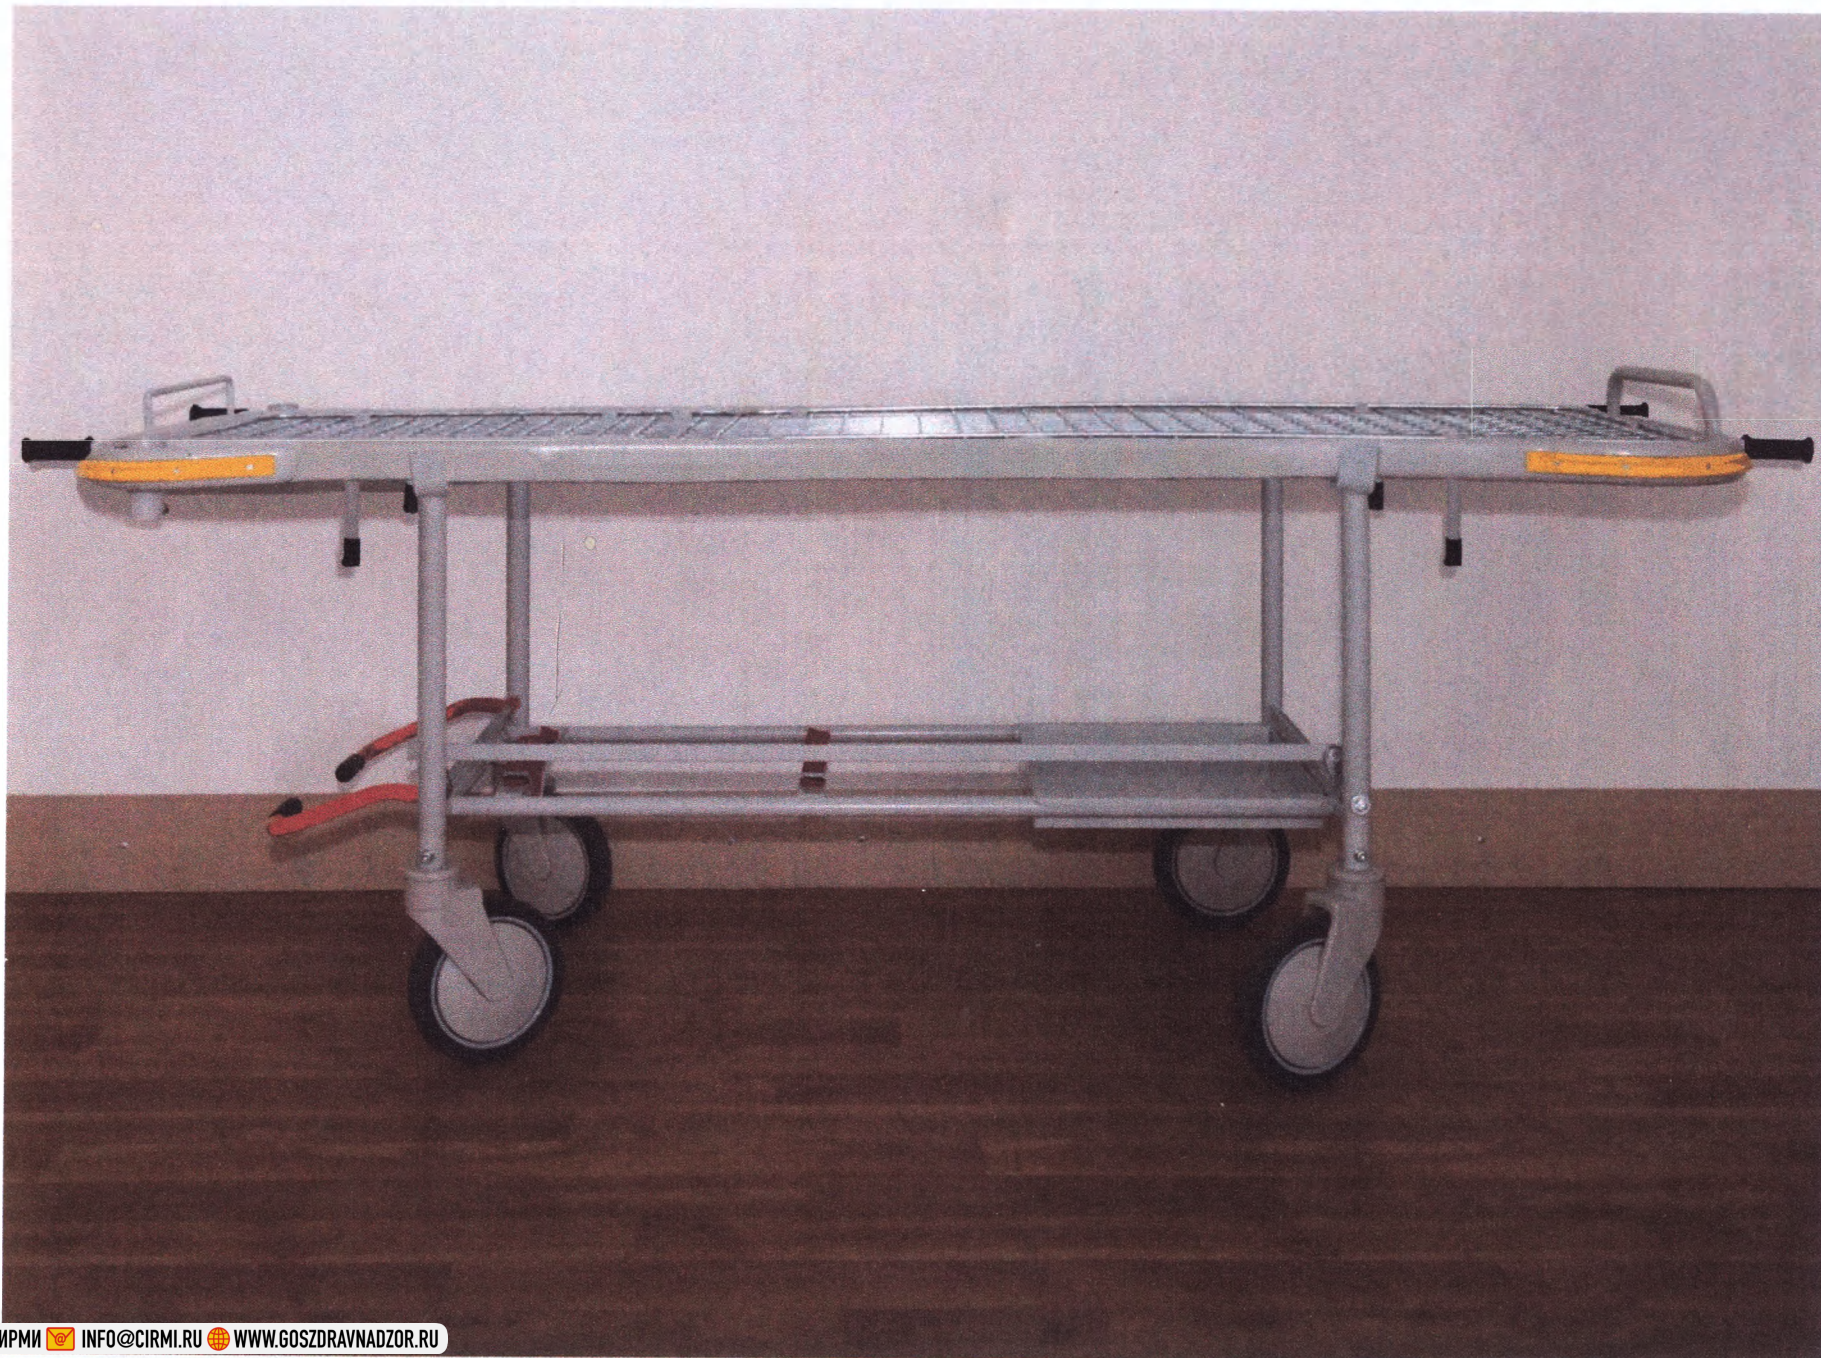


Фото 1.2. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-1-1.

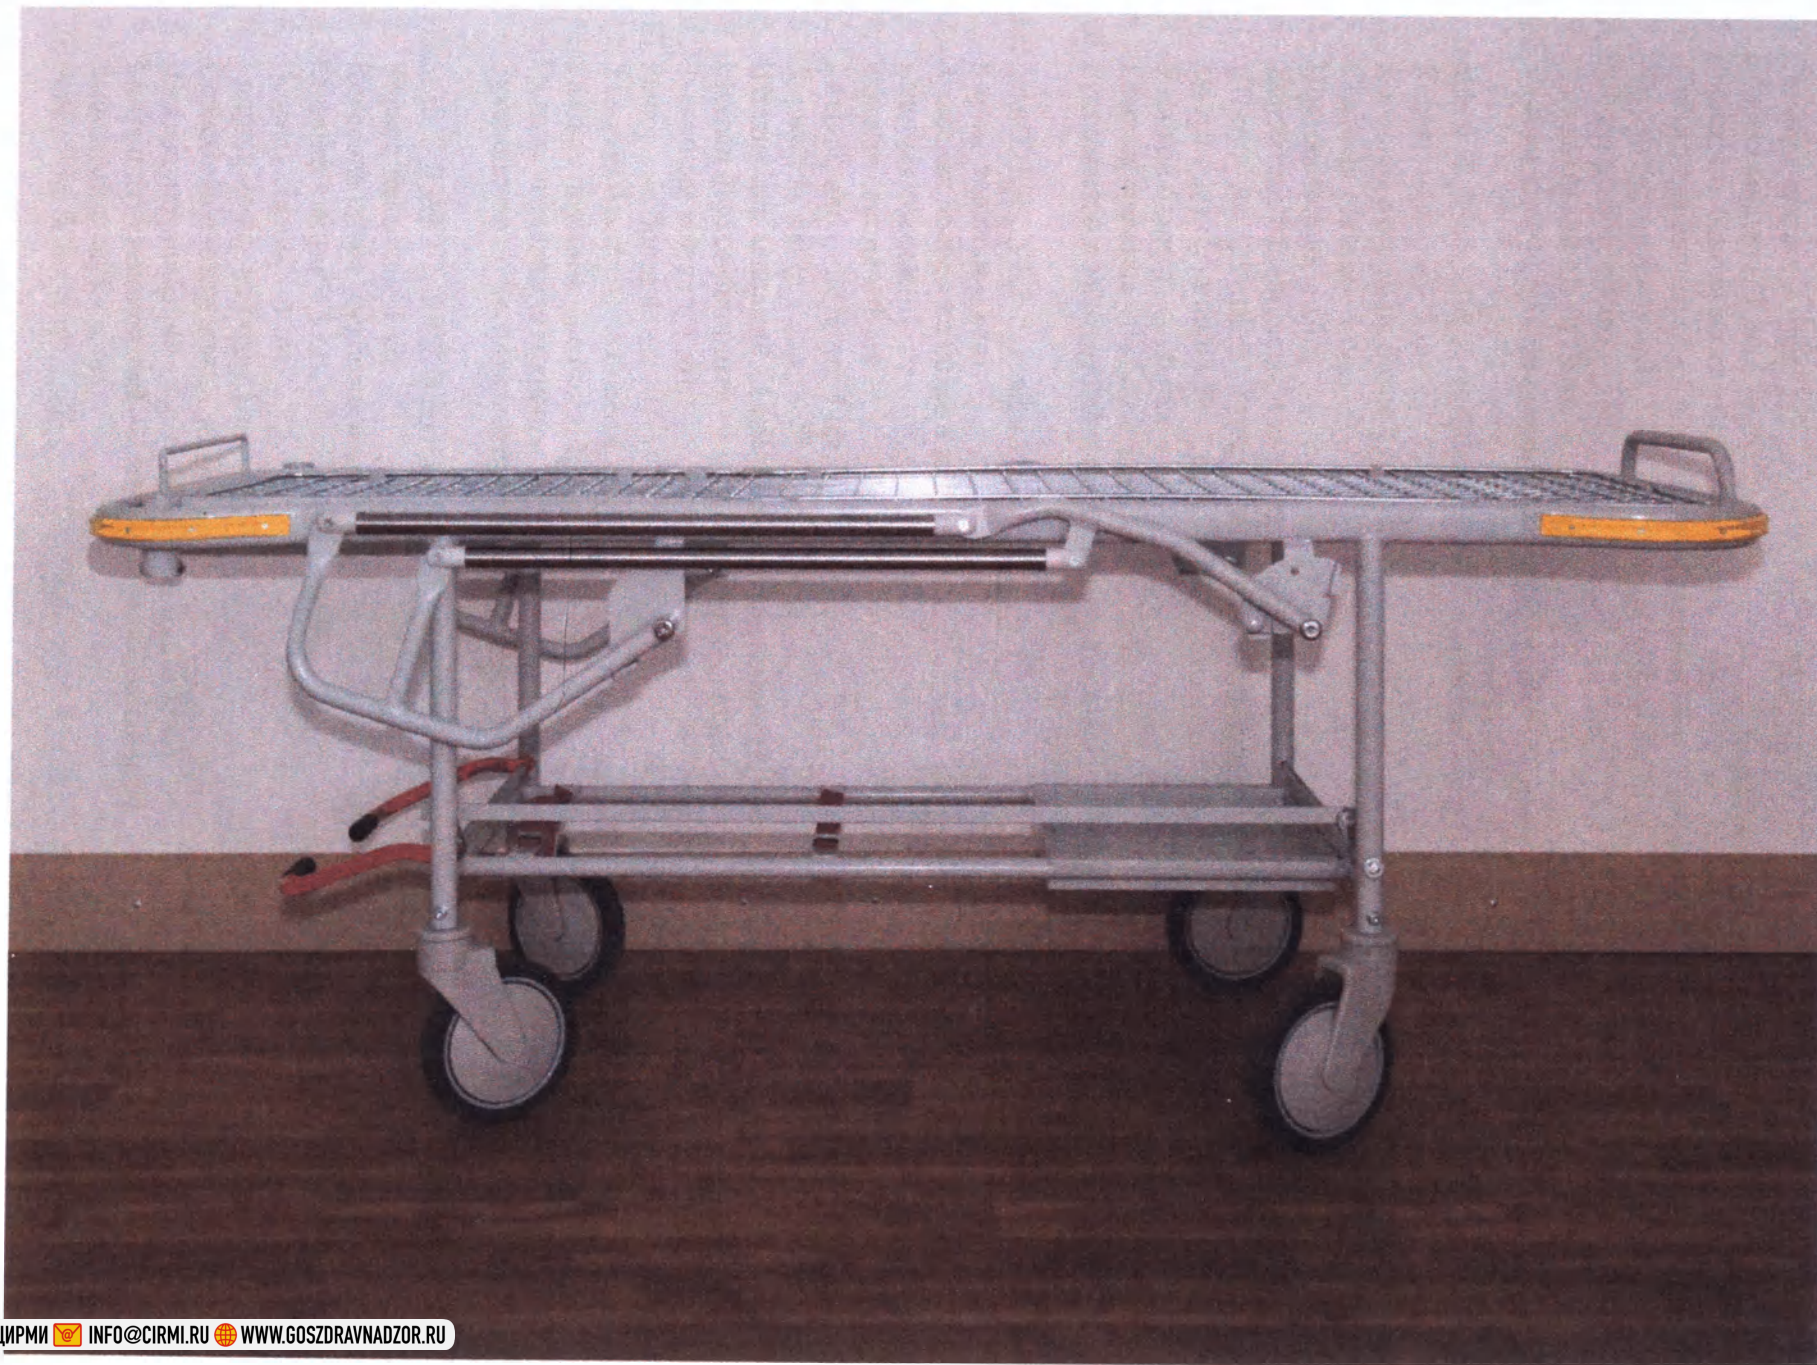

II. Двухсекционные:

Моделей Т-ДЗМО-1-2-Р, Т-ДЗМО-1-2-Р/С в составе:

1. Каркас тележки – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Спинная секция – 1 шт.
4. Ножная секция - 1 шт.
5. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
6. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
7. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
8. Рейка – не более 4 шт.
9. Угловой бампер – не более 4 шт.
10. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Моделей Т-ДЗМО-1-2-Г, Т-ДЗМО-1-2-Г/С в составе:

1. Каркас тележки – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Спинная секция – 1 шт.
4. Ножная секция - 1 шт.
5. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
6. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
7. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
8. Угловой бампер – не более 4 шт.
9. Газовая пружина - не более 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Модели Т-ДЗМО-2-2-Р в составе:

1. Каркас тележки – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Спинная секция – 1 шт.
4. Ножная секция - 1 шт.
5. Гидропривод - не более 1 шт.
6. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
7. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
8. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
9. Защитный кожух – 1 шт.
10. Рейка – не более 4 шт.
11. Угловой бампер – не более 4 шт.
12. Газовая пружина - не более 1 шт.
13. Педаль управления гидроприводом – не более 2 шт.
14. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Модели Т-ДЗМО-2-2-Р/С в составе:

1. Каркас тележки – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Спинная секция – 1 шт.
4. Ножная секция - 1 шт.
5. Гидропривод - не более 1 шт.
6. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
7. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
8. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
9. Защитный кожух – 1 шт.
10. Рейка – не более 4 шт.

11. Угловой бампер – не более 4 шт.
12. Газовая пружина - не более 1 шт.
13. Педаль управления гидроприводом – не более 2 шт.
14. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Моделей Т-ДЗМО-2-2-Г, Т-ДЗМО-2-2-Г/С в составе:

1. Каркас тележки – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Спинная секция – 1 шт.
4. Ножная секция - 1 шт.
5. Гидропривод - не более 1 шт.
6. Держатель панели лежа – не более 50 шт.
7. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
8. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
9. Защитный кожух – 1 шт.
10. Угловой бампер – не более 4 шт.
11. Газовая пружина - не более 2 шт.
12. Педаль управления гидроприводом – не более 2 шт.
13. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Фотографические изображения изделий, не показанные на общих фотографиях моделей, см. в разделе «Принадлежности и изделия входящие в состав, не изображенные на фото общего вида варианта исполнения тележки».

Фото 2.1. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-1-2-Р.

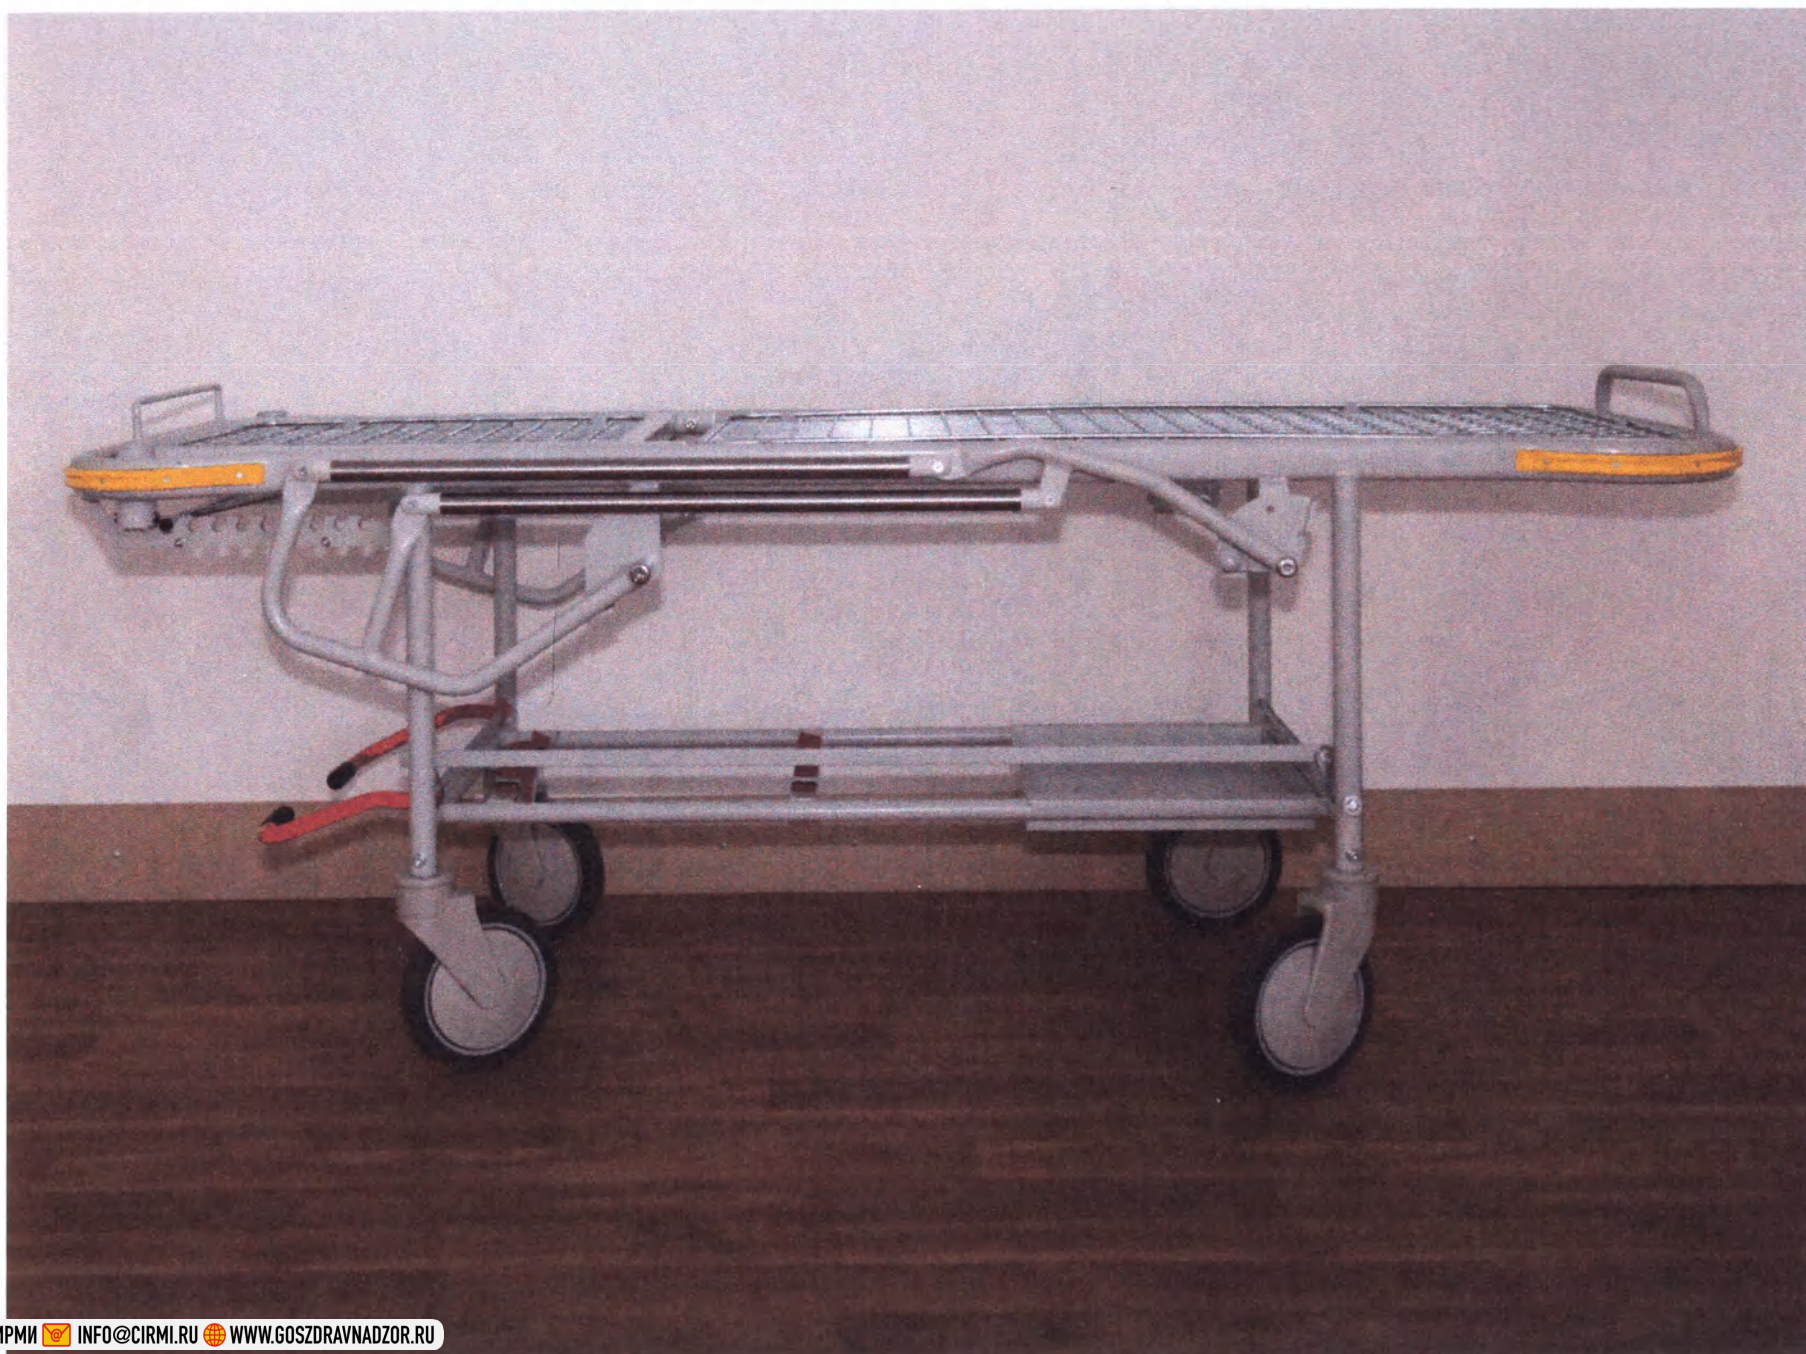


Фото 2.2. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-1-2-Г.

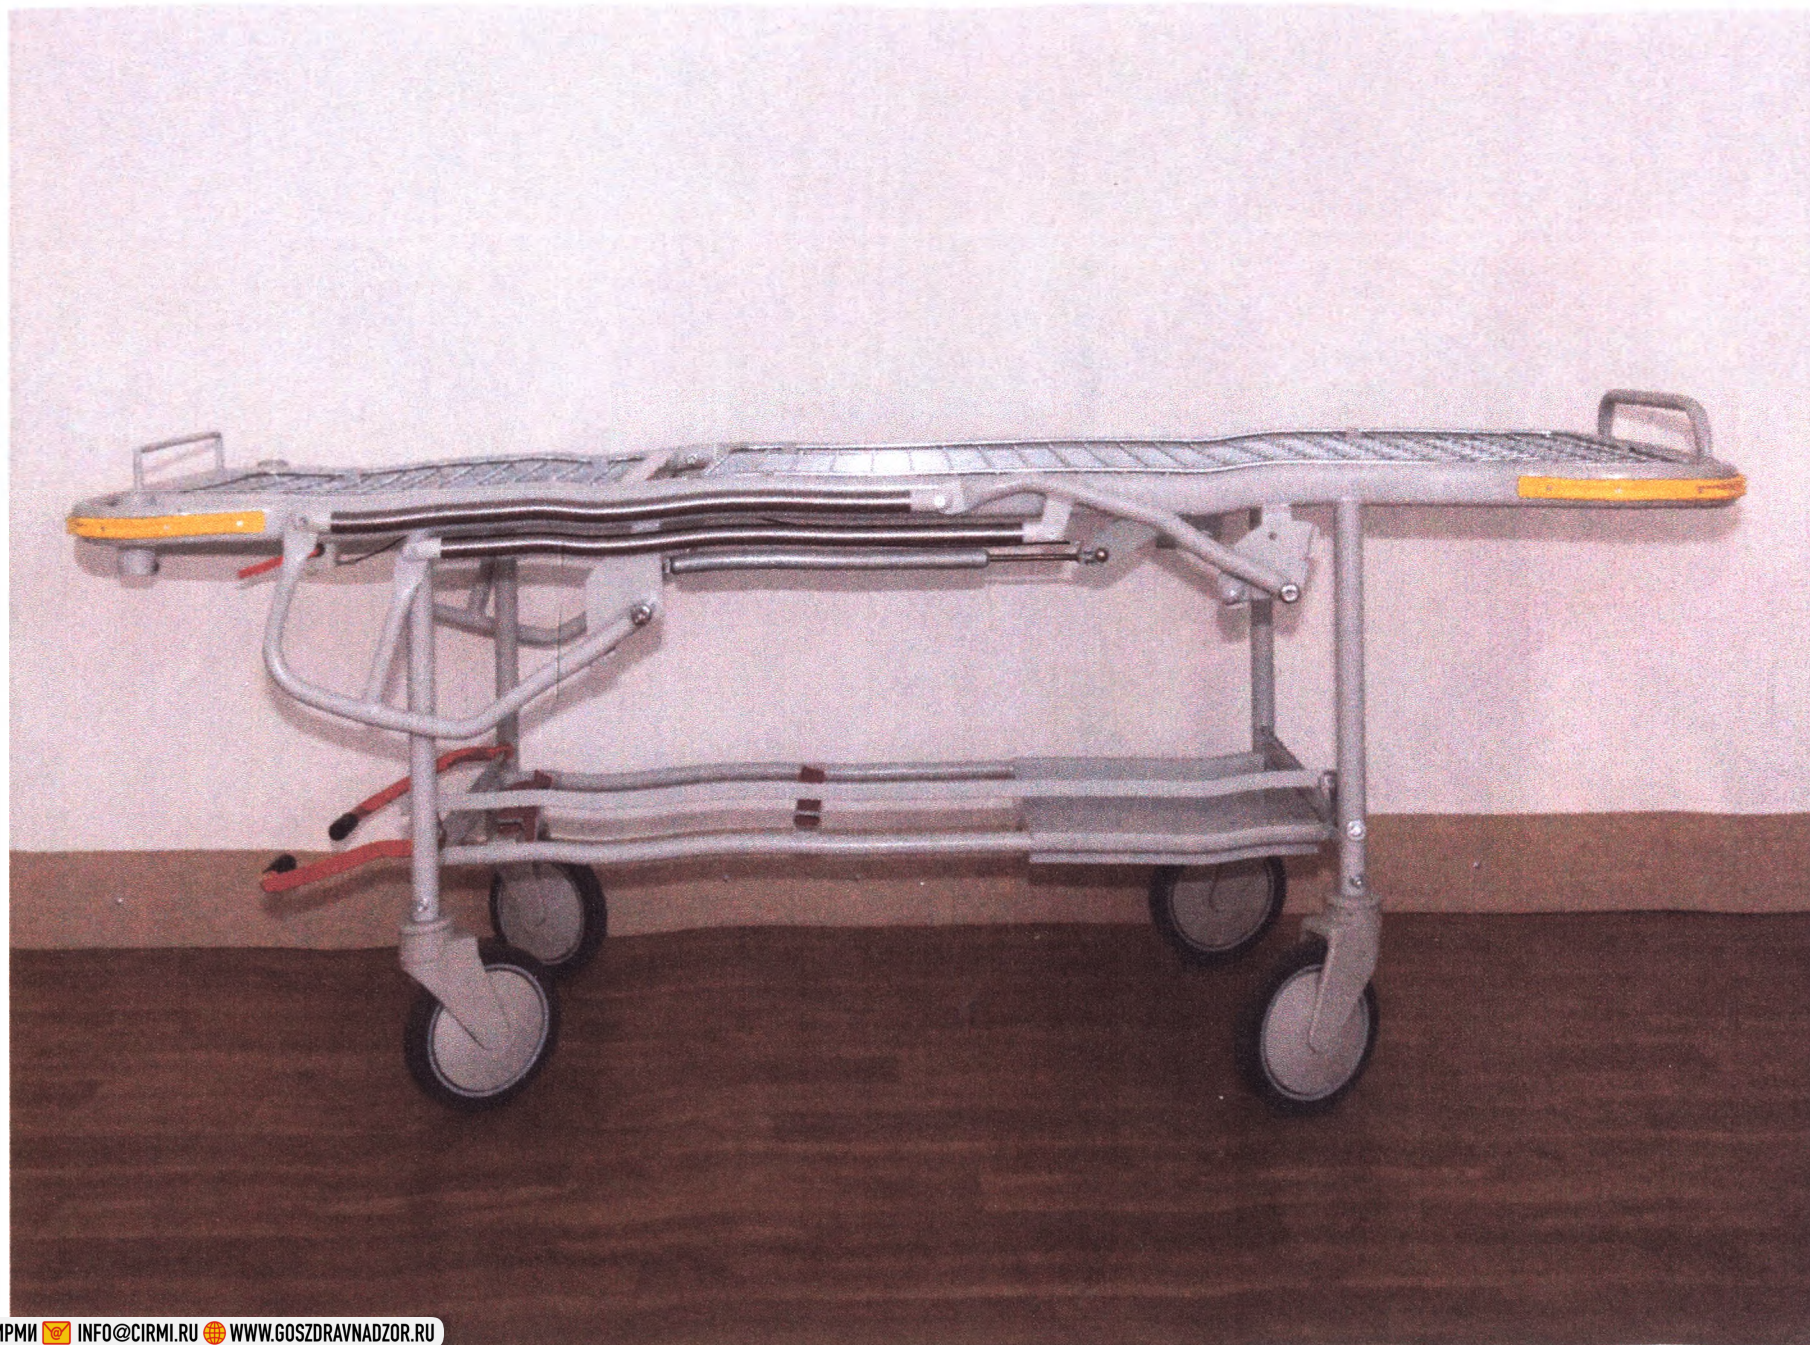


Фото 2.3. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-1-2-Р/С.

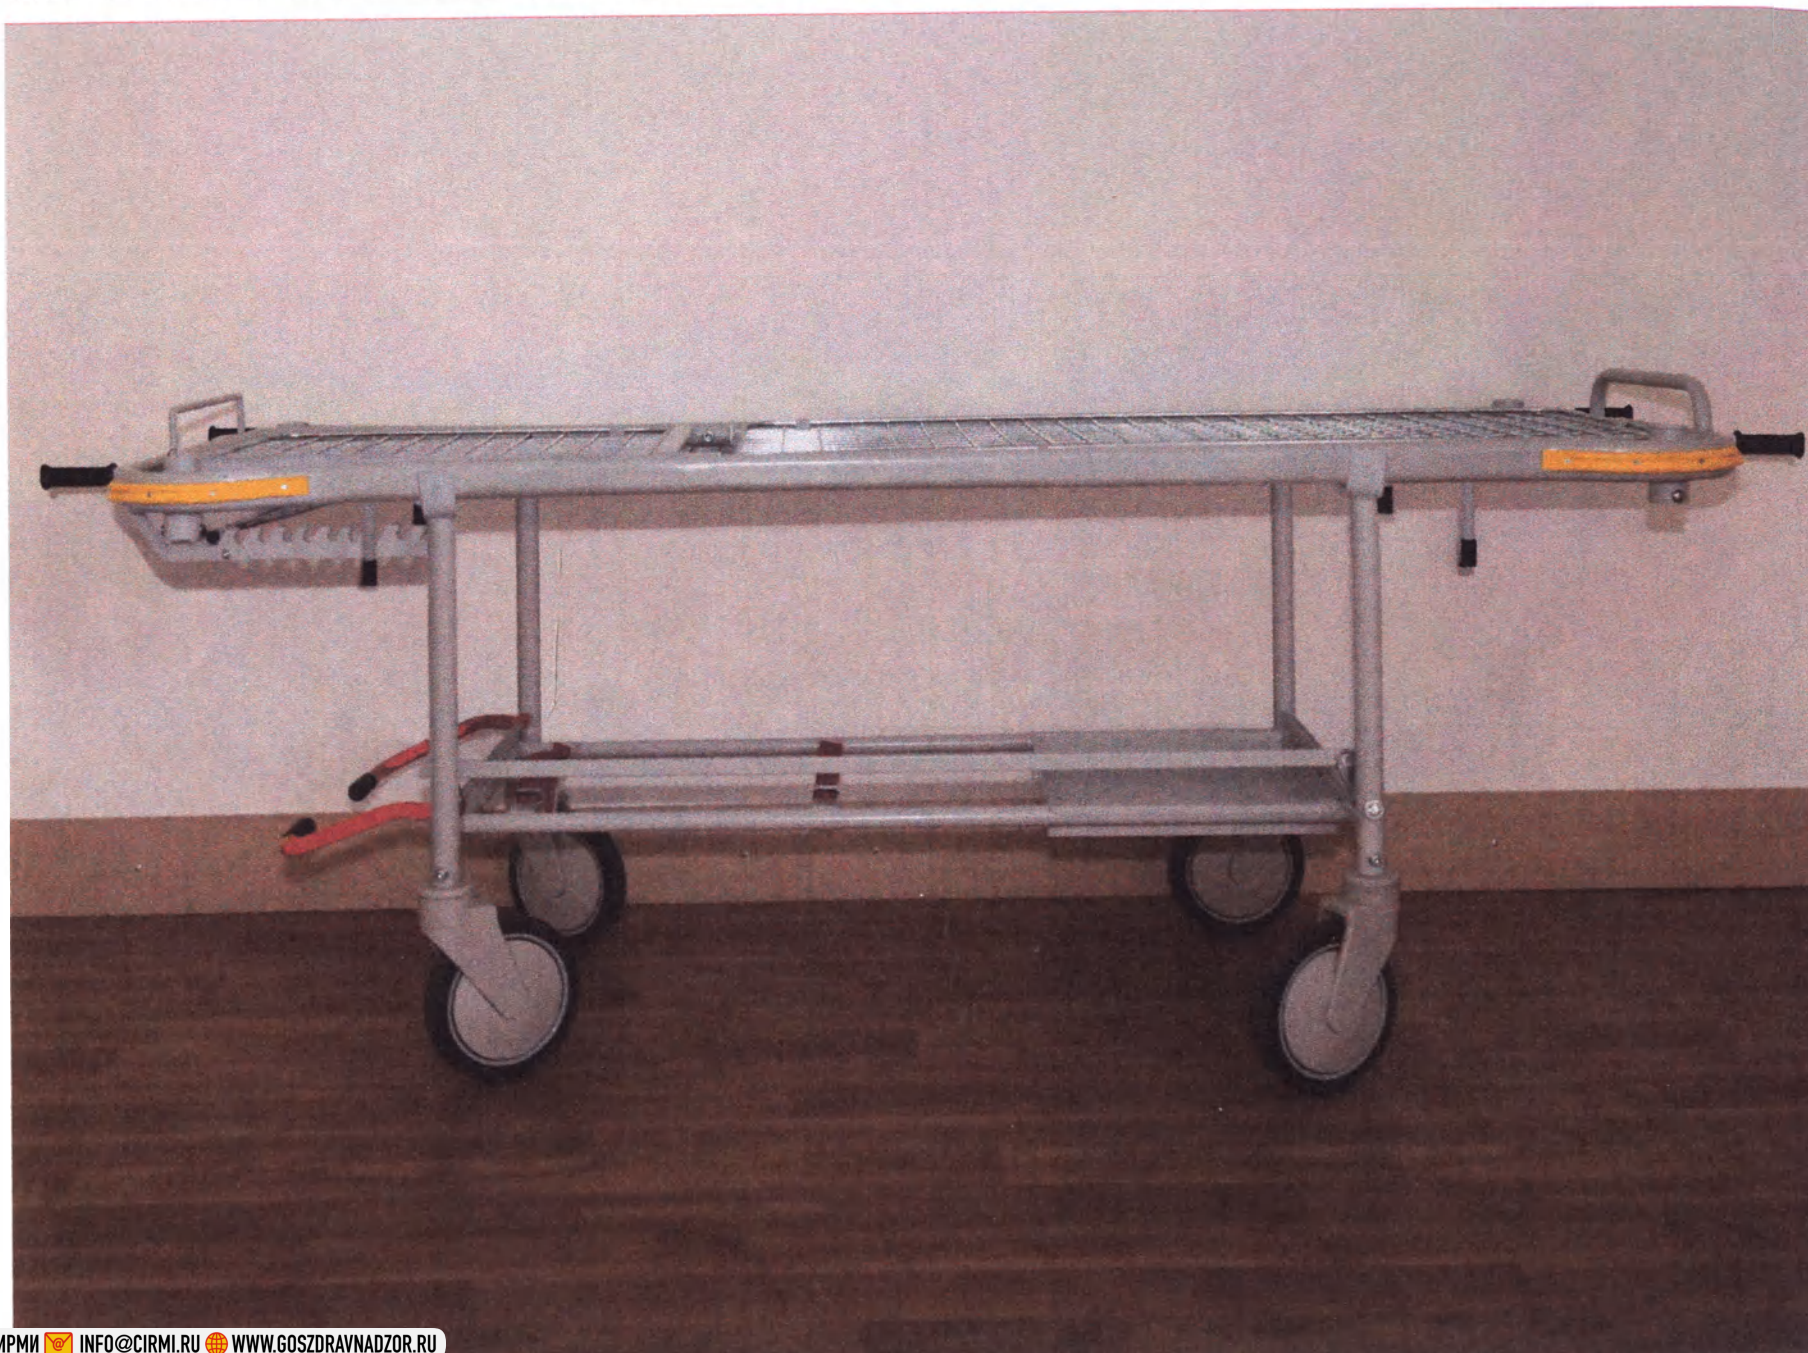


Фото 2.4. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-1-2-Г/С.

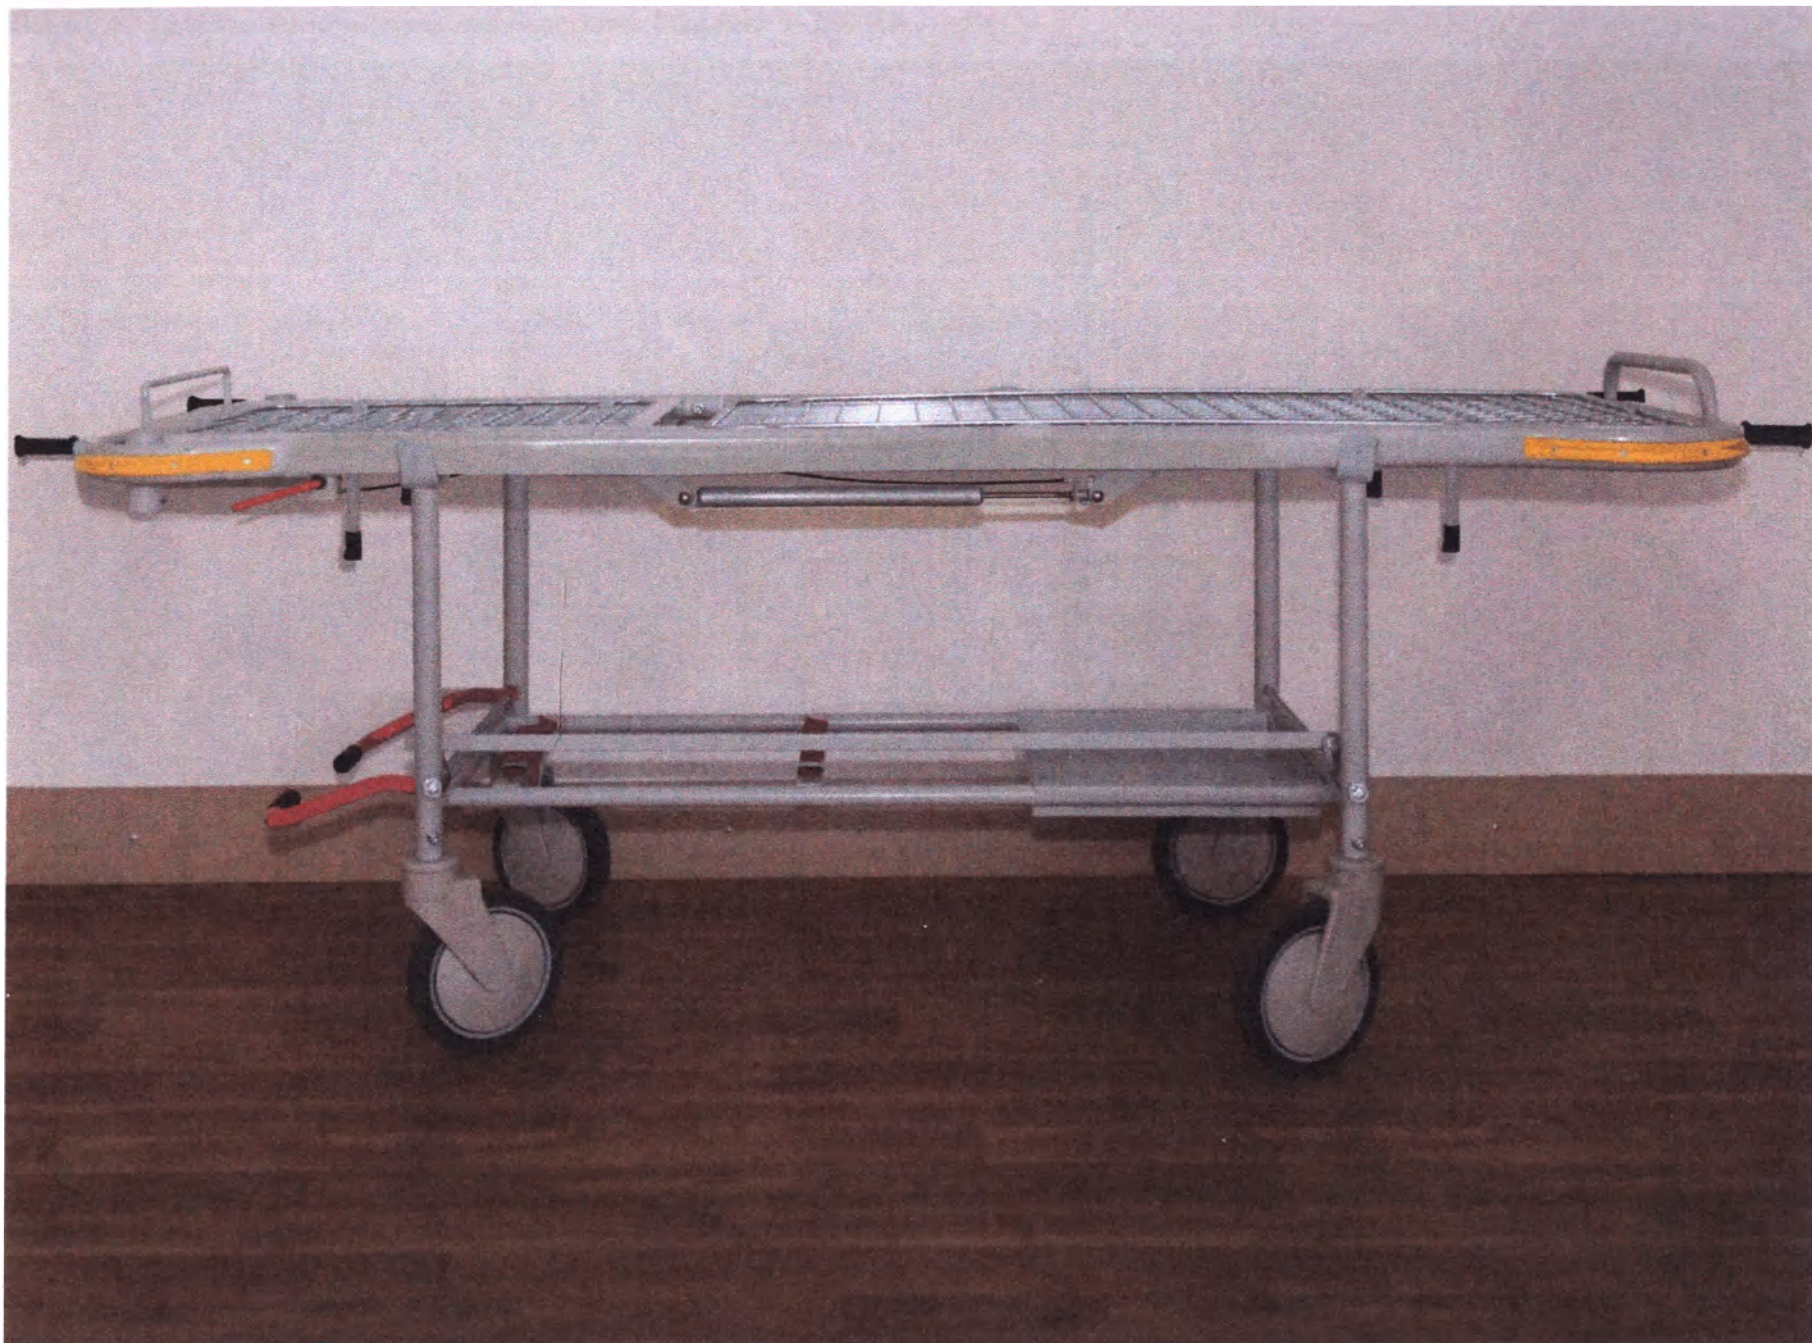


Фото 2.5. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-2-2-Р.

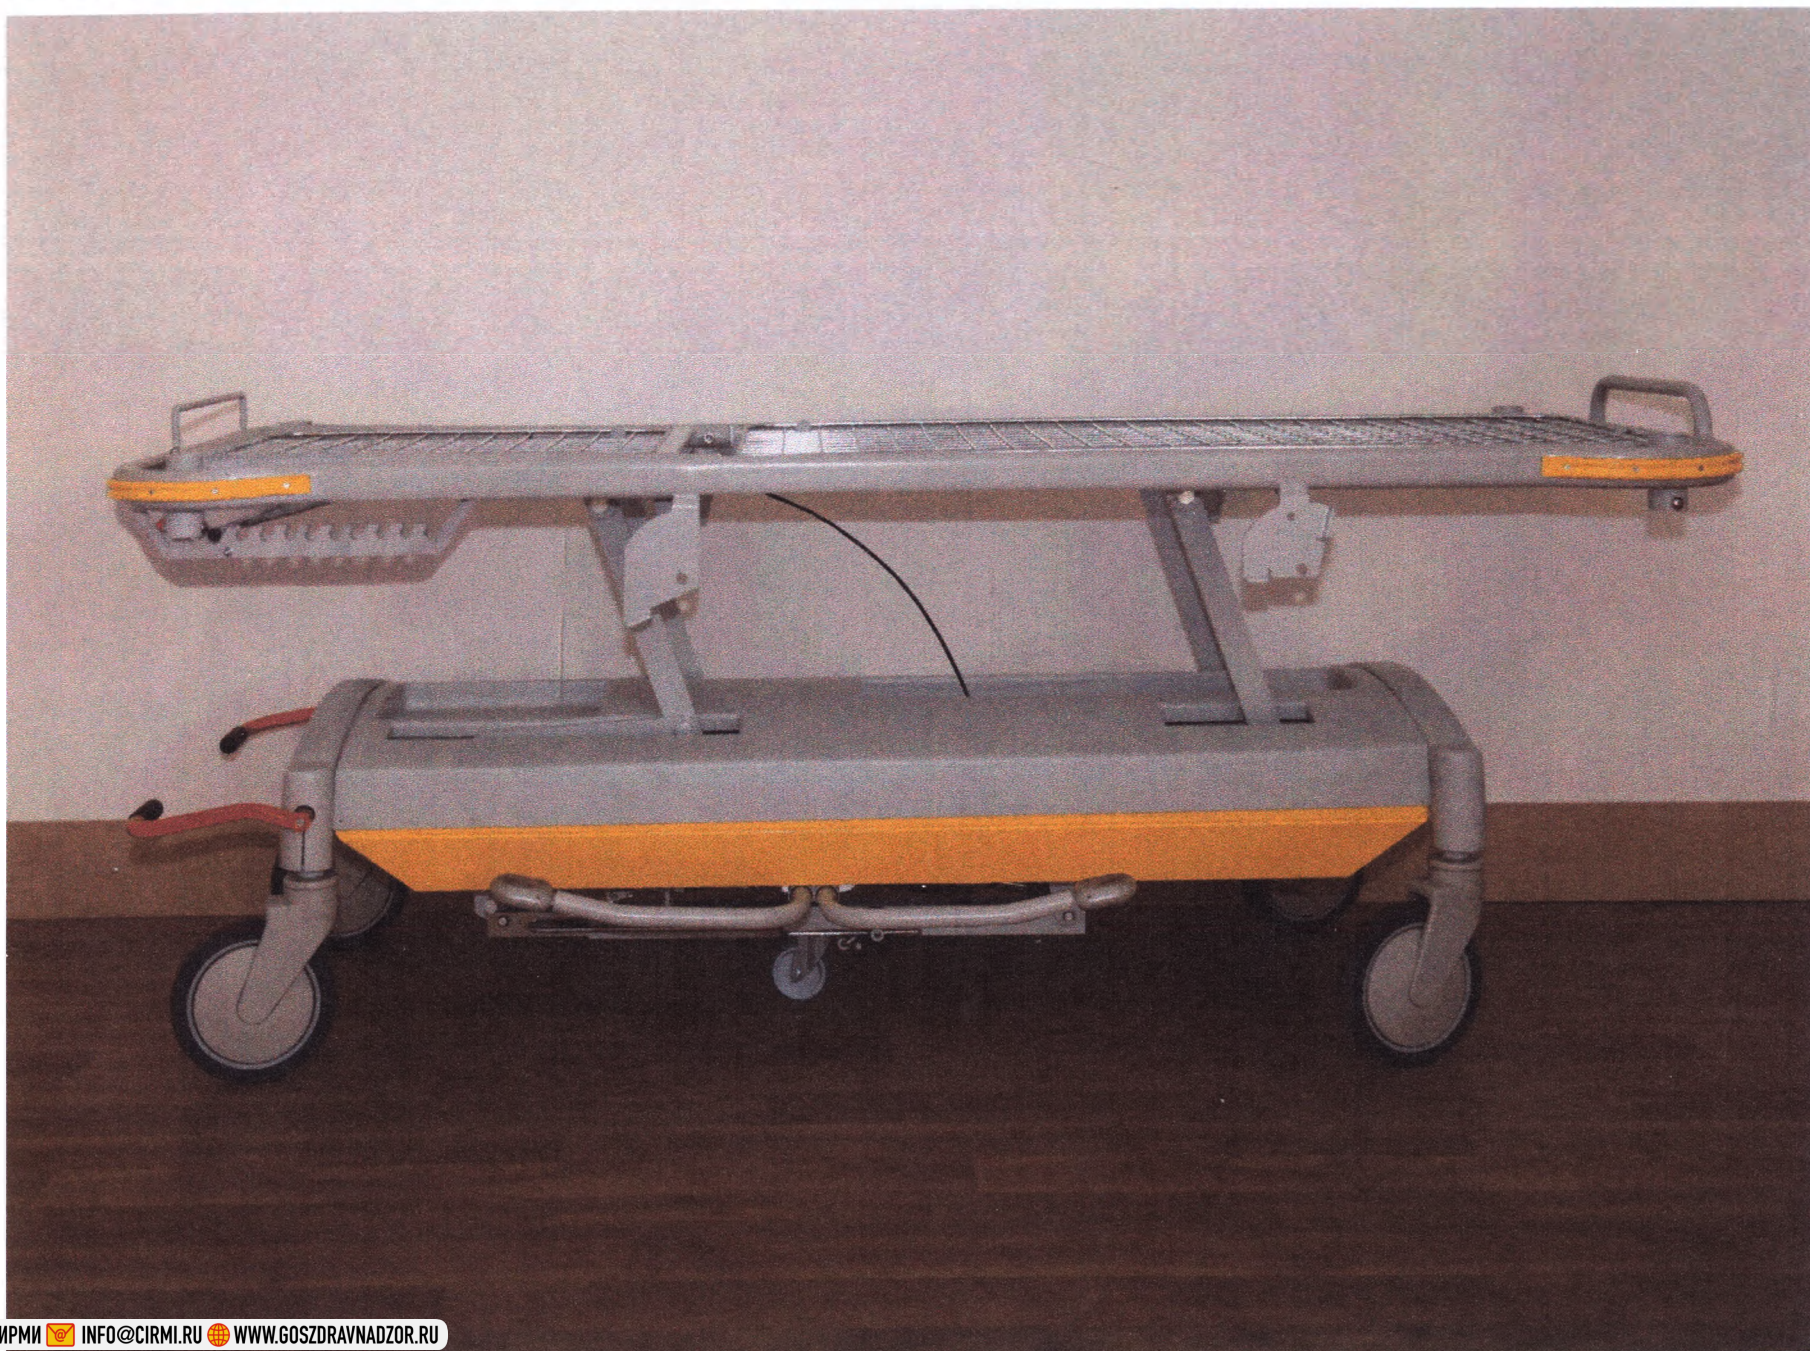


Фото 2.6. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-2-2-Г.

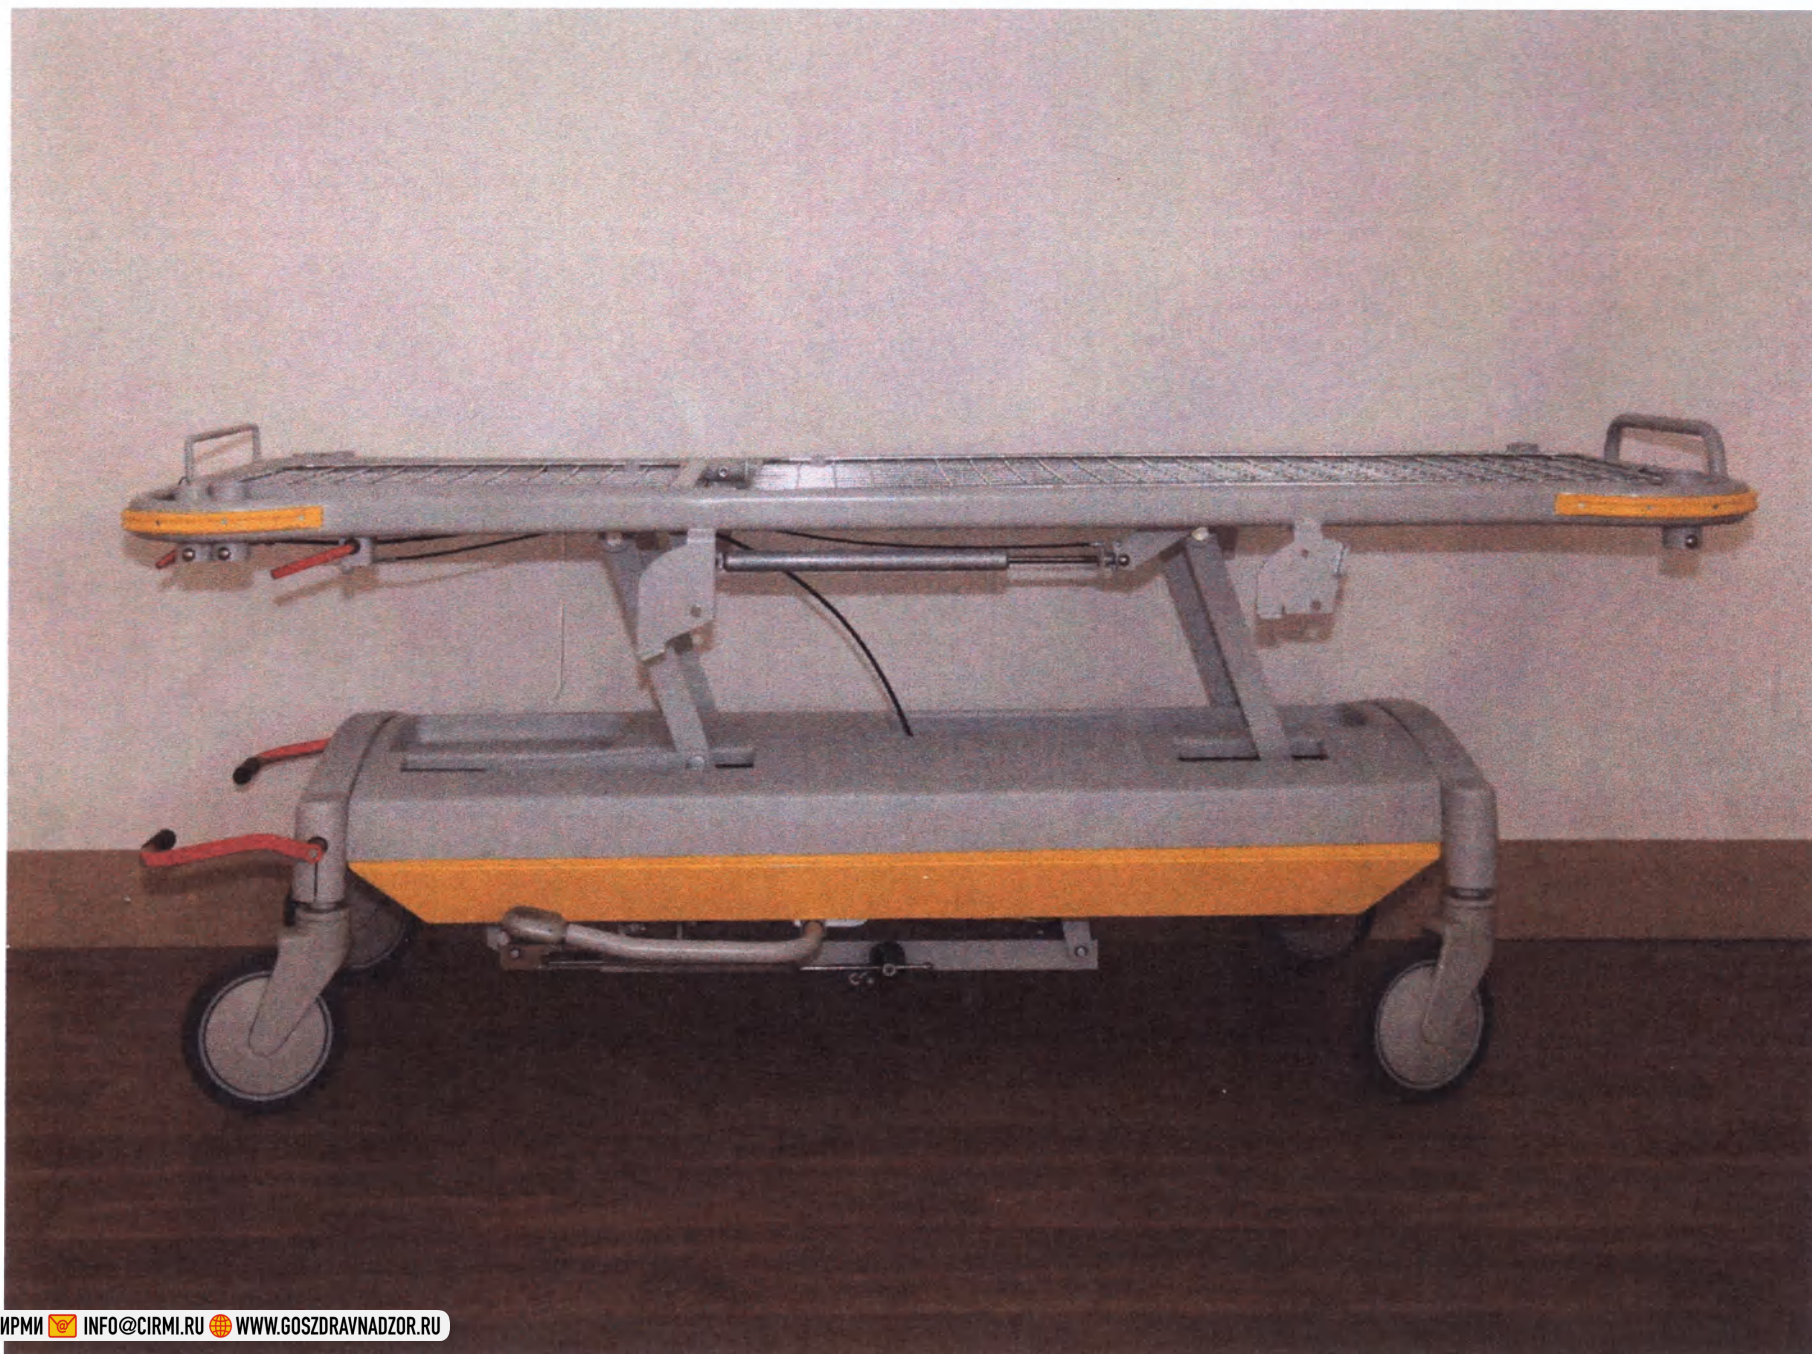


Фото 2.7. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-2-2-Р/С.



Фото 2.8. Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-2-2-Г/С.



Принадлежности:

1. Боковое ограждение – 2 шт.
2. Шарнир бокового ограждения – не более 12 шт.
3. Держатель кислородного баллона – 1 шт.
4. Корзина – 1 шт.
5. Выдвижное пятое колесо – не более 2 шт.
6. Колесная опора с центральным тормозом – не более 4 шт.
7. Педаль управления выдвижным пятым колесом – не более 2 шт.
8. Защитный чехол для матраца – 1 шт.
9. Перекладчик складной – 1 шт.
10. Ремень фиксирующий – не более 6 шт.
11. Карман для истории болезни пациента – не более 2 шт.
12. Педаль тормоза – не более 4 шт.
13. Приспособление для мытья пациентов – 1 шт.

Принадлежности и изделия входящие в состав, не изображенные на фото общего вида варианта исполнения тележки

Фото 3.1. Боковое ограждение.




Фото 3.2. Шарнир бокового ограждения.


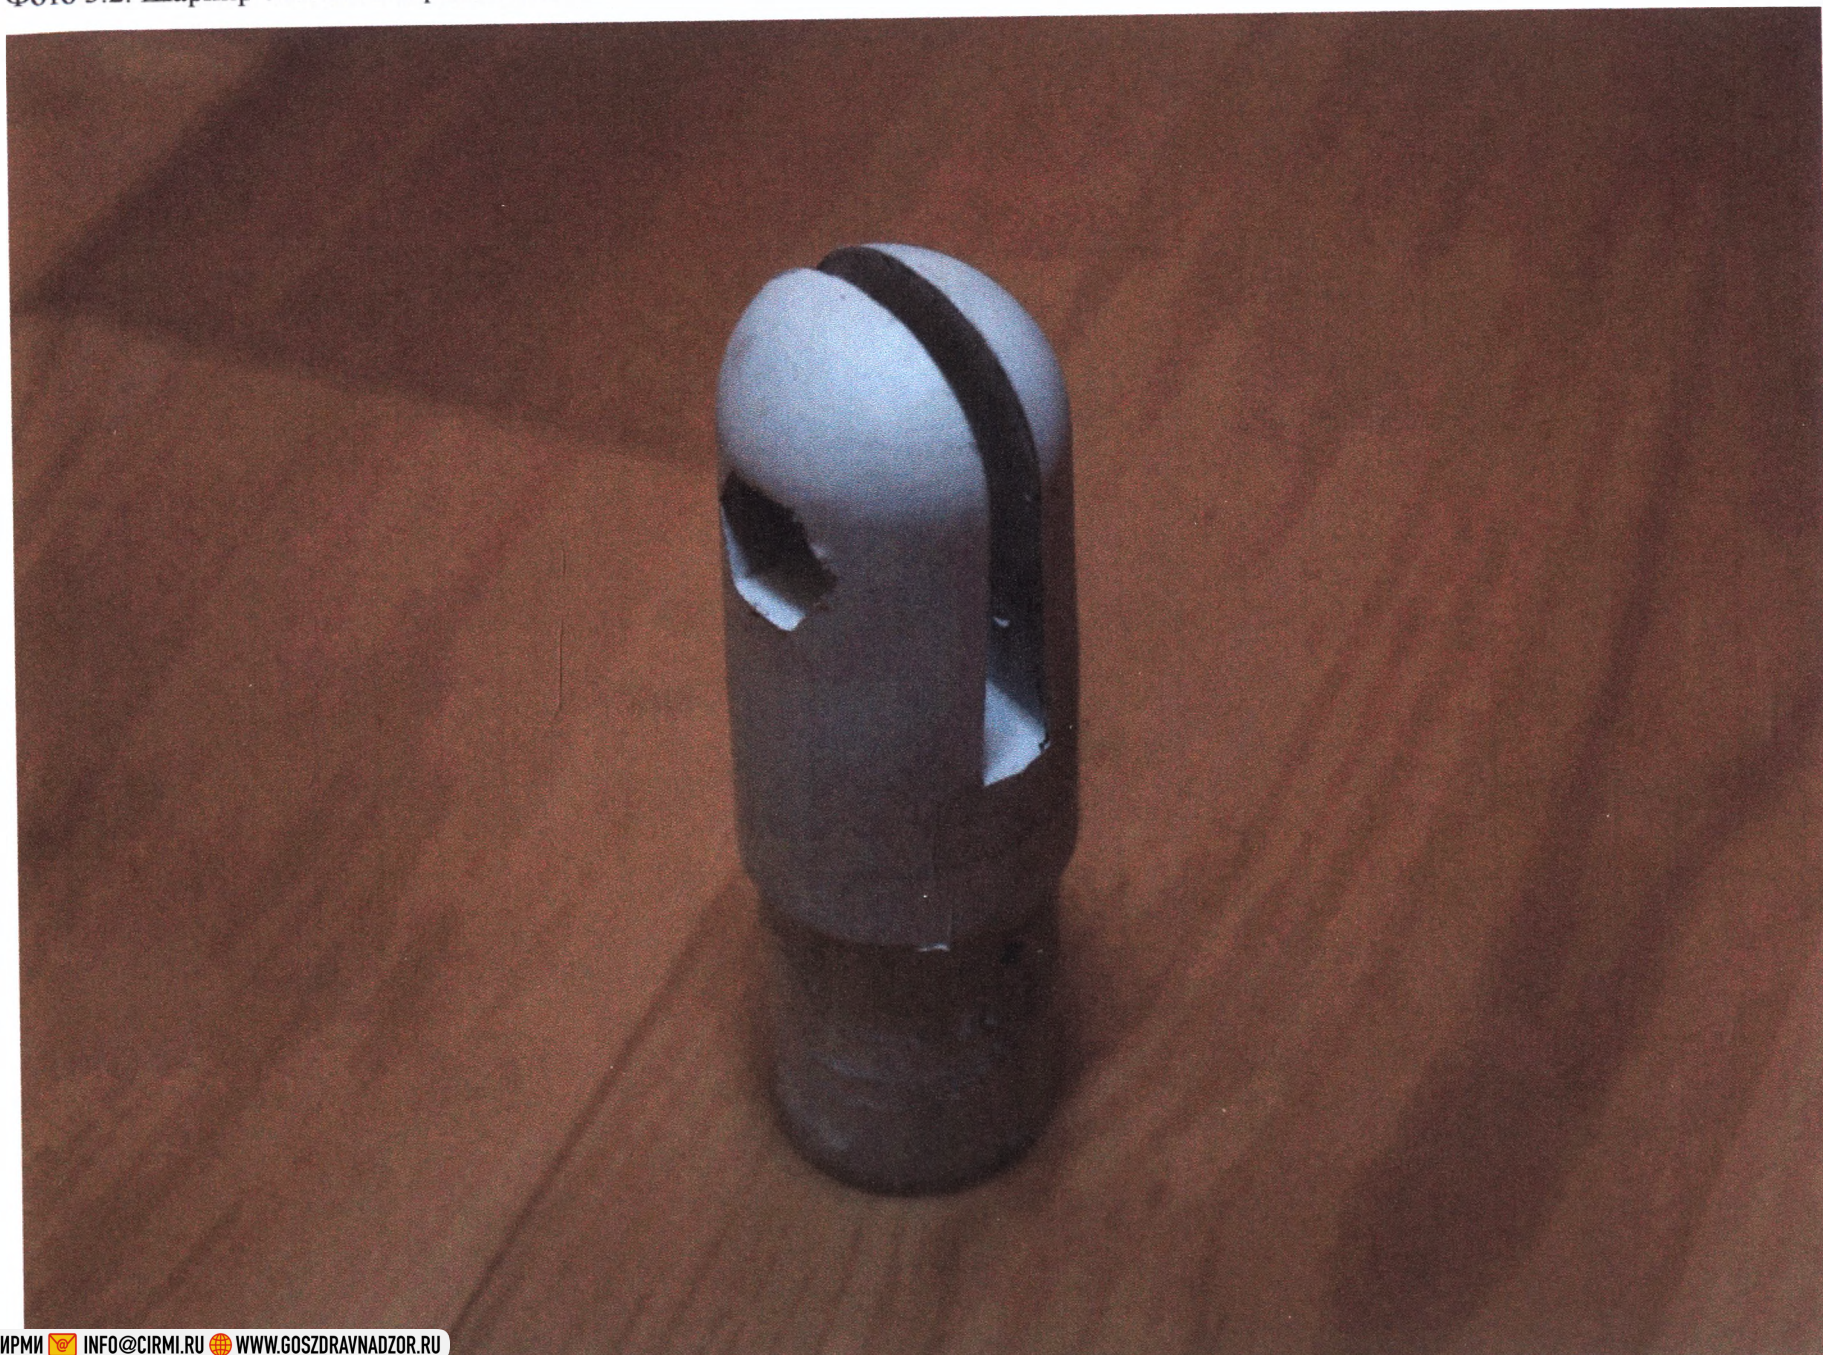


Фото 3.3. Держатель кислородного баллона.



Фото 3.5. Корзина.

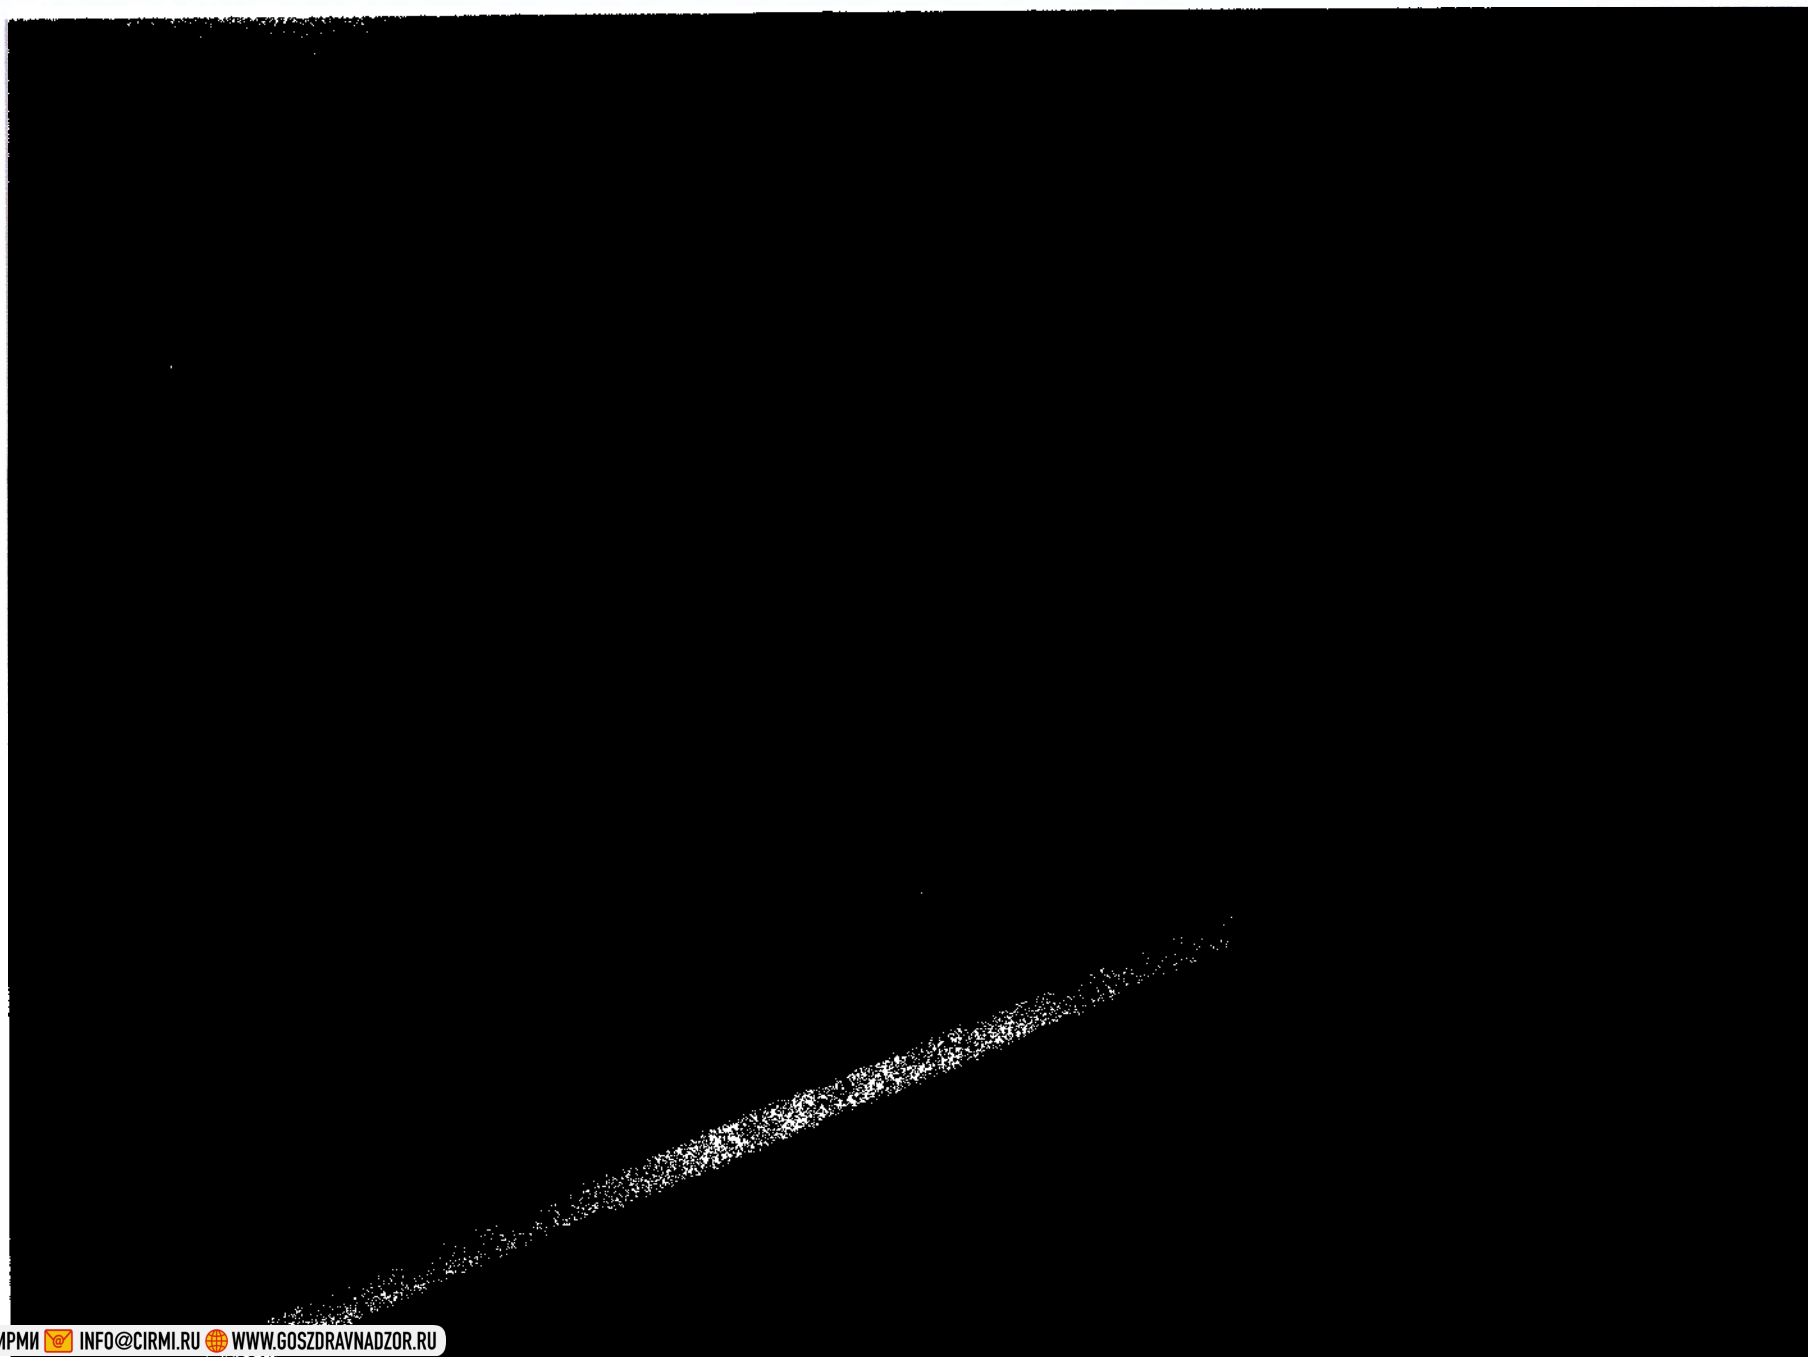

19

Фото 3.6. Выдвижное пятое колесо

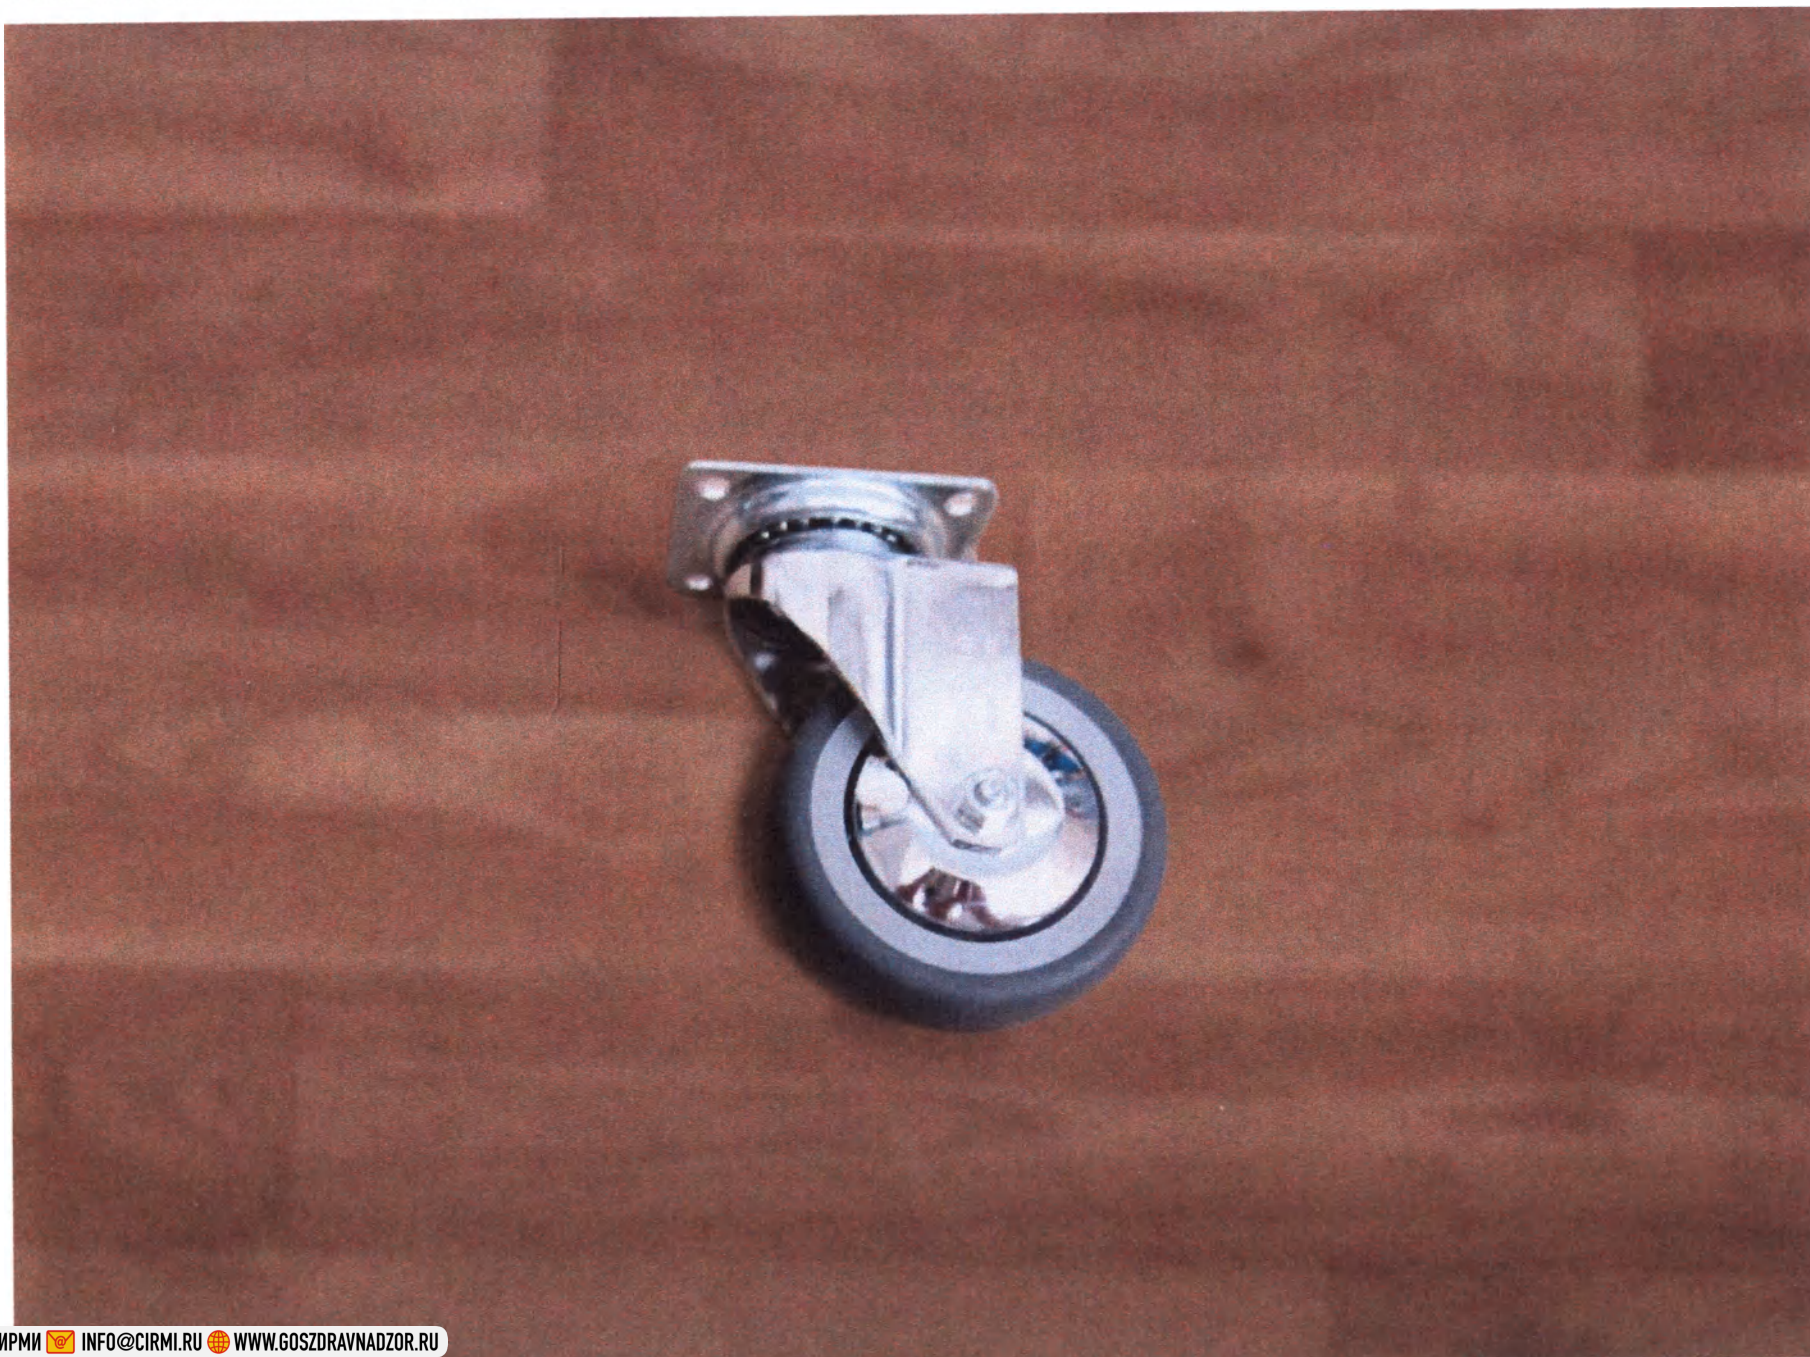


Фото 3.7. Педаль управления выдвижным пятым колесом.


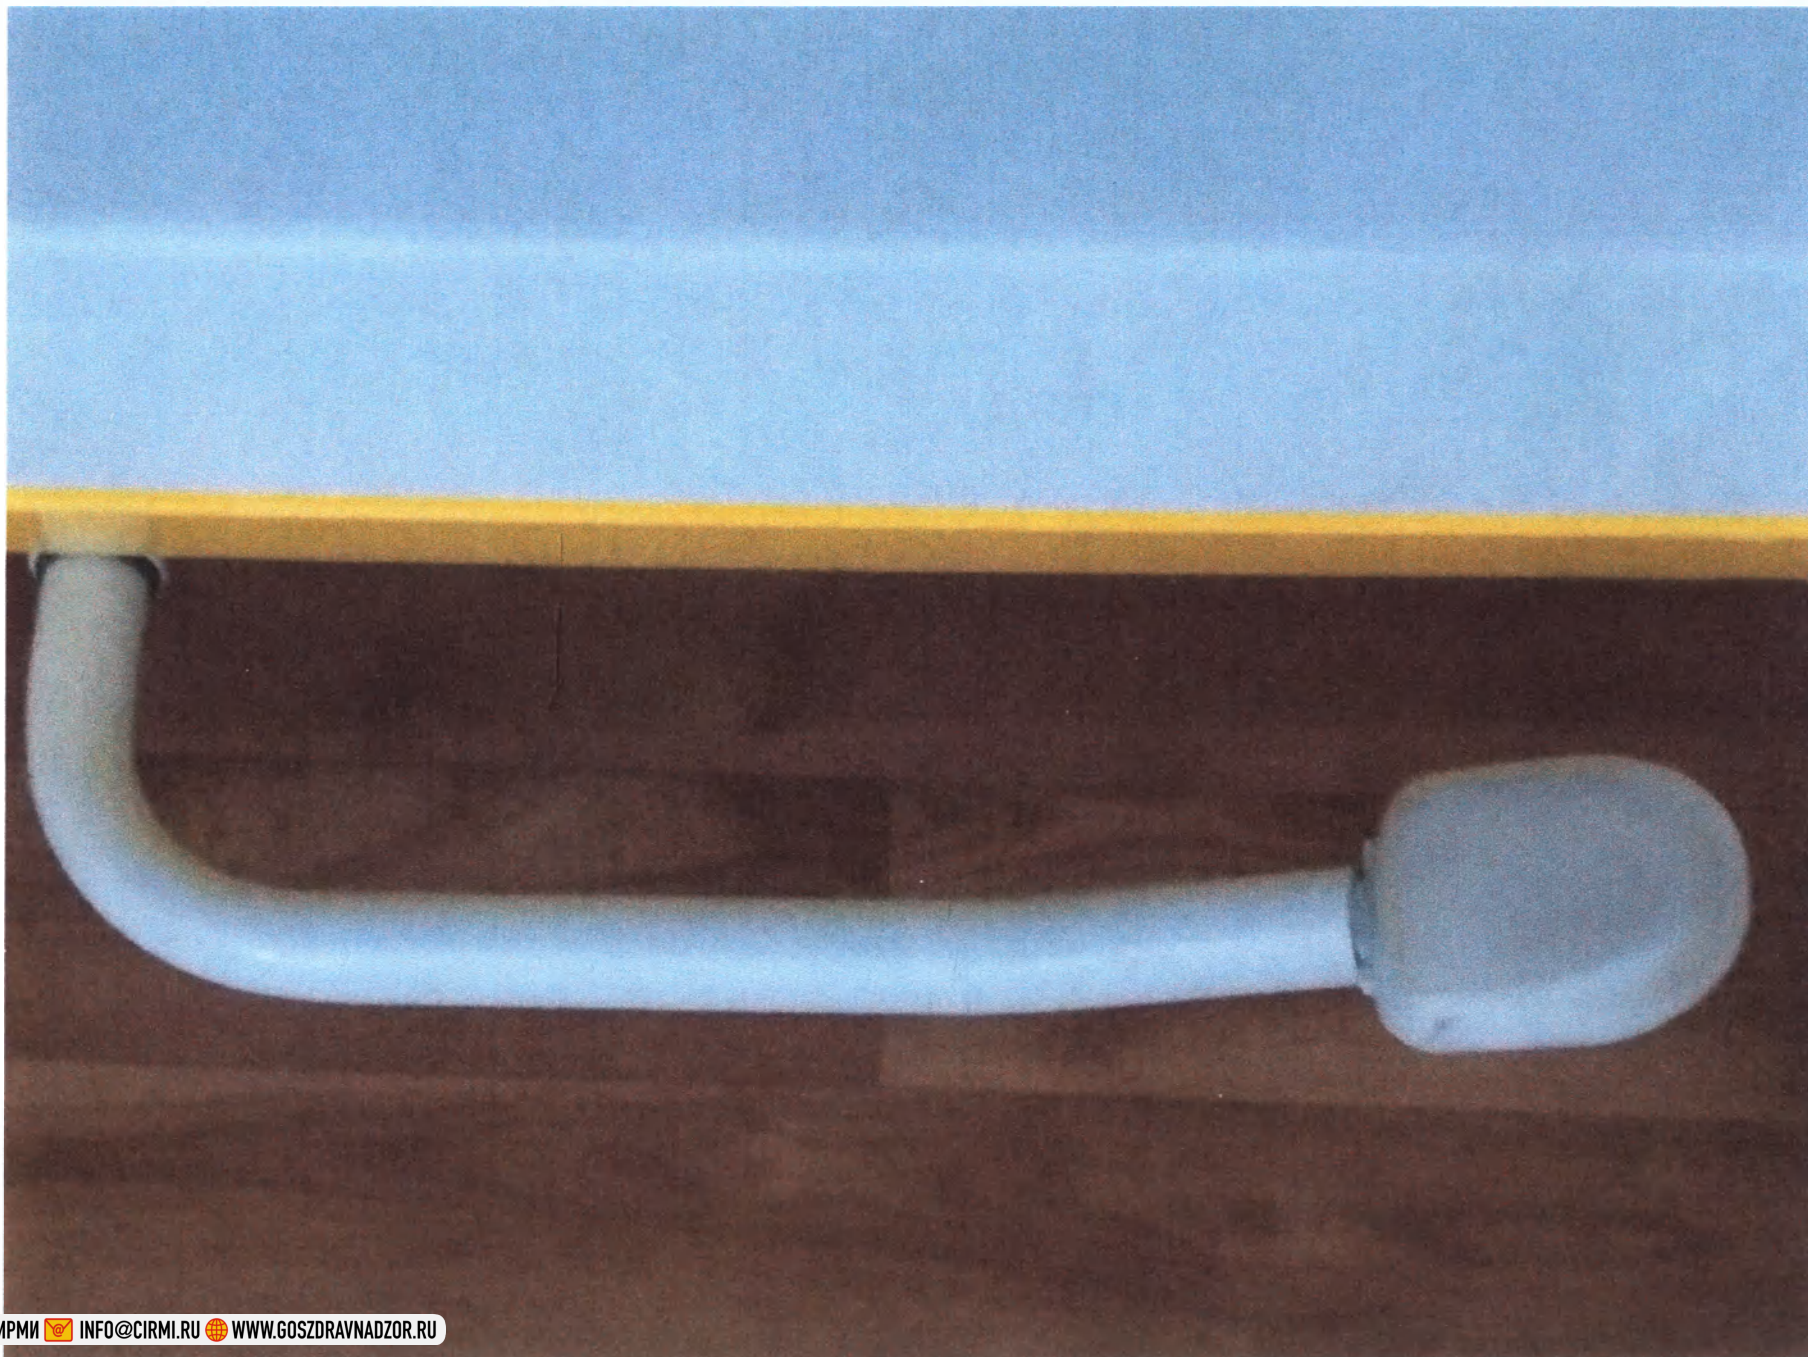


Фото 3.8. Защитный чехол для матраца.



Фото 3.9. Перекладчик складной.

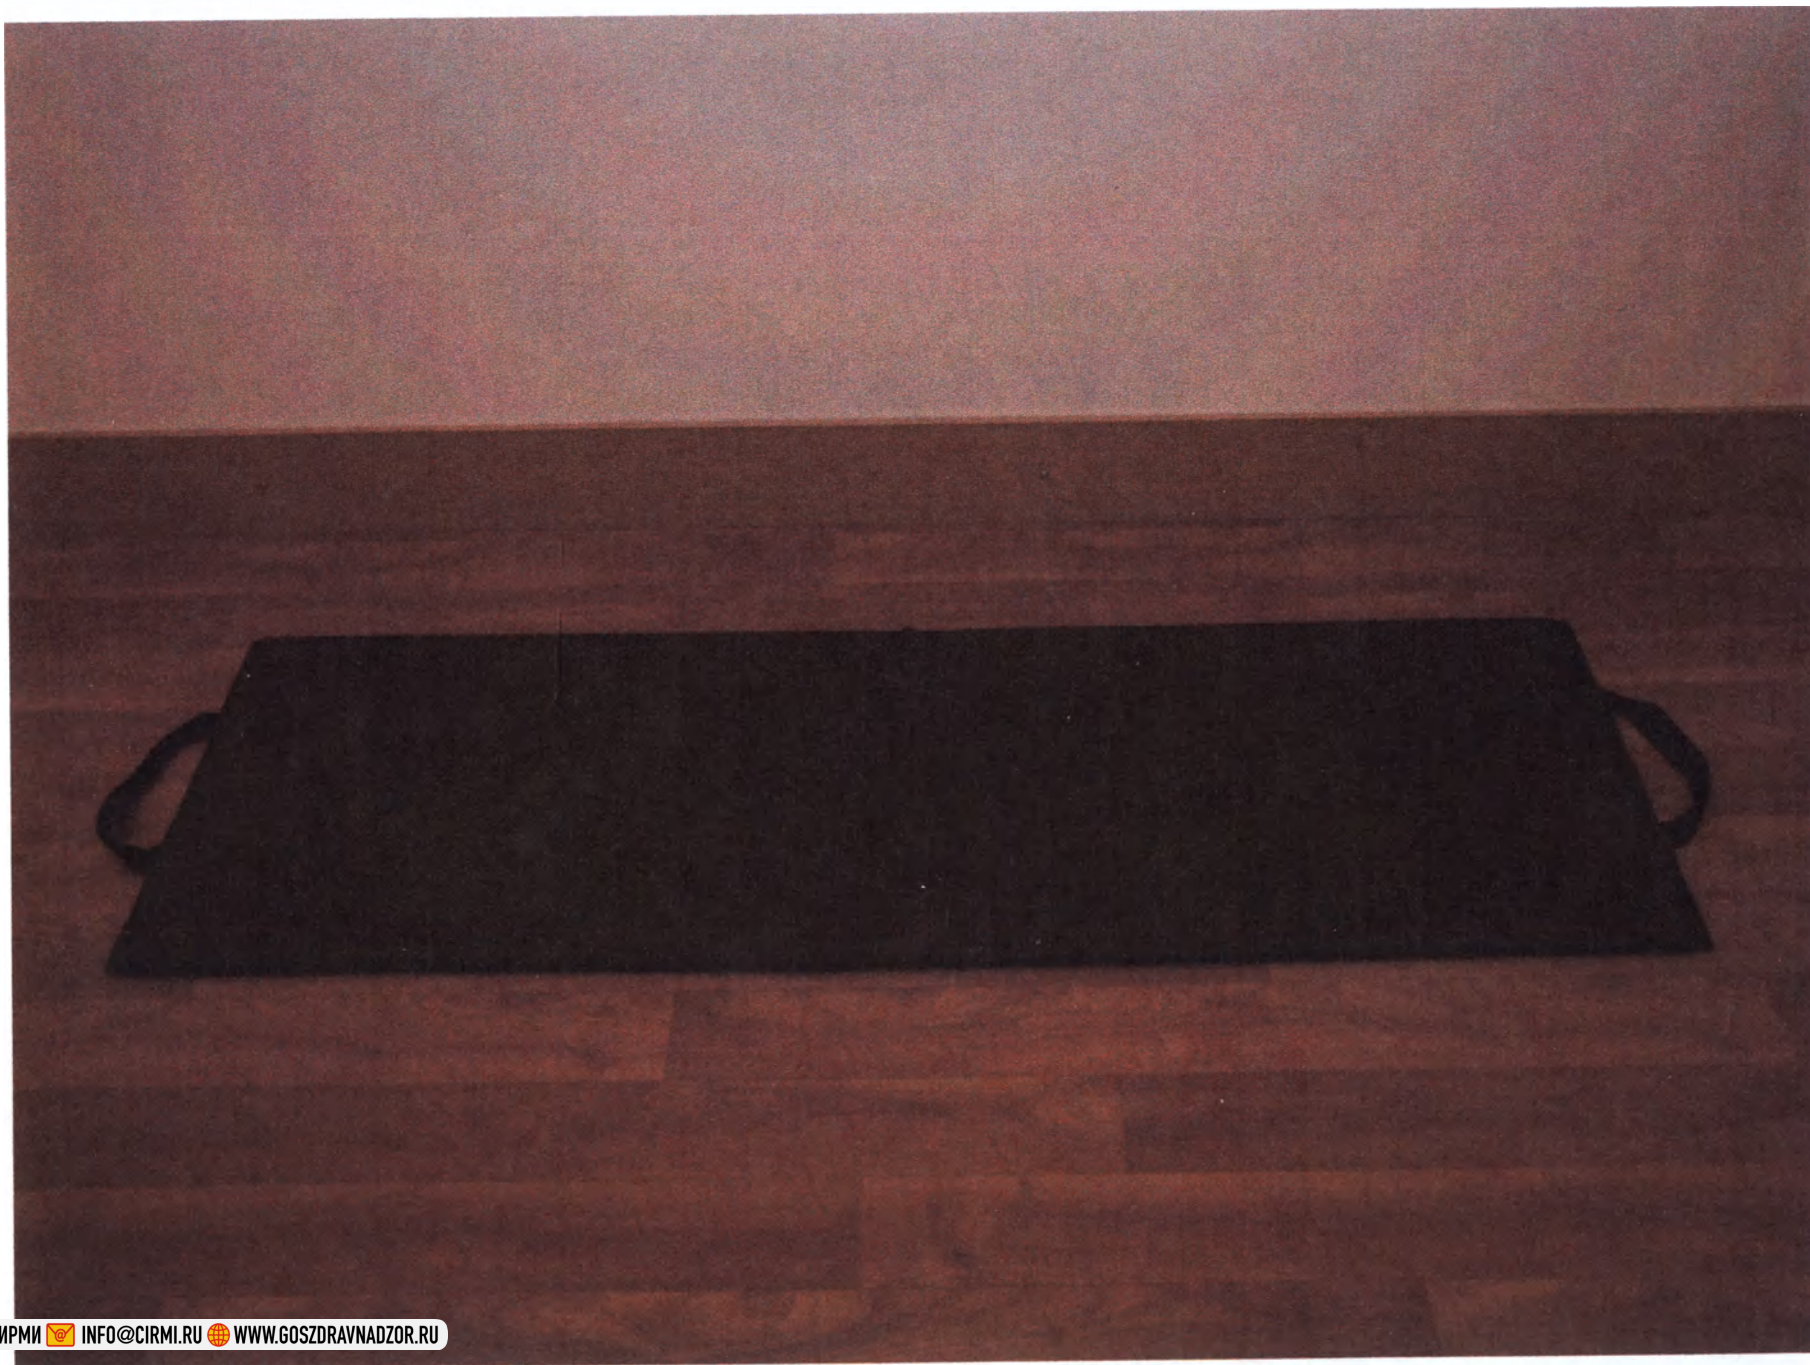

23

Фото 3.10. Ремень фиксирующий.

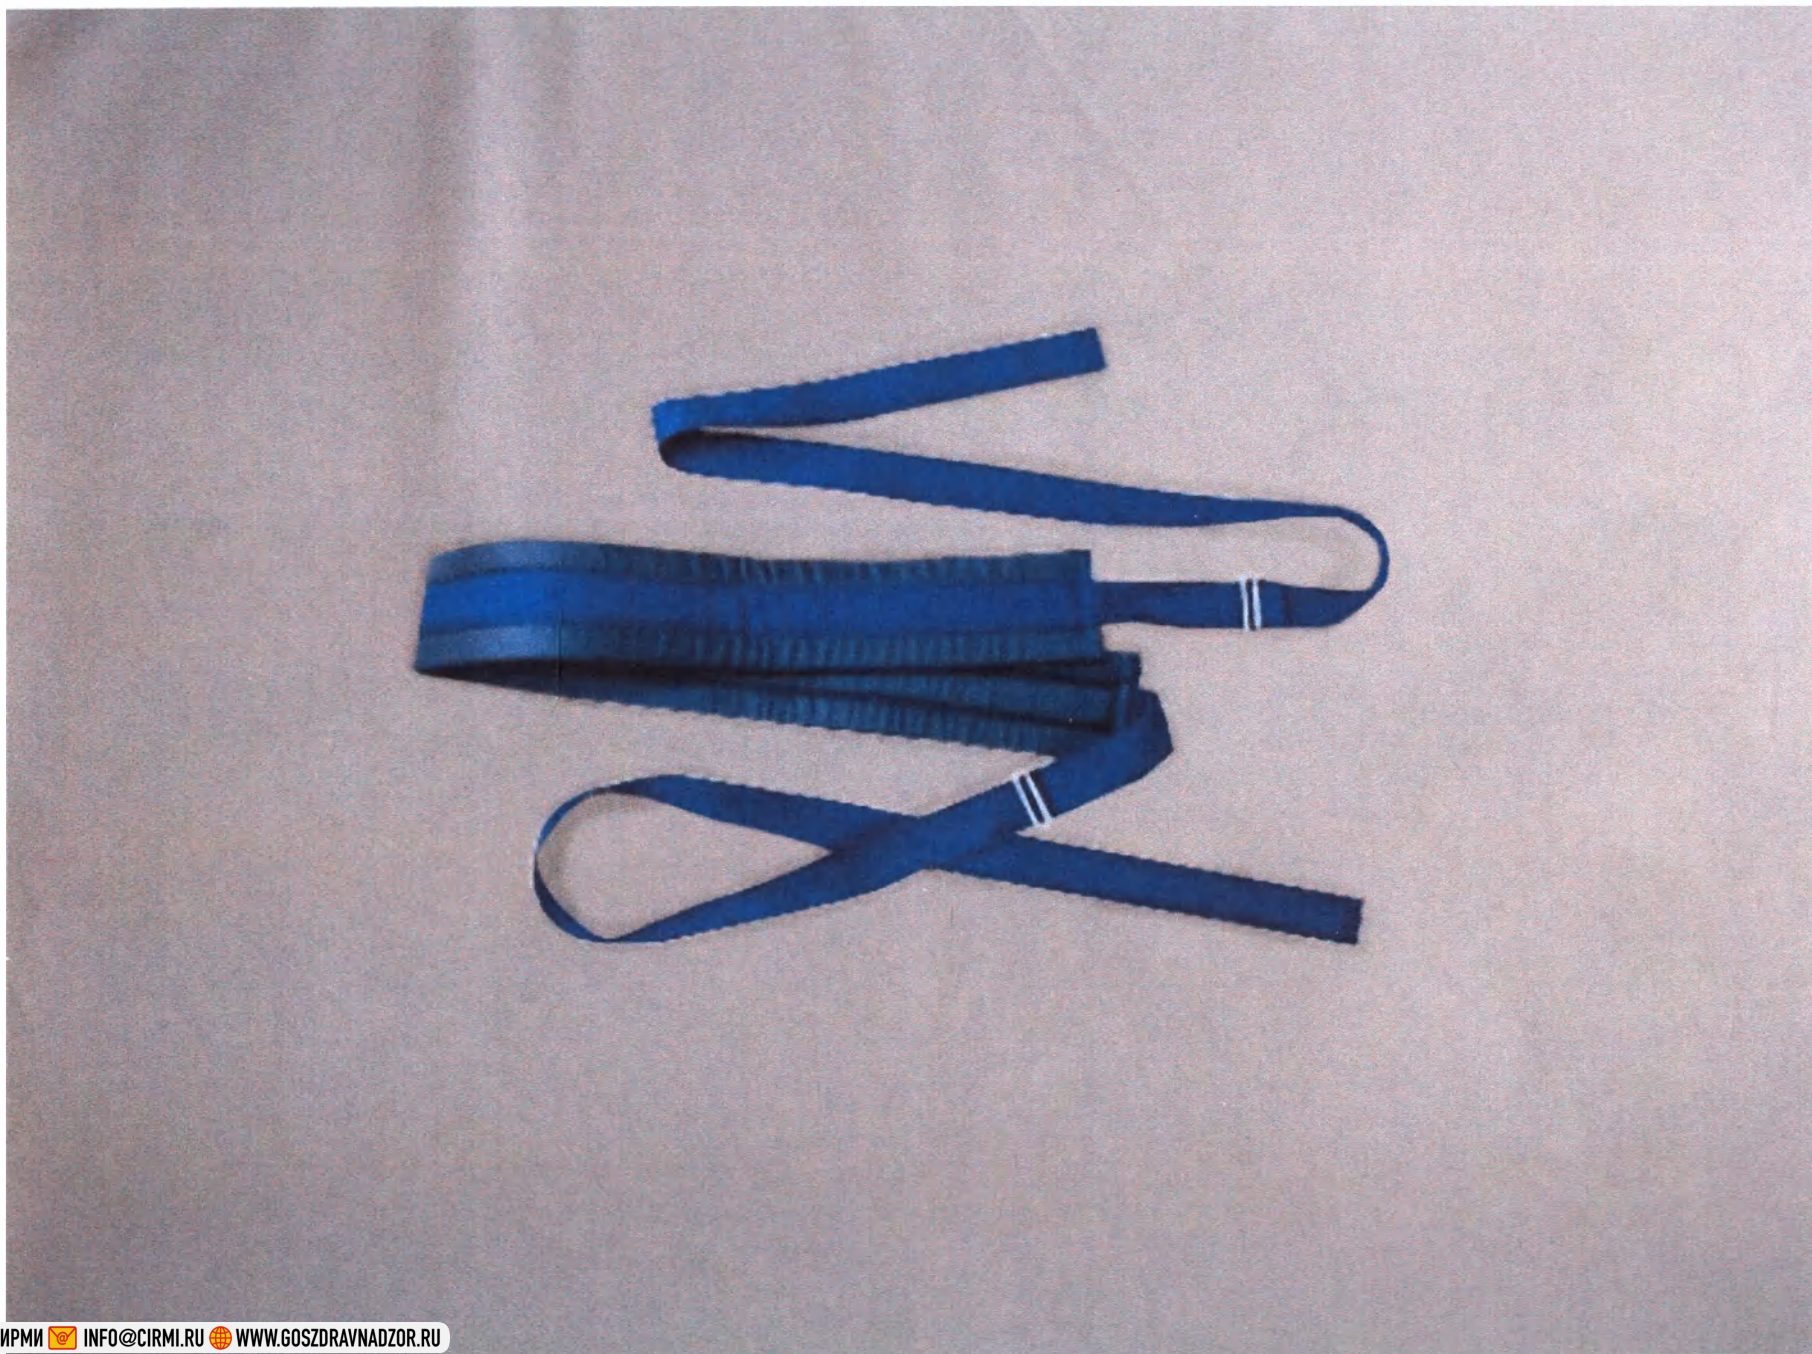


Фото 3.11. Карман для истории болезни пациента.

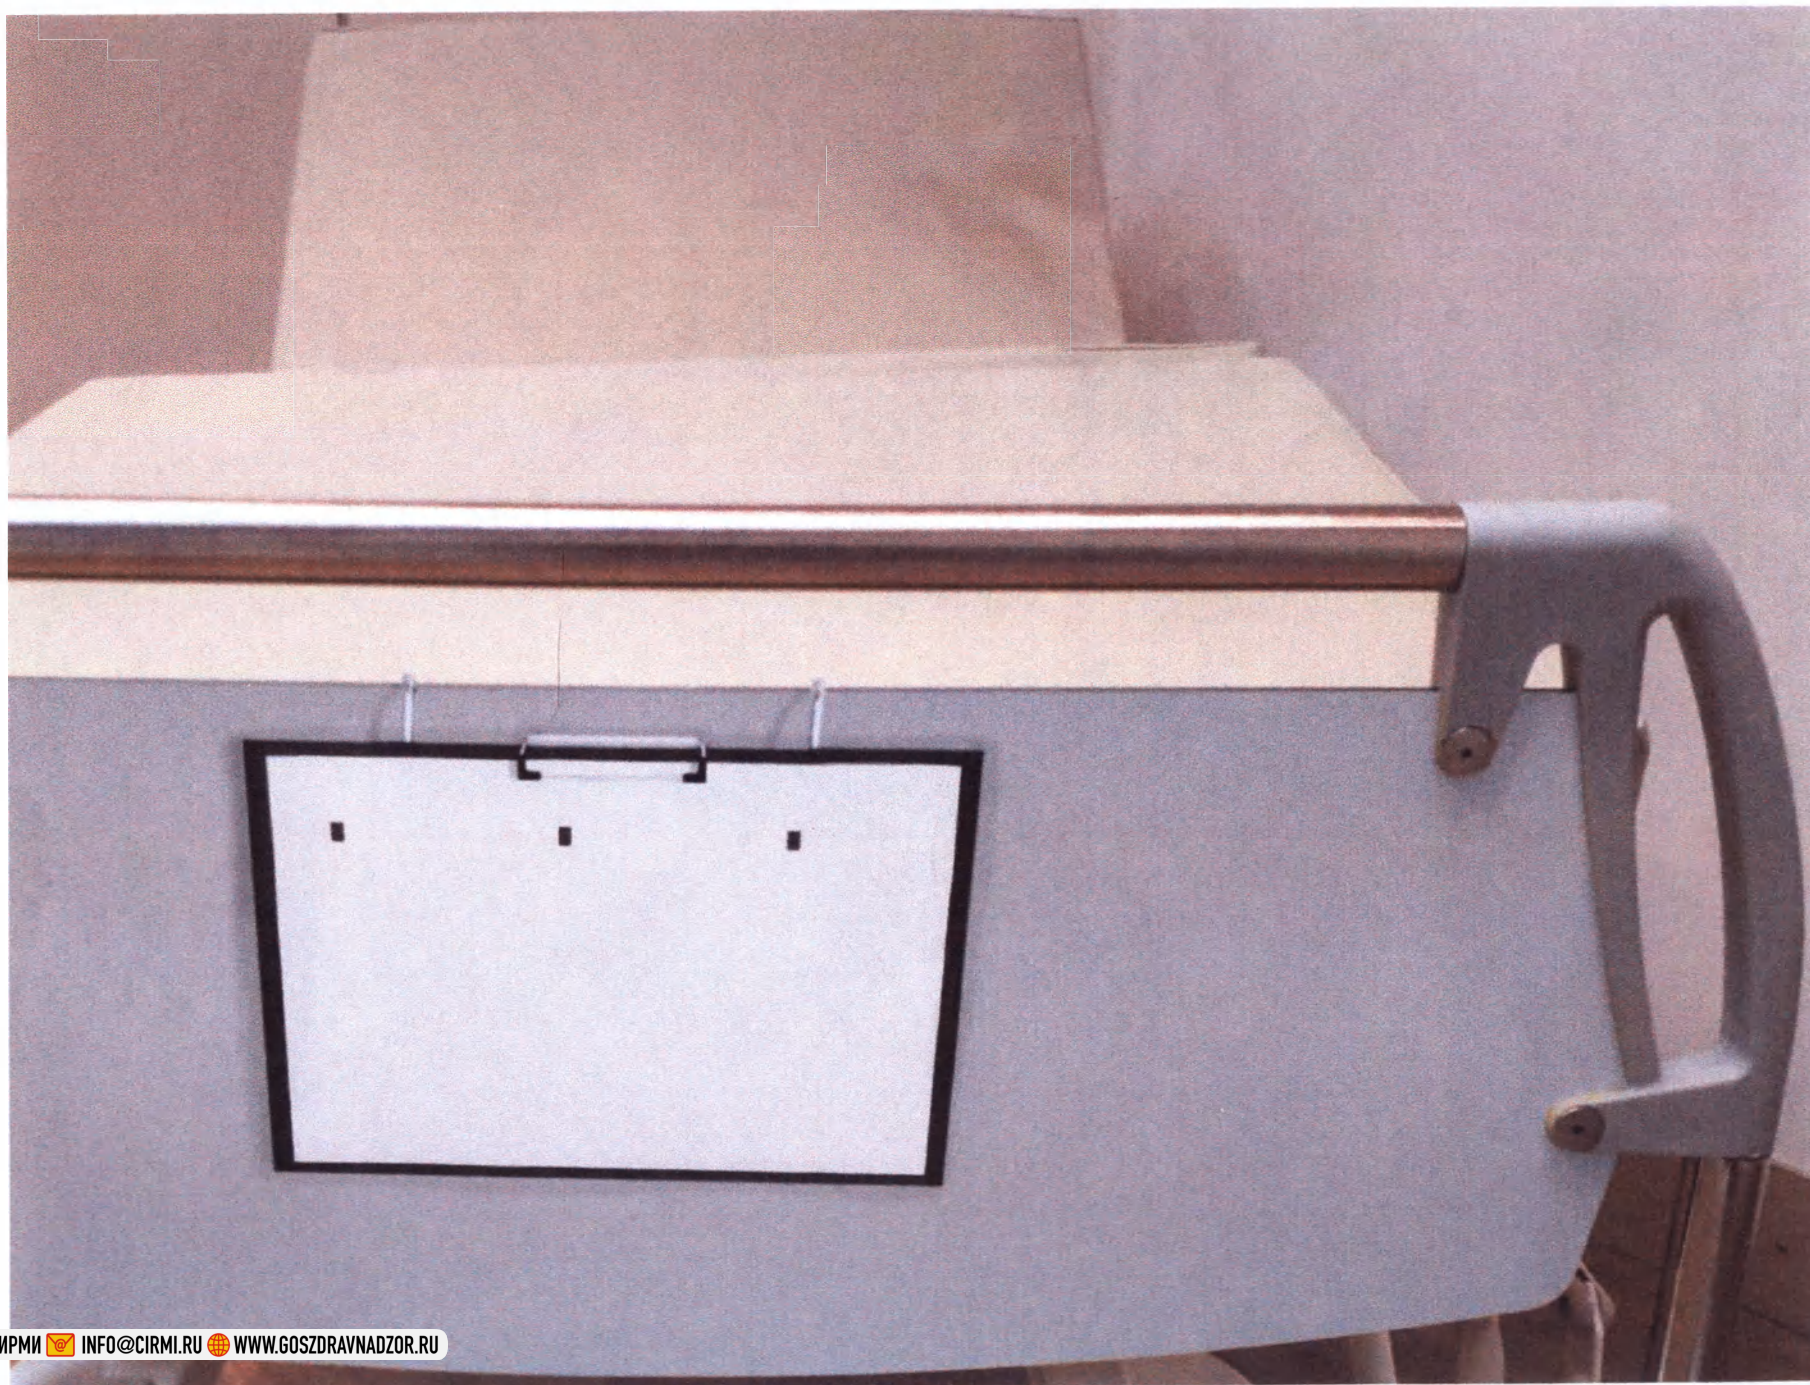


Фото 3.12. Педаль тормоза.



Фото 3.13. Угловой бампер

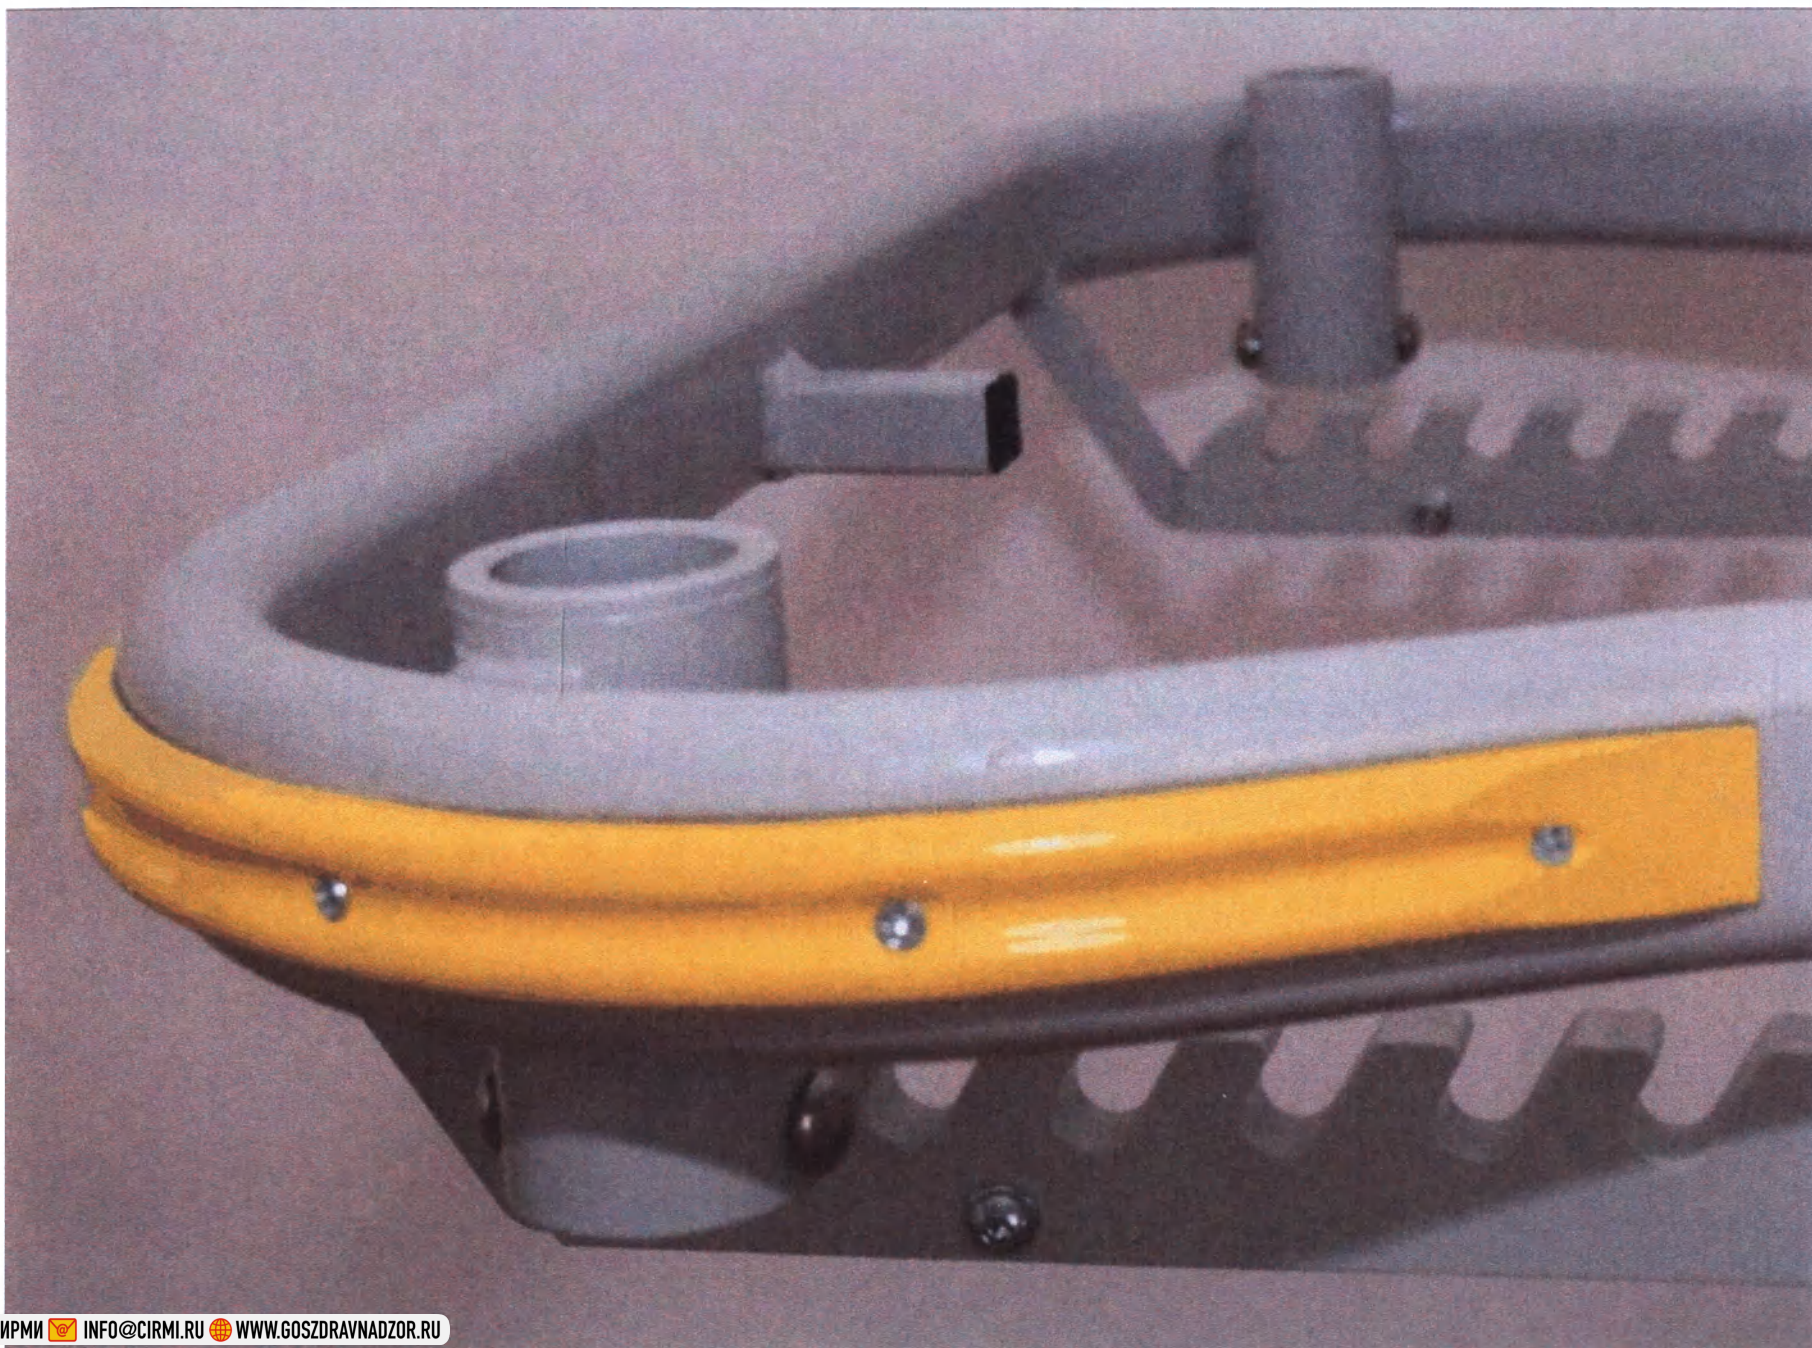


Фото 3.14. Штатив для вливаний.

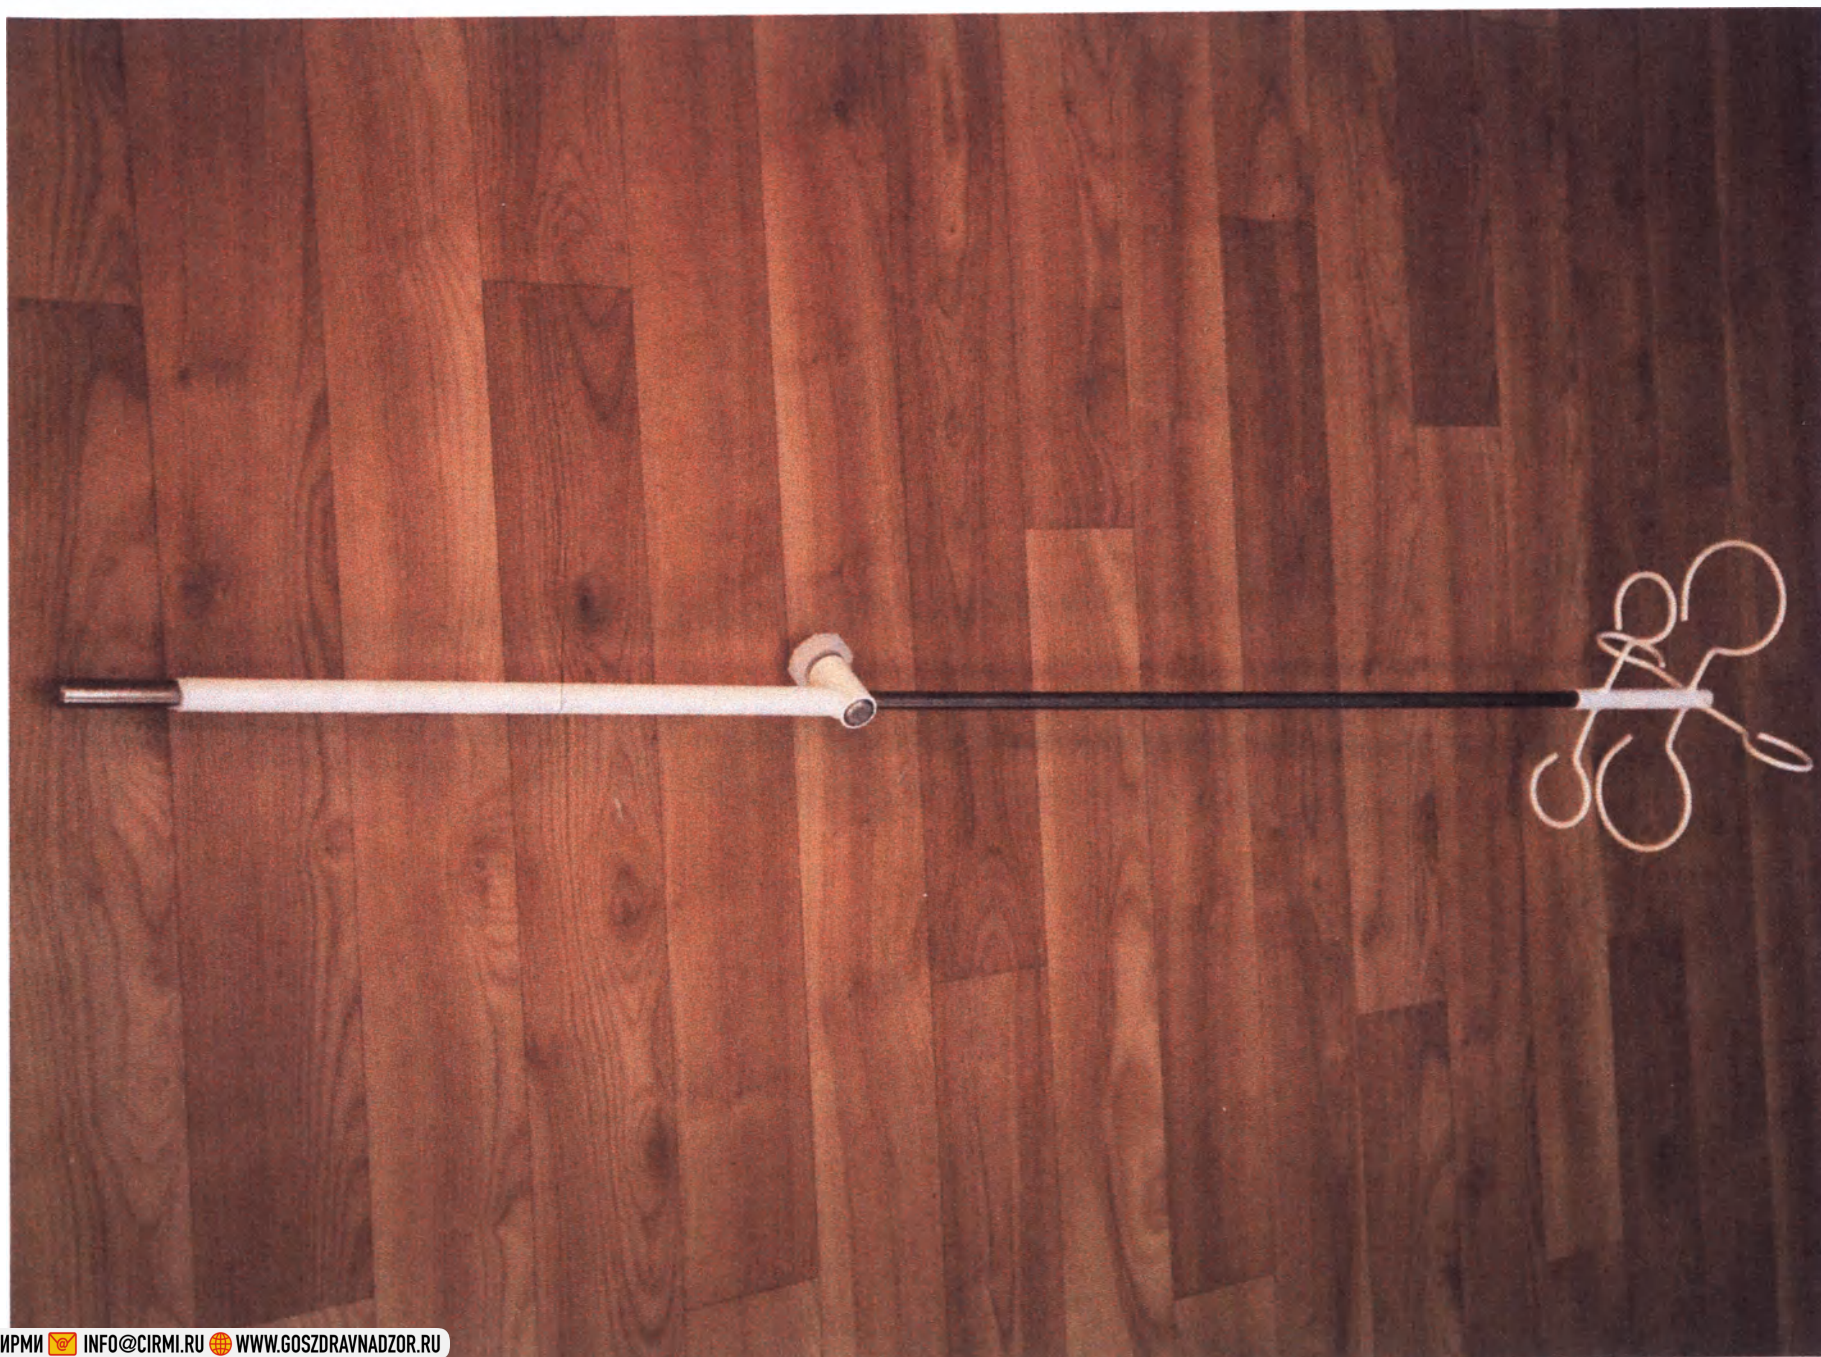


Фото 3.15. Матрац односекционный.

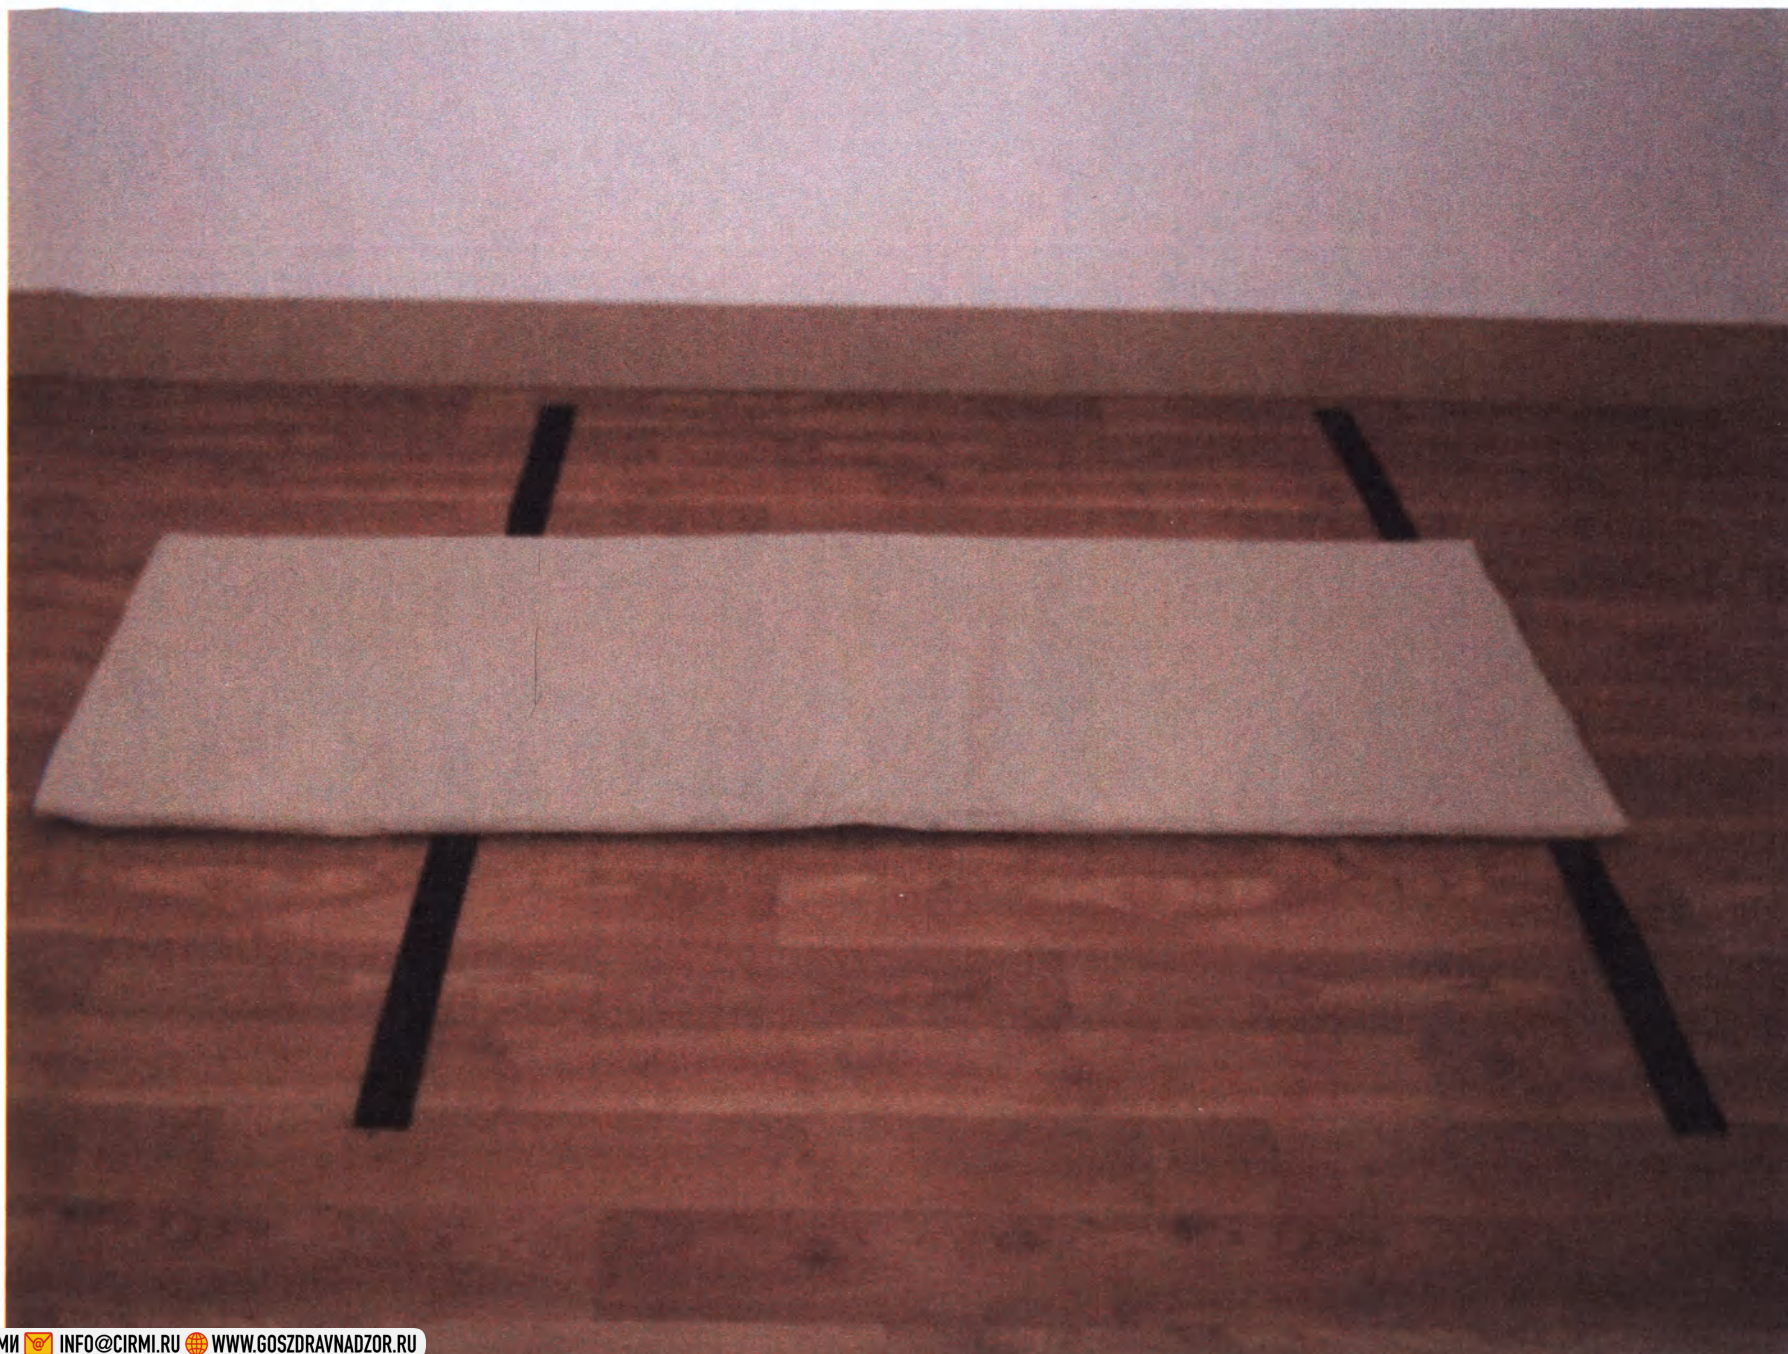


Фото 3.16. Матрац двухсекционный.

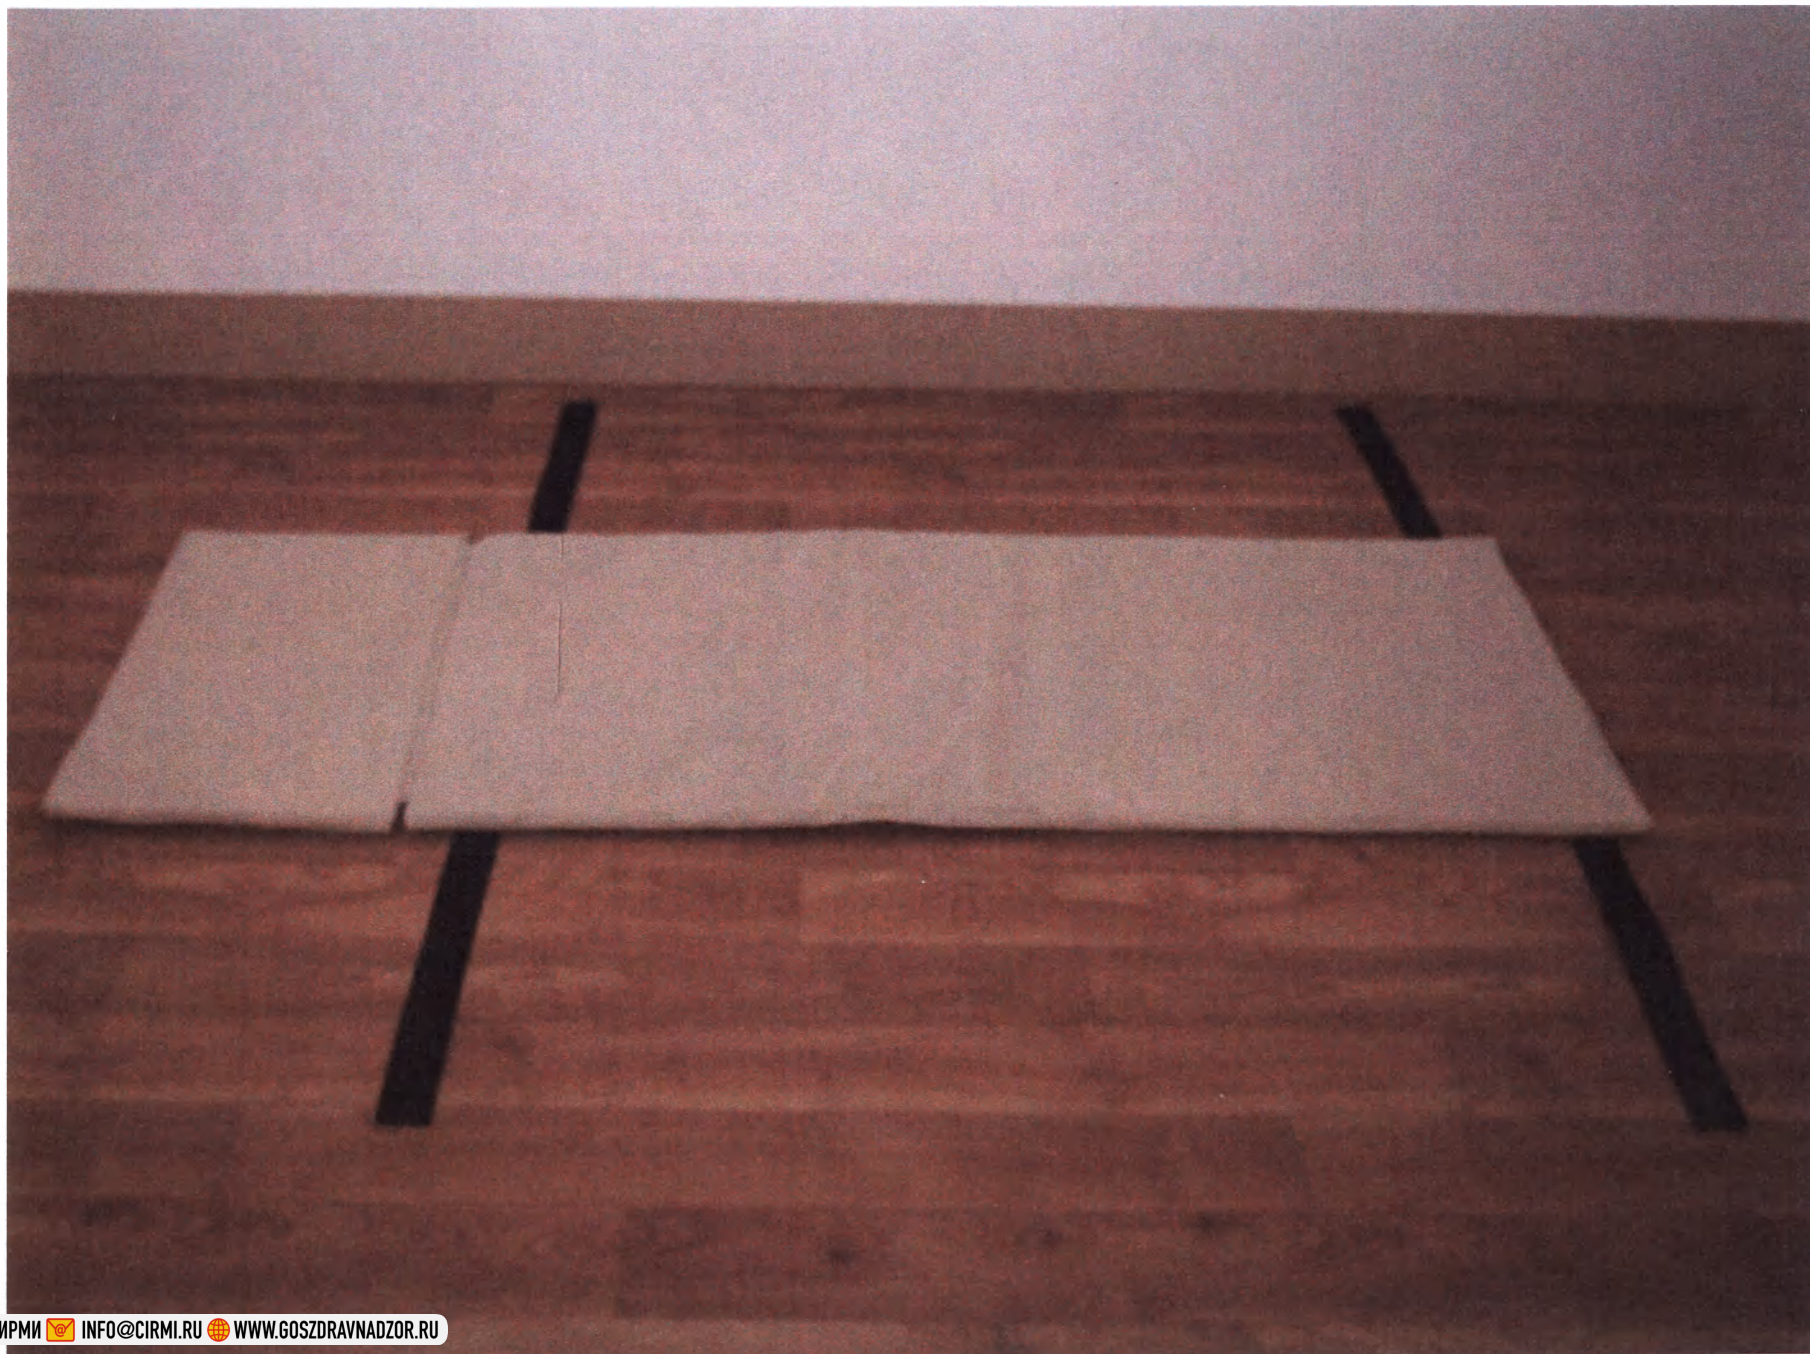


Фото 3.17. Приспособление для мытья пациентов.

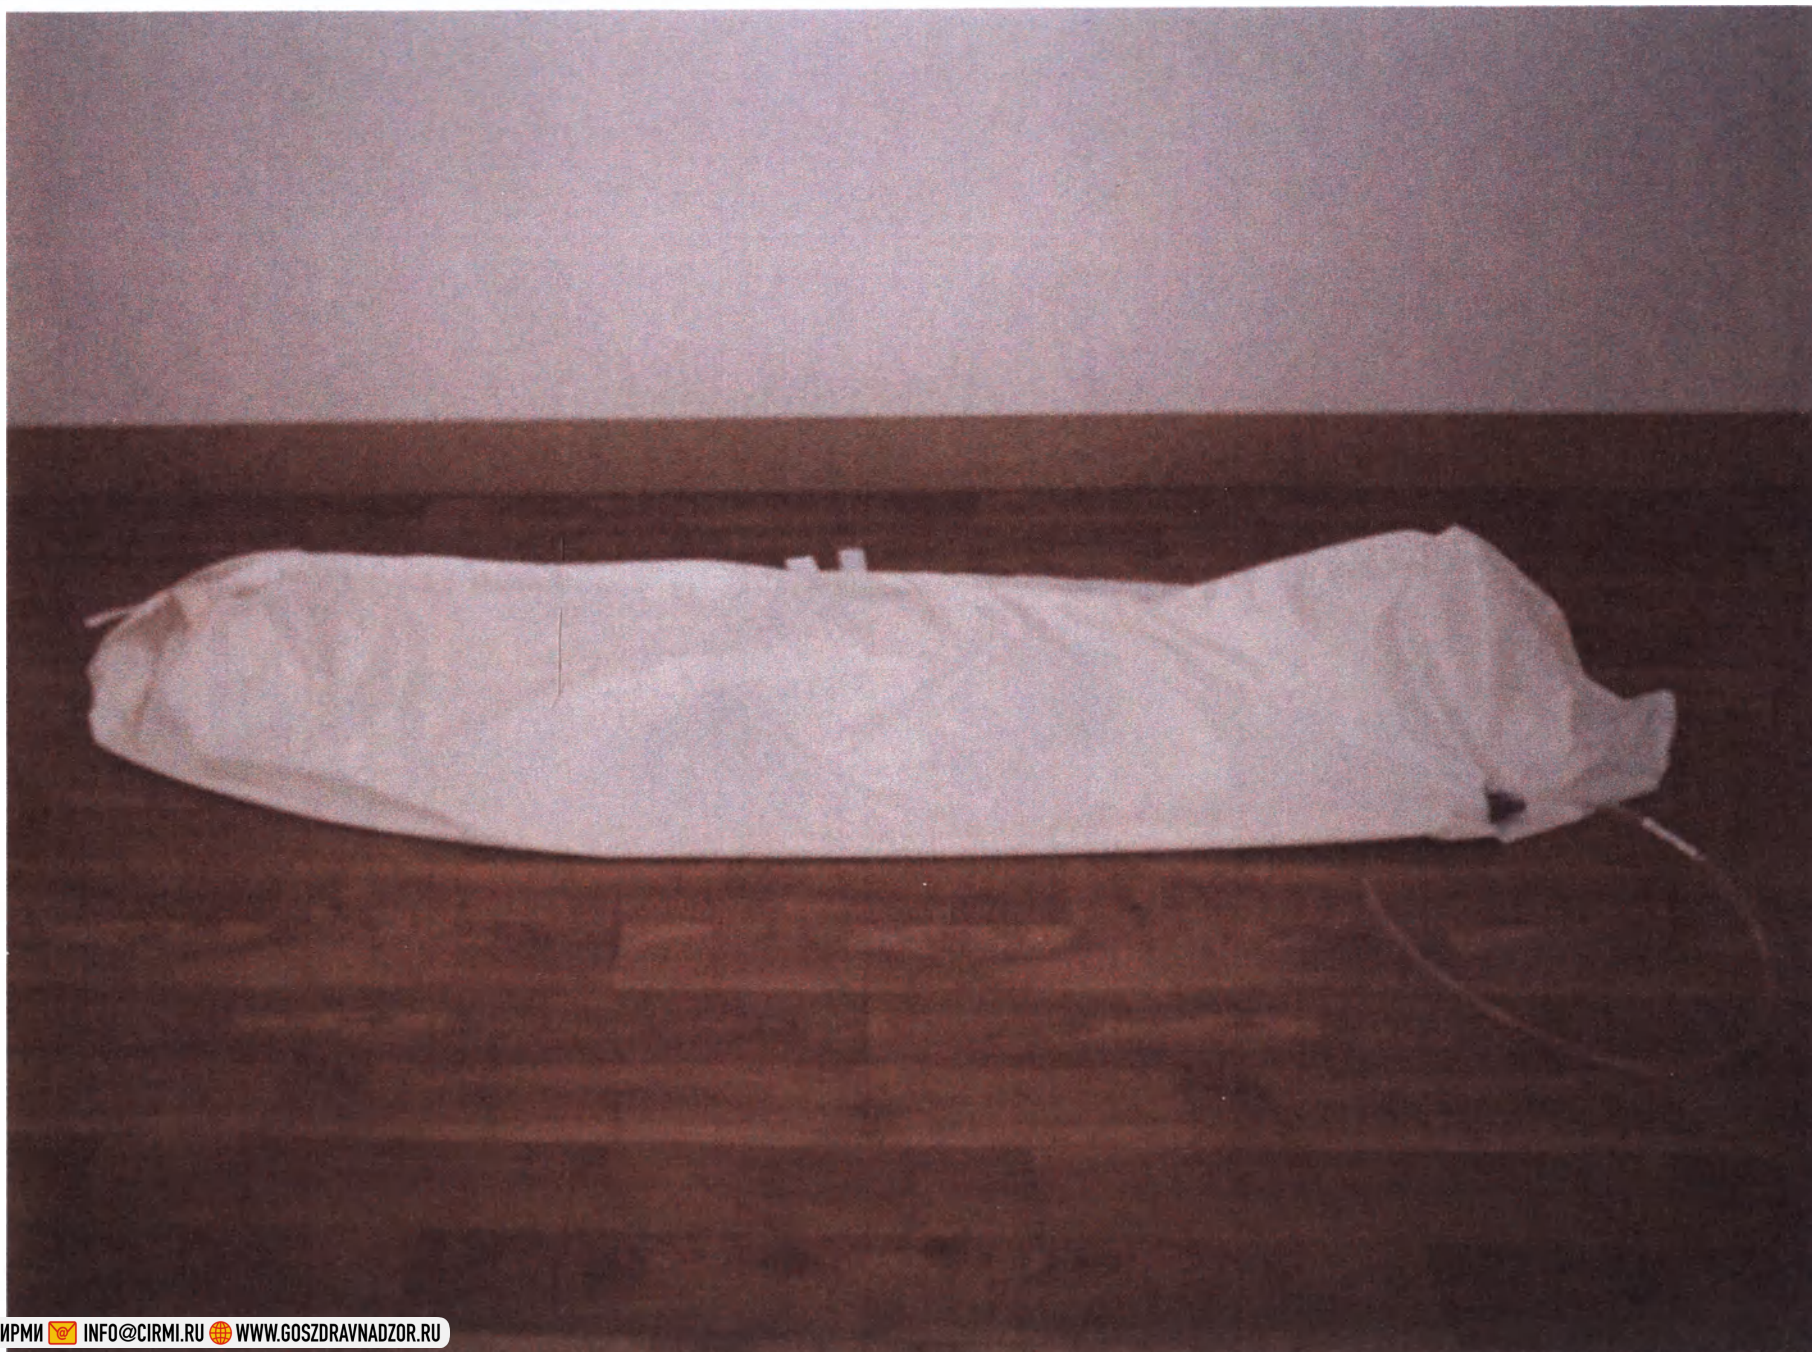


Фото 3.18. Рейка.



Фото 3.19. Колесная опора с центральным тормозом

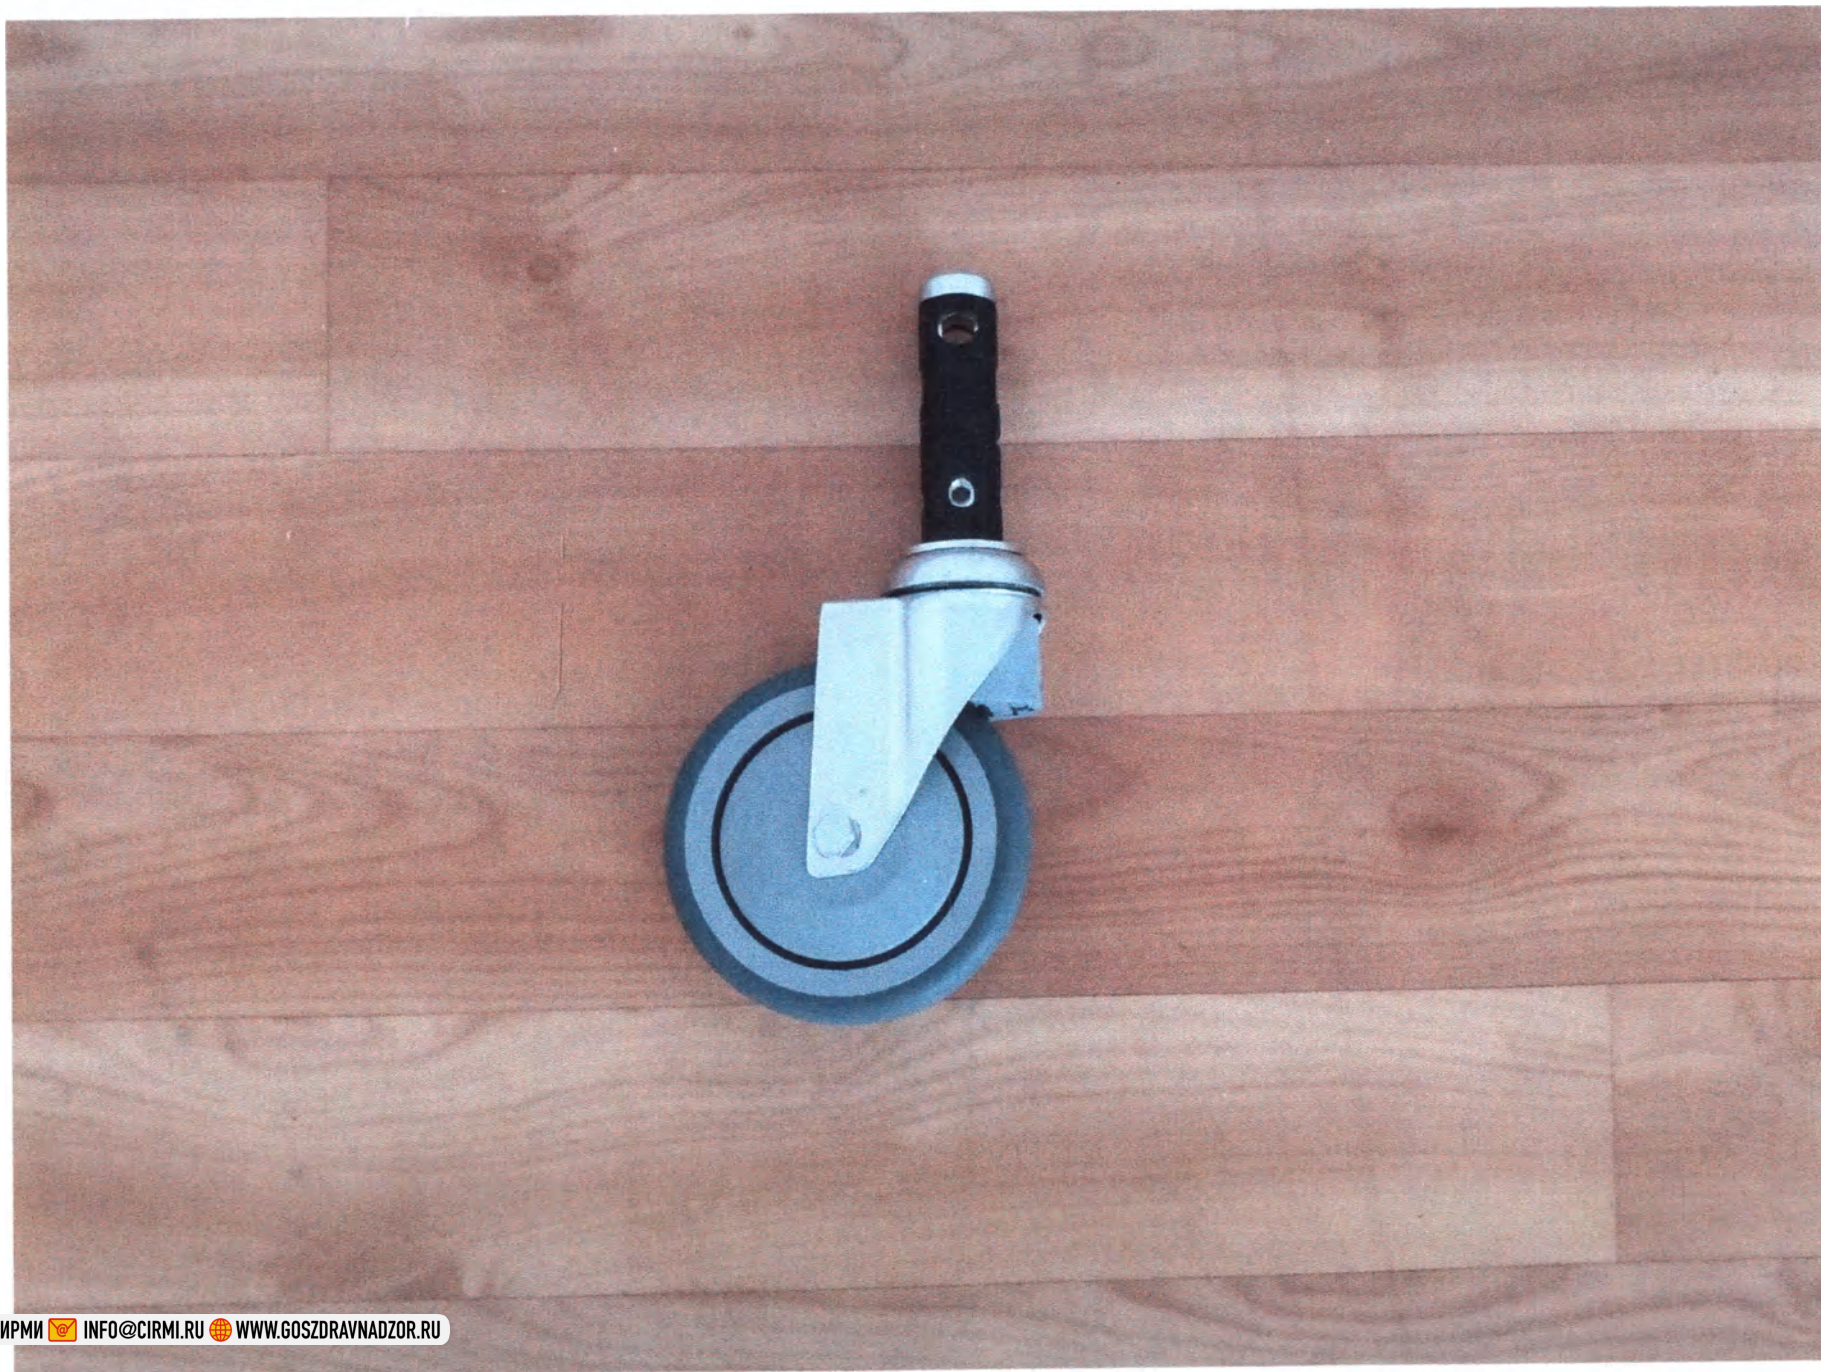


Фото 3.20. Колесная опора с центральным тормозом и педаль тормоза.



Фото 3.21. Колесная опора.

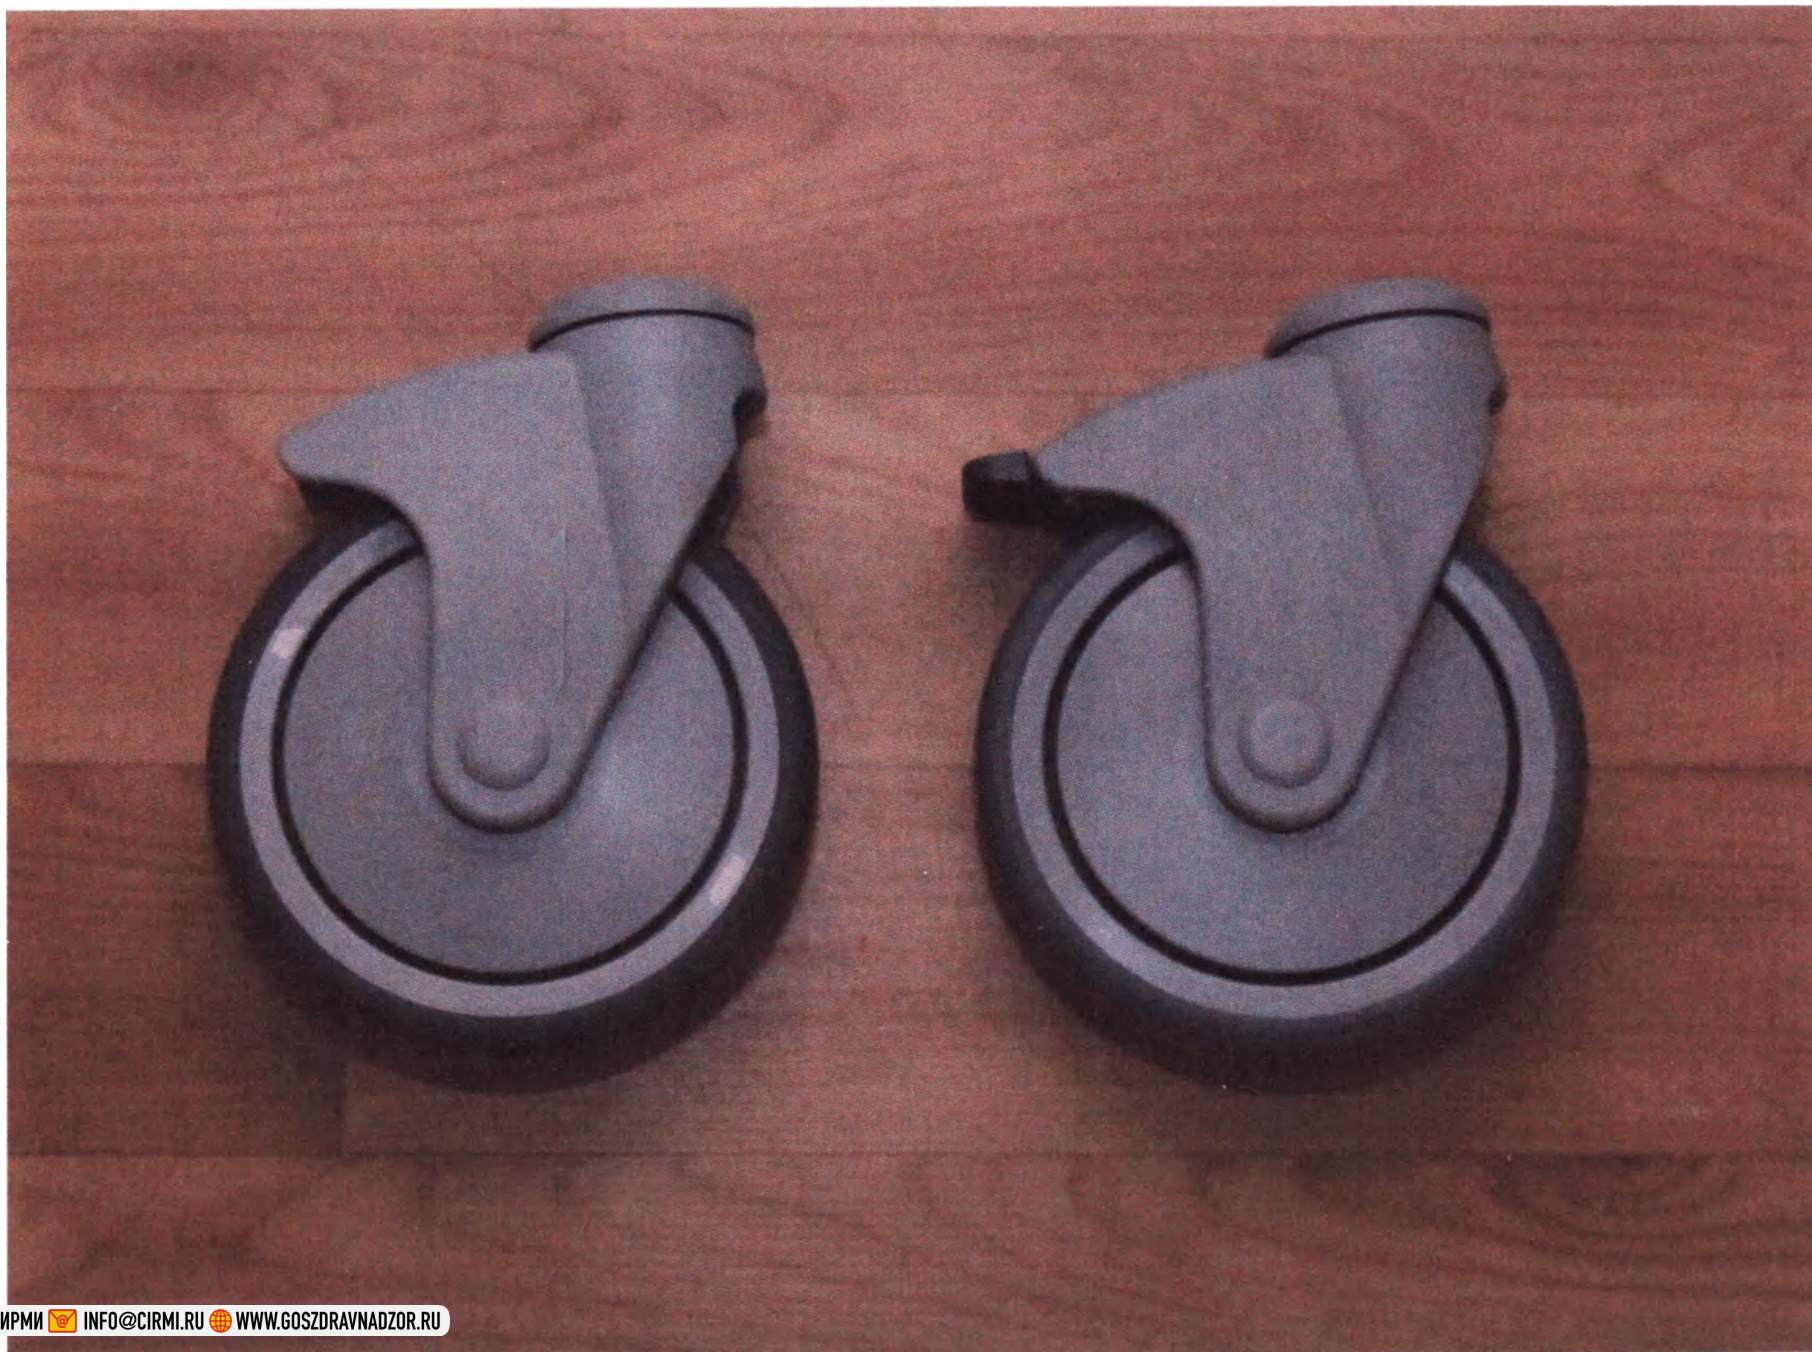


Фото 3.22. Гидропривод.



Фото 3.23. Держатель панели ложа.

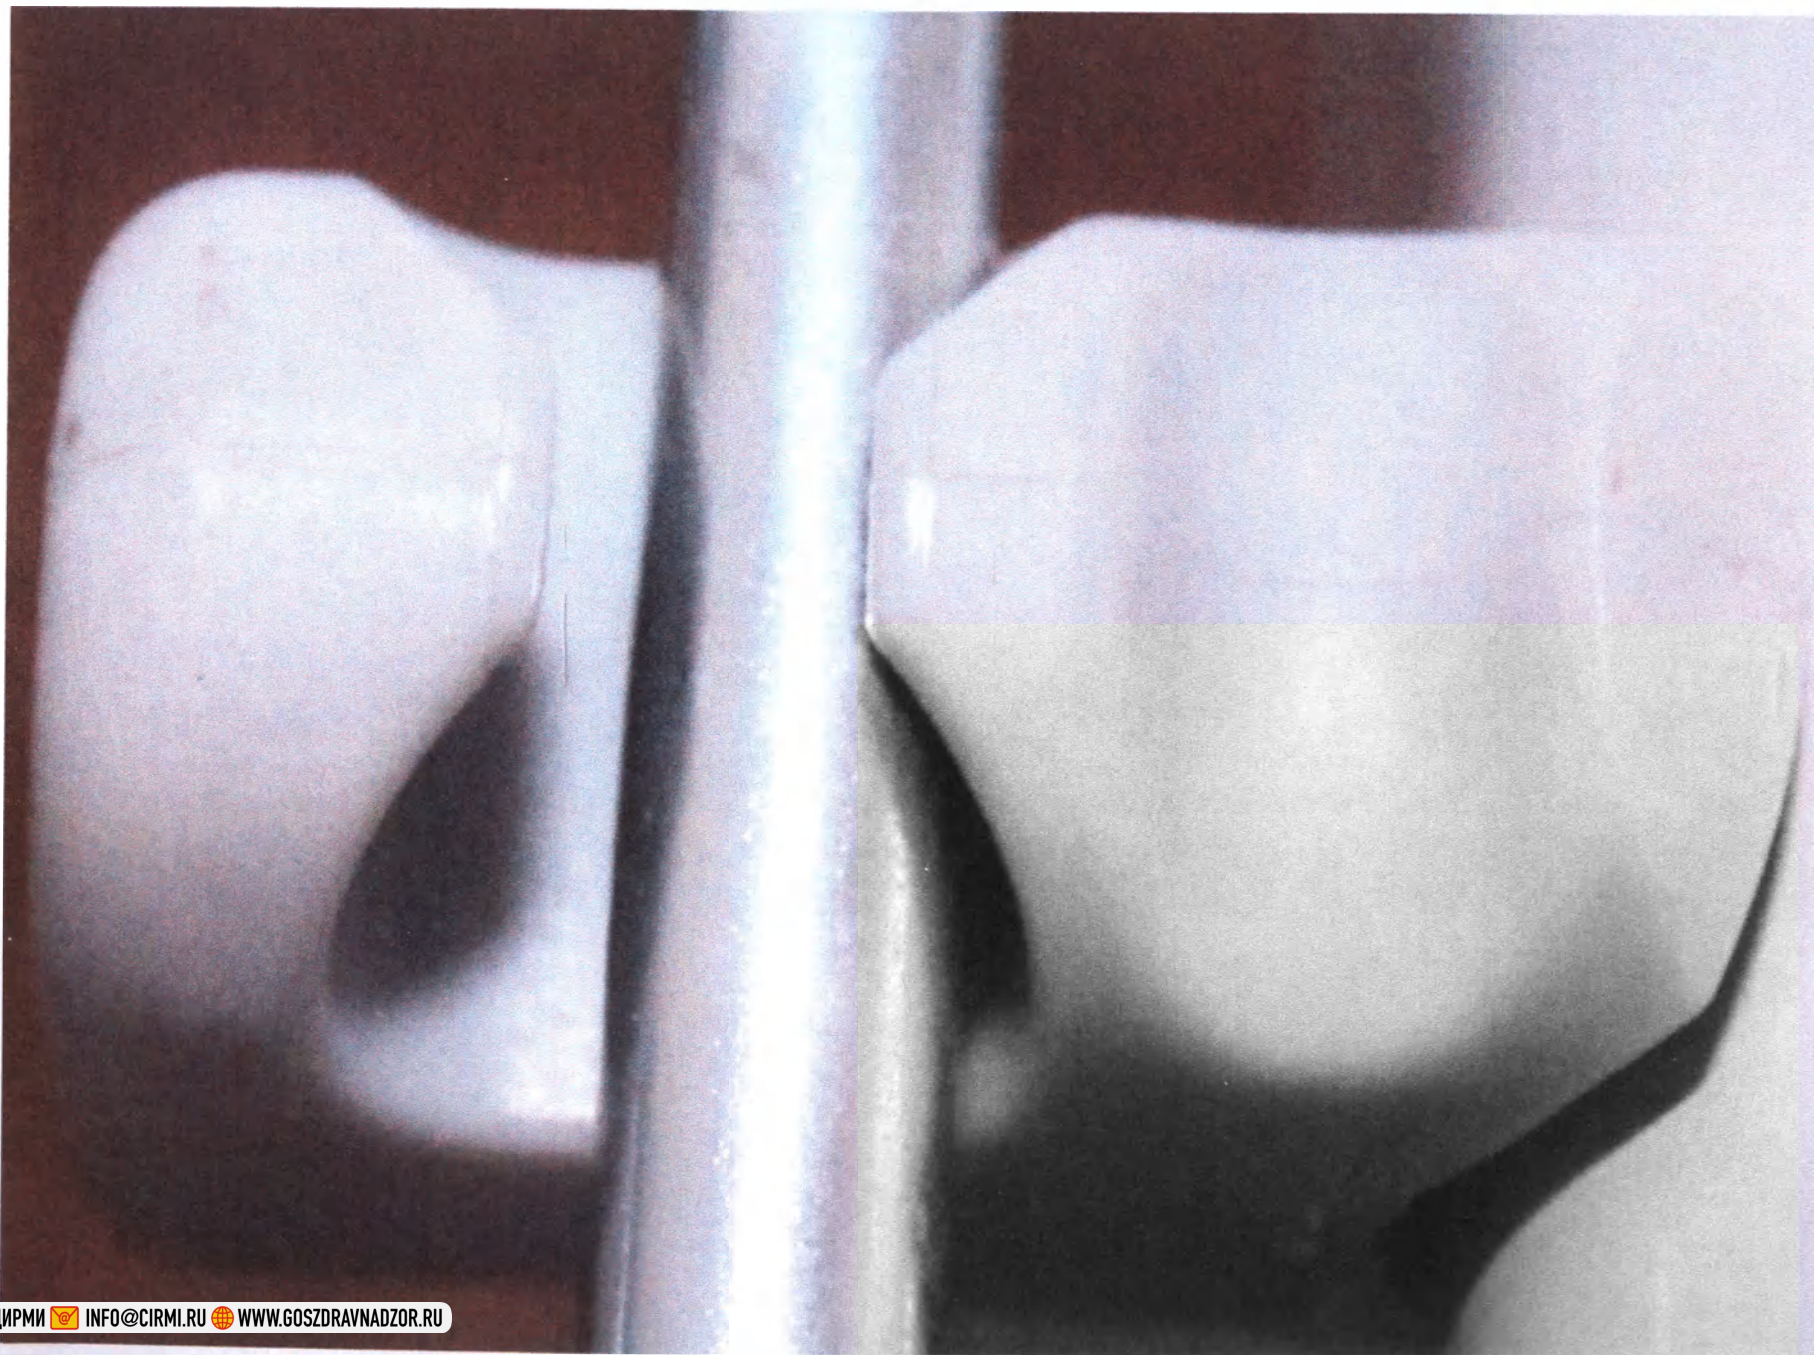


Фото 3.24. Газовая пружина.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 38 (

тридцать восемь) листов

Генеральный директор АО «ДЗМО»

А.В. Костров А.В. Костров

