

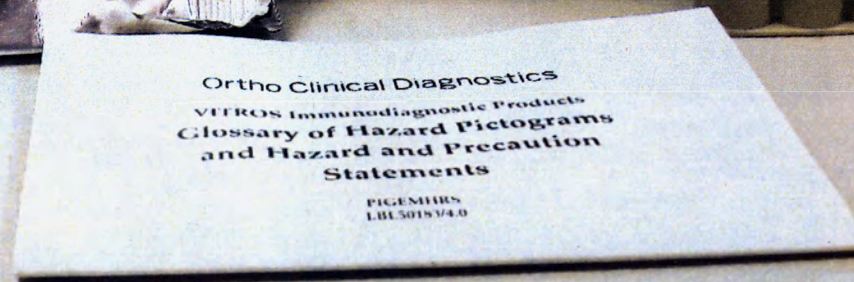


**Фотографическое изображение  
общего вида медицинского изделия:**

Реагент **Витрос** общий 25-ОН витамин D в кассете (25-ОН Vitamin D Total Reagent Pack) для количественного определения общего 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови на анализаторах серии VITROS

**необходимое для применения медицинского изделия по назначению**

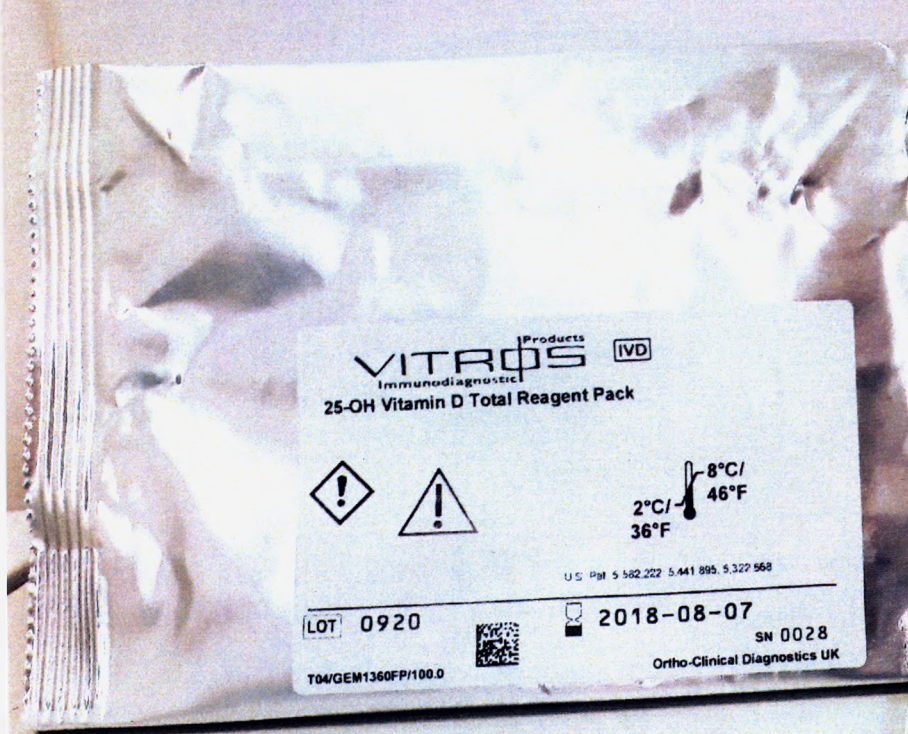

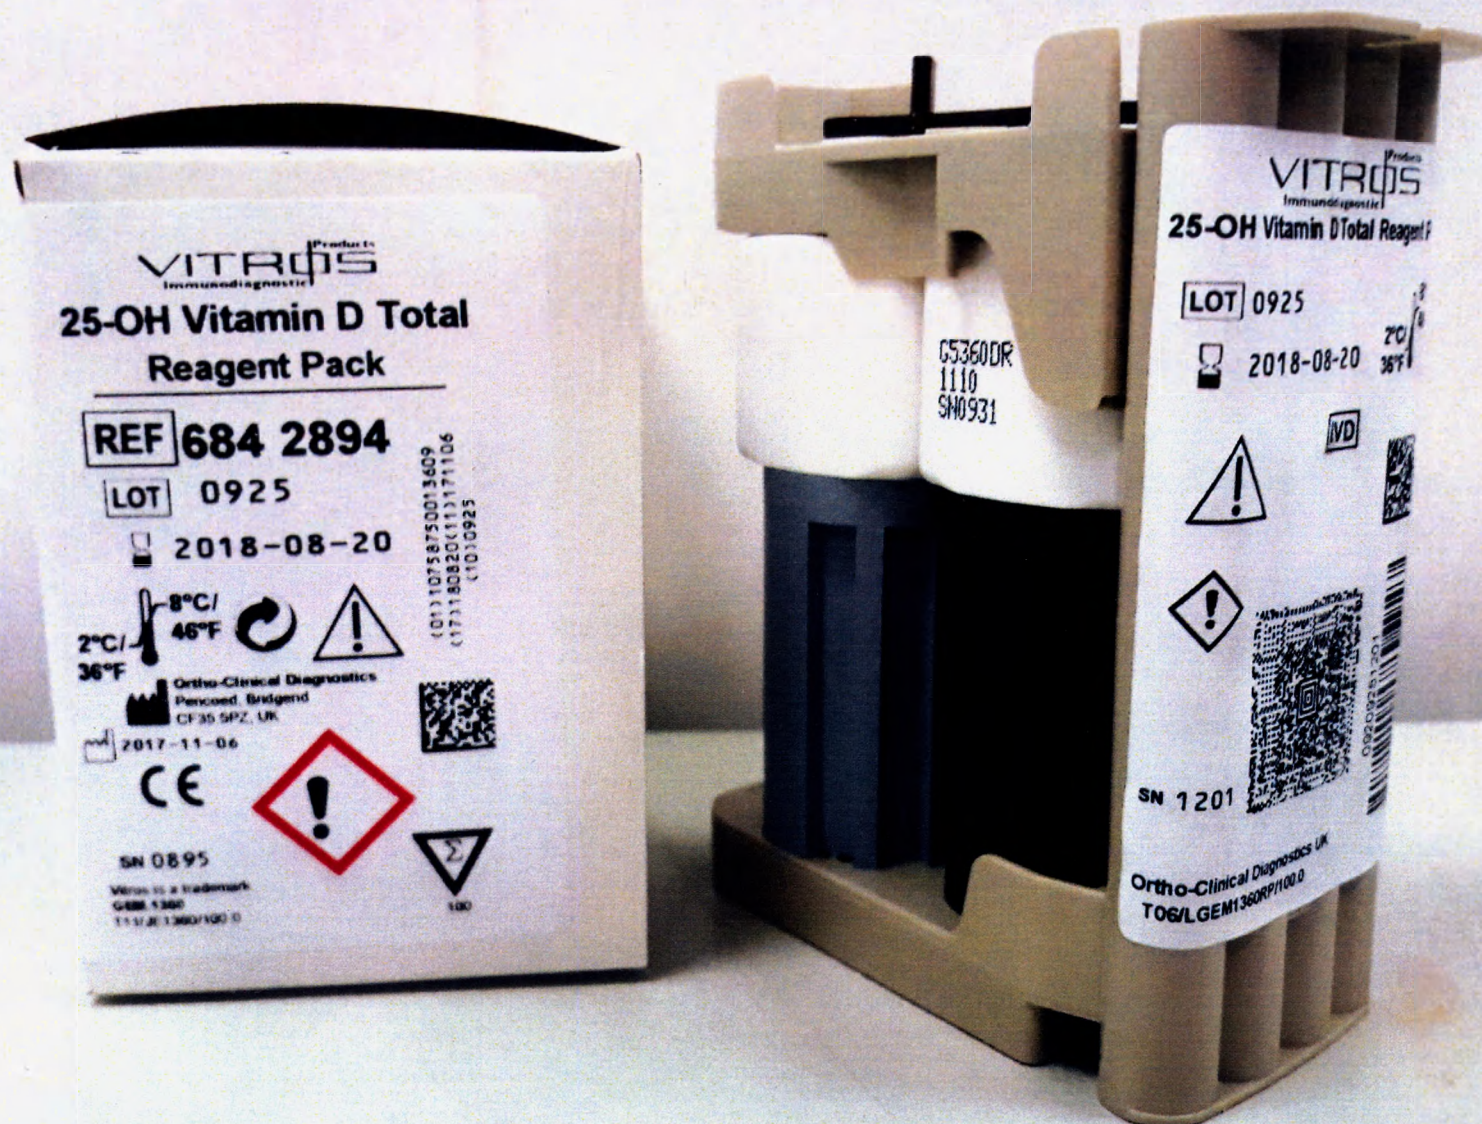


**Реагент Витрос общий 25-ОН витамин D в кассете (25-ОН Vitamin D Total Reagent Pack) для количественного определения общего 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови на анализаторах серии VITROS**

**Предназначен для количественного определения общего 25-ОН витамина D в сыворотке крови человека иммунохемилюминесцентным методом с помощью анализаторов серии VITROS (VITROS Eci/EciQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600)**

**Регистрационное удостоверение в РФ: \_\_\_\_\_**

**Уполномоченная организация на территории РФ:  
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия,  
143026, Московская область, Одинцовский район,  
дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, лит. А,А**



ВСЕГО 4 листов  
«14 11» 2019 г.  
Генеральный Директор  
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

\_\_\_\_\_  
Сергеенко В.К.

