ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Зажим Resolution 360 , варианты исполнения:

1. Зажим Resolution 360 , рабочая длина 155 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 1шт/уп, 10 шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп.;

2. Зажим Resolution 360 , рабочая длина 235 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 1шт/уп, 10 шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп.;

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

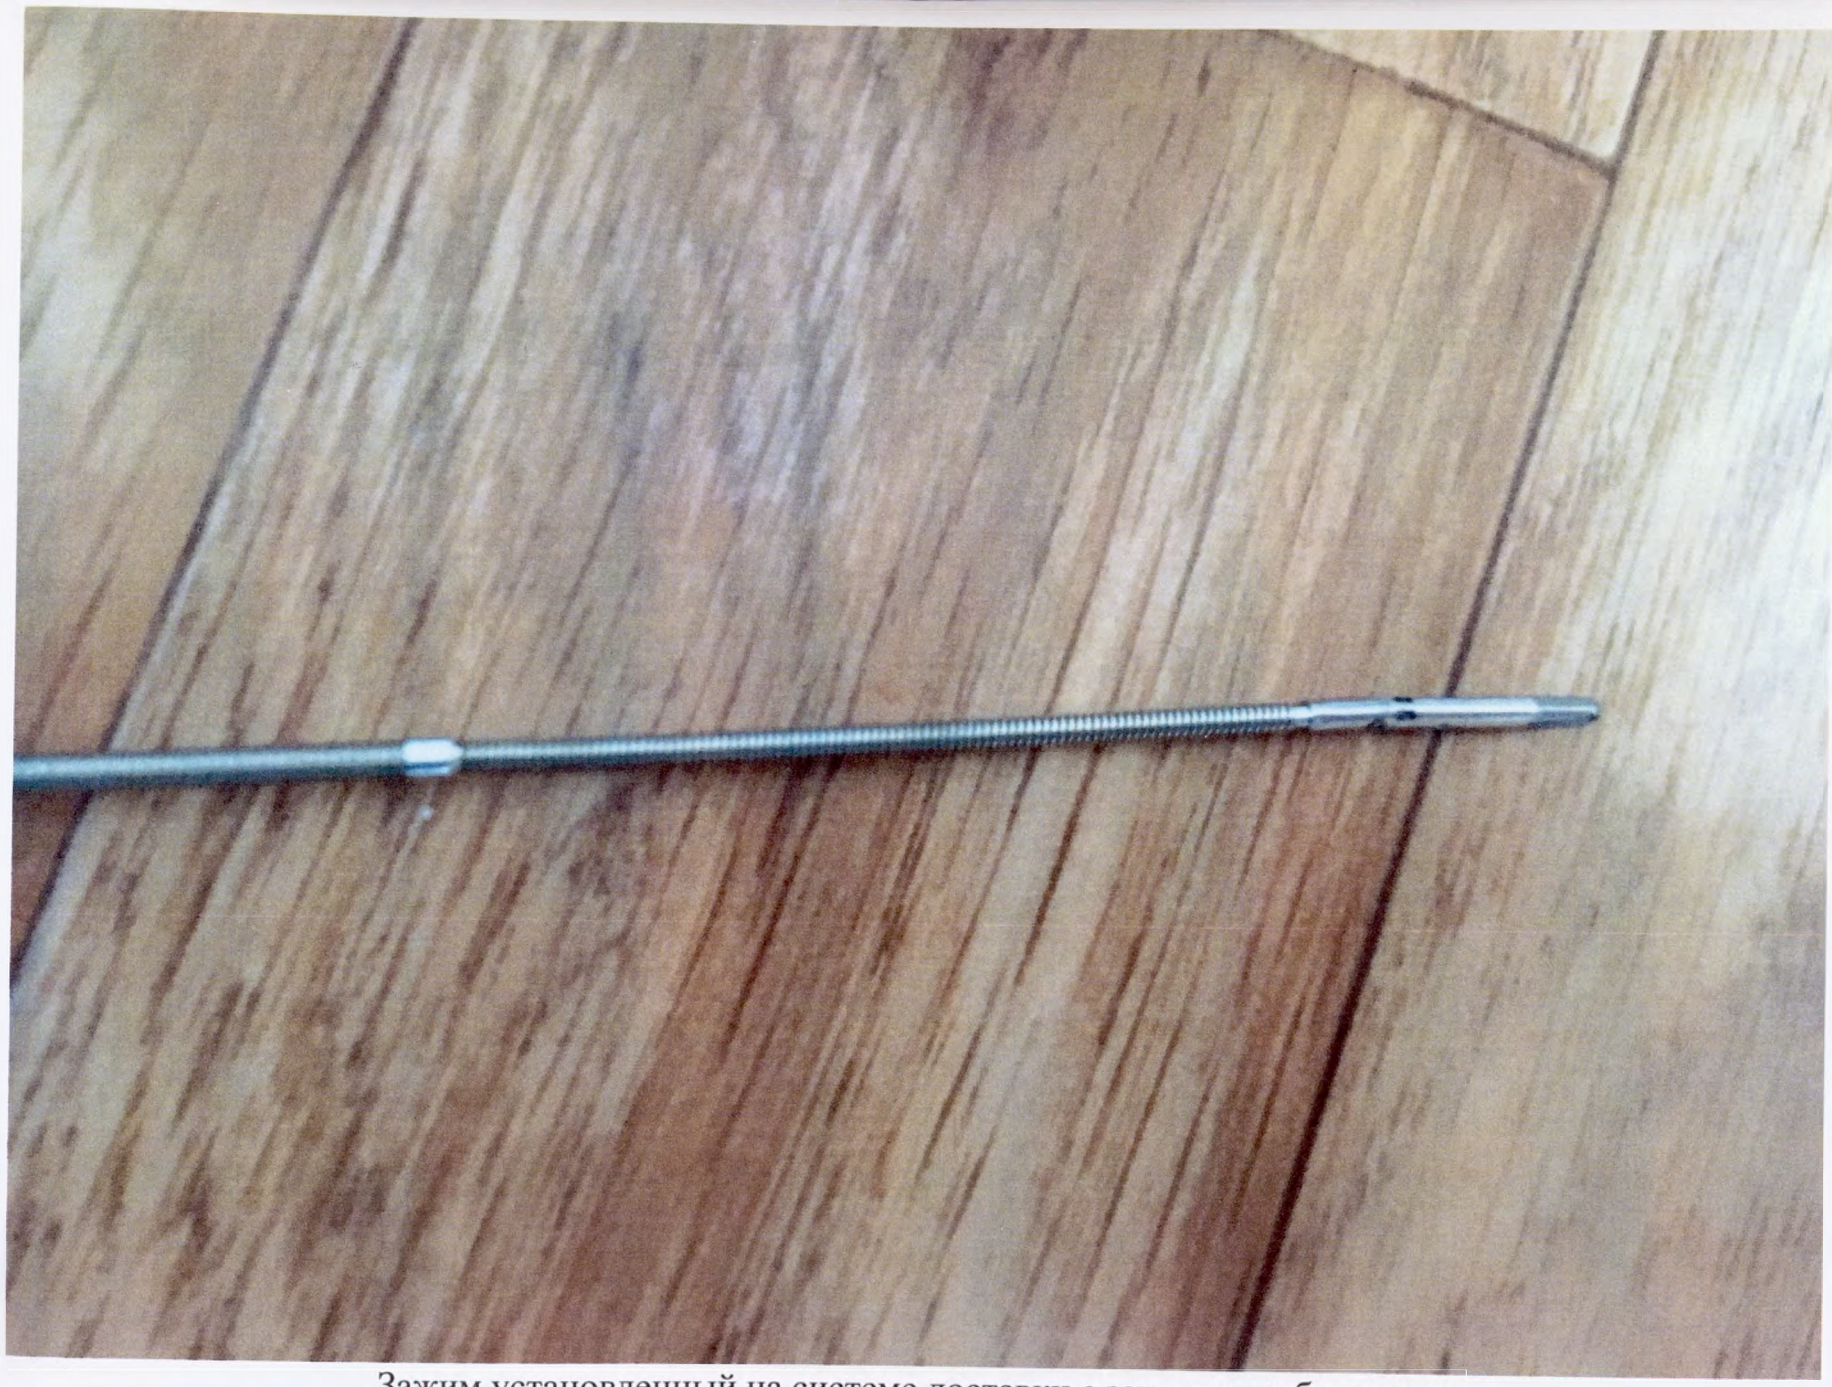

Зажим установленный на системе доставки с закрытыми браншами

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зажим установленный на системе доставки с раскрытыми браншами

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

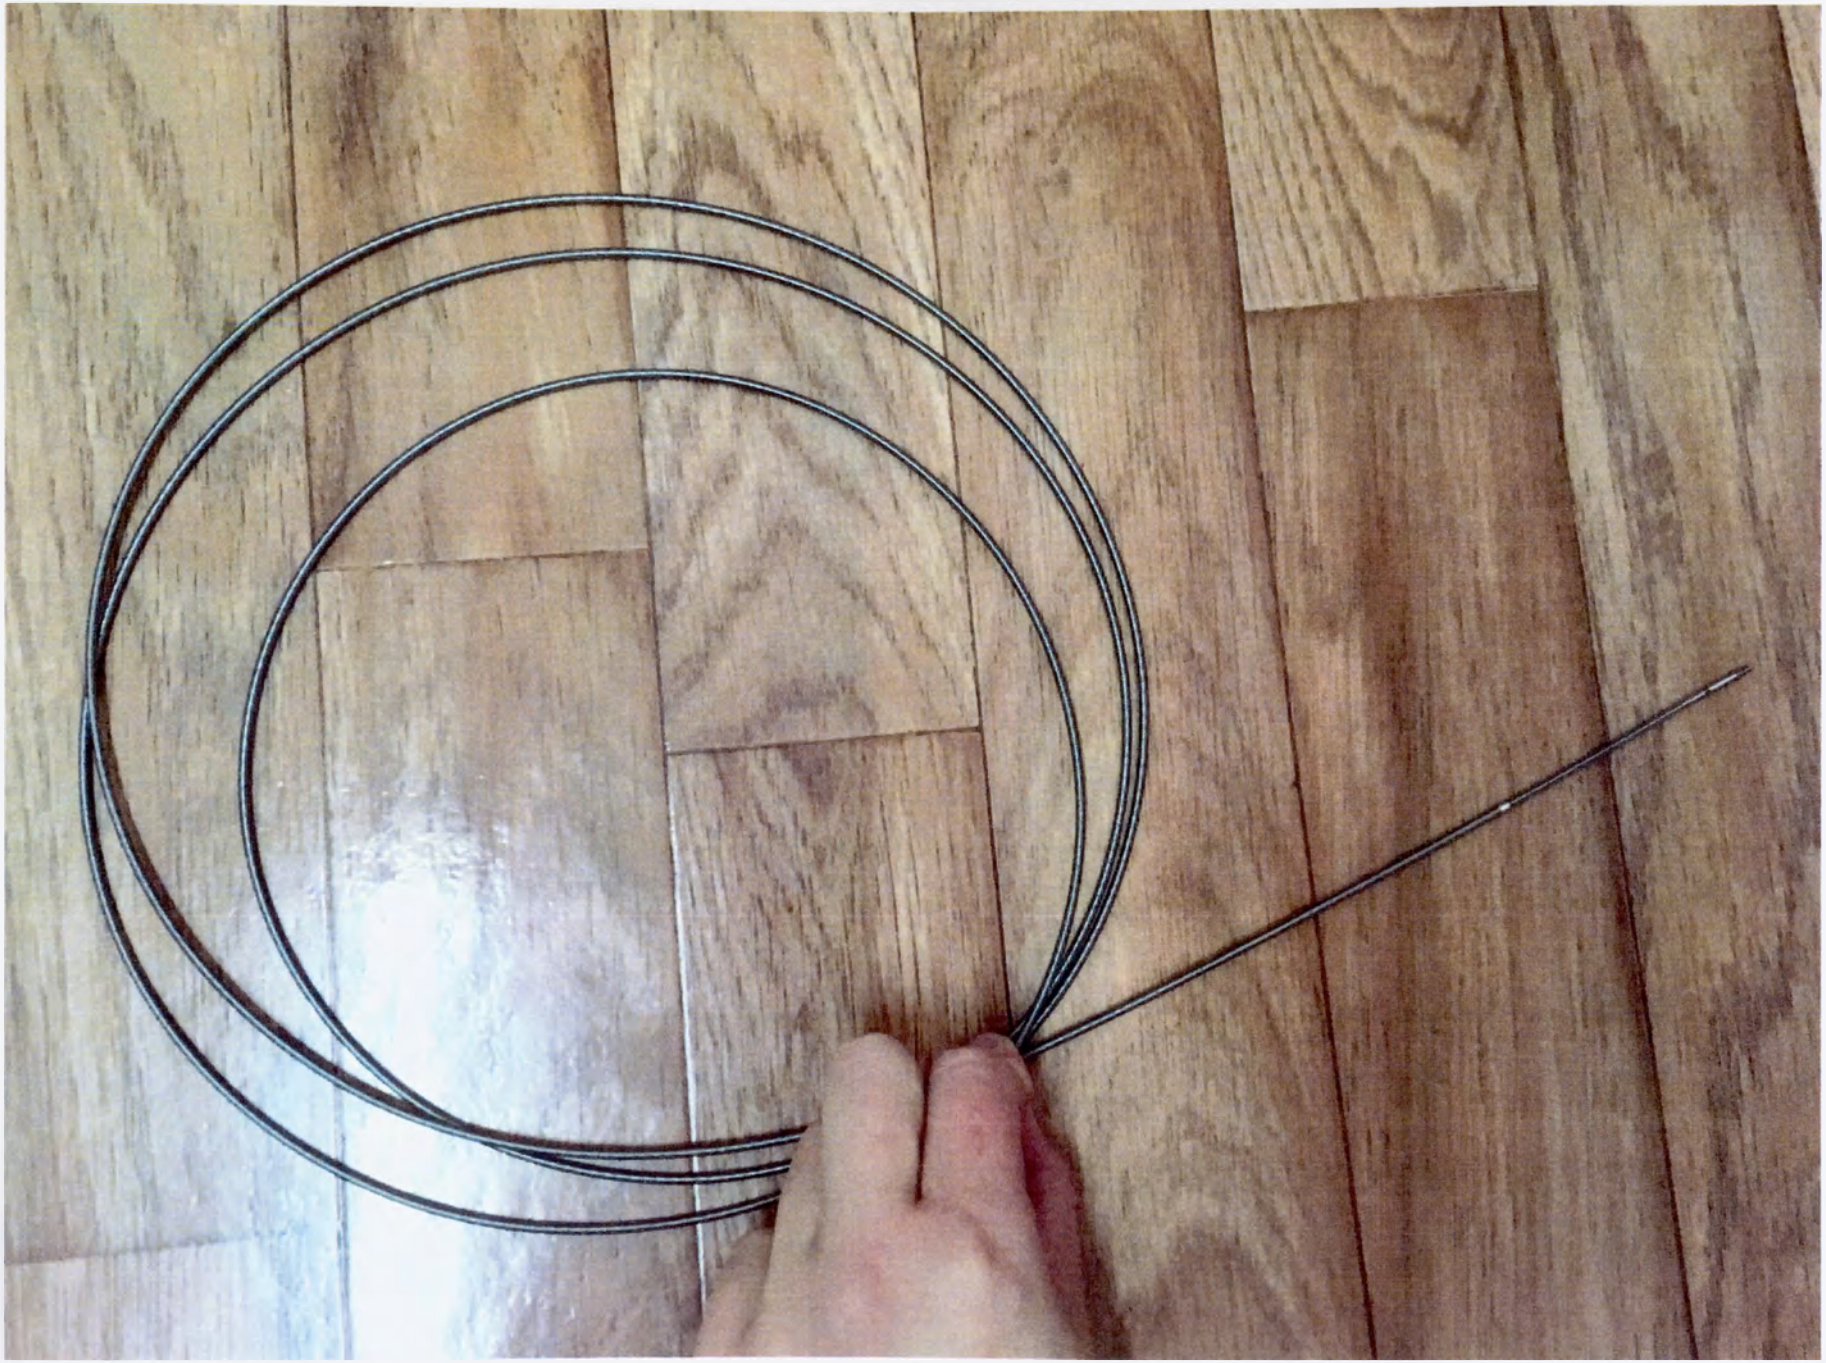

Система доставки (катетер)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

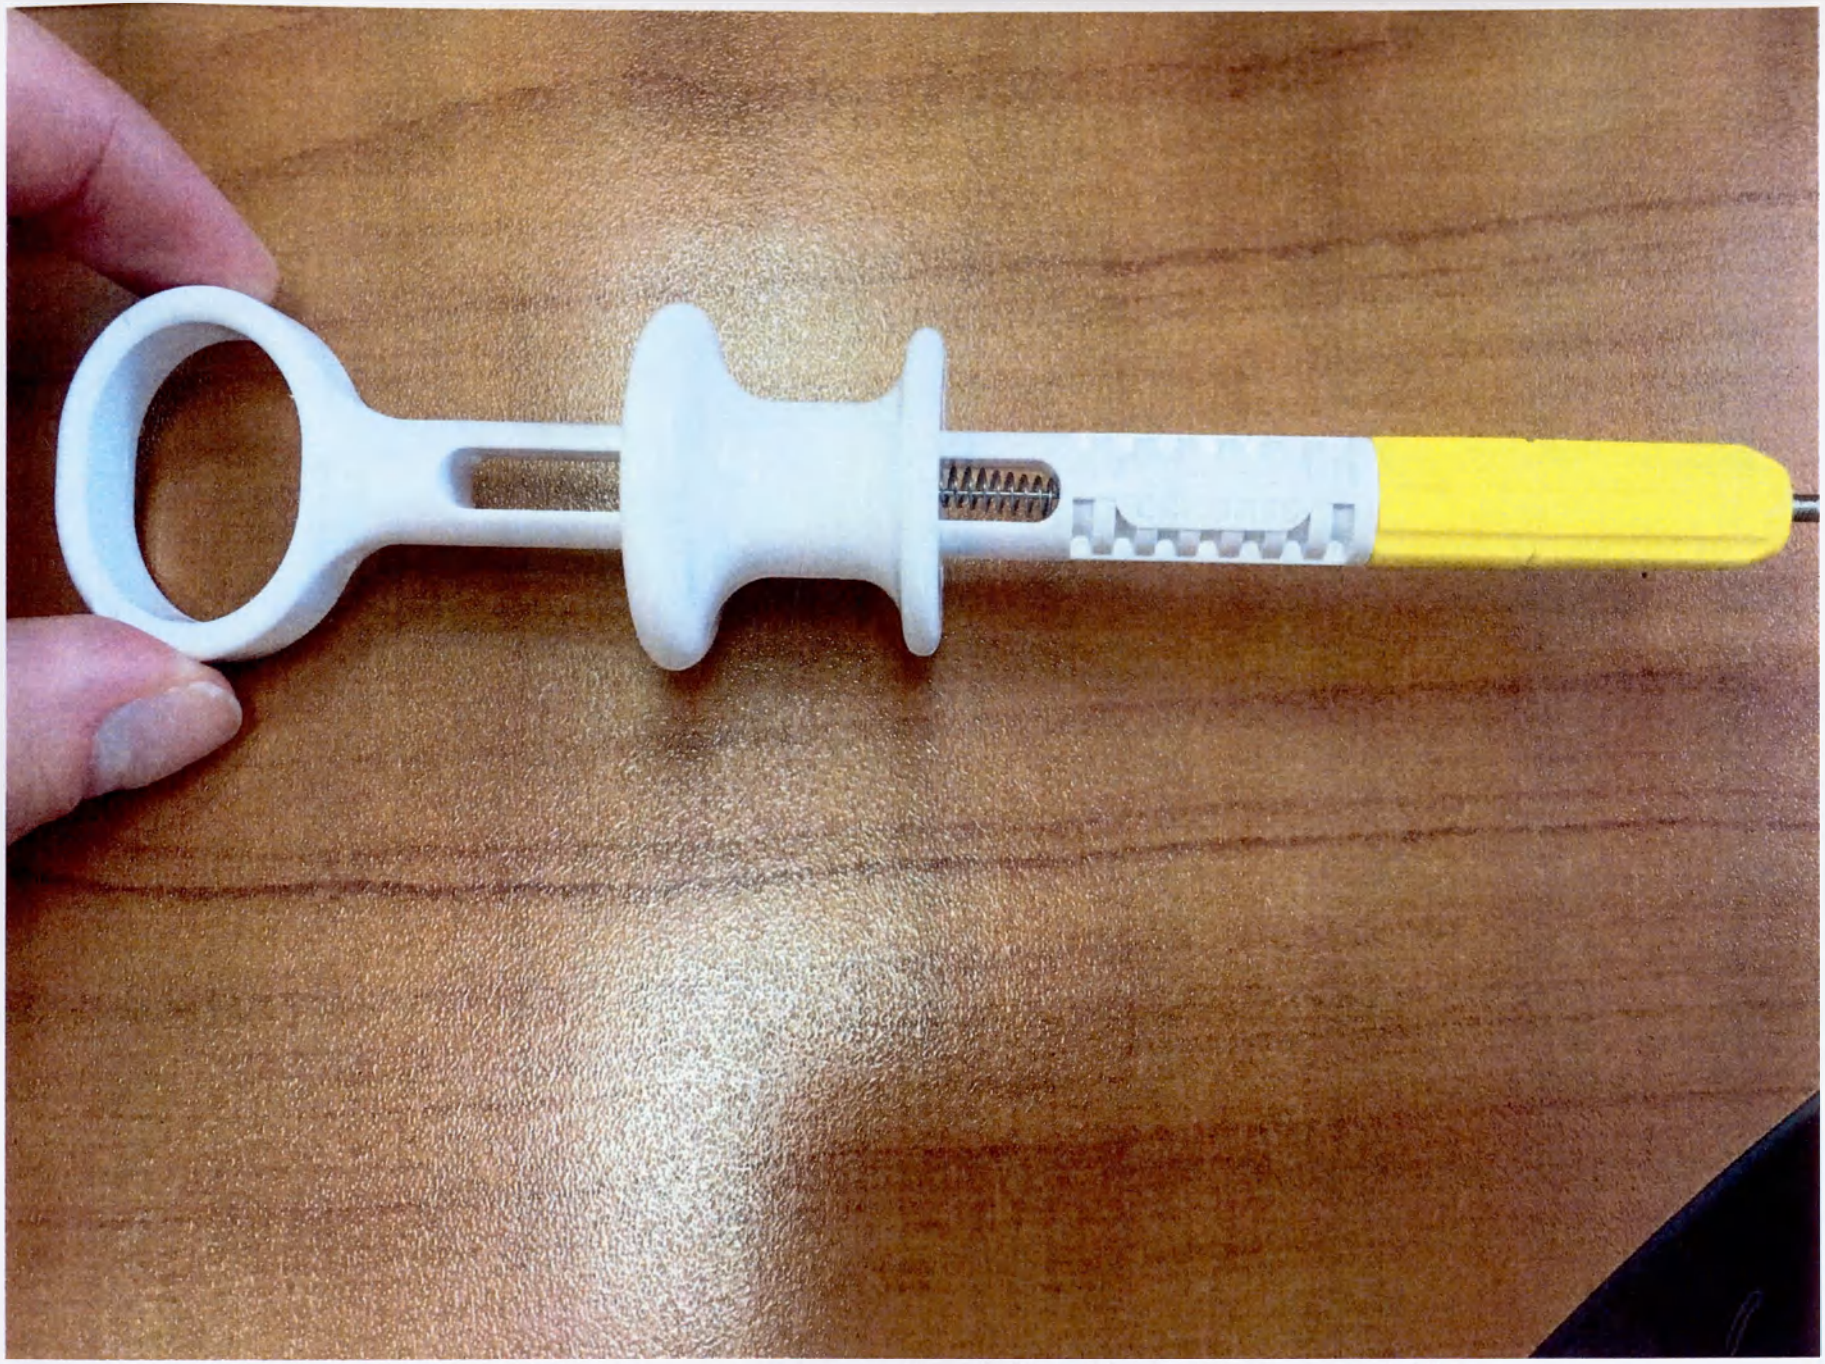

Рукоятка, система доставки зажима Resolution 360 рабочая длина 155 см,
минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Запечатываемый пакет.(сторона 1)Зажим Resolution 360 рабочая длина 155 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Запечатываемый пакет.(сторона 2) Зажим Resolution 360 рабочая длина 155 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Коробка зажима Resolution 360 рабочая длина 155 см,
минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 10 шт/уп. (сторона 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

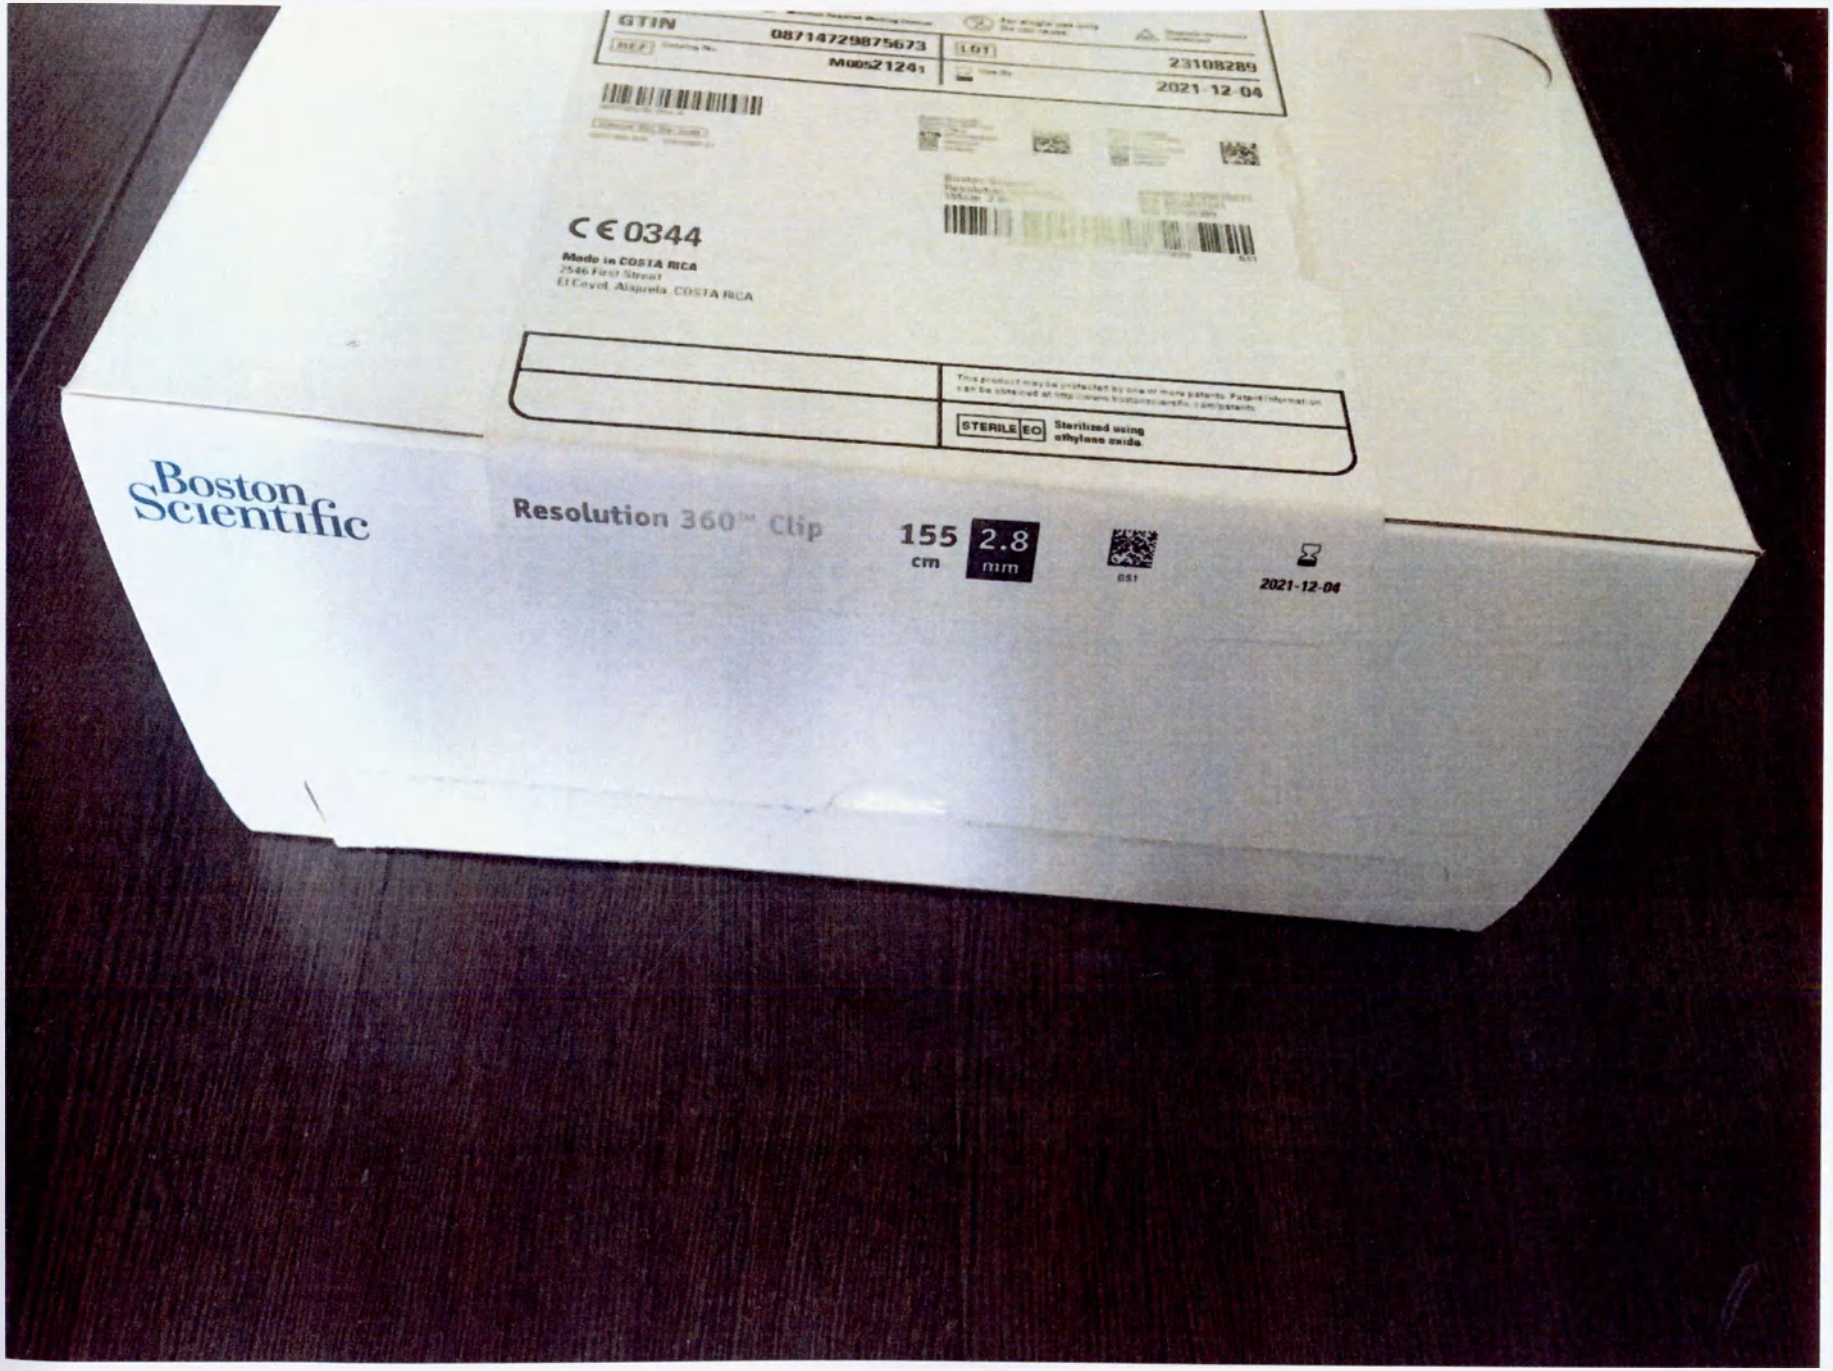

Коробка зажима Resolution 360 рабочая длина 155 см,
минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 10 шт/уп.(сторона 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Коробка зажима Resolution 360 рабочая длина 155 см,
минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 10 шт/уп.(сторона 3)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

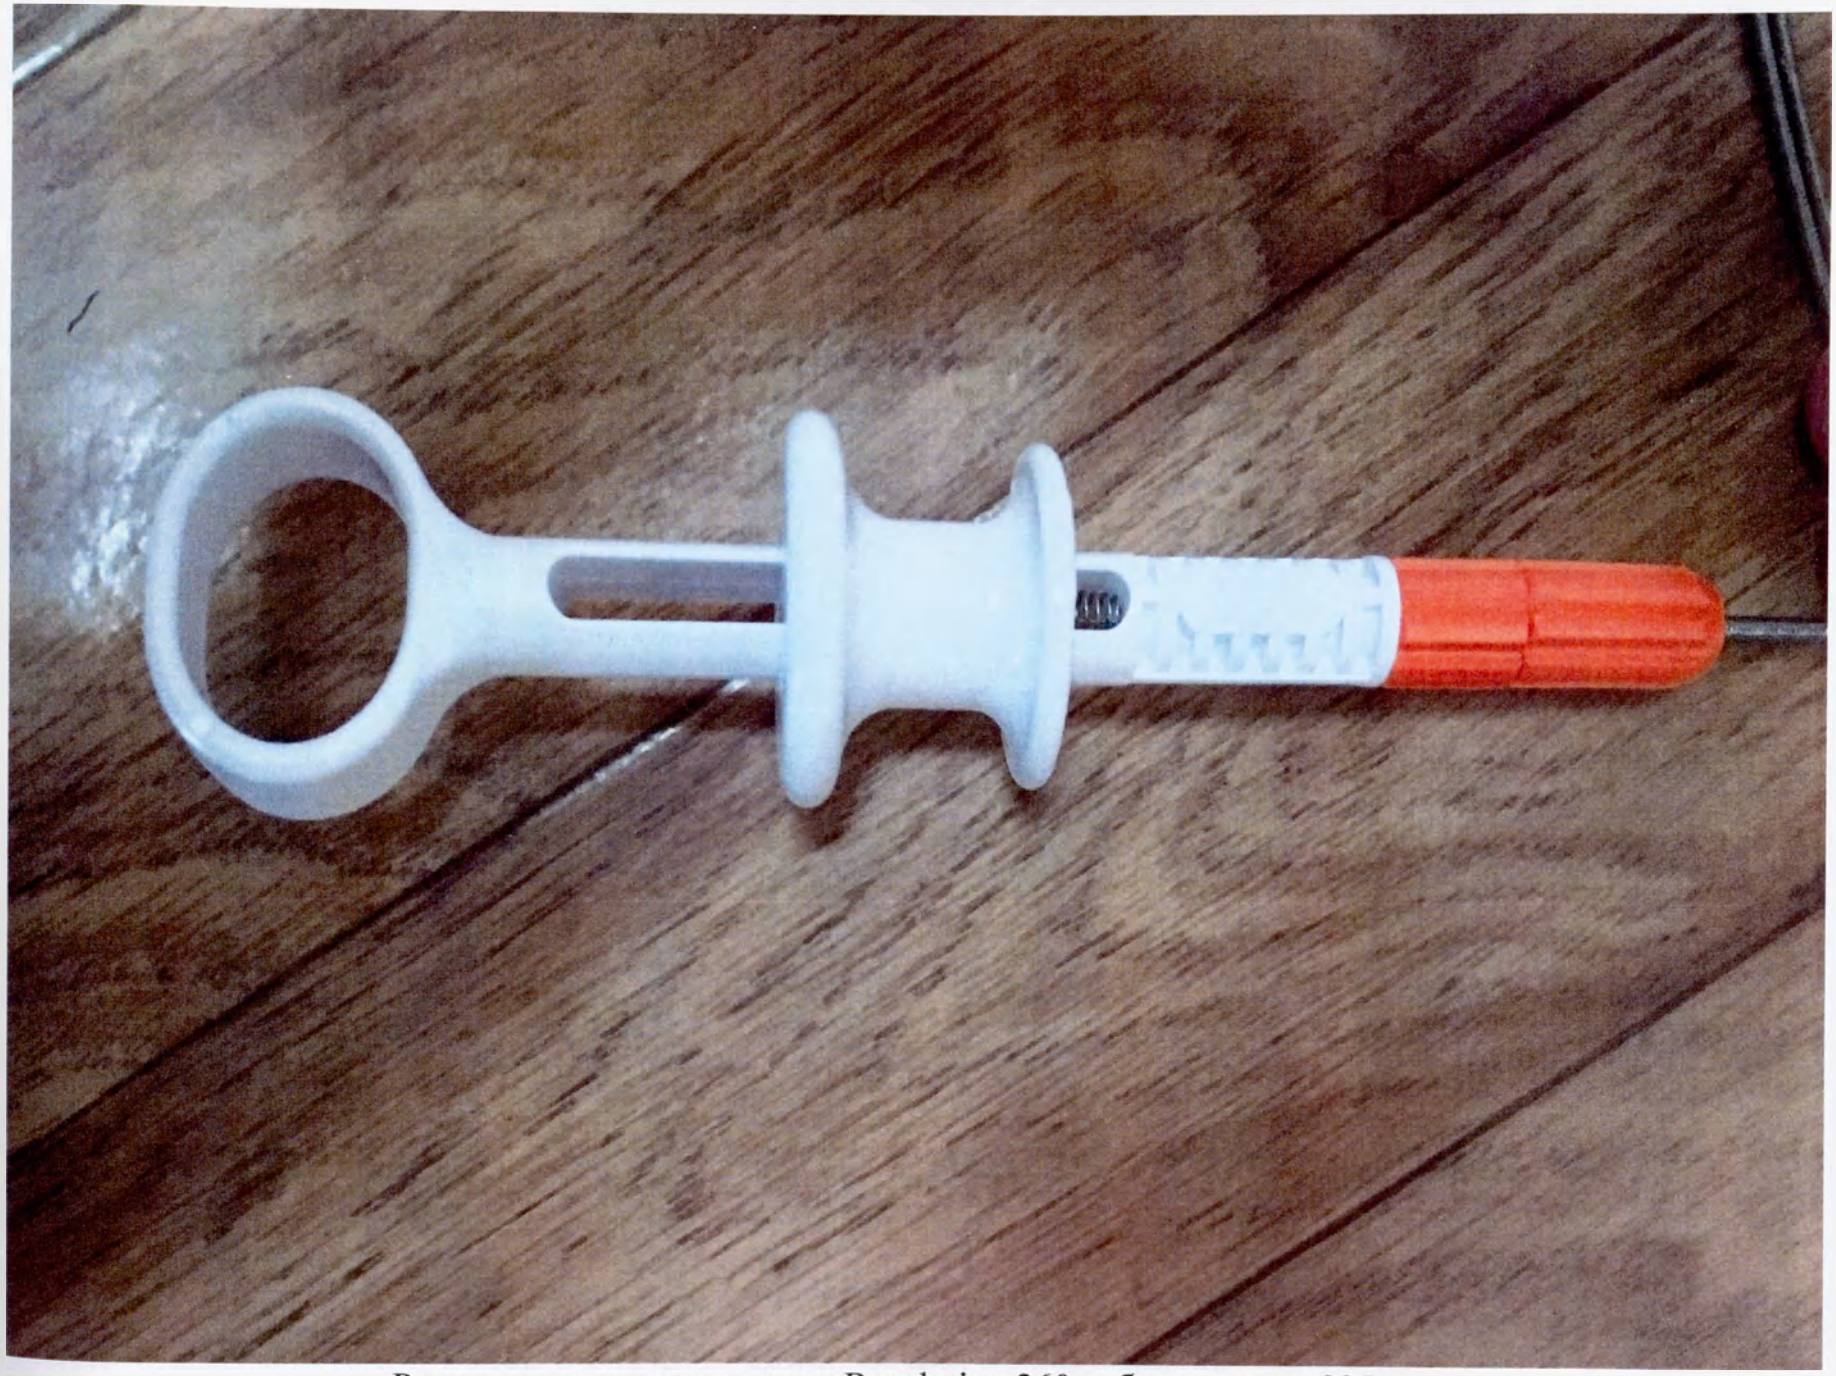

Рукоятка, система доставки Resolution 360 рабочая длина 235 см,
минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Запечатываемый пакет(сторона 1).Зажим Resolution 360 рабочая длина 235 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Запечатываемый пакет(сторона 2).Зажим Resolution 360 рабочая длина 235 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

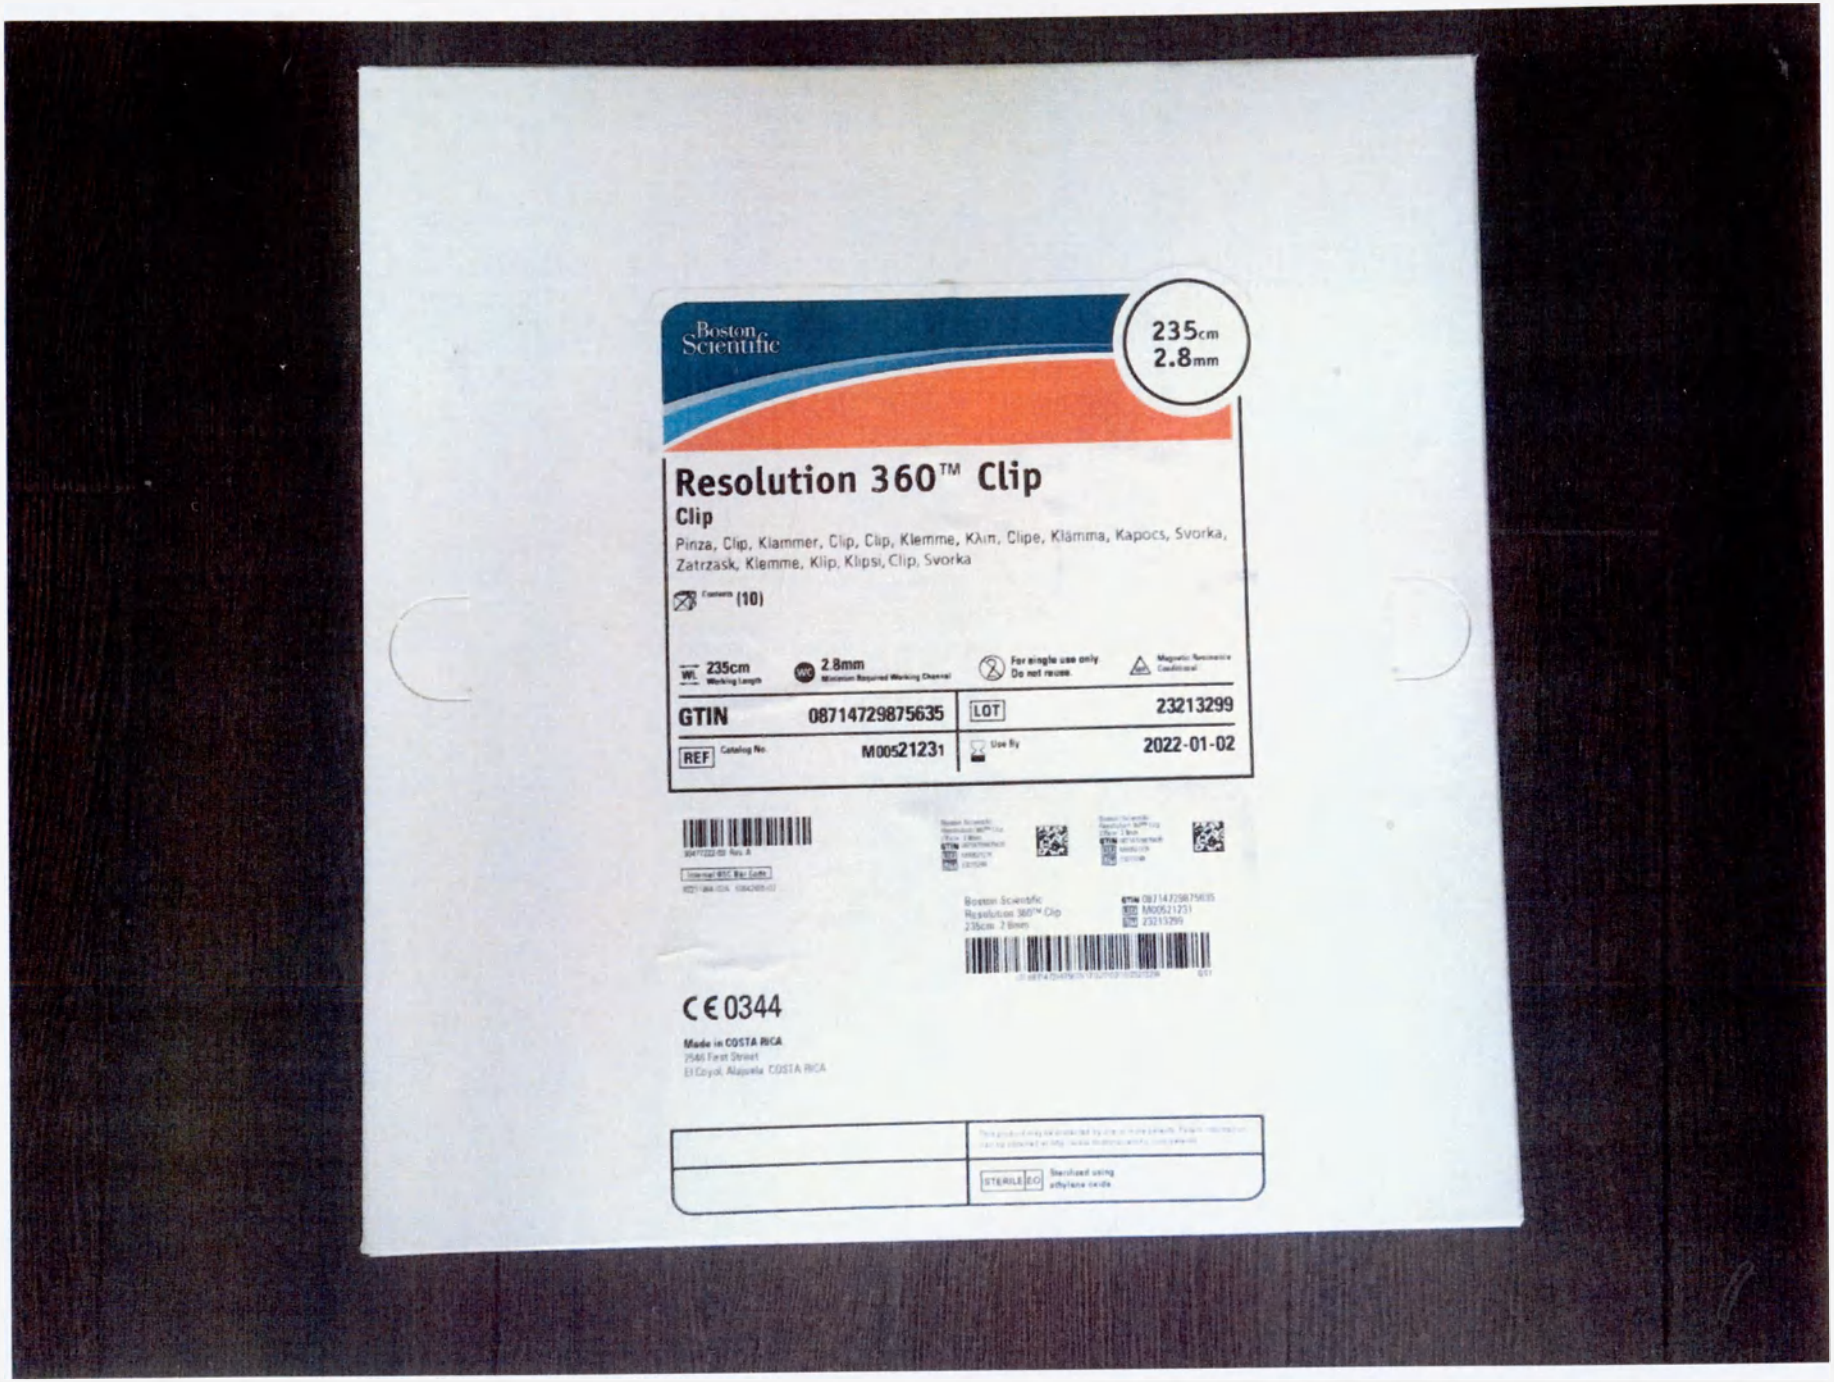

Коробка зажима Resolution 360 рабочая длина 235 см,
имальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 10 шт/уп. (сторона 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

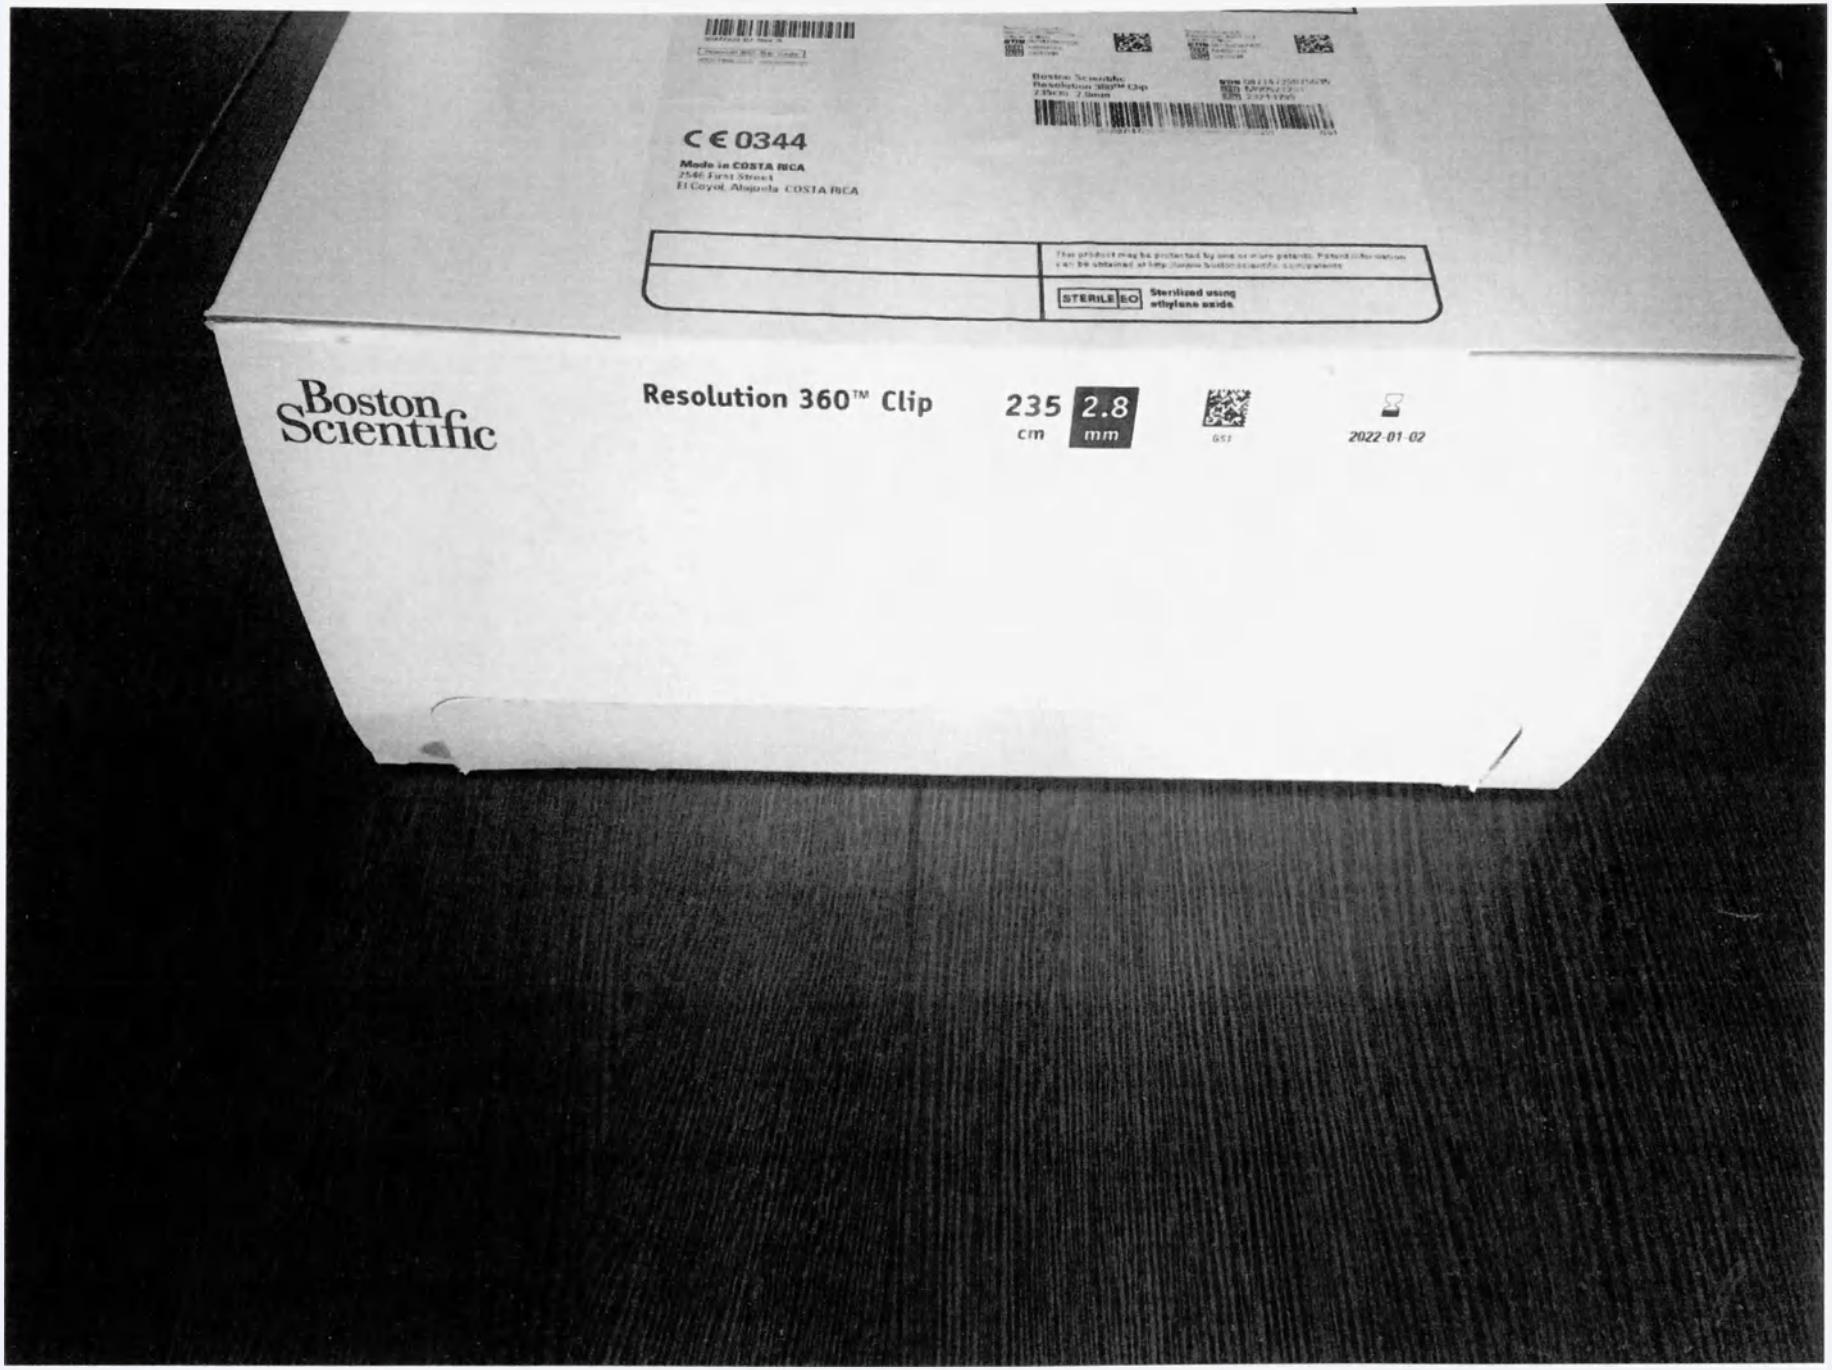

Коробка зажима Resolution 360 рабочая длина 235 см,
минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 10 шт/уп.(сторона 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

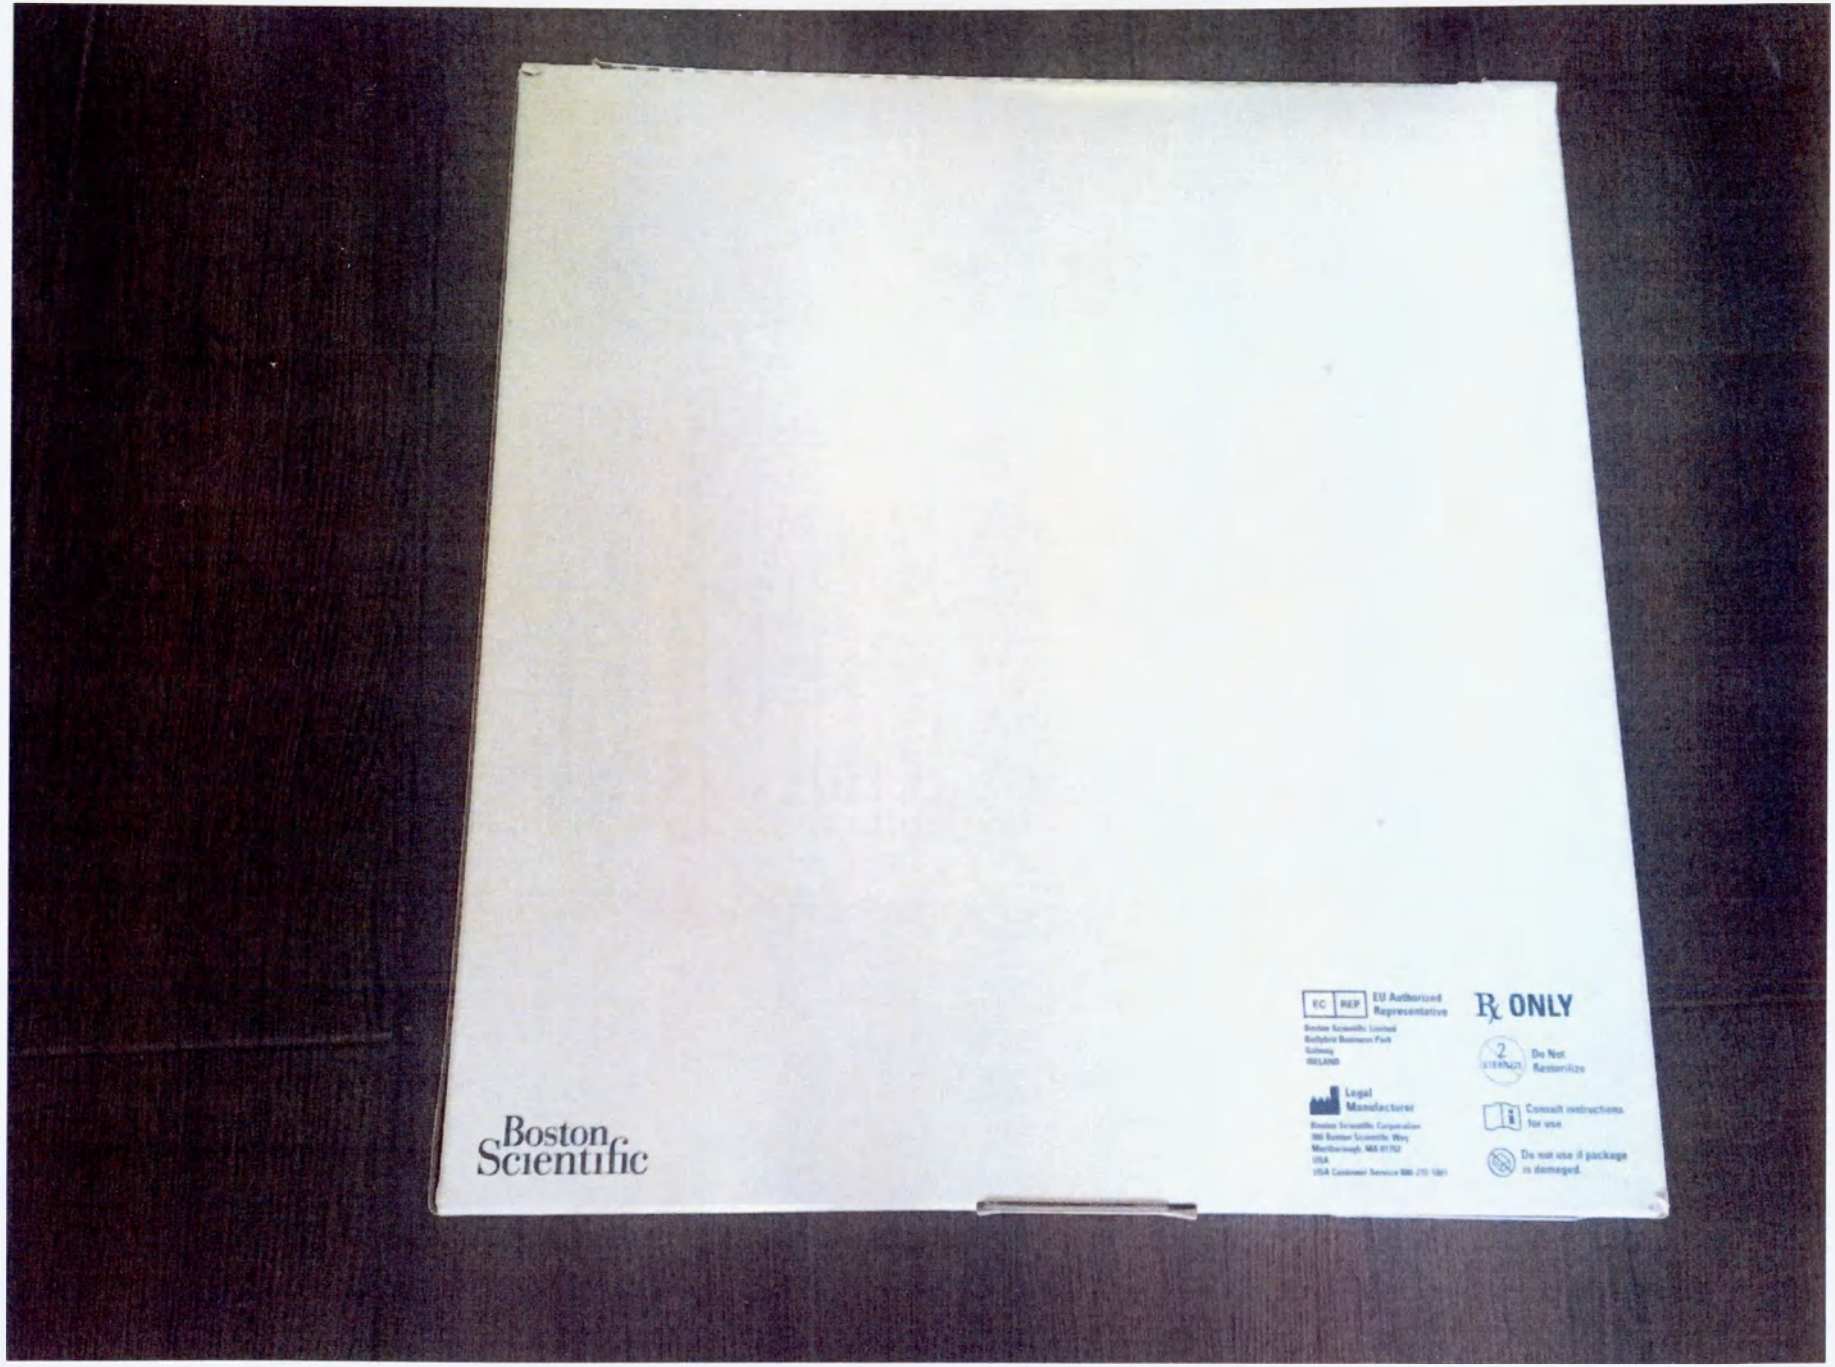

Коробка зажима Resolution 360 рабочая длина 235 см,
минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2,8 мм, - 10 шт/уп.(сторона 3)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инструкция по применению

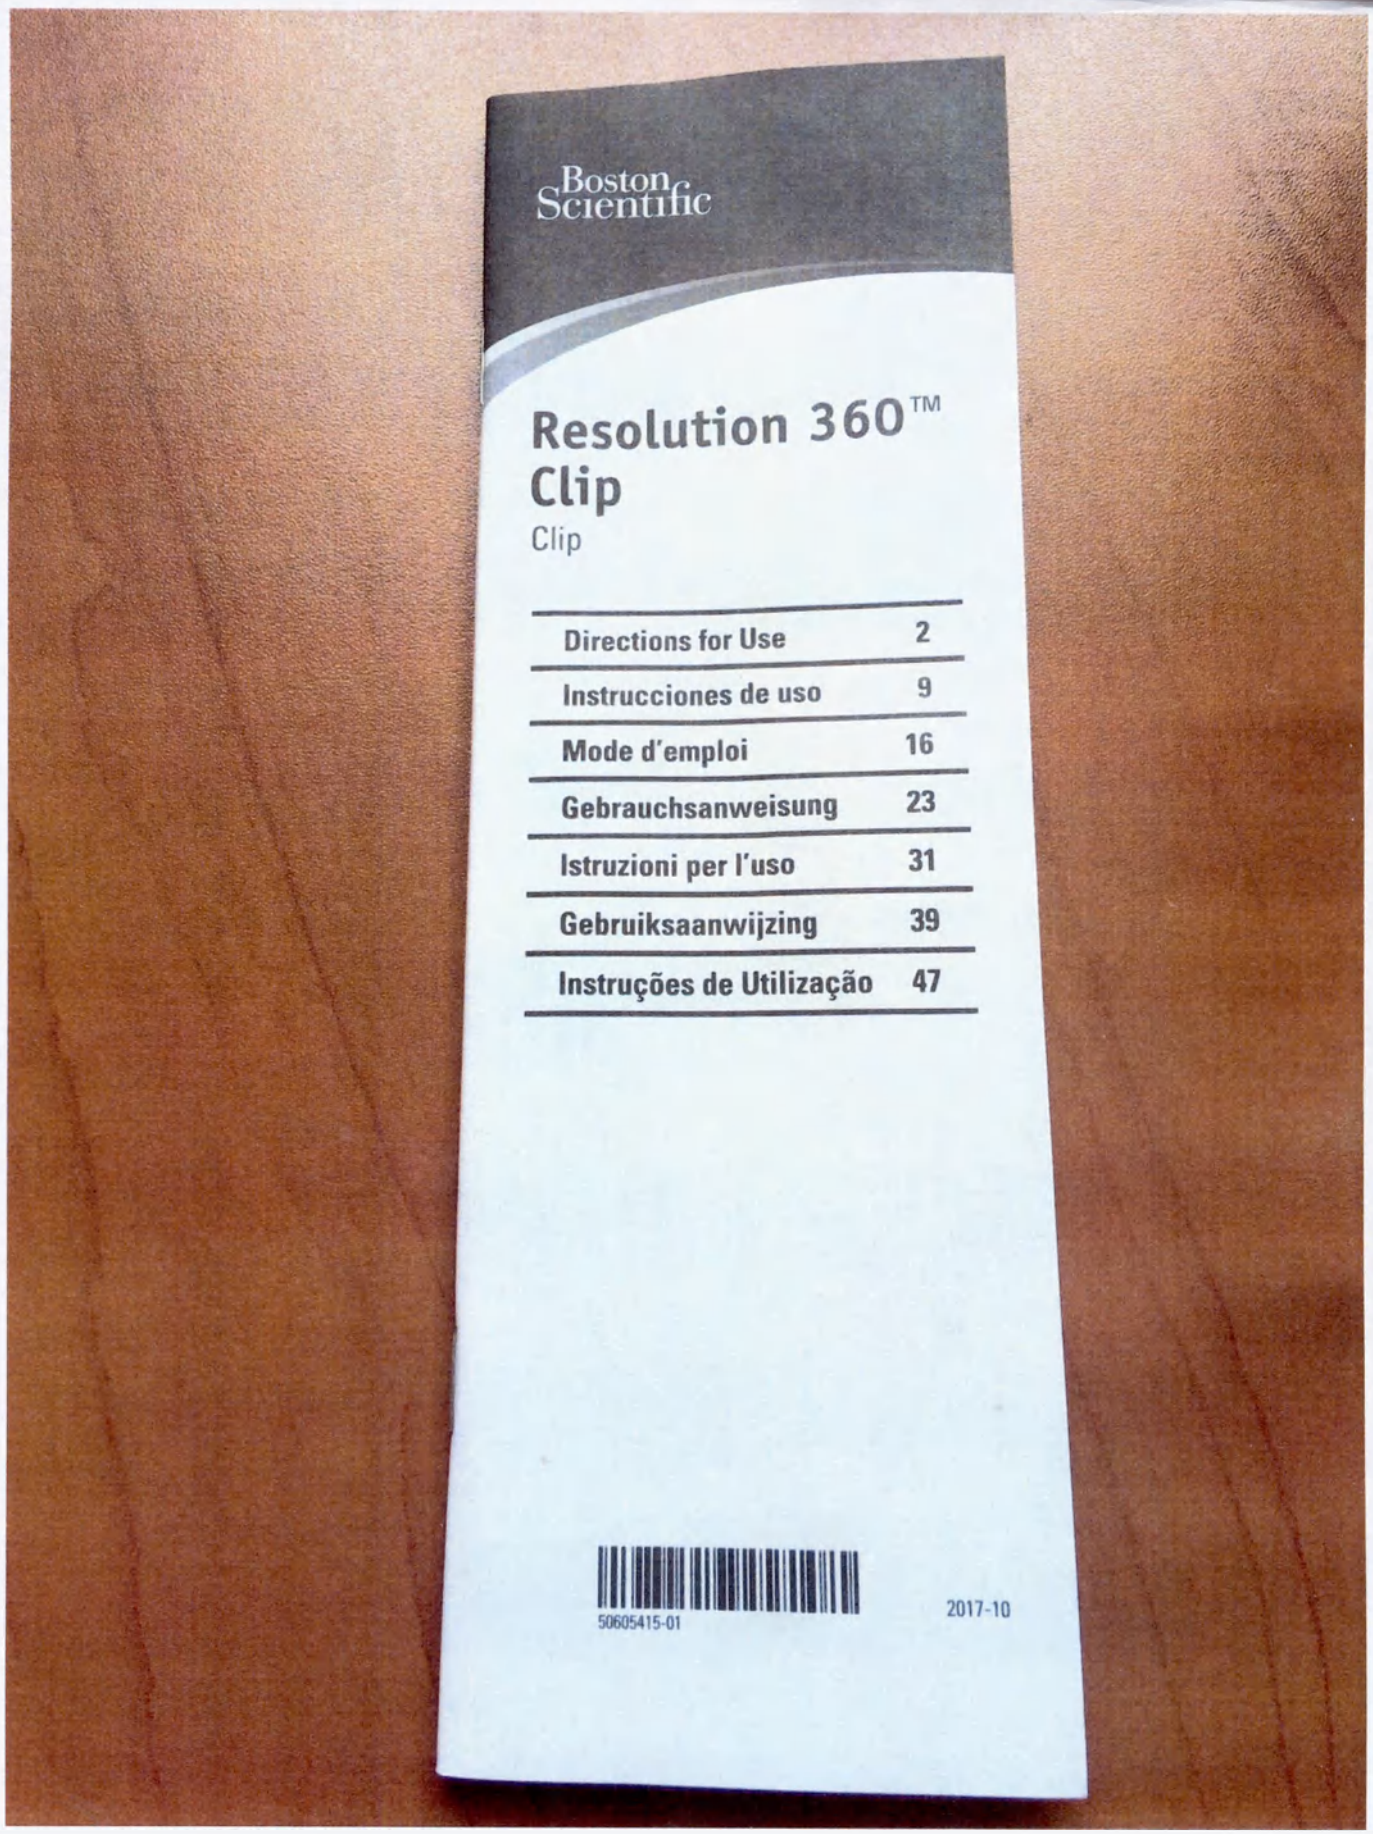

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
17 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО «РК»
ИНН 7725685587 КПП 772501001
119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15,
этаж 4, помещение IV, комната 12
Тел./факс: (495) 633-70-63

Исх. № б/н от 07.10.2019 г.

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Проект маркировки на русском языке
«Зажим Resolution 360», производства «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США

Проект маркировки на русском языке (порядок слов и расположение символов могут быть изменены):

Зажим Resolution 360,
рабочая длина 155 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2.8 мм

Регистрационное удостоверение № **от**

Производитель: Бостон Сайентифик Корпорейшн, 300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752, США
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «РК», 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 4, помещение IV, комната 12, +7(495) 633-70-63
Апирогенно, Нетоксично

Зажим Resolution 360,
рабочая длина 235 см, минимальный рекомендуемый рабочий диаметр 2.8 мм

Регистрационное удостоверение № **от**

Производитель: Бостон Сайентифик Корпорейшн, 300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752, США
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «РК», 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 4, помещение IV, комната 12, +7(495) 633-70-63
Апирогенно, Нетоксично

Генеральный директор
ООО «Регистрационная компания» Шевчук Е.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU