

ООО «Медсистем»
197350 г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр. д.41, корп. 1, кв.(офис) 637
ИНН 7814697552, КПП 781401001
ОГРН 1177847236490
Тел.8-(812) 970-06-09, 449-70-16, 449-70-17, 449-70-18
Эл.почта: medio-system@yandex.ru

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия: **Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) (2 линии) (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах) (для «in vitro» диагностики)**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медсистем»




_____ Курбатов А.В.

Wondfo®
Leading POCT Manufacturer

Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) (2 линии) (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках) (для «in vitro» диагностики)

Состав 1: Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) (2 линии) (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках) (для «in vitro» диагностики)

1. 50 индивидуальных пакетов, каждый из которых содержит:

Тест-полоску.

Мешочек с осушителем.

2. Буферный раствор (5 мл) (2 шт.).

Комплект поставки:

набор реагентов (Состав 1);

инструкция по применению.

Голландия для диагностики in vitro

Регистрационное удостоверение: №

Номер серии, срок годности, условия хранения, содержание и графические символы указаны на оригинальной упаковке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd

No.8 Lishishan Road, Science City, Laogang District, Guangzhou, P.R.China

тел: +86-20-32296082, sales@wondfo.com.cn

УПОМОЩЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Медистема» (ООО «Медистема»)

197350 г. Санкт-Петербург, Шуваевский пр. д.41, корп. 1, кв. (офис) 637

Тел: +7 (901) 316-54-61; +7(812) 449-70-17 (16, 18), E-mail: medfo-system@yandex.ru

Для профессионального применения

Содержит материалы животного происхождения

Не содержит опасных веществ



IVD



We Are Working For You Health

Wondfo®

Инструкция по применению

Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) (2 линии) (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках) (для «in vitro» диагностики)

Состав 1

Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) (2 линии) (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках) (для «in vitro» диагностики)

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Иммунохроматографический метод является качественным методом диагностики. Для подтверждения результатов тестирования необходимо использовать дополнительные методы исследования.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.


ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.


ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.




ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

ВНИМАНИЕ! Этот набор предназначен для домашнего использования. Не использовать для профессионального применения.

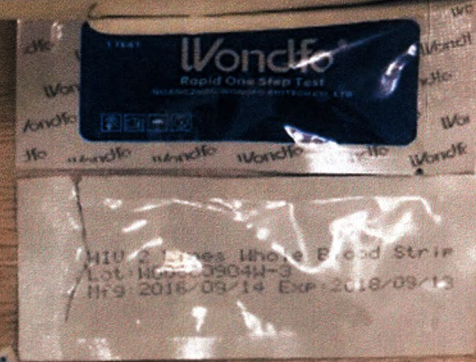

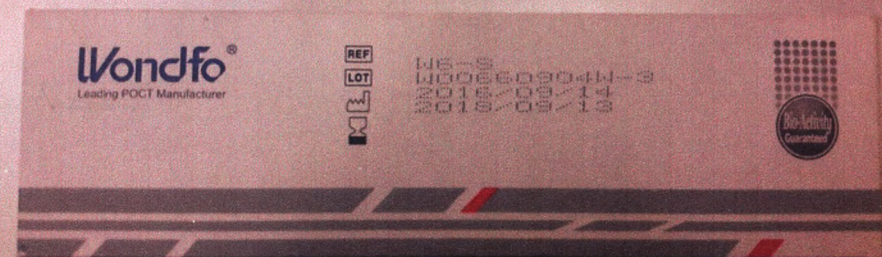

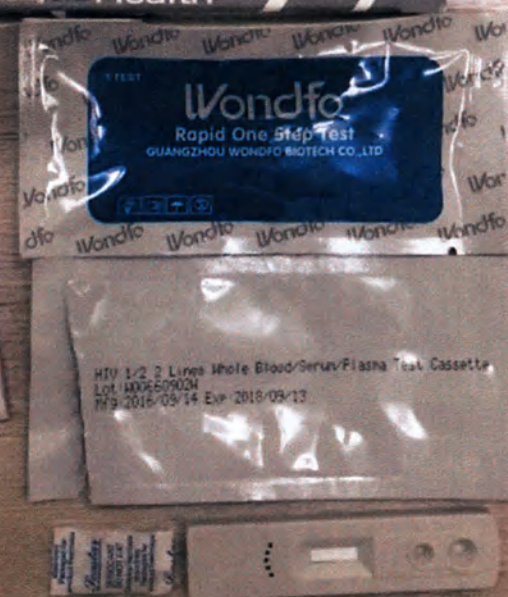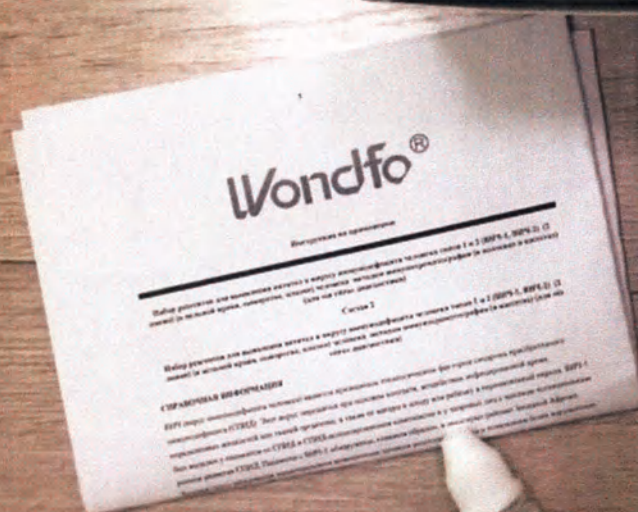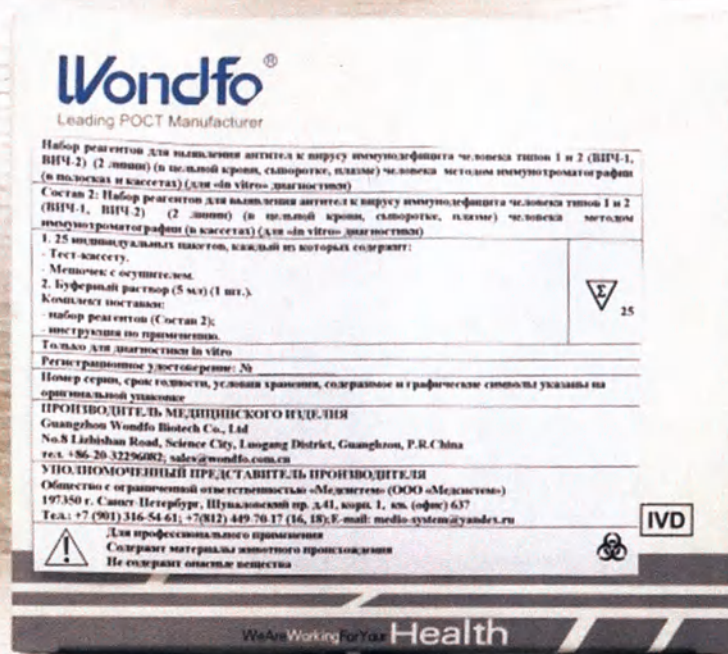


Wondfo®
Leading POCT Manufacturer


FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY
FOR PROFESSIONAL USE ONLY



Wondfo®
Leading POCT Manufacturer



REF
LOT
W6-C
W00660902W
2016/09/14
2018/09/13



Wondfo®
Leading POCT Manufacturer



Wondfo®
Leading POCT Manufacturer



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.
Генеральный директор
ООО «Медсистем»
А.В. Курбатов

