



Фотографические изображения медицинского изделия

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма "АРМИС" по ТУ 9442-002-76949675-2009 в составе

1. Центральный блок

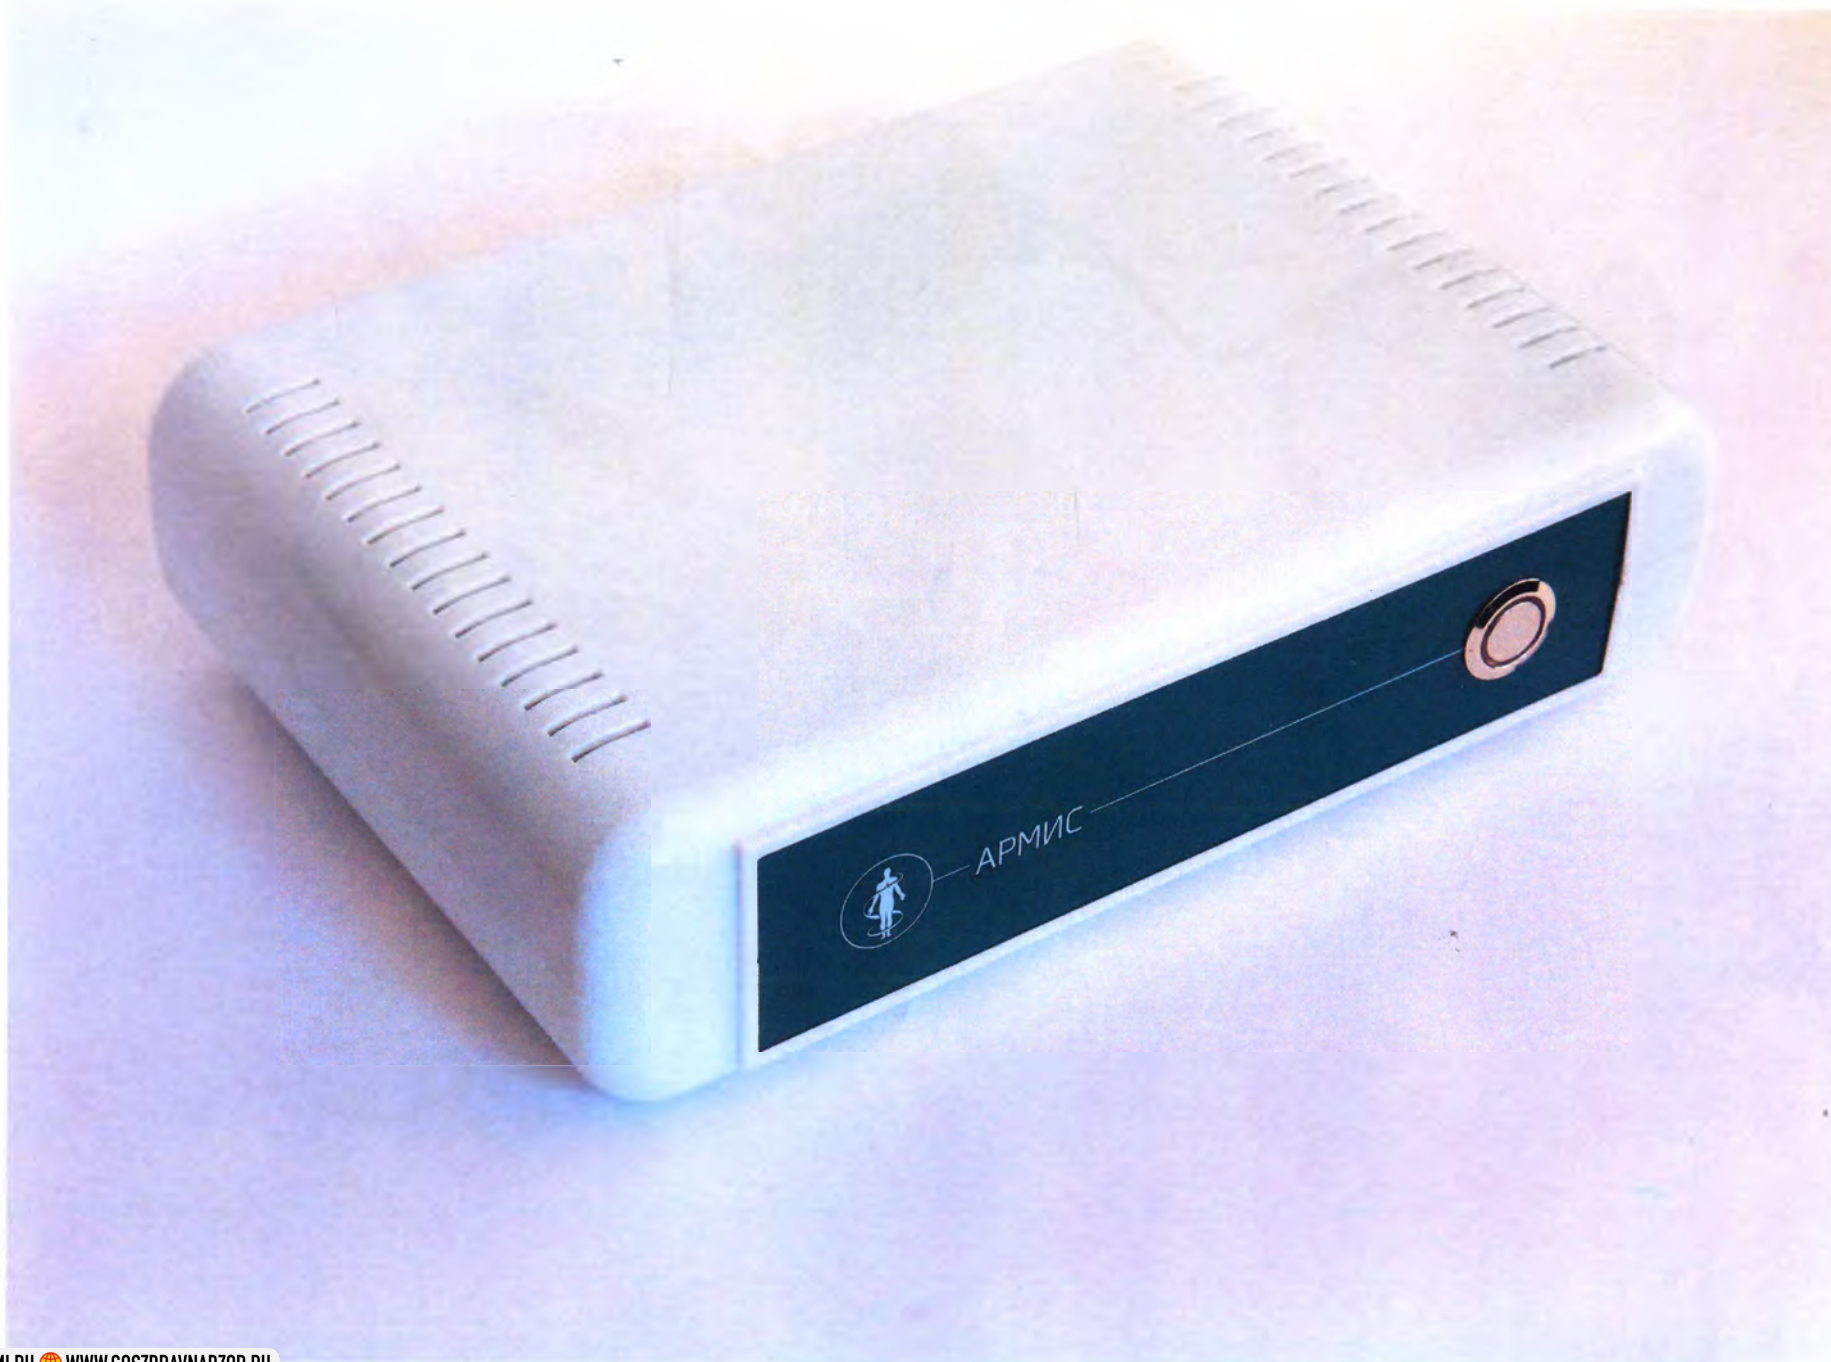


2. Пульт оператора с головными телефонами (при необходимости).

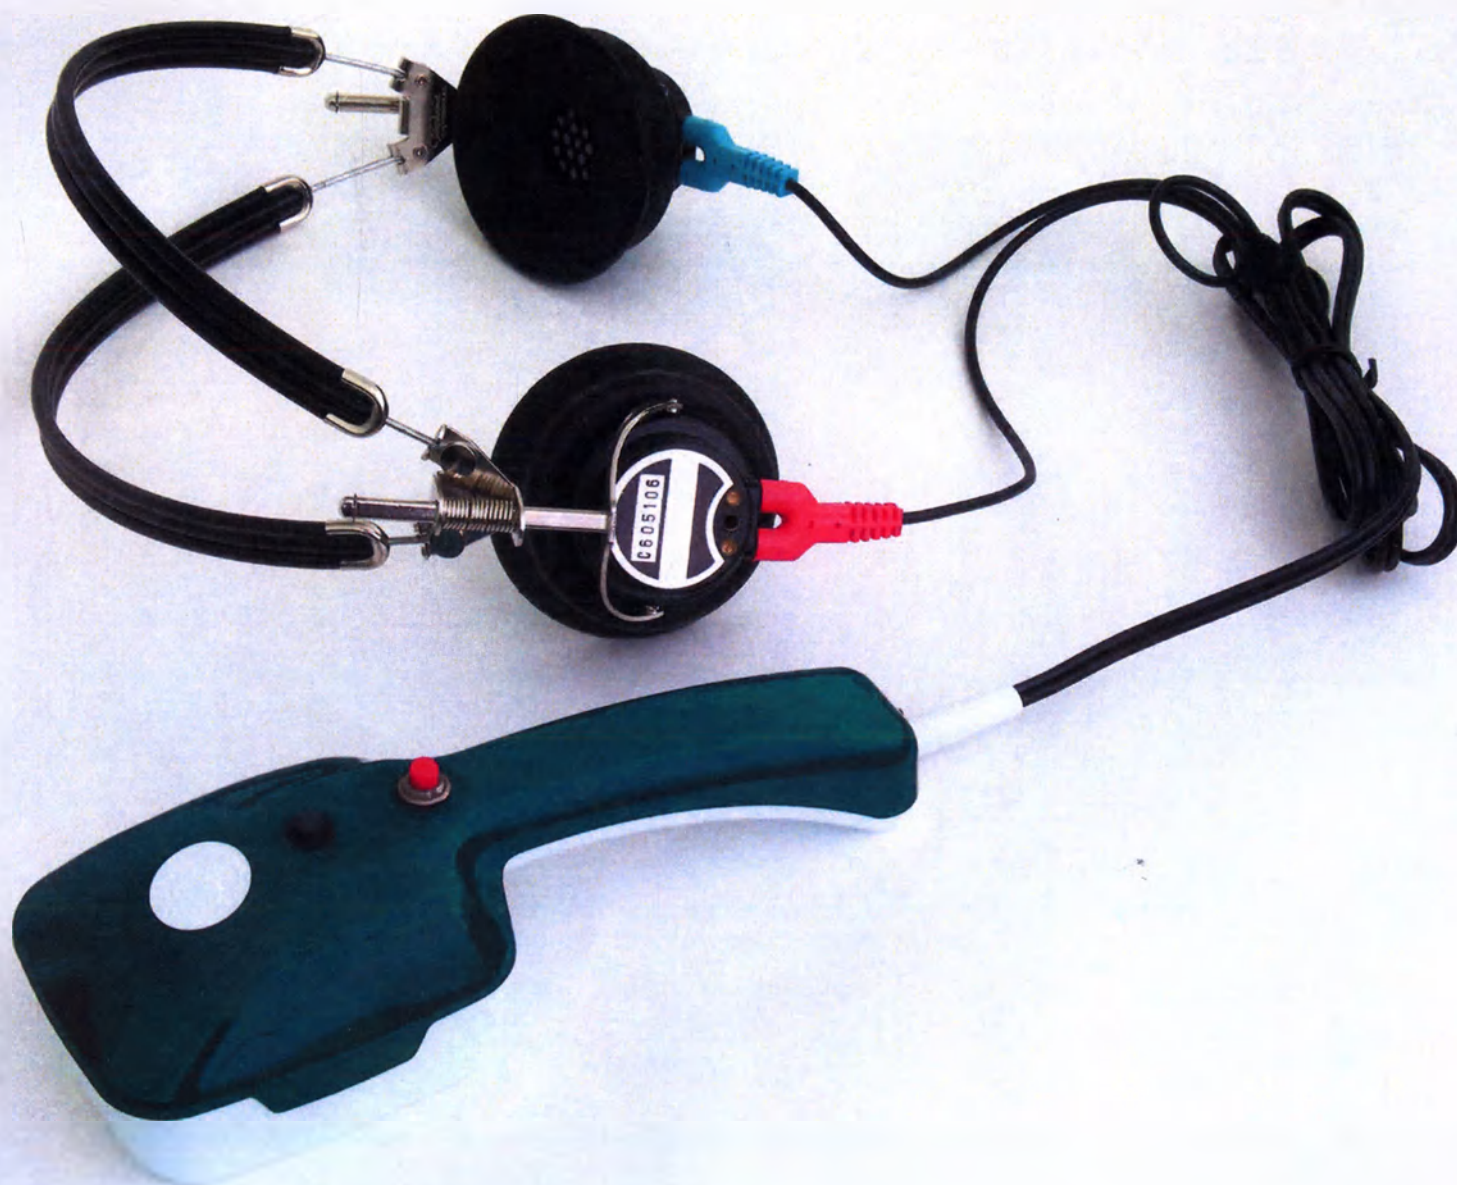

3. Модуль электрокардиографии (при необходимости).



4. Модуль кистевого динамометра (при необходимости).

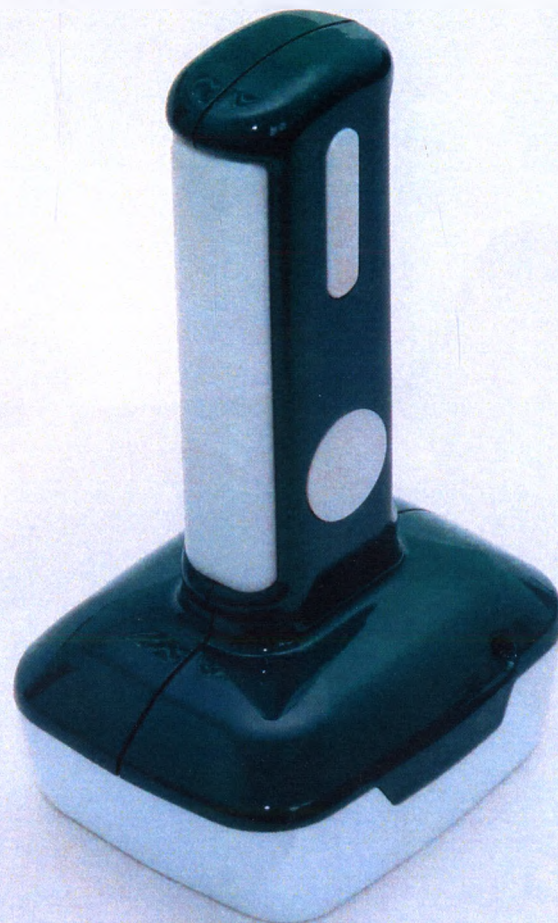

5. Модуль спирометрического датчика дыхания (при необходимости).



6. Модуль периметрического датчика дыхания (при необходимости).




7. Модуль измерения артериального давления крови (при необходимости).



8. Модуль плантографии (при необходимости).



9. Модуль оптической топографии для контроля осанки (при необходимости).

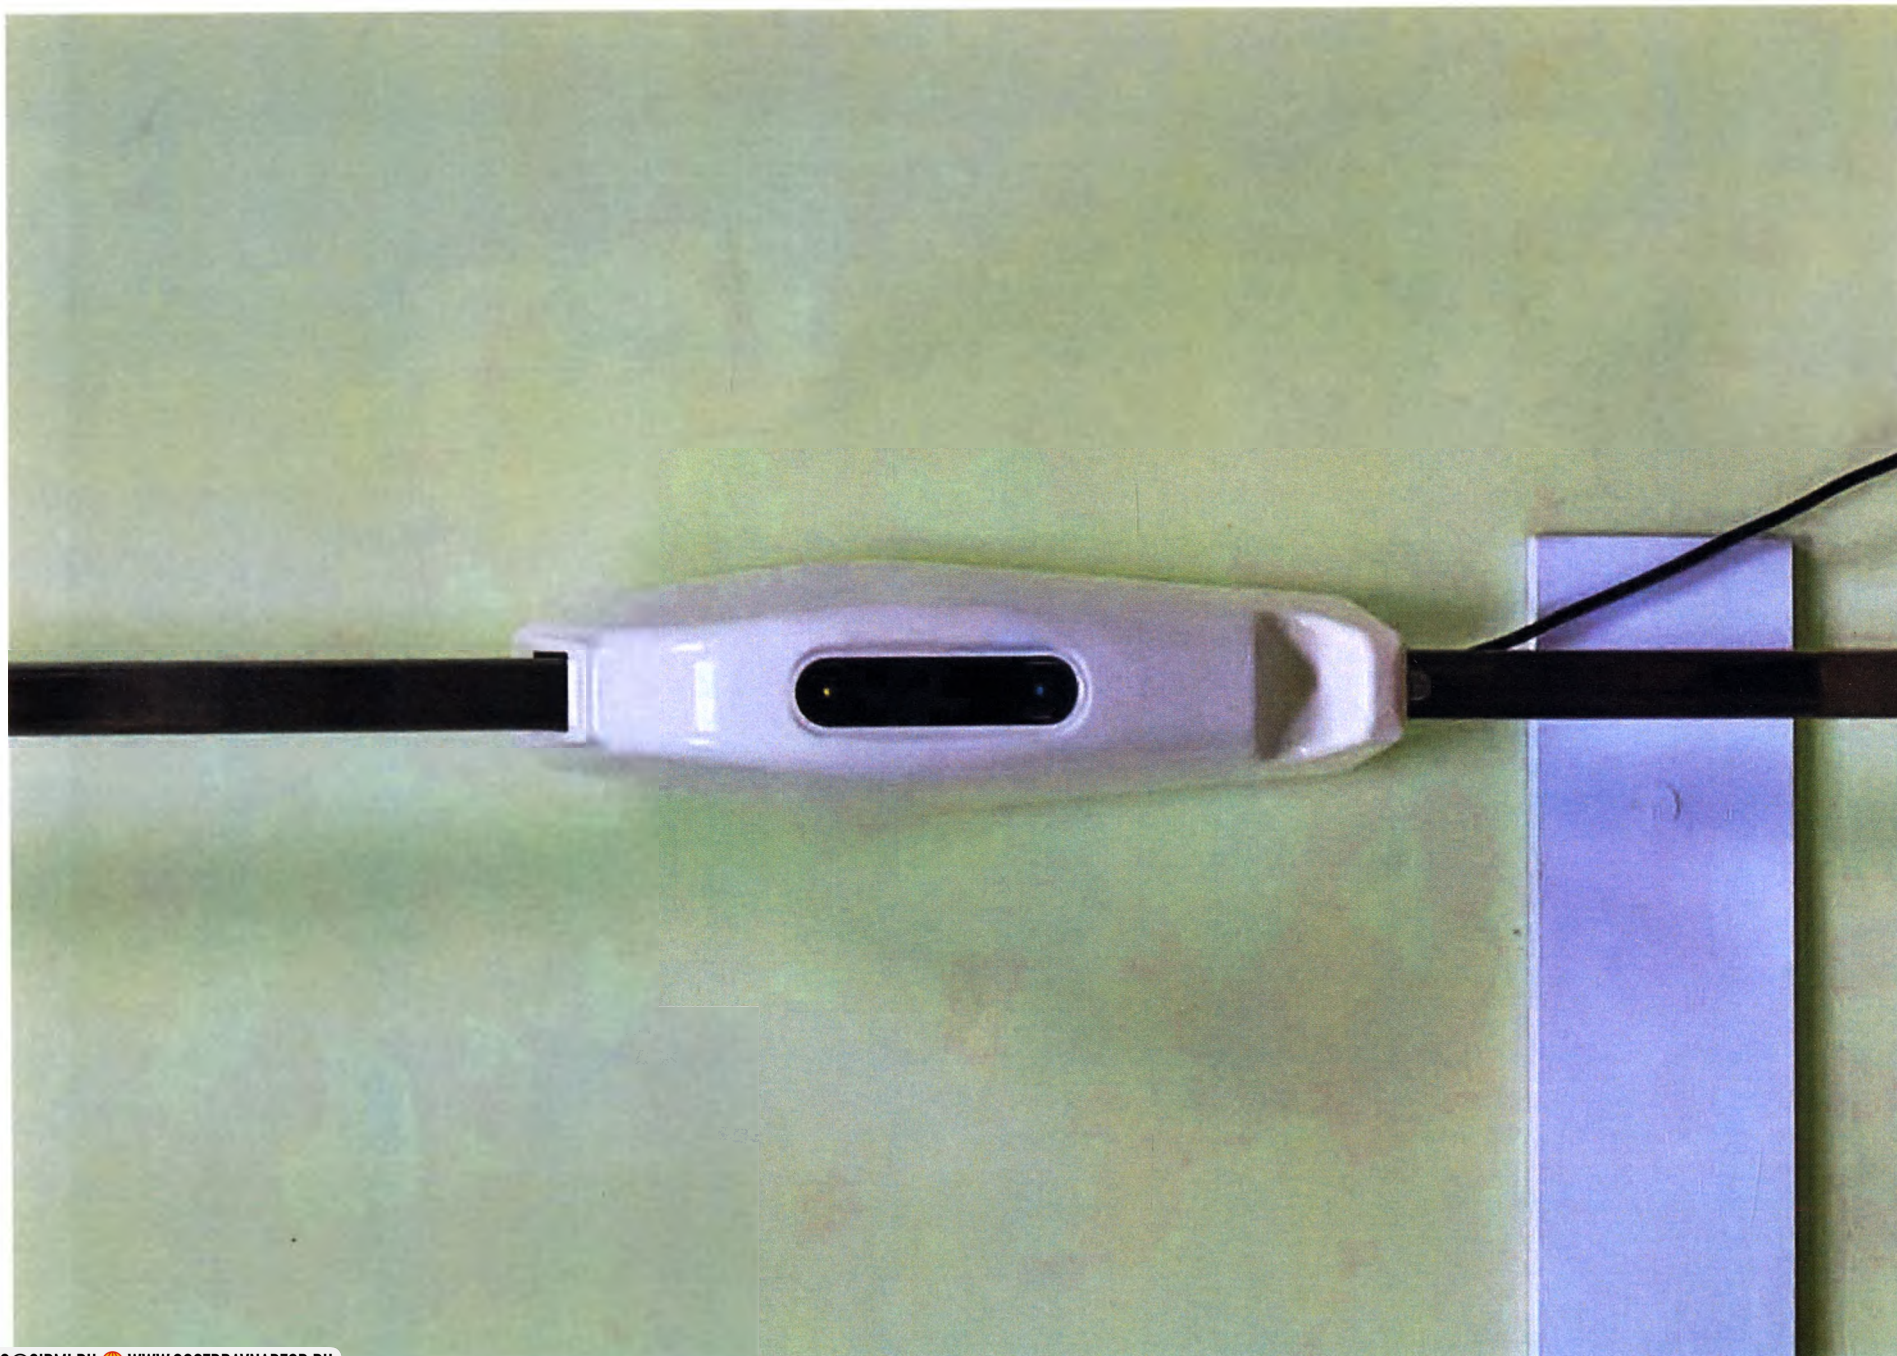


10. Программное обеспечение



11. Персональный компьютер



12. Принтер

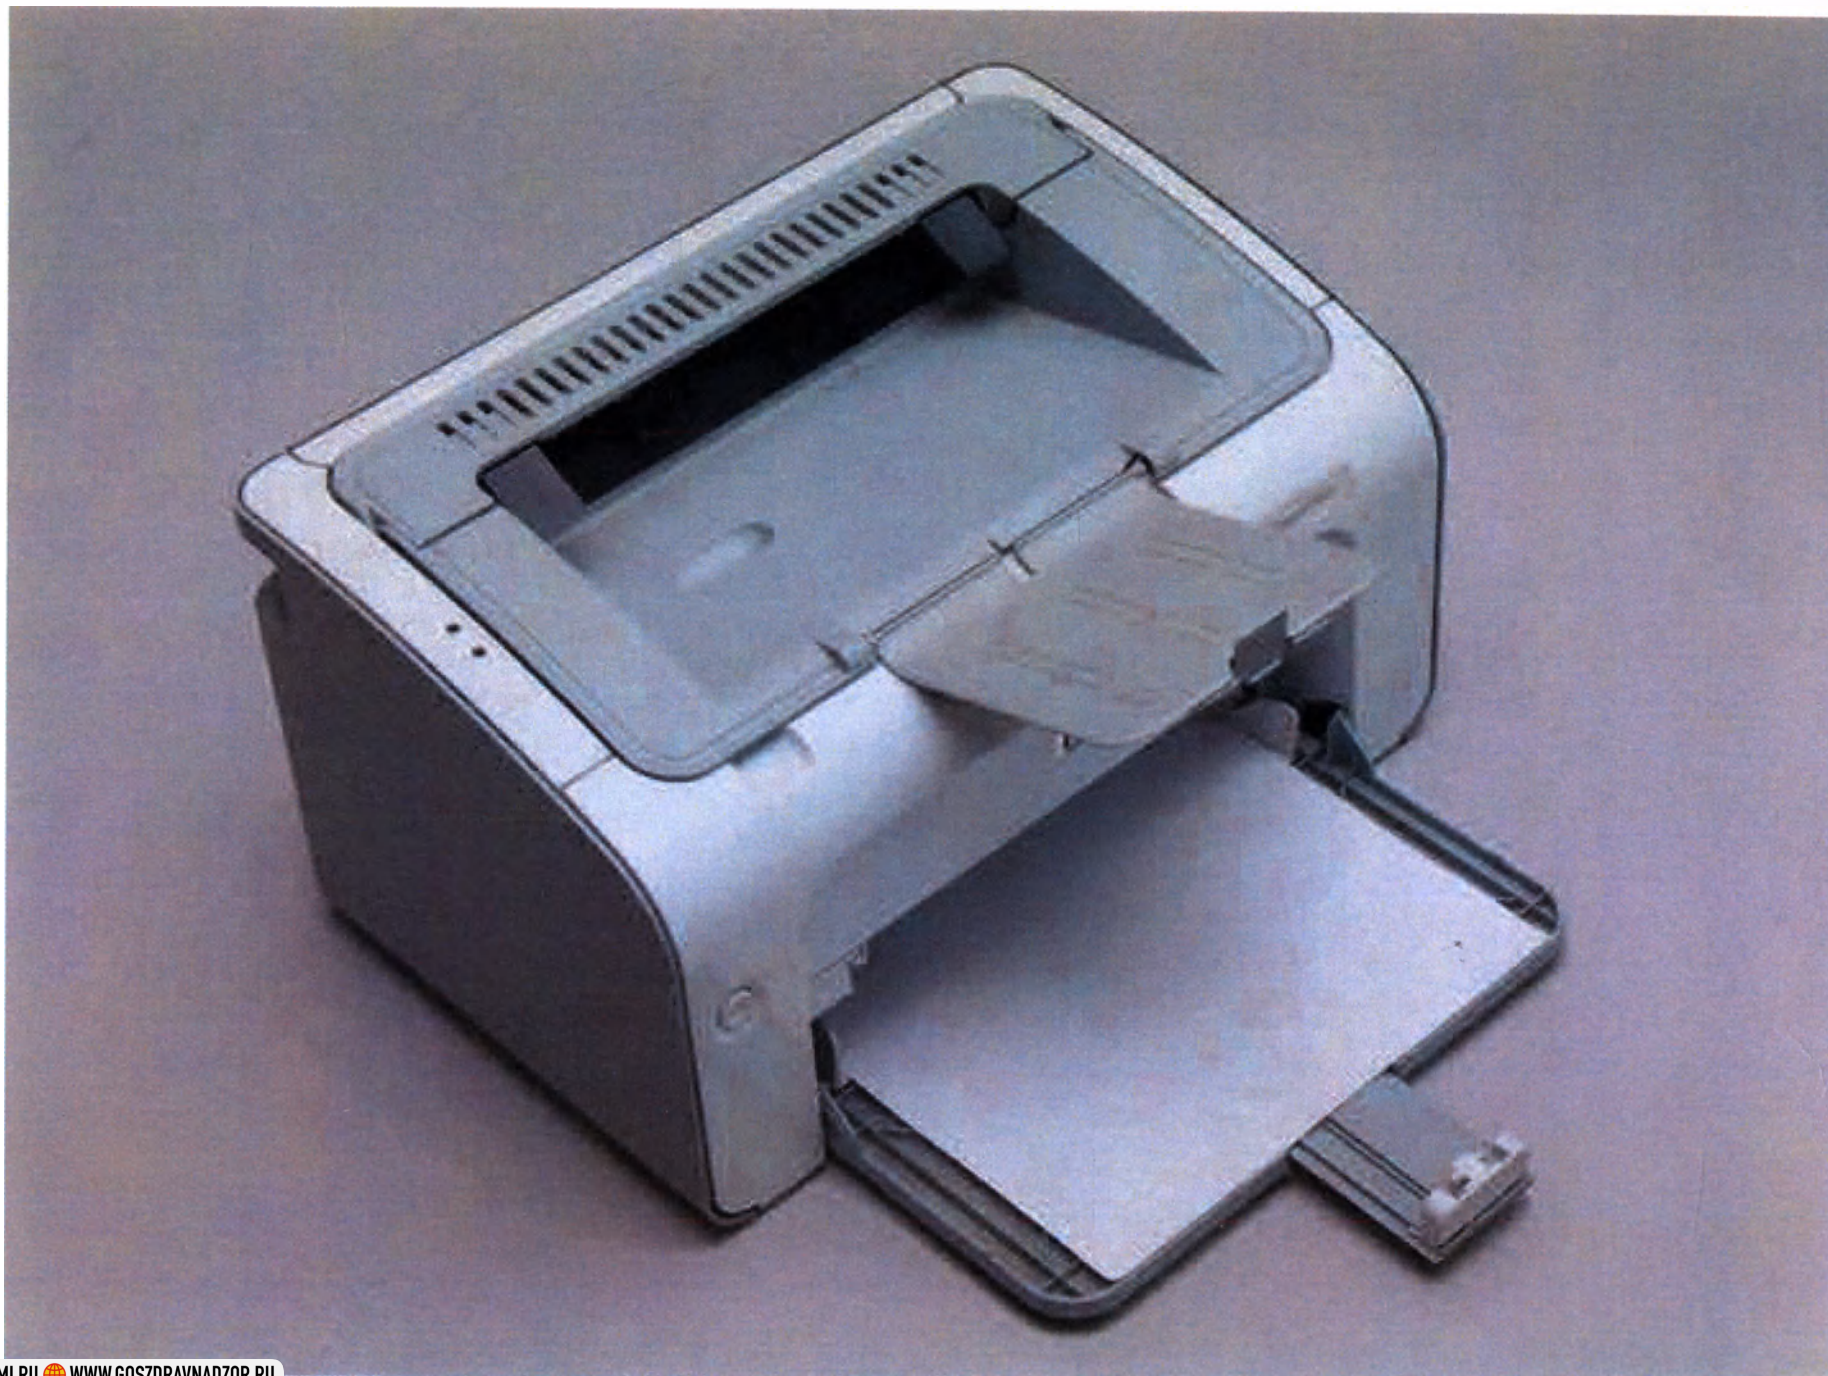

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки
уровня психофизиологического и соматического
здоровья, функциональных и адаптивных резервов
организма «АРМИС»

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ


МГРТ.941118.002 РЭ

2016




Имя, № докум.	Подп. и дата	Имя, № докум.	Подп. и дата

Макет маркировки

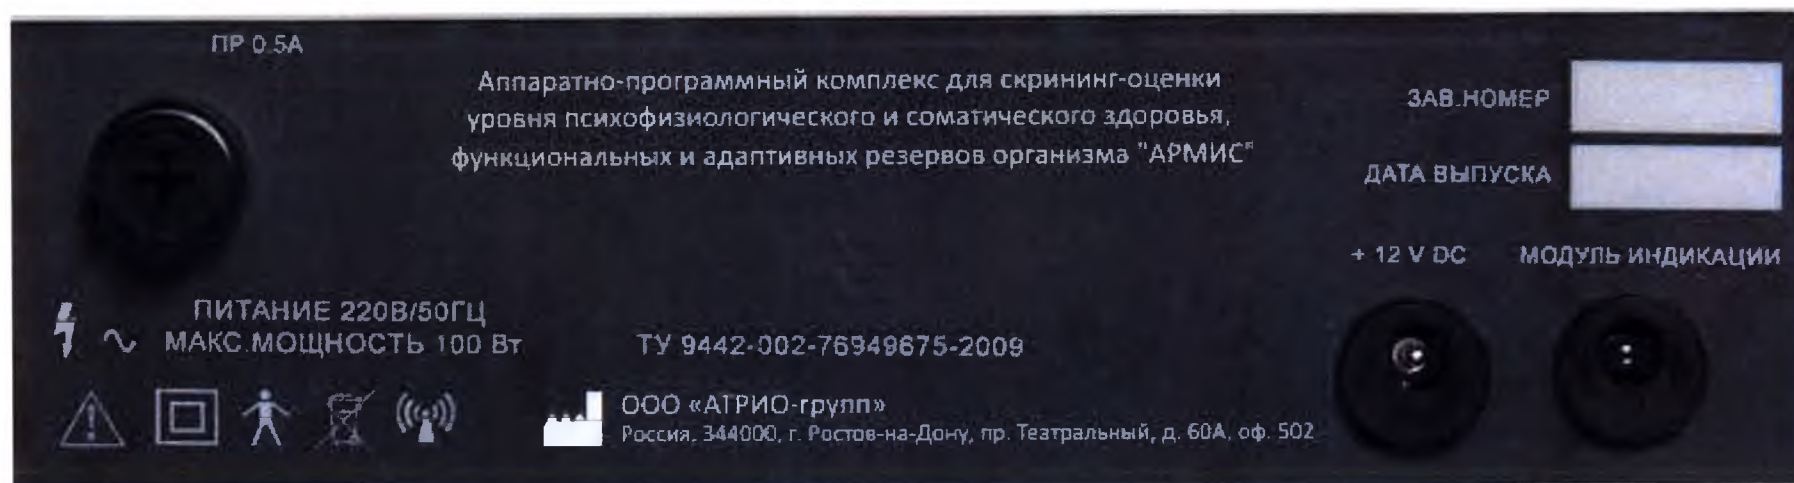

Образец упаковки

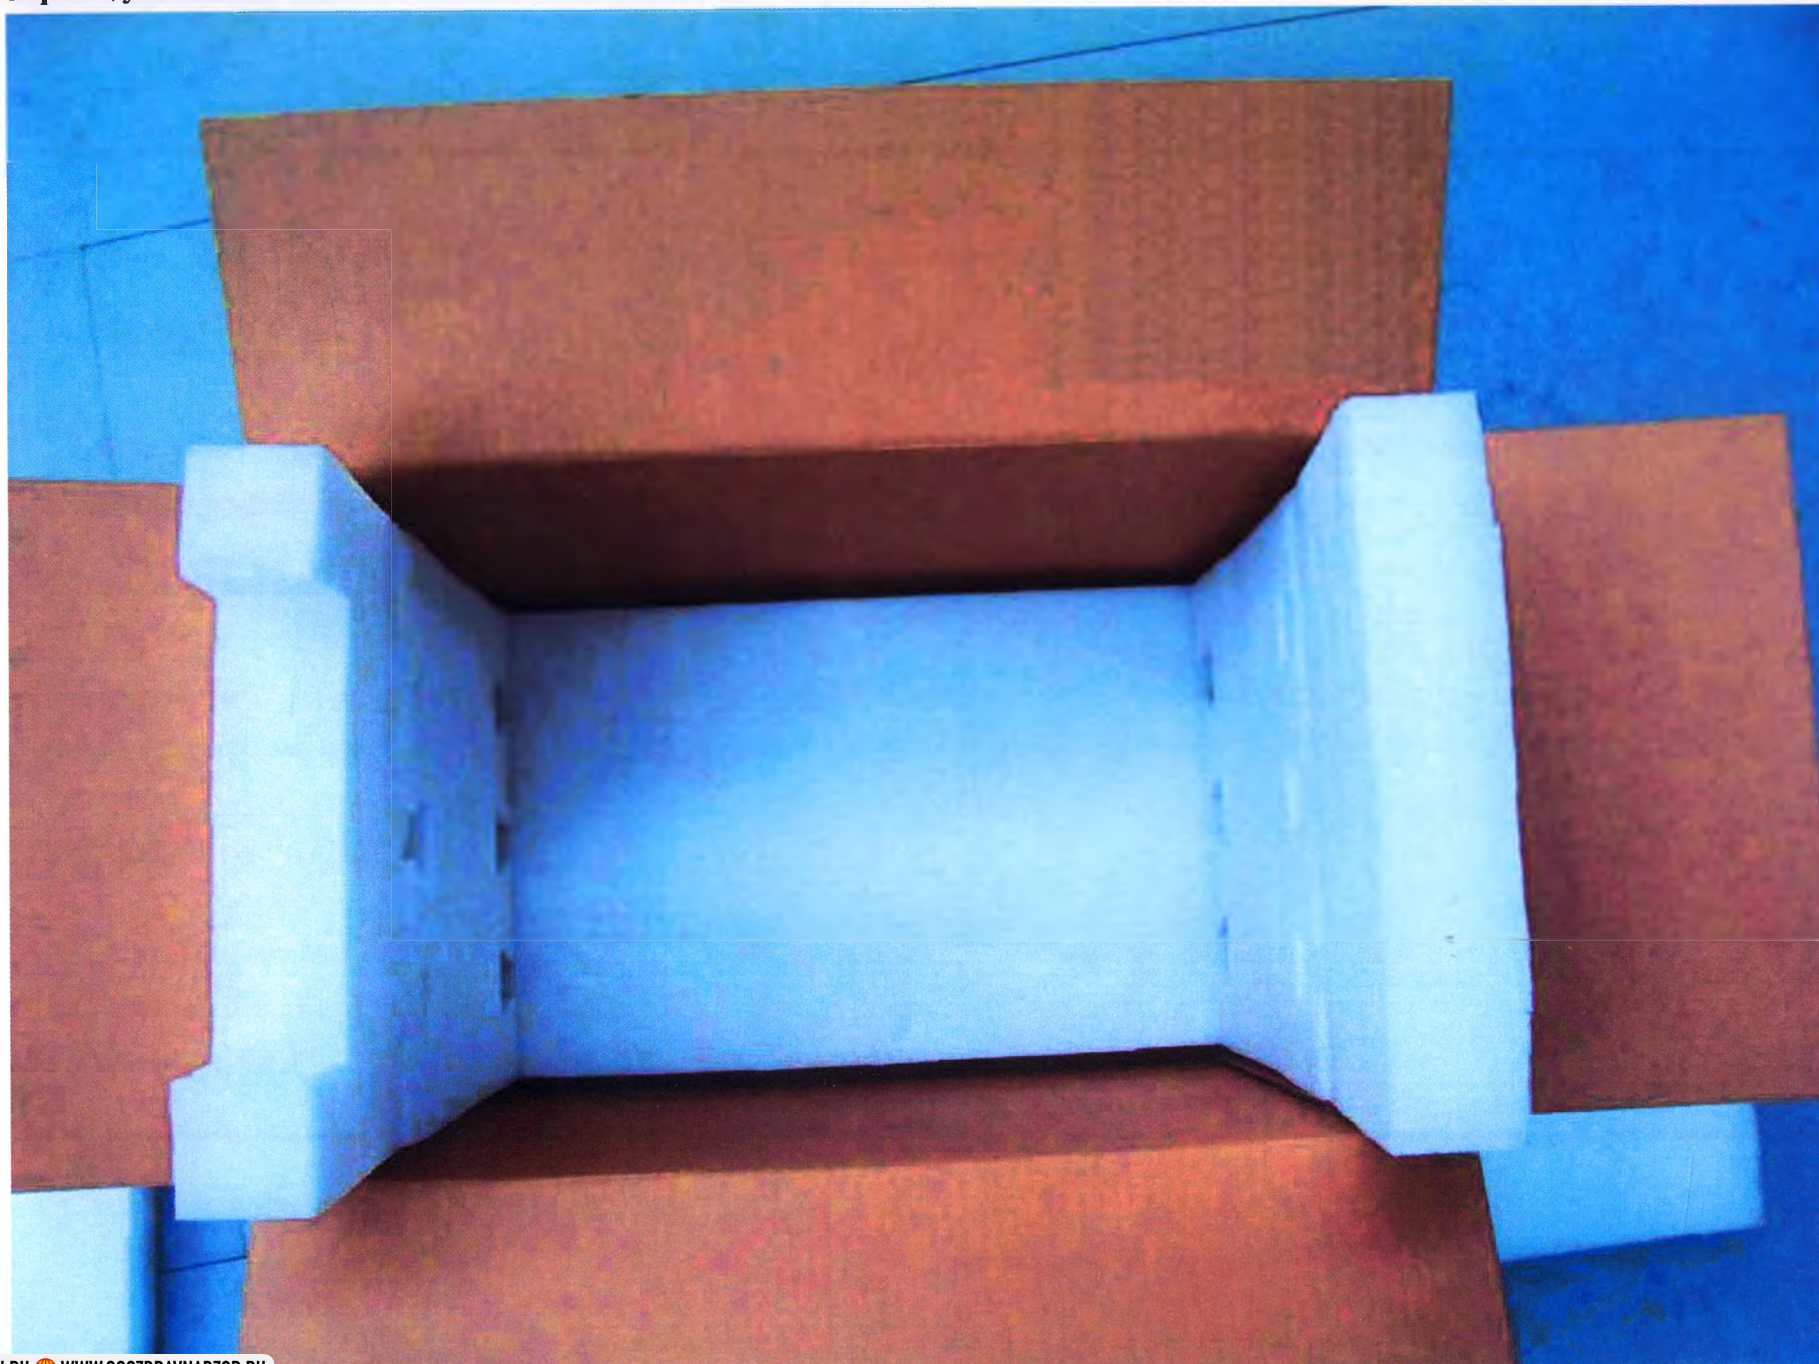



Атрио
групп

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма "АРМИС"

ТУ 9442-002-76949675-2009

Назначение: оценки уровня здоровья при проведении скрининга и мониторинга, профотборе, определения текущего функционального состояния и индивидуальных особенностей человека.

Упаковано: XX.XXXX

Производитель:

ООО «АТРИО-групп»


Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, д. 60А, оф. 502

Прошито и пронумеровано " 17 " листов

Семь над четью

(количество прописью)

Директор ООО "АТРИО-групп"

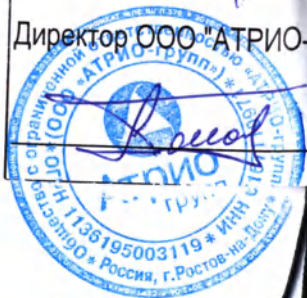

/Попов С.Н./